HOSPITAL
NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN
¡Trabajamos con el CORAZÓN!

Carmen de Apicalá, septiembre 09 de 2021

Señor
EDUIN AUGUSTO RIVERA LOAIZA

Profesional Universitario
Secretaria de salud del Tolima
Supervisor convenio 0993 de 2021

Asunto: Informe de ejecución técnica convenio interadministrativo 0993 de 2021.

Reciba un cordial saludo de la manera más atenta me permito dirigir a usted el informe técnico de la ejecución realizada por el Hospital Nuestra Señora del Carmen ESE, identificado con Nit. 890.702.241 con respecto al convenio interadministrativo 0993 de 2021:

ACTIVIDADES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES**	**PRODUCTOS**
Velar por el cumplimiento del objeto contractual.	El Hospital Nuestra Señora del Carmen ESE, identificada con Nit. 890.702.241-0 suscribió contrato a través de la empresa ARCRON, mediante contrato No. 056 de 2021una ambulancia tipo TAB (Transporte Asistencial Básico), establecidos en la normatividad vigente.	Contrato No. 056 de 2021 (el cual se anexa) y hace parte de este informe.
Invertir adecuadamente los recursos aportados por la Gobernación del Tolima, en desarrollo del presente convenio de manera exclusiva para la adquisición de la ambulancia tipo TAB.	Se realiza apertura cuenta de ahorros Bancolombia numero 413-21411663 donde se recibieron por parte de la Gobernación del Tolima los recursos el día 9 de julio de 2021 por valor de $84.500.000, los cuales fueron girados al contratista ARCRON mediante Giro de Gastos No. 2021000261 Por valor de $84.500. 000.oo el día 13 de julio de 2021.	Copia transferencia

Recibí
Eduin Rivera.
13-09-2021.

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN E.S.E
Calle 2a. No. 5-07 Barrio Lucitania
Contacto: (038) 247 8175 / hospitalcarmenapicala@gmail.com
Nit 890702241-0
Carmen de Apicalá, Tolima

Aportar la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000) MCTE, de acuerdo al certificado de disponibilidad presupuestal presentado por el Hospital Nuestra Señora del Carmen del municipio de Carmen de Apicalá - Tolima.	La alcaldía Municipio de Carmen de Apicalá, realiza transferencia electrónica a la cuenta de ahorros 413-200530-62 el día 16 de julio de 2021 por valor de $30.000.000. en virtud contrato interadministrativo 112 de 2021 el Hospital Nuestra Señora del Carmen cuenta con el recurso en la cuenta bancaria.	Se adjuntan CDP números CD1-202100292 y CD2-2021000035.
Adquirir la ambulancia según los lineamientos estipulados en las características técnicas descritas A continuación, en cumplimiento de la Resolución 2003 de 2014 y Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y la Protección Social, como en la NTC 3729.	Se adquirió una ambulancia de acuerdo lineamientos estipulados en las características técnicas descritas A continuación, en cumplimiento de la Resolución 2003 de 2014 y Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y la Protección Social, como en la NTC 3729.	Se adjuntan tarjeta de propiedad del vehículo, hojas de vida de los equipos, certificados de calibración, garantía de los equipos, declaración de importación, factura de compra, entrada de almacén, orden suministro e instalación GPS.
Cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y parafiscales	Se cumple con la obligación.	Se adjunta certificación de pago de parafiscales firmado por la gerente y el contador de la ESE.
Cumplir el objeto del convenio, mediante la certificación de la sostenibilidad y operatividad técnica y financiera de la ambulancia tipo TAB por parte de la Gerencia del Hospital Nuestra Señora del Carmen E.S.E del municipio de Carmen de Apicalá - Tolima		Se adjunta certificación de la Gerente de la ESE.

HOSPITAL
NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN
¡Trabajamos con el CORAZÓN!

Constituir las pólizas requeridas para el presente acto contractual	El Hospital Nuestra Señora del Carmen ESE constituyo una póliza con el fin de dar cumplimiento a las garantías exigidas por el contratante.	Se adjunta póliza numero 480 47 994000041475 Aseguradora solidaria de Colombia

CAROLINA MURILLO GUARNIZO
GERENTE

HOSPITAL
NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN
¡Trabajamos con el CORAZÓN!

CUENTA DE COBRO
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN ESE
NIT. 890.702.241-0

LA GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT. 800.113.672-7

DEBE A:

Hospital Nuestra Señora del Carmen ESE, del Municipio del Carmen de Apicalá, Tolima identificado con NIT°. 890.702.241-0, la suma de Ochenta y cuatro Millones Quinientos Mil Pesos ($84.500.000) Mcte., por concepto del segundo desembolso correspondiente al saldo del 50% del valor del aporte del convenio interadministrativo No. 0993 de abril 15 de 2021, cuyo objeto es aunar esfuerzos entre la Gobernación del Tolima y el Hospital Nuestra Señora del Carmen ESE del Carmen de Apicalá, para la adquisición de una ambulancia tipo TAB (Transporte Asistencial Básico), que cumpla con los requisitos establecidos en la normatividad vigente, para la prestación de servicios de salud, en atención al fortalecimiento de la capacidad de respuesta del Municipio del Carmen de Apicalá – Tolima ante situaciones de urgencia en salud.

A los nueve (9) días del mes septiembre de dos mil veintiuno (2021).

Dichos recursos girarlos a la cuenta de ahorro No. 413-214116-63 de Bancolombia, se adjunta certificación bancaria.

YEIMY CAROLINA MURILLO GUARNIZO
GERENTE

CARMEN DE APICALA- TOLIMA
NIT 890702241-0
Calle 2 N° 5-07 Tel: 2478175
"Trabajamos con el Corazón"

HOSPITAL
NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN
¡Trabajamos con el CORAZÓN!

LA SUSCRITA GERENTE DEL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN E.S.E DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA -TOLIMA

CERTIFICA:

Que cuenta con el presupuesto necesario para cubrir los costos de sostenibilidad y operatividad del vehículo ambulancia de placa GRS-557 de propiedad del Hospital Nuestra Señora del Carmen ESE. Adquirida mediante convenio interadministrativo 0993 de abril 15 de 2021, suscrito entre la Gobernación del Tolima y el Hospital Nuestra Señora del Carmen ESE.

La presente certificación se expide en el municipio del Carmen de Apicalá, a los nueve (9) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

YEIMY CAROLINA MURILLO GUARNIZO
GERENTE

HOSPITAL
NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN
¡Trabajamos con el CORAZÓN!

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE CARÁCTER PRIVADO CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE CARMEN DE APICALA I NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y ARTICULOS CROMADOS ARCRON SAS

NUMERO.	056
FECHA Y LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	18 DE MAYO DE 2021
CONTRATANTE.	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.
NIT.	890702241-0.
CONTRATISTA.	ARTICULOS CROMADOS ARCRON SAS
NIT	900.093.151-7
RESPRESENTANTE LEGAL	JORGE ELIECER LOPEZ SIERRA
IDENTIFICACION	79292472
LUGAR EJECUCIÓN	CARMEN DE APICALA
FECHA DE INICIO.	13 DE MAYO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN.	13 DE JULIO DE 2021
VALOR.	DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DE PESOS ($204.000.000)
OBJETO	ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB (TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO), QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN ATENCION AL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Entre los suscritos a saber, **YEIMY CAROLINA MURILLO GUARNIZO,** mayor de edad, actuando como Gerente del **HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE CARMEN DE APICALA NIVEL I EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO,** de Nivel Uno del Orden Municipal con Personería Jurídica vigente, con patrimonio propio y autonomía administrativa y sometido al régimen jurídico previsto en el Título II -

HOSPITAL
NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN
¡Trabajamos con el CORAZÓN!

Capítulo III – Artículos 194 – 195 y 197 de la Ley 100 de 1.993, de conformidad con lo establecido en los estatutos de contratación de la Empresa Social del Estado, la Ley 80 de 1.993, Acuerdos de la Junta Directiva, Ley 100 de 1.993, Decreto Reglamentario 1876 de 1.994 y debidamente facultada como ordenadora del gasto y quien para los efectos legales del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE Y/O HOSPITAL** y por la otra, **ARTICULOS CROMADOS ARCRON SAS** identificado con Nit: **900093151-7**, representada legalmente por **JORGE ELIECER LOPEZ SIERRA,** mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía N°79292472, quien declara hallarse sin inhabilidades e incompatibilidades y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos acordado celebrar el presente **CONTRATO DE COMPRAVENTA DE CARÁCTER PRIVADO,** que se regirá por lo señalado en el numeral 6° del artículo 195 de la ley 100 de 1993, y las normas que regulan la materia en el Código Civil previas las siguientes **CONSIDERACIONES:** **1)** Que **EL HOSPITAL** tiene como objeto primordial la prestación del servicio de salud, entendidos como un servicio público a Cargo del Estado como parte integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud. **2)** Que de acuerdo con lo señalado por el Articulo 195 de la Ley 100 de 1993, los contratos celebrados por las Empresas Sociales del Estado se rigen por lo preceptuado en el régimen del derecho privado y por lo estipulado en su manual interno de contratación. **3)** Que la Resolución 3100 de 2019 emitida por el Ministerio de Salud y de la Protección Social definió los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud y por ende establece en el punto 11.6.2 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL los requisitos y exigencias técnicas que se debe tener en el momento de la adquisición de las ambulancias para baja complejidad que existe certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la celebración del contrato; **4)** que el Proceso de Contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones. 5) que la propuesta presentada por el proponente cumple con la especificaciones indicadas en la Resolución N° 3100 de 2019----------

Así las cosas el contrato se regirá por las siguientes clausulas

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB (TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO), QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN ATENCION AL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN **CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA-** En desarrollo del objeto del contrato, el contratista deberá cumplir las siguientes obligaciones: El contratista en

desarrollo del objeto contractual, tendrá que desarrollar las siguientes actividades: 1. . Entregar el bien objeto del contrato de compraventa dentro de los plazos señalados en este contrato y con las características técnicas que se relacionan a continuación: ----------

MARCA	NISSAN NP300
No. CILINDROS	4 cilindros en línea
CILINDRADA	2.488
POTENCIA	161 hp / 3.600 rpm
TORQUE	41.1 km / 2.000 rpm
SISTEMA DE ALIMENTACION	Inyección Directa + Riel Común
COMBUSTIBLE	Diesel
TRACCION	4x4
DIRECCION	Piñón y Cremallera Asistida Hidráulicamente
SUSPENSION	**Delantera** Independiente con doble horquilla, muelle helicoidal sobre amortiguador telescópico y barra estabilizadora. **Trasera** MultiLink con eje rígido, muelle helicoidal con amortiguador telescópico y barra estabilizadora
FRENOS	**Delanteros** de discos ventilados. **Traseros** de tambor

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CARROCERÍA

ESTRUCTURA

Estructura fabricada en lámina calibre 18 Coll Roll, piso y puentes de 1/8 y lamina Calibre 16, forrada interior y exteriormente en fibra de vidrio.

PINTURA

Pintada en su totalidad de color blanco poliuretano e inmunizado todo el piso.

GENERALIDADES

- La carrocería de la ambulancia será independiente de la cabina del conductor.

- Sistema de intercomunicación.

- Cuenta con un módulo de intercomunicación visual y auditiva instalado entre el tabique de separación de la cabina del conductor y el compartimiento del paciente por medio de ventanas corredizas construidas en vidrio de seguridad para vehículos. Anteriormente nombrado en las especificaciones de la carrocería.

- El revestimiento interior del compartimiento del paciente, se realizará en inyección de poliuretano en toda su totalidad. Con el fin de dar protección retardante al fuego, termo acústica y agilizar el proceso térmico al momento de poner en funcionamiento del aire acondicionado.

HOSPITAL
NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN
¡Trabajamos con el CORAZÓN!

desarrollo del objeto contractual, tendrá que desarrollar las siguientes actividades: 1. . Entregar el bien objeto del contrato de compraventa dentro de los plazos señalados en este contrato y con las características técnicas que se relacionan a continuación: ----------

MARCA	[illegible] NP300
No. CILINDROS	4 cilindros en línea
CILINDRADA	2.488
POTENCIA	161 hp / 3.600 rpm
TORQUE	[illegible] / 2.000 rpm
SISTEMA DE ALIMENTACION	Inyección Directa + Riel Común
COMBUSTIBLE	Diesel
TRACCION	4x4
DIRECCION	Piñón y Cremallera Asistida hidráulicamente
SUSPENSION	Delantera Independiente con doble horquilla, muelle helicoidal sobre amortiguador telescópico y barra estabilizadora. Trasera MultiLink con eje rígido, muelle helicoidal con amortiguador telescópico y barra estabilizadora
FRENOS	Delanteros de discos ventilados. Traseros de tambor

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CARROCERÍA

ESTRUCTURA

Estructura fabricada en lámina calibre 18 Coll Roll, piso y puentes de 1/8 y lamina Calibre 16, forrada interior y exteriormente en fibra de vidrio.

PINTURA

Pintada en su totalidad de color blanco poliuretano e inmunizado todo el piso.

GENERALIDADES

- La carrocería de la ambulancia será independiente de la cabina del conductor.

- Sistema de intercomunicación.

- Cuenta con un módulo de intercomunicación visual y auditiva instalado entre el tabique de separación de la cabina del conductor y el compartimiento del paciente por medio de ventanas corredizas construidas en vidrio de seguridad para vehículos. Anteriormente nombrado en las especificaciones de la carrocería.

- El revestimiento interior del compartimiento del paciente, se realizará en inyección de poliuretano en toda su totalidad. Con el fin de dar protección retardante al fuego, termo acústica y agilizar el proceso térmico al momento de poner en funcionamiento del aire acondicionado.

- La ambulancia será forrada interiormente en fibra de vidrio debidamente bocelado y rematado en los filos con el fin de evitar puntas, superficies cortantes o afiladas. Los elementos peligrosos como soportes, y elementos metálicos. La fibra de vidrio facilita la limpieza y desinfección con desinfectantes de uso tradicional en los hospitales y clínicas. El espesor de la lámina de fibra será de 05 mm.

De una sola pieza. Los empates y uniones se realizarán por medio de pegues y se bocelará completamente con el fin de evitar la filtración de líquidos al interior de la estructura de la ambulancia.

- Acceso principal al compartimiento del paciente por la parte posterior que cuenta con una apertura útil de mínimo 1.10 metros altura y de 0.90 metros de ancho, con mecanismo que permite el bloqueo en posición de "abierta", con un peldaño adherido a la carrocería con acabado antideslizante para facilitar el acceso al compartimiento del paciente. Sobre estas medidas se autorizan variaciones máximas del 10 %.
- Los gases del tubo de escape no ingresan al interior de la ambulancia.

CAMAROTE
Ubicado sobre la cabina de conducción para almacenar equipos varios.

MEDIDAS APROXIMADAS DE CARROCERIA
Largo útil 2.35 mts
Ancho útil 1.75 mts
Alto útil 1.60 mts

PISO
El piso será de una pieza, en caucho antideslizante el cual es aislante eléctrico, sin costuras 5 centímetros y bocelado en pirlán de aluminio en todos los contornos.

UNA BARRA PASAMANOS
Localizada a todo lo largo del compartimiento del paciente, para el sostenimiento del personal asistencial cuando el vehículo esté en movimiento.

SISTEMA ELECTRICO DE LA AMBULANCIA
Todos los sistemas instalados se protegerán mediante fusibles calibrados de fácil acceso para su eventual sustitución, los fusibles correspondientes al equipo médico o especial que lleva el vehículo se agruparán en una caja única. Todo el equipo eléctrico debe funcionar a una tensión nominal de 12 V de corriente continua, con circuito independiente para manejar los aparatos de la cabina y el área de pacientes. distribución del sistema eléctrico:

- Barra de luces con perifoneo y sirena tipo LED
- Mini barra de luces tipo LED
- Dos exploradoras delanteras LED
- Una exploradora trasera LED
- Diez luces laterales LED
- Cuatro luces interiores LED
- Un extractor de olores
- Una lámpara de luz fría
- Inversor de corriente de 2000 vatios digital con sus respectivas tomas
- Batería adicional con máster
- Pito de reversa

DISTRIBUCIÓN DE MUEBLES

- UN MUEBLE LATERAL IZQUIERDO
La ambulancia se dotará con gabinetes en el compartimiento del paciente, fabricado en fibra de vidrio con garantía de (5) años de fábrica por deterioro no por mala manipulación y recubierto en fórmica para su fácil limpieza, los bordes redondeados y fijos postformados demarcados con sus respectivos colores de identificación, así:

Amarrillo: Pediátrico Azul: Respiratorio
Verde: Quirúrgico y varios Rojo: Cardiaco circulatorio
Las puertas de los gabinetes y muebles serán del tipo corredizo fabricadas en láminas de acrílico de 4 mm. Transparentes con sus correspondientes anclajes y seguros que evitarán la apertura de las mismas cuando el vehículo está en movimiento.

- UN MUEBLE LATERAL DERECHO
Este mueble sirve como camilla auxiliar o como asiento para personal, fabricado en fibra de vidrio con garantía de (5) años de fábrica por deterioro no por mala manipulación recubierto en fórmica, puntas redondeadas, tapa abatible para poder guardar insumos de la ambulancia, tres cinturones de dos puntos con espaldar y apoya cabezas.

AVISOS
Se le instalan franjas y logotipos todo en cinta reflectiva.
Leyenda de "este es un espacio libre de humo de tabaco" u otro similar" y "use el cinturón de seguridad", ubicada en el compartimiento del paciente

- Dos (2) Letreros de "**AMBULANCIA**" en los costados.
- Un (1) Letrero de "**AMBULANCIA**" en la parte delantera en sentido inverso con medidas reglamentarias con el fin de ser leído claramente en un espejo retrovisor a una distancia mínima de 60 metros.
- Un (1) Letrero de "**AMBULANCIA**" en la parte trasera.
- Un (1) Letrero de "**AMBULANCIA**" en el techo.
- Un (1) Símbolo Internacional de la "**CRUZ DE LA VIDA**" instalado en puerta trasera de la Ambulancia.
- Tres (3) Siglas **"TAB"**, instalada en los costados y puerta trasera de la Ambulancia.
- Calcomanía de "**CONSERVE SU DISTANCIA**" ubicada en la parte trasera de la Ambulancia.
- ***Nota: La rotulación, identificación y decoración exterior, se demarcará con cinta reflectiva que cumple con las normas ASTM-4956-93 y ASTM-810.***

SISTEMA RESPIRATORIO
Un (1) cilindro de oxígeno de 3.5 metros cúbicos en aluminio, toma de pared con su flujómetro y regulador de oxígeno y un (1) cilindro portátil de 0.5 m3 con regulador.

UNA BARRA DE SOLUCIONES
Fabricada en aluminio instalada en el techo con cuatro ganchos que soportan líquidos parenterales.

DOTACIÓN PARA AMBULANCIA DE TRASLADO ASISTENCIAL EQUIPO MEDICO

- Un (1) Termómetro digital
- Una (1) Riñonera en acero inoxidable
- Un (1) Pato orinal en acero inoxidable
- Un (1) Pato coprológico en acero inoxidable
- Una (1) Linterna de examen
- Un (1) Fonendoscopio Adulto
- Un (1) Fonendoscopio Pediátrico
- Un (1) Tensiómetro Adulto
- Un (1) Tensiómetro Pediátrico
- Una (1) Manta térmica
- Un (1) Ambu adulto con máscara y bolsa de reservorio
- Un (1) Ambu pediátrico con máscara y bolsa de reservorio
- Tres (3) Cánulas de guedell de diferente tamaño (adulto y pediátrico)

HOSPITAL
NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN
¡Trabajamos con el CORAZÓN!

- Una (1) Máscara de oxígeno adulto
- Una (1) Máscara de oxígeno pediátrico
- Una (1) Máscara de no reinhalación adulto
- Una (1) Máscara de no reinhalación pediátrico
- Dos (2) Sistemas ventury adulto
- Dos (2) Sistema ventury pediátrico
- Una (1) Cánula nasal adulto
- Una (1) Cánula nasal pediátrica
- Dos (2) Aditamento Supraglotico Adulto
- Dos (2) Aditamentos Supraglotico Pediátrico
- Dos (2) Mangueras de oxigeno
- Dos (2) Collares cervicales Adultos
- Dos (2) Collares cervicales Pediátricos
- Un (1) Inmovilizador lateral de cabeza
- Un (1) Juego de Férulas para brazo, antebrazo, pierna y pie acartonadas
- Dos (2) Vendas de algodón
- Dos (2) Vendas de gasa
- Dos (2) Vendas elásticas
- Dos (2) Vendas triangulares

Equipo de parto:

- Cinco (5) Ligaduras para cordón umbilical
- Dos (2) Pinzas Rochester largas.
- Una (1) Tijera de episiotomía
- Una (1) Perilla de succión

INMOVILIZADOR RIGIDO CERVICAL
Fabricado en polietileno de 1.80m de largo X 0.40 m de ancho con sus respectivas correas y arnés.

INMOVILIZADOR RIGIDO ESPINAL
Fabricado en polietileno con sus respectivas correas de sujeción.

INSUMOS

- Una (1) Caja de guantes

HOSPITAL
NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN
¡Trabajamos con el CORAZÓN!

- Una (1) Caja de tapabocas
- Una (1) Gafas de bioproteccion
- Un (1) Paquete de paños desechables
- Dos (2) Apósitos de gasa
- Un (1) Paquete de apósitos de algodón
- Cinco (5) Sondas naso gástricas
- Cinco (5) Sondas de nelaton
- Dos (2) Rollos de esparadrapo
- Dos (2) Rollos de micropore
- Dos (2) Sabanas para camilla
- Dos (2) Batas desechables para paciente
- Un (1) Sistema guardián
- Dos (2) Canecas para desperdicios
- Seis (6) Solución salina al 9%
- Cuatro (4) Lactato de ringuer
- Dos (2) Bolsas de Dextrosa al 5%
- Una (1) Bolsa de Dextrosa al 10%

INSUMOS

- Un (1) Nebulizador
- Una (1) Cobija para el paciente
- Una (1) Pinza de Maguill
- Dos (2) Vaso humidificador simple
- Dos (2) Vasos humidificadores venturi
- Una (1) Microcámara de nebulización con mascarilla para adulto
- Una (1) Microcámara de nebulización con mascarilla pediátrica
- Cinco (5) Pericraneales o agujas tipo mariposa de diferentes tamaños
- Tres (3) Equipos de microgoteo
- Seis (6) Equipos de macrogoteo
- Dos (2) Torniquetes para acceso IV
- Un (1) Torniquete para hemorragias
- Jeringas desechables de diferentes tamaños (1cc a 50 cc)
- Seis (6) Yelcos de diferentes tañamos

- Un (1) Equipo de pequeña cirugía
- Una (1) Tijera cortatodo
- Un (1) Dispositivo para cortar anillos
- Un (1) Frasco con jabón antiséptico
- Un (1) Frasco con jabón quirúrgico
- Un (1) Glucómetro.

EQUIPOS E INSUMOS TRASLADO ASISTENCIAL BASICO (TAB) RESOLUCION 3100 DE 2019

EQUIPOS
- UN (1) DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA
- UN (1) MONITOR DE SIGNOS VITALES
- UN (1) ASPIRADOR DE SECRECIONES (SUCCIONADOR)

UNA CAMILLA PRINCIPAL
Tipo ambulancia de dos niveles con patas abatibles, construida en tubería de 7/8" Cal. 18 en aluminio reforzada, piezas de armadura en aluminio resistentes al impacto, tendido en fibra de vidrio, con ruedas de deslizamiento de 5" en caucho resistente antibacterial, que no deja ningún marca en la superficie de la ambulancia, Ruedas de 4" de choque para ingreso a la ambulancia, las cuales permiten el acceso de esta al vehículo, adicionalmente lleva 4 ruedas de patín de alta resistencia para fácil deslizamiento de la camilla dentro del vehículo, con espaldar reclinable, barandillas abatibles, pies deslizantes, sistema mecánico de bloqueo, además estas camillas son las únicas en el mercado que cuentan con pines de seguridad.
Colchoneta de espuma de 10 cm de espesor de densidad 0.26 marca espumados, recubiertas en cordobán que impide filtraciones de líquidos y forradas interiormente con bolsa plástica; atril para suero, tres cinturones de seguridad de dos puntos, soporte de fijación.
Medidas: Largo: 1.90 m, Ancho: 0.55 m, Alto Mínimo: 0.25 y Alto Máximo: a la altura requerida por el vehículo. Resistencia en kg: 180 kg Aproximadamente. Cumple con las normas técnicas requeridas.
La camilla debe incluir una cápsula de aislamiento para pacientes con posible COVID-19.

UNA SILLA DE RUEDAS PORTATIL
Fabricada en tubería redonda terminado en pintura electrostática y lona de alta resistencia, dos cinturones de dos puntos de seguridad, resistencia de 120 kilogramos.

HOSPITAL
NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN
¡Trabajamos con el CORAZÓN!

UNA SILLA PARA MEDICO ABATIBLE
Fabricada en tubo de 1" de diámetro tapizada, con un cinturón de seguridad de dos puntos.

AIRE ACONDICIONADO
Parte delantera original del vehículo y parte trasera del compartimiento del paciente instalado con la siguiente capacidad de 22000 a 25000 BTU
– 650 A 750 CFM.
2 motores a 650 CFM
Válvula Expansión 1 Tonelada Serpentín de flujo directo Control de temperatura.

UN RADIO TELEFONO DE TELECOMUNICACIONES
GENERALIDADES:
- Bloqueo de canal ocupado.
- Escucha monitoreo remoto.
- Volumen mínimo programable.
- Alerta de bocina megafonía.
- Clonación radio.
- Sistema de transposición.
- Señalización 5 tonos.
- Bloque y desactivación remota.
- Alerta de emergencias.
- Desvió de llamadas.
- Recepción dual.
- Función hablar sin repetidor.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
- Dos (2) Extintores de polvo polivalente ABC de 5 LIBRAS, uno instalado en la parte delantera del vehículo y el otro extintor ubicado en la parte trasera de la ambulancia.
- Una (1) Caja de herramientas plástica
- Un (1) Alicate de mango aislado
- Tres (3) Destornilladores de pala
- Tres (3) Destornilladores de estrella
-Juego de llaves fijas
- Una (1) Llave inglesa
- Un (1) Martillo metálico
- Dos (2) Chalecos fluorescente

- Una (1) Lámpara recargable
- Fusibles surtidos
- Una (1) Palanca patecabra
- Una (1) Cuerda con ganchos de tracción 20 m
- Un (1) Cable de red urbana
- Un (1) Juego de cables de ignición
- Cuchilla para romper cinturones de seguridad
- Martillo rompe vidrio.
- Mesa para equipos instalada en la camilla principal
- Cámara de reversa con monitor en la cabina del conductor

2. desarrollar con autonomía e independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes del mismo debiendo reportar en forma escrita al supervisor o interventor del contrato cualquier situación que afecte su autonomía. 23. Cumplir con las especificaciones técnicas de los bienes de acuerdo con lo previsto en la propuesta en los anexos, en la ficha técnica y en los estudios previos. 4. Garantizar la calidad de los bienes suministrados y el funcionamiento de estos. 5 reemplazar. Los bienes suministrados cuando presenten defectos de calidad, funcionamiento o de fábrica. 6. Cumplir con las obligaciones posteriores a la liquidación del contrato. 7. Constituir las garantías correspondientes para la debida ejecución del contrato. 8. Cumplir con las obligaciones de Seguridad Social integral. 9 Matricular la ambulancia a nombre del hospital nuestra señora del Carmen ESE. En la Secretaría de tránsito y transporte y movilidad del departamento del Tolima. Incluyendo todos los trámites, impuestos, seguros obligatorios como SOAT con vigencia mínima de un año. 10. Contratista garantiza que la ambulancia es de excelente marca reconocida por el fabricante y que cumple con todas las normas técnicas y de seguridad y garantiza el excelente funcionamiento durante el periodo de vida de esta. 11. El contratista deberá entregar los documentos de importación y de legalización de la ambulancia. 12. Realizar la entrega n la entidad contratante, ubicada en el municipio del Carmen de Apicalá. 13. asumir bajo su costo y riesgo todos los impuestos, tasas y contribuciones en que incurra en la ejecución del contrato. 14). firmar el acta de inicio, de común acuerdo con el supervisor una vez legalizado y perfeccionado el contrato de compraventa. 15). guardar la suficiente reserva profesional sobre la información que se obtenga en desarrollo de las actividades realizadas 16.) las demás que resulten de la ejecución del contrato

OBLIGACIONES DEL HOSPITAL. a) Suministrar al CONTRATISTA la información, documentación y demás elementos necesarios para el cabal cumplimiento del contrato, facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma finalidad; **b)** Controlar la calidad del Bien contratado y el cumplimiento de los requisitos y condiciones convenidas; **c)** Recibir el bien

contratado en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor tiempo posible, los documentos correspondientes a la ejecución del contrato; **d)** Cancelar el valor del presente contrato de acuerdo a la forma estipulada en la cláusula cuarta. e) Facilitar al contratista las condiciones (suministro de información, documentación y demás elementos), que le permitan cumplir en la forma y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma finalidad **CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO:** El valor del presente contrato es por la suma de DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DE PESOS ($204.000.000) **PARAGRAFO: ESTAMPILLAS.** El Contratista deberá cancelar él (6.5%) sobre el valor del contrato antes de IVA por concepto de estampillas así: PROCULTURA, valor de la Consignación él (1%), PROANCIANOS, valor de la Consignación él (4%), PRO-DEPORTE Y RECREACION valor de la Consignación él (1.5%) requisitos que se entienden cumplidos con la presentación de las respectivas estampillas. **CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO**: El CONTRATANTE se obliga a pagar al CONTRATISTA el valor de este contrato en DOS (02) pagos, un 50% a titulo de anticipo una vez legalizado y perfeccionado el contrato, y el otro 50% previa presentación de factura con sus respectivos soportes previa revisión y certificación dada por el supervisor del contrato. **PARAGRAFO:** Para el desembolso el contratista deberá acreditar el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral. El supervisor que no verifique el pago de los aportes, incurrirá en causal de mala conducta que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente, de acuerdo a lo establecido en la ley. **CLÁUSULA QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del contrato, es de Dos (2) meses a partir de la firma del acta de inicio **CLÁUSULA SEXTA.- CESIÓN:** EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato a menos que exista fuerza mayor o caso fortuito previa autorización expresa y escrita del CONTRATANTE, la cual requerirá concepto previo del supervisor, mediante acto administrativo motivado. **CLÁUSULA SEPTIMA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO**: Por mutuo acuerdo y en eventos de fuerza mayor o caso fortuito las partes podrán suspender la ejecución del contrato. Este hecho, previo concepto del supervisor, se hará constar en acta que suscribirán el CONTRATISTA y el supervisor con el visto bueno del ordenador del gasto. **CLÁUSULA OCTAVA.- CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** En caso de incumplimiento a cargo del CONTRATISTA, éste deberá pagar un valor equivalente al 20% del valor del contrato. **CLÁUSULA NOVENA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la constitución y en la ley, Manual de contratación de la ESE. **CLAUSULA DECIMA- SUPERVISORIA:** Sera ejercida por la Profesional del área administrativa del Hospital NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN ESE de CARMEN DE APICALA, como Supervisora del Contrato. **CLAUSULA DECIMA PRIMERA - AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL**: El

presente contrato no genera relación laboral alguna entre el **HOSPITAL** y el Contratista y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula tercera. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DEBER DE CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA:** El Contratista, está sometido al deber de confidencialidad y reserva en el manejo de la información que con ocasión del contrato le sea suministrada por el **HOSPITAL** o conocida por él por cualquier medio. **CLAUSULA DECIMA TERCERA.- MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:** Las controversias que surjan durante la ejecución del objeto contractual o por el incumplimiento en el futuro haciendo referencia a la garantía de los elementos y/o equipos suministrados ofrecidas en la propuesta y que hace parte integral del presente contrato, se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación previstos en la Ley 80 de 1993, Manual de contratación de la ESE y normas que la modifiquen o adicionen, de no ser posible se acudirá a la conciliación prejudicial y posterior inicio de proceso ante lo contencioso administrativo. **CLÁUSULA DECIMA CUARTA:** El Supervisor verificará el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 23 de la Ley 1150/07 durante la vigencia del contrato por parte del Contratista. **CLÁUSULA DECIMA QUINTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Forman parte integrante de éste contrato los siguientes documentos: 1- Los documentos que soportan el proceso pre-contractual. 2- Todas las modificaciones, adiciones o aclaraciones que se expidan con posterioridad. **CLAUSULA DECIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO:** El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y para su legalización se requiere la aprobación por parte del contratante de la garantías exigidas al contratista y la suscripción del acta de inicio. **CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. -CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** a) Por terminación de la vigencia o expiración del término de ejecución. b) Por mutuo acuerdo entre las partes, c) Por muerte del contratista, d) Por incumplimiento de las obligaciones especiales del contratista especificadas en la cláusula Segunda del contrato, f) Por incumplimiento a cualquiera de las estipulaciones contractuales **CLAUSULA DECIMA OCTAVA: GARANTIAS:** En cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, el manual de contratación de la ESE, el oferente y el contratista deberán garantizar al HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la calidad de los elementos suministrados, la calidad del servicio prestado y los Riesgos a los que se encuentran expuestas la ESE, Para lo cual el contratista deberá constituir en favor del hospital nuestra señora del Carmen una póliza de seguro con una compañía legalmente establecida en el país. Y que conste de A) cumplimiento por el 20% del valor del contrato durante el término del contrato y 6 meses más B) calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados por el 30% del valor del

HOSPITAL
NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN
¡Trabajamos con el CORAZÓN!

contrato y durante el término de contrato y tres años mas, C) Correcto y Buen Manejo del anticipo que ampare el 100% del valor recibido en calidad de anticipo por el término del contrato y hasta su liquidación **CLAUSULA DECIMA NOVENA: DOMICILIO CONTRACTUAL**: Las partes acuerdan como domicilio contractual el municipio de CARMEN DE APICALA Tolima.

Para constancia se firma, a los dieciocho (18) días del mes de mayo de 2021

EL CONTRATANTE, **EL CONTRATISTA,**

YEIMY CAROLINA MURILLO GUARNIZO
GERENTE

JORGE ELIECER LOPEZ SIERRA
Rte Legal ARCRON

SUPERVISORA

CLAUDIA STELLA RODRIUEZ RAMIREZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Nit: 890702241-0
CRA 2 NO 5-07 CARMEN DE APICALA TOLIMA Tel. 2479693

Registro Presupuestal No.

RP2 - 2021000178
May-18-2021

Tercero JORGE LOPEZ **C.C./Nit** 900093151 **CUIN**
Documento CONVENIO **No**
Contrato CONTRATO DE COMPRA VENTA **No** 56 **CDP No.** CD2-021000173
Proyecto _61XOHB9X2

Detalles ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB PARA EL HNSC

Imputacion presupuestal

CDP / Rubro presupuestal	Descripcion	Valor Registro	Nuevo saldo
CD2-021000035			
2502	Inversiom con recursos propios	5,000,000.00	0.00
CD2-021000129			
2503	DOTACION APOYO PARQUE AUTOMOTOR	30,000,000.00	0.00
CD2-021000173			
250101	Cofinanciación convenio ambulancia	169,000,000.00	0.00
Son : DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DE PESOS		**Total**	**204,000,000.00**

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito

Elaboró GLORIA ANGELICA MORENO **Aprobó** **Ordenador Gasto**

Observaciones Hace constar que se ha hecho el registro presupuestal de acuerdo al presupuesto de la vigencia fiscal 2021 el dia May-18-2021

MURILLO GUARNIZO YENNY CAROLINA
C.C. No 28980258

HOSPITAL
NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN
¡Trabajamos con el CORAZÓN!

ACTA DE INICIO - CONTRATO 056 DE 2021

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE CARÁCTER PRIVADO CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE CARMEN DE APICALA I NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y ARTICULOS CROMADOS ARCRON SAS

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB (TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO), QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN ATENCION AL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

CONTRATISTA: ARTICULOS CROMADOS ARCRON SAS
SUPERVISIÓN: CLAUDIA STELLA RODRIGUEZ RAMIREZ

LUGAR EJECUCIÓN	CARMEN DE APICALA
PLAZO DE EJECUCIÓN.	DOS MESES
FECHA DE INICIO.	18 DE MAYO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN.	18 DE JULIO
VALOR	**$204.000.000**

Los suscritos CLAUDIA STELLA RODRIGUEZ RAMIREZ, en calidad de Supervisor del contrato de la referencia y actuando en representación del HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN y ARTICULOS CROMADOS ARCRON SAS identificada con NIT 900093151-7, representada legalmente por JORGE ELIECER LOPEZ SIERRA, mediante la presente acta dejan constancia de la iniciación del objeto contratado, descrito en la cláusula PRIMERA del Contrato No. 056 de 2021.

El contratista manifiesta que se compromete a cumplir con el objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en el contrato y la propuesta presentada por éste, documentos que forman parte integral del presente documento.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Dieciocho (18) días del mes de Mayo de 2021.

CLAUDIA STELLA RODRIGUEZ RAMIREZ
Supervisora

JORGE ELIECER LOPEZ SIERRA
C.C. No. 79.292.472

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: HOSPITAL NUESTRA SE#
NIT: 890702241
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: cancelasaldoanticamb
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 41320053062

Fecha: 09-09-2021 **Hora:** 12:46:37
Fecha de Generación: 09-09-2021

Fecha de envío del pago: 16-07-2021
Fecha para Procesar el pago: 16-07-2021

Impreso por: 52704451

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $17,500,000.00	**Valor Registros Procesados:** $17,500,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
99685481819	Ahorros	900093151	ARTICULOS CROMADOS	17,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-07-2021

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: HOSPITAL NUESTRA SE#
NIT: 890702241
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ABONOADAMBULANCIA
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 41321411663

Fecha: 09-09-2021 **Hora:** 12:45:42
Fecha de Generación: 09-09-2021

Fecha de envío del pago: 13-07-2021
Fecha para Procesar el pago: 13-07-2021

Impreso por: 52704451

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $84,500,000.00	**Valor Registros Procesados:** $84,500,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
99685481819	Ahorros	900093151	ARTICULOS CROMADOS	84,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-07-2021

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/06/30 HASTA: 2021/07/31

CUENTA DE AHORROS


NÚMERO 41321411663

SUCURSAL MELGAR

ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB

HOSPITALCARMENAPICALA@GMAIL.COM

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	10,903,286
TOTAL ABONOS	$	84,501,852.05	*CUENTAS X COBRAR*	$	336,147.95
TOTAL CARGOS	$	84,501,852.05	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,852.05
SALDO ACTUAL	$	.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
9/07	PAGO INTERBANC GOBIERNO DEPART			84,500,000.00	84,500,000.00
12/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,852.05	84,501,852.05
13/07	PAGO A PROV ARTICULOS CROMADOS			-84,500,000.00	1,852.05
13/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,852.05	.00
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL CARMEN DE APICALA
Nit: 800100050-1
CRA 5 CALLE 5 ESQUINA CARMEN DE APICALA TOLIMA Tel. 2478665

Certificado De Disponibilidad Presupuestal No.

CD1 - 202100292
Mar-24-2021

Documento SOLICITUD CDP **No** 292 _60F0H312L

Detalles COFINANCIACION LA COMPRA DE UNA AMBULANCIA TAB PARA EL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA

EL RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
C E R T I F I C A :

Que dentro del presupuesto de egresos y gastos de la vigencia fiscal de 2021 , existe DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS con cargo a la siguiente imputacion presupuestal:

Codigo	Descripcion	Valor
26	PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSION	
2601	DIMENSION SOCIAL	
260101	EJE ESTRATEGICO 1 : POR UN CARMEN CON EQUIDAD SOCI AL	
26010102	SECTOR SALUD Y PROTECCION SOCIAL	
2601010201	PROGRAMA SALUD CON EFICIENCIA	
260101020104	Fortalecimiento a la autoridad sanitaria instituci ón del Mpio de Carmen de Apicala	
26010102010404	Saldo no ejecutado vigencia anterior S.G.P. libre destinación 42% -Apoyo compra ambulancia	30,000,000.00

Son : TREINTA MILLONES DE PESOS **Total** **30,000,000.00**

Estado del rubro presupuestal	
Saldo anterior	**30,000,000.00**
Menos esta certificacion	**30,000,000.00**
Nuevo saldo	**0.00**

Fecha de la certificación Mar-24-2021
Este cerdificado expira el dia Dic-31-2021

ELABORO
ALBA

APROBO
CAROLINA RODRIGUEZ ESCOBAR
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA

Observaciones

REPUBLICA DE COLOMBIA
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Nit: 890702241-0
CRA 2 NO 5-07 CARMEN DE APICALA TOLIMA Tel. 2479693

Certificado De Disponibilidad Presupuestal No.

CD2 - 2021000129
Mar-26-2021

Documento **No** 60G0GVG91

Detalles COFINANCIACION ADQUISICION AMBULANCIA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 112

EL RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
C E R T I F I C A :

Que dentro del presupuesto de egresos y gastos de la vigencia fiscal de 2021 , existe DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS con cargo a la siguiente imputacion presupuestal:

Codigo	Descripcion	Valor
25	INVERSIONES	
2503	DOTACION APOYO PARQUE AUTOMOTOR	30,000,000.00

Son : TREINTA MILLONES DE PESOS **Total** **30,000,000.00**

Estado del rubro presupuestal

Saldo anterior	**30,000,000.00**
Menos esta certificacion	**30,000,000.00**
Nuevo saldo	**0.00**

Fecha de la certificación Mar-26-2021
Este certificado expira el dia Dic-31-2021

Elaboró GLORIA ANGELICA MORENO

Aprobó

Vº. Bº Ordenador Gasto

MURILLO GUARNIZO YEIMY CAROLINA
C.C. No 28980258

Observaciones

REPUBLICA DE COLOMBIA
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
NIT: 890702241-0
CRA 2 NO 5-07 CARMEN DE APICALA TOLIMA Tel. 2479693

Certificado De Disponibilidad Presupuestal No.

CD2 - 2021000035
Ene-19-2021

Documento CONVENIO **No** _5YMQXBYQ6

Detalles PARA CUBRIR APORTE COMPRA AMBULANCIA PARA LA ESE

EL RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
C E R T I F I C A :

Que dentro del presupuesto de egresos y gastos de la vigencia fiscal de 2021 , existe DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL por la suma de CINCO MILLONES DE PESOS con cargo a la siguiente imputacion presupuestal:

Codigo	Descripcion	Valor
15	INVERSIONES	
1502	Inversion con recursos propios	5,000,000.00

Son : CINCO MILLONES DE PESOS **Total** **5,000,000.00**

Estado del rubro presupuestal

Saldo anterior	**27,500,000.00**
Menos esta certificacion	**5,000,000.00**
Nuevo saldo	**22,500,000.00**

Fecha de la certificación Ene-19-2021
Este certificado expira el dia Dic-31-2021

Elaboró GLORIA ANGELICA MORENO

Aprobó

Vº. Bº Ordenador Gasto

MURILLO GUARNIZO YEIMY CAROLINA
C.C. No 28980298

Observaciones

Hospital

ARCRON

Factura Electrónica De Venta No

ARC No. 259

Resolución de Facturación DIAN No.18763004095638 del 07 de Febrero de 2020
Facturación Electronica Desde la ARC No. 1 Hasta la ARC No. 1000 Vence el 06 de Agosto de 2021

ARTICULOS CROMADOS ARCRON SAS

Nit 900093151

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 2920 6.90 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE CCARMEN DE APICALA I
NIT	890702241 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 2 5 07	rmen De Apic	2478175

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN CONTRATO DE COMPRAVENTA No 056

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/08/2021	09/08/2021	JORGE ELIECER LOPEZ SIERRA	50% Anticipo y 50% Contraentrega

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DE AMBULANCIA DE TRASLADO ASISTENCIAL BASICO (TAB) SOBRE CHASIS NISSAN PARA EL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE CARMEN DE APICALA MARCA: NISSAN MODELO: 2022 SERIE/VIN/CHASIS:3N6CD35B8ZK435056 MOTOR: YD25-734347P NOTA: ESTA FACTURA INCLUYE UN VEHICULO DE CHASIS NISSAN FRONTIER SEGÚN HOMOLOGACION No AA- 84431 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y ADECUACICN SEGÚN RESOLUCION No 20213040023825.	1	Und.	171.428.571	19%	32.571.429	171.428.571

1 **Total Item**

SUBTOTAL	171.428.571
IVA	32.571.429
TOTAL DE LA OPERACIÓN	204.000.000
RETEFUENTE	1.714.286
RETEIVA	4.885.714
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	197.400.000

Valor en Letras

CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Fecha y Hora de Generación: 09/08/2021 12:15:32

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Medios de Pago: Efectivo

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
FECHA RECIBIDO
QUIEN RECIBE
DESTINO
FOLIOS

Tel: 233 0614 - Cel: 315 315 7190
Fax: 403 9211
www.arcron.com.co
j.lopez@arcron.com.co
Calle 34 Sur Nº 89 - 73
Barrio Carvajal - Bogotá, D.C.

CUFE: 19974e60829f29b11113b654bd792af45d1582b6b8ef78d736b5a617e2e8eb6f5afa4504c3a888784b24b383999c15b7--Expedición:09/08/2021 12:18 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Nit: 890702241-0 _64Y13F44N

Concepto SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y Pág: 1

ENTRADAS ALMACEN No:

FC2 - 2019000167
Ago-30-2021
No.ext:259

Proveedor: **JORGE LOPEZ** CC/Nit: **900093151-7** Afecta: -
Direcc: **CALLE 34 SUR NO. 69-73** Plazo: **0** **Ago-30-2021**
BOGOTA D.C. - BOGOTA

Referencia	Detalle	Unidad	Iva	Cajas	Cant	Vr/Unit	Vr/Total
16571	CHASIS NISSAN FRONTIER MODELO 2022 3N6CD35B8ZK435056		0		1.00	117,000,000.00	117,000,000.00
1373132	MONITOR DE CAMARA DE REVERSA ACCIONADO DE LA PARTE DEL CONDUCTOR		0		1.00	1,150,000.00	1,150,000.00
132465432	PANEL DE CONTROL SIRENA Y PERIFONEO		0		1.00	1,350,000.00	1,350,000.00
23165476132	PANEL DE CONTROL LUCES AMBULANCIA		0		1.00	1,100,000.00	1,100,000.00
13574698432	RADIO TELEFONO DE COMUNICACIONES		0		1.00	2,500,000.00	2,500,000.00
13276987213	INVERSOR DE 12 VOLTIOS DE 2000 VATIOS CON SUS RESPECTIVAS TOMAS		0		1.00	1,300,000.00	1,300,000.00
132168768	BATERIA ADICIONAL		0		1.00	500,000.00	500,000.00
1354312	AIRE ACONDICIONADO PARTE DELANTERA Y TRASERA		0		1.00	3,750,000.00	3,750,000.00
13247698731	MUEBLE DE GAVETAS, PUERTA EN ACRILICO		0		1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
13476874231	MUEBLE CON 3 PUESTOS PARA TRIPULACION		0		1.00	2,700,000.00	2,700,000.00
.13524654132.0.	TABLA CERVICAL PLASTICA CON INMOBILIZADOR Y SU RESPECTIVO ARNES		0		1.00	190,000.00	190,000.00
1246876132	UNA TABLA ESPINAL PLASTICA CON SU RESPECTIVO ARNES		0		1.00	120,000.00	120,000.00
1657986413	UNA SILLA PARAMEDICA CON BASE EN ALUMINIO		0		1.00	560,000.00	560,000.00
137698763	UNA BARRA DE GANCHOS PARA LIQUIDOS		0		1.00	180,000.00	180,000.00
137687312	UNA BARRA PASAMANOS		0		1.00	240,000.00	240,000.00
1321637864635	LAMPARA DE LUZ FRIA		0		1.00	350,000.00	350,000.00
135748712	CINCO LUCES DE TECHOS		0		5.00	156,000.00	780,000.00
1324687321	SEIS TOMAS DOBLES DE 110 V		0		6.00	78,333.33	470,000.00
12343651	CANECA DE DESECHOS VERDES		0		1.00	65,000.00	65,000.00
13324658721	CANECA DE DESECHOS ROJA		0		1.00	65,000.00	65,000.00
15367864	DISPENSADOR DE JABON		0		1.00	79,000.00	79,000.00
123167641	MARTILLOS ROMPE VIDRIOS		0		2.00	32,500.00	65,000.00
23576543	SILLA DE RUEDAS		0		1.00	700,000.00	700,000.00
1635768941	CAMILLA DE DOS NIVELES		0		1.00	2,700,000.00	2,700,000.00
123168765132	REGULADOR TIPO YUGO PARA BALA DE OXIGENO PORTATIL		0		1.00	170,000.00	170,000.00
13213498871	TERMOMETRO DIGITAL		0		1.00	40,000.00	40,000.00
1327681	RIÑONERA EN ACERO INOXIDABLE		0		1.00	90,000.00	90,000.00
3168765541	PATO ORINAL EN ACERO INOXIDABLE		0		1.00	70,000.00	70,000.00
21676431	PATO CROPOLOGICO EN ACERO INOXIDABLE		0		1.00	70,000.00	70,000.00
2136578664.2132	MANGUERAS PARA SUBSIONADOR		0		1.00	30,000.00	30,000.00
13274685123	LINTERNA EXAMEN		0		1.00	12,000.00	12,000.00
364651	FONENDOSCOPIO ADULTO		0		1.00	45,000.00	45,000.00
123768	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO		0		1.00	45,000.00	45,000.00
13234	TENSIOMETRO ADULTO		0		1.00	43,000.00	43,000.00
2316768321	TENSIOMETRO PEDIATRICO		0		1.00	43,000.00	43,000.00
313276984451	MANTA TERMICA		0		1.00	25,000.00	25,000.00
213354897	ASPIRADOR DE SECRECIONES (SUCCIONADOR)		0		1.00	1,024,100.00	1,024,100.00
231687361	AMBU ADULTO CON MASCARA Y BOLSA DE RESERVORIO		0		1.00	49,000.00	49,000.00
1365786	AMBU PEDIATRICO CON MASCARA Y BOLSA DE RESERVORIO		0		1.00	49,000.00	49,000.00

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Nit: 890702241-0 _64V13F44N

ENTRADAS ALMACEN No:

FC2 - 2019000167
Ago-30-2021
No.ext:259

Concepto SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y Pág: 2

Proveedor: **JORGE LOPEZ** CC/NIT: **900093151-7** Afecta: -
Direcc: **CALLE 34 SUR NO. 69-73** Plazo: **0** **Ago-30-2021**
BOGOTA D.C. - BOGOTA

132465	CANULAS DE GUEDELL DE DIFERENTES TAMAÑOS (ADULTO Y PEDIATRICO)	0	18.00	2,388.89	43,000.00
132638713	MASCARA DE OXIGENO ADULTO	0	1.00	46,000.00	46,000.00
1.045640	MASCARA DE OXIGENO PEDIATRICA	0	1.00	46,000.00	46,000.00
213234654	MASCARA NO REINHALADORA ADULTO	0	1.00	58,000.00	58,000.00
124654	MASCARA DE NO REINHALACION PEDIATRICO	0	1.00	58,000.00	58,000.00
31657651	SISTEMA DE VENTURY ADULTO	0	2.00	37,000.00	74,000.00
1324654233	SISTEMA VENTURY PEDIATRICO	0	2.00	37,000.00	74,000.00
2316542	CANULA NASAL ADULTO	0	1.00	26,000.00	26,000.00
21657131	CANULA NASAL PEDIATRICA	0	1.00	26,000.00	26,000.00
32135431231	ADITAMIENTO SUPRAGLOTICO ADULTO	0	2.00	28,000.00	56,000.00
132435	ADITAMIENTO SUPRAGLOTICO PEDIATRICO	0	2.00	28,000.00	56,000.00
231354651	MANGUERA DE OXIGENO	0	1.00	35,000.00	35,000.00
0.354	COLLARES CERVICALES ADULTOS	0	2.00	19,500.00	39,000.00
31687132	COLLARES CERVICALES PEDIATRICOS	0	2.00	19,500.00	39,000.00
1635768S1	INMOVILIZADOR LATERAL DE CABEZA	0	1.00	34,000.00	34,000.00
215471	JUEGO DE FERULAS PARA BRAZO, ANTEBRAZO, PIERNA Y PIE ACARTONADOS	0	1.00	44,000.00	44,000.00
1254631	VENDAS DE ALGODON	0	2.00	14,000.00	28,000.00
231654	VENDAS DE GASA	0	2.00	12,000.00	24,000.00
323454	VENDAS ELASTICAS	0	2.00	14,500.00	29,000.00
215465	VENDA TRIANGULARES	0	2.00	17,000.00	34,000.00
123798632	LIGADURAS PARA CORDON UMBILICAL	0	5.00	6,000.00	30,000.00
1223465	PINZAS ROCHESTER LARGAS	0	2.00	21,000.00	42,000.00
02454	TIJERAS DE EPISIOTOMIA	0	1.00	28,000.00	28,000.00
13247654	PERILLA DE SUCCION	0	1.00	12,000.00	12,000.00
21541	CAJA DE GUANTES	0	1.00	15,000.00	15,000.00
32635761	CAJA DE TAPABOCAS	0	1.00	15,000.00	15,000.00
171	GAFAS DE BIOPROTECCION	0	1.00	30,000.00	30,000.00
1268712	PAQUETES DE PAÑOS DESECHABLES	0	2.00	5,500.00	11,000.00
1978451	APOSITO DE GASA	0	2.00	4,500.00	9,000.00
313786312	APOSITO DE ALGODON	0	1.00	4,000.00	4,000.00
132171	SONDA NASOGASTRICAS	0	5.00	2,600.00	13,000.00
97813456	SONDAS DE NELATON	0	5.00	3,400.00	17,000.00
19791231	ROLLO DE ESPARADRAPO	0	2.00	4,500.00	9,000.00
2137812	ROLLO DE MICROPORE	0	2.00	7,500.00	15,000.00
,3168761	SABANAS PARA CAMILLA	0	5.00	7,800.00	39,000.00
22196871	BATAS DESECHABLES PARA PACIENTES	0	2.00	20,500.00	41,000.00
123781	SISTEMA GUARDIAN	0	1.00	9,000.00	9,000.00
16871	SOLUCION SALINA AL 9%	0	6.00	4,833.33	29,000.00
12354651	LACTATO DE RINGER	0	4.00	4,250.00	17,000.00
21687813121	BOLSAS DE DEXTROSA AL 5%	0	2.00	5,500.00	11,000.00
13247683112	BOLSA DE DEXTROSA AL 10%	0	1.00	5,000.00	5,000.00
12687123	NEBULIZADOR	0	1.00	650,000.00	650,000.00
216871	COBIJA PARA PACIENTE	0	1.00	45,000.00	45,000.00
168712	PINZA DE MANGUIL	0	1.00	39,000.00	39,000.00
31365768132	VASOS HUMIFICADOR SIMPLE	0	2.00	19,000.00	38,000.00
3216385761	GLUCOMETRO	0	1.00	250,000.00	250,000.00
168761	ASPIRADOR NASAL MANUAL	0	1.00	15,000.00	15,000.00
123798	VASOS HUMIFICADORES VENTURY	0	2.00	30,500.00	61,000.00
3168721	MICROCAMARA DE NEBULIZACION CON MASCARILLA PARA ADULTO	0	2.00	13,500.00	27,000.00

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Nit: 890702241-0 _64V13F44N

ENTRADAS ALMACEN No:

FC2 - 2019000167
Ago-30-2021
No.ext:259

Concepto SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y

Proveedor: **JORGE LOPEZ** CC/Nit: **900093151-7** Afecta: -

Direcc: **CALLE 34 SUR NO. 69-73**
BOGOTA D.C. - BOGOTA

Plazo: **0** **Ago-30-2021**

1698723	MICROCAMARA DE NEBULIZACION CON MASCARILLA PEDIATRICA	0	2.00	13,500.00	27,000.00
1248564321321	PERICRANEALES O AGUJAS TIPO MARIPOSA DE DIFERENTES TAMAÑOS	0	5.00	6,400.00	32,000.00
0165746513	EQUIPOS DE MACROGOTEO	0	6.00	7,333.33	44,000.00
01354	EQUIPO DE MICROGOTEO	0	3.00	966.67	2,900.00
2135764432	TORNIQUETES PARA ACCESO IV	0	2.00	19,500.00	39,000.00
054651	TORNIQUETE PARA HEMORRAGIAS	0	1.00	85,000.00	85,000.00
17481	JERINGAS DESECHABLES DE DIFERENTES TAMAÑOS (1CC A 50CC)	0	6.00	5,500.00	33,000.00
1263571	YELCOS DE DIFERENTES TAMAÑOS	0	6.00	7,500.00	45,000.00
3125476651	EQUIPO DE PEQUEÑAS CIRUGIA	0	1.00	59,000.00	59,000.00
12674643147	TIJERAS CORTA TODO	0	1.00	25,000.00	25,000.00
7987451	DISPOSITIVO PARA CORTAR ANILLOS	0	1.00	41,000.00	41,000.00
31571	FRASCO CON JABON ANTISEPTICO	0	1.00	35,000.00	35,000.00
1687964	FRASCO CON JABON QUIRURGICO	0	1.00	23,000.00	23,000.00
321685761	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA	0	1.00	3,990,000.00	3,990,000.00
12713134	MONITOR DE SIGNOS VITALES	0	1.00	4,500,000.00	4,500,000.00
1326871	CILINDRO DE OXIGENO DE 3.5 M ALUMINIO,TOMA DE PARED, MANGUERA, RE	0	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00
13578651	CILINDRO PORTATIL 0.5 M CON REGULADOR	0	1.00	1,300,000.00	1,300,000.00
231681	BARRA DE LUCES TIPO LED	0	1.00	2,100,000.00	2,100,000.00
16981	MINI BARRA DE LUCES TIPO LED	0	1.00	1,300,000.00	1,300,000.00
1871231	EXPLORADORAS DELANTERAS LED	0	2.00	850,000.00	1,700,000.00
1781	LUCES INTERMITENTES ROJO Y BLANCO LED	0	2.00	475,000.00	950,000.00
16871231	EXPLORADORA TRASERA LED	0	1.00	995,000.00	995,000.00
123476541	LUCES LATERALES LED	0	10.00	250,000.00	2,500,000.00
136541	LUCES EXTERIORES ROJO BLANCO	0	4.00	1,182,500.00	4,730,000.00
14574121	EXTRACTOR DE OLORES	0	1.00	450,000.00	450,000.00
1357531	BATERIA ADICIONAL CON MASTER	0	1.00	1,600,000.00	1,600,000.00
213654681	PITO DE REVERSA	0	1.00	350,000.00	350,000.00
21685421	EXTINTOR POLVO POLIVALENTE ABC DE 5 LIBRAS	0	1.00	38,000.00	38,000.00
2316354	CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICAS	0	1.00	51,000.00	51,000.00
2136432	ALICATE DE MANGO AISLADO	0	1.00	25,000.00	25,000.00
3218431	DESTORNILLADORES DE PALA	0	3.00	8,333.33	25,000.00
3136871	DESTORNILLADORES DE ESTRELLA	0	3.00	8,333.33	25,000.00
1371	JUEGO DE LLAVES FIJAS	0	1.00	53,000.00	53,000.00
321345341	LLAVE INGLES	0	1.00	69,000.00	69,000.00
12341634	MARTILLO METALICO	0	1.00	15,000.00	15,000.00
123871	CHALECOS FLUORESCENTE	0	2.00	18,500.00	37,000.00
236412	LAMPARA RECARGABLE	0	1.00	29,000.00	29,000.00
21334321	FUSIBLES SURTIDOS	0	5.00	9,800.00	49,000.00
032540	PALANCA PATECABRA	0	1.00	55,000.00	55,000.00
132112	CUERDA CON GANCHOS DE TRACCION 20 M	0	1.00	43,000.00	43,000.00
23136541	CABLE DE RED URBANA	0	1.00	51,000.00	51,000.00
23135412	JUEGO DE CABLES DE IGNICION	0	1.00	950,000.00	950,000.00
2165461	CUCHILLA PARA ROMPER CINTURONES DE SEGURIDAD	0	1.00	9,000.00	9,000.00
13541	TIJERA CORTA LAMINA	0	1.00	51,000.00	51,000.00
2312347651	CARROCERIA DE AMBULANCIA,CAMAROTE, INSTLACION FRANJAS Y LOGOTIPOS	0	1.00	26,855,000.00	26,855,000.00

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Nit: 890702241-0 _64V13F44N

Concepto SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y Pág: 4

ENTRADAS ALMACEN No:

FC2 - 2019000167
Ago-30-2021
No.ext:259

Proveedor: **JORGE LOPEZ** OC/Nit: **900093151-7** Afecta: -

Direcc: **CALLE 34 SUR NO. 69-73**
BOGOTA D.C. - BOGOTA

Plazo: **0** **Ago-30-2021**

Detalle Retenciones			
RetFte	0		
RetIva	0		
RetIca	0	Sobretasa	0
RetCre	0		

Iva	Tarifa	Base	Vr.Iva
	0%	204,000,000	

Subtotal	204,000,000.00
Iva	0.00
Retencion	0.00
Dto.Fin	0.00
Total	**204,000,000.00**

Imputación contable

Codigo	Tercero	C.Costo	Detalle	Base	Db/Cr
190604	900093151		SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA		102,000,000.00 CR
243612001	900093151		SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA		1,714,286.00 CR
243625001	900093151		SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA		4,885,714.00 CR
163501008	900093151		SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C		117,000,000.00 DB
163501008	900093151		SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 M		1,150,000.00 DB
163501008	900093151		SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 P		1,350,000.00 DB
163501008	900093151		SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 P		1,100,000.00 DB
163501008	900093151		SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 R		2,500,000.00 DB
163501008	900093151		SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 I		1,300,000.00 DB
163501008	900093151		SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 B		500,000.00 DB
163501008	900093151		SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 A		3,750,000.00 DB
163501008	900093151		SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 M		4,000,000.00 DB
163501008	900093151		SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 M		2,700,000.00 DB
163501008	900093151		SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 T		190,000.00 DB
163501008	900093151		SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 U		120,000.00 DB

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Nit: 890702241-0 _64V13F44N

Concepto SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y Pág: 5

ENTRADAS ALMACEN No:

FC2 - 2019000167
Ago-30-2021
No.ext:259

Proveedor: **JORGE LOPEZ** OC/Nit: **900093151-7** Afecta: -

Direcc: **CALLE 34 SUR NO. 69-73**
BOGOTA D.C. - BOGOTA

Plazo: **0** **Ago-30-2021**

163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 U	560,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 U	180,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 U	240,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 L	780,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C	470,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 S	65,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C	65,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 D	79,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 M	65,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 S	700,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C	2,700,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 R	170,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 T	40,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 R	90,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 P	70,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 P	70,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 M	30,000.00 DB

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Nit: 890702241-0 _64V13F44N

Concepto SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y Pág: 6

ENTRADAS ALMACEN No:

FC2 - 2019000167
Ago-30-2021
No.ext:259

Proveedor: **JORGE LOPEZ** CC/Nit: **900093151-7** Afecta: -

Direcc: **CALLE 34 SUR NO. 69-73**
BOGOTA D.C. - BOGOTA

Plazo: **0** **Ago-30-2021**

163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 L	12,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 F	45,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 F	45,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 T	43,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 T	43,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 M	25,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 A	1,024,100.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 A	49,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 A	49,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C	43,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 M	46,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 M	46,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 M	58,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 M	58,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 S	74,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 S	74,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C	26,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C	26,000.00 DB

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Nit: 890702241-0 _64V13F44N

Concepto SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y Pág: 7

ENTRADAS ALMACEN No:

FC2 - 2019000167
Ago-30-2021
No.ext:259

Proveedor: **JORGE LOPEZ** CC/Nit: **900093151-7** Afecta: -

Direcc: **CALLE 34 SUR NO. 69-73**
BOGOTA D.C. - BOGOTA

Plazo: **0** **Ago-30-2021**

151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 A	56,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 A	56,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 A	35,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 M	39,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C	39,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C	34,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 I	44,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 J	28,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 V	24,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 V	29,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 V	34,000.00 DB
151407001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 V	30,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 L	42,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 P	28,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 T	12,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 P	15,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C	15,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C	30,000.00 DB
		SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 G	

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Nit: 890702241-0 _64V13F44N

Concepto SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y Pág: 8

ENTRADAS ALMACEN No:

FC2 - 2019000167
Ago-30-2021
No.ext:259

Proveedor: **JORGE LOPEZ** CC/Nit: **900093151-7** Afecta: -

Direcc: **CALLE 34 SUR NO. 69-73**
BOGOTA D.C. - BOGOTA

Plazo: **0** **Ago-30-2021**

151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 P	11,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 A	9,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 A	4,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 S	13,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 S	17,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 R	9,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 R	15,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 S	39,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 B	41,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 S	9,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 S	29,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 L	17,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 B	11,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 B	5,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 N	650,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C	45,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 P	39,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 V	38,000.00 DB

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Nit: 890702241-0 _64V13F44N

Concepto SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y Pág: 9

ENTRADAS ALMACEN No:

FC2 - 2019000167
Ago-30-2021
No.ext:259

Proveedor: **JORGE LOPEZ** CC/Nit: **900093151-7** Afecta: -
Direcc: **CALLE 34 SUR NO. 69-73** Plazo: **0** **Ago-30-2021**
BOGOTA D.C. - BOGOTA

163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 G	250,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 A	15,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 V	61,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 M	27,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 M	27,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 P	32,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 E	44,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 E	2,900.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 T	39,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 T	85,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 J	33,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 Y	45,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 E	59,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 T	25,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 D	41,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 F	35,000.00 DB
151404001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 F	23,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 D	3,990,000.00 DB

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Nit: 890702241-0 _64V13F44N

Concepto SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y Pág: 10

ENTRADAS ALMACEN No:

FC2 - 2019000167
Ago-30-2021
No.ext:259

Proveedor: **JORGE LOPEZ** CC/Nit: **900093151-7** Afecta: -

Direcc: **CALLE 34 SUR NO. 69-73**
BOGOTA D.C. - BOGOTA

Plazo: **0** **Ago-30-2021**

163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 M	4,500,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C	2,500,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C	1,300,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 B	2,100,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 M	1,300,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 E	1,700,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 L	950,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 E	995,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 L	2,500,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 L	4,730,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 E	450,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 B	1,600,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 P	350,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 E	38,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C	51,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 A	25,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 D	25,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 D	25,000.00 DB

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Nit: 890702241-0 _64V13F44N

Concepto SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y **Pág:** 11

ENTRADAS ALMACEN No:

FC2 - 2019000167
Ago-30-2021
No.ext:259

Proveedor: **JORGE LOPEZ** CC/Nit: **900093151-7** Afecta: -
Direcc: **CALLE 34 SUR NO. 69-73** Plazo: **0** **Ago-30-2021**
BOGOTA D.C. - BOGOTA

163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 J	53,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 L	69,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 M	15,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C	37,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 L	29,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 F	49,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 P	55,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C	43,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C	51,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 J	950,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C	9,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 T	51,000.00 DB
163501008	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259 C	26,855,000.00 DB
240101001	900093151	SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB CHASIS NISSAN CONVENIO GOBERNACION Y ALCALDIA 259	95,400,000.00 CR

Elaboró	Revisó	Aprobó
ANDREA MARCELA		

Total **95,400,000.00**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023654923

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
GRS557	NISSAN	FRONTIER	2022

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.488	BLANCO	OFICIAL

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	AMBULANCIA	DIESEL	

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
YD25-734347P	N	3N6CD35B8ZK435056

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
3N6CD35B8ZK435056	N	3N6CD35B8ZK435056	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D	NIT 890702241

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	161

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
482021000344003	I	15/06/2021	0


LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
12/08/2021	12/08/2021	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DPTO ADTVO TTOYTTE TOLIMA/GUAMO

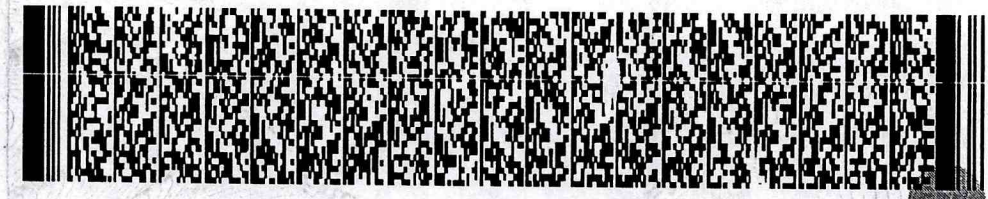

LT02006683857

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO MES DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO MES DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO MES DÍA
2021-08-11	2021-08-12	2022-08-11

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
10211000006640	GRS557	OFICIALES,ESPECIALES,	OFICIAL	2488	2022

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	NISSAN	AMBULANCIA
	LÍNEA VEHICULO: FRONTIER	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
YD25734347P	3N6CD35B8ZK435056	3N6CD35B8ZK435056	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL CARMEN	2478175	NIT	8907022410	CARMEN DE APIC

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	25	20189	0	IBAGUE

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
420	$ 615600	$ 307800	$ 1800

TOTAL A PAGAR

$ 925200

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	MÍNIMOS
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	LEGALES DIARIOS
D GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	VIGENTES

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Protección de datos personales:

Como consumidor financiero obrando a nombre propio o de un tercero debidamente facultado para ello, autorizo de manera previa, expresa e informada a SEGUROS DEL ESTADO S.A Y SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. (las Aseguradoras) para que mis datos personales y sensibles sean tratados con las siguientes finalidades:

a) La gestión y ejecución integral del contrato de seguros al vincularme como cliente; hacer transferencia nacional o internacional cuando sea necesario para la prestación del servicio.

b) Recibir, procesar y compartir mi información con su grupo empresarial, filiales o subsidiarias, centrales de riesgo, proveedores, intermediarios de Seguros, canales de comercialización y otros encargados del tratamiento que resulten necesarios para la celebración, ejecución o extinción de seguros, estadísticas y/o solicitud o reporte del cumplimiento de las obligaciones contractuales, financieras o crediticias a centrales de información y de riesgos.

c) Para las demás contempladas en las disposiciones legales vigentes y en la política de Tratamiento de Datos de las Aseguradoras.

d) Para el envío de información, beneficios, ofertas de productos, incluida su prórroga, recordar el vencimiento de la póliza, renovación o modificación, fines comerciales y para ser contactado directamente o a través de sus canales de comercialización.

Será facultativa la autorización de las respuestas a las preguntas sobre el tratamiento de datos sensibles o de menores de edad. Como Titular de mis datos personales tengo derecho a conocerlos, actualizarlos, revocarlos, y solicitar la supresión cuando proceda, de conformidad con las Políticas de Tratamiento de Datos publicadas en las páginas www.segurosdelestado.com y www.segurosdevidadelestado.com Los responsables del tratamiento de sus datos son las ASEGURADORAS.

El Titular podrá ejercer sus derechos a través de cualquiera de los canales establecidos para tal fin, como lo son:
- Oficinas de SEGUROS DEL ESTADO a nivel nacional
- Sitio web: A través de las páginas www.segurosdelestado.com y www.segurosdevidadelestado.com
- Contáctenos. Correo electrónico: info@segurosdelestado.com

ARCRON

Bogotá, 28 de agosto de 2021

SEÑORES
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE CCARMEN DE APICALA I NIVEL
NIT. 890.702.241-0

REF: CERTIFICACION

Por medio de la presente me permito informar que el Chasis Nissan Frontier Modelo 2022 de placas **GRS 557** matriculada en Guamo - Tolima tiene una garantía directa del concesionario Nissan a Nivel Nacional de Tres (3) años o 100.000 km, lo primero que suceda

Agradezco su atención prestada.

Atentamente

Jorge López Sierra
CC: 79'292.472 Btá.
Gerente Arcron SAS

Quien Recibe
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
NIT: 890.702.241-0
CORRESPONDENCIA
FECHA RECIBIDO 28/08/2021 10:43 Am
QUIEN RECIBE
DESTINO Oc

Nombre: Andrea Cano
C.C: 1006868512
Cargo: Aux Adm SIAU

Tel: 238 0614 - Cel: 315 315 7190
Fax: 403 9211
www.arcron.com.co
j.lopez@arcron.com.co
Calle 34 Sur Nº 69 - 73
Barrio Carvajal - Bogotá, D.C.

ARCRON

Bogotá, 28 de agosto de 2021

SEÑORES
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE CCARMEN DE APICALA I NIVEL
NIT. 890.702.241-0

REF: CERTIFICACION

Por medio de la presente me permito certificar la calidad de la fabricación y dotación de la ambulancia de placa **GRS 557**, se garantiza por un periodo de un (1) año por defectos de fábrica, la garantía no cubre mala manipulación.

Esta garantía cubre los siguientes ítems:

- Carrocería de la ambulancia y todas sus partes que la componen.
- Dotación básica.
- Equipos médicos.

Agradezco su atención prestada.

Atentamente

Jorge López Sierra
CC: 79'292.472 Btá.
Gerente Arcron SAS

Quien Recibe
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
NIT. 890.702.241-0
FECHA RECIBIDO 28/08/2021 703 am
QUIEN RECIBE
DESTINO
FOLIOS

Nombre:
C.C:
Cargo: Aux Administrativo

Tel: 238 0614 - Cel: 315 315 7190
Fax: 403 9211
www.arcron.com.co
j.lopez@arcron.com.co
Calle 34 Sur Nº 69 - 73
Barrio Carvajal - Bogotá, D.C.

ARCRON

Bogotá, 28 de agosto de 2021

SEÑORES

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE CCARMEN DE APICALA I NIVEL
NIT. 890.702.241-0

REF: INFORMACION

Por medio de la presente me permito notificar que nuestra empresa ARTICULOS CROMADOS ARCRON SAS Nit: 900.09.151-7 les hace las siguientes recomendaciones al usar el equipo de la ambulancia como lo son:

- Lámpara de luz fría
- Inversor de corriente
- Sirena
- Luces altas

Deben ser utilizados únicamente con el vehículo encendido ya que si no se realiza de esta manera la batería del carro sufre alteraciones por el nivel de energía que consumen estos equipos y por lo tanto sufre daños colaterales que no siempre se presentan al instante si no al transcurrir unas horas o incluso al día siguiente.

- Cuando la ambulancia haya tenido un recorrido de distancia considerable al llegar al destino final no se debe apagar inmediatamente, se debe dejar de 10 a 15 minutos, esto con el fin de que a futuro no sufra inconvenientes de recalentamiento
- Las chapas de las puertas deben ser manipuladas de forma correcta como se explicó en la entrega para que con su buen uso no hayan daños de las mismas.

Por lo tanto solicitamos que tengan muy encuentra estas recomendaciones para el óptimo funcionamiento de la ambulancia.

Agradezco su atención prestada.

Atentamente

Jorge López Sierra
CC: 79'292.472 Btá.
Gerente Arcron SAS

Quien Recibe

Nombre:
C.C:
Cargo:

Tel: 238 0614 - Cel: 315 315 7190
Fax: 403 9211
www.arcron.com.co
j.lopez@arcron.com.co
Calle 34 Sur N° 69 - 73
Barrio Carvajal - Bogotá, D.C.

ARCRON

Bogotá, 28 de agosto de 2021

SEÑORES

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE CCARMEN DE APICALA I NIVEL
NIT. 890.702.241-0

Asunto: Entrega de ambulancia Nissan Frontier NP300.

Número de chasis: 3N6CD35B8ZK435056
Número de Motor: YD25-734347P
Número Vin: 3N6CD35B8ZK435056
Placa No: GRS 557

Se entrega el vehículo anteriormente mencionado con los siguientes elementos:

CABINA:

- Tarjeta de propiedad del vehículo.
- SOAT Vehículo.
- Un (1) Monitor de cámara de reversa accionado de la parte del conductor.
- Un (1) Manual del vehículo.
- Dos (2) Llaves del vehículo.
- Un (1) Panel de control Sirena y Perifoneo.
- Un (1) Panel de control Luces Ambulancia.
- Un (1) Radio teléfono de comunicaciones.
- Herramienta original del vehículo.
- Un (1) Gato Hidráulico Original del vehículo.
- Un (1) Extintor de 5 libras.

ARCRON

PARTE EXTERIOR

- Señalización de franjas y logotipos según lo estipulado y aprobado anteriormente.
- Barra de luces tipo LED
- Mini barra de luces tipo LED
- Dos exploradoras delanteras LED.
- Cuatro luces intermitentes rojo y blanco LED laterales
- Una exploradora trasera LED
- Seis luces laterales LED Rojo
- Cuatro Luces LED laterales Blanco
- Un extractor de olores.
- Batería adicional con máster.
- Pito de reversa.

COMPARTIMIENTO DEL PACIENTE

- Un (1) Inversor de 12 voltios de 2000 vatios con sus respectivas tomas.
- Una (1) Batería adicional.
- Una (1) Unidad de aire acondicionado parte delantera y trasera del vehículo.
- Piso antideslizante instalado en el compartimiento del paciente, y lámina de acero inoxidable en la parte donde se desliza la camilla de dos niveles.
- Un (1) Mueble de gavetas, puertas en acrílico transparente, marcadas con sus respectiva señalización, con correas de seguridad, y en el cubículo de la bala de oxigeno de 3.5 M^3 va con sus respectivos soportes y correas.
- Un (1) Mueble con tres puestos para tripulación, con tres cinturones de seguridad de dos puntos y espaldares individuales para acompañante.
- Una (1) Rampa de acceso para la camilla parte trasera de la ambulancia.
- Una (1) Camilla de dos niveles con atril porta suero y tres cinturones de seguridad de dos puntos
- Una (1) Silla de ruedas portátil con cinturón de seguridad de dos puntos.
- Una (1) Tabla cervical plástica y su respectivo arnés.
- Una (1) Tabla espinal plástica con su respectivo arnés.
- Una (1) Silla paramédica abatible con dos cinturones de seguridad de dos puntos.
- Una (1) Barra de ganchos para líquidos.
- Una (1) Barra pasamanos.

Tel: 238 0614 - Cel: 315 315 7190
Fax: 403 9211
www.arcron.com.co
j.lopez@arcron.com.co
Calle 34 Sur Nº 69 - 73
Barrio Carvajal - Bogotá, D.C.

- Una (1) Lámpara de luz fría.
- Cinco (5) Luces de techo.
- Seis (6) Tomas dobles de 110 V.
- Una (1) Caneca de desechos verde.
- Una (1) Caneca de desechos roja.
- Un (1) Dispensador de jabón.
- Dos (2) Martillos rompe vidrios.
- Un (1) Sistema guardián de 1 litro.

DOTACION

- Una (1) Capsula de aislamiento para pacientes con posible COVID-19.
- Un (1) Kit Tensiómetro y Fonendoscopio Adulto Ficha técnica certificado de calibración y registro INVIMA
- Un (1) Tensiómetro Pediátrico Ficha técnica certificado de calibración y registro INVIMA
- Un (1) Aspirador nasal manual.
- Un (1) Inmovilizador lateral de cabeza
- Un (1) Paquete de paños desechables
- Un (1) Paquete de apósitos de algodón
- Dos (2) Vasos humidificadores ventury
- Una (1) Máscara de no reinhalación adulto
- Una (1) Máscara de no reinhalación pediátrico
- Una (1) Cobija para el paciente
- Una (1) Riñonera en acero inoxidable
- Un (1) Pato orinal en acero inoxidable
- Un (1) Pato coprológico en acero inoxidable
- Un Regulador para cilindro portátil (sn:20200806602)
- Un (1) Termómetro digital Ficha técnica y registro INVIMA
- Una (1) Linterna de examen
- Un (1) Fonendoscopio Pediátrico Ficha técnica cerificado de calibración y registro INVIMA
- Una (1) Manta térmica
- Un (1) Ambu adulto con máscara y bolsa de reservorio
- Un (1) Ambu pediátrico con máscara y bolsa de reservorio
- Tres (3) Cánulas de guedell de tamaño (0)
- Tres (3) Cánulas de guedell de tamaño (1)
- Tres (3) Cánulas de guedell de tamaño (2)
- Tres (3) Cánulas de guedell de tamaño (3)
- Tres (3) Cánulas de guedell de tamaño (4)
- Tres (3) Cánulas de guedell de tamaño (5)
- Una (1) Máscara de oxígeno adulto
- Una (1) Máscara de oxígeno pediátrico

- Dos (2) Sistemas ventury adulto
- Dos (2) Sistema ventury pediátrico
- Una (1) Cánula nasal adulto
- Una (1) Cánula nasal pediátrica
- Dos (2) Aditamento Supraglotico Adulto
- Dos (2) Aditamentos Supraglotico Pediátrico
- Una (1) Mangueras de oxigeno
- Dos (2) Collares cervicales Adultos
- Dos (2) Collares cervicales Pediátricos
- Un (1) Juego de Férulas para brazo, antebrazo, pierna y pie acartonadas
- Dos (2) Vendas de algodón
- Dos (2) Vendas de gasa
- Dos (2) Vendas elásticas
- Dos (2) Vendas triangulares

Equipo de parto:

- Cinco (5) Ligaduras para cordón umbilical
- Dos (2) Pinzas Rochester largas.
- Una (1) Tijera de episiotomía
- Una (1) Perilla de succión
- Una (1) Caja de guantes
- Una (1) Caja de tapabocas
- Una (1) Gafas de bioproteccion
- Dos (2) Apósitos de gasa
- Cinco (5) Sondas naso gástricas
- Cinco (5) Sondas de nelaton
- Dos (2) Rollos de esparadrapo
- Dos (2) Rollos de micropore
- Cinco (5) Sabanas para camilla
- Dos (2) Batas desechables para paciente
- Seis (6) Solución salina al 9%
- Cuatro (4) Lactato de ringuer
- Dos (2) Bolsas de Dextrosa al 5%
- Una (1) Bolsa de Dextrosa al 10%
- Un (1) Nebulizador (serie: 20204530100017S6) Ficha técnica y registro INVIMA
- Una (1) Pinza de Maguill
- Dos (2) Vasos humidificadores simple
- Dos (2) Microcámara de nebulización con mascarilla para adulto
- Dos (2) Microcámara de nebulización con mascarilla pediátrica
- Cinco (5) Pericraneales o agujas tipo mariposa de diferentes tamaños
- Tres (3) Equipos de microgoteo

- Seis (6) Equipos de macrogoteo
- Dos (2) Torniquetes para acceso IV
- Un (1) Torniquete para hemorragias
- Seis (6) Jeringas desechables de diferentes tamaños (1cc a 50 cc)
- Seis (6) Yelcos de diferentes tañamos
- Un (1) Equipo de pequeña cirugía
- Una (1) Tijera cortatodo
- Un (1) Dispositivo para cortar anillos
- Un (1) Frasco con jabón antiséptico
- Un (1) Frasco con jabón quirúrgico
- Un (1) Glucómetro. (Serie: YL12NJ034910) Ficha técnica y registro INVIMA

EQUIPOS E INSUMOS TRASLADO ASISTENCIAL BASICO

- Desfibrilador externo automático (DEA: Mindray BeneHeart D1 serie:FQ-13056592) con su respectivo (manual de instrucciones, ficha técnica, registro invima, declaración de importación y hoja de vida)
- Aspirador de secreciones (succionador Serie: 201015704030150) con su respectiva documentación (manual de instrucciones, ficha técnica, registro invima, declaración de importación, hoja de vida y certificado y patronos de calibración).
- Monitor de signos vitales marca Mindray IMEC8 (serie: EW-13073604) con su respectiva documentación. (manual de instrucciones, ficha técnica, registró invima, declaración de importación, hoja de vida y certificado y patronos de calibración).
- Un (1) cilindro de oxígeno de 3.5 M^3 en aluminio con su respectiva toma de pared, manguera, regulador (sn:1622320) y flujómetro (sn:1340417)
- Un (1) cilindro portátil de 0.5 M^3.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Un (1) Extintor de polvo polivalente ABC de 5 LIBRAS, instalado en la parte trasera del vehículo.
- Un (1) Juego de cables de ignición
- Dos (2) Tacos de madera
- Una (1) Lámpara recargable
- Una (1) Caja de herramientas plástica
- Una (1) Palanca patecabra
- Dos (2) Chalecos fluorescente.
- Fusibles surtidos
- Un (1) Alicate de mango aislado
- Tres (3) Destornilladores de pala

ARCRON

- Tres (3) Destornilladores de estrella
- Juego de llaves fijas
- Una (1) Llave ingles
- Un (1) Martillo metálico
- Cuchilla para romper cinturones de seguridad. (bisturí)
- Una (1) Tijera corta lamina.
- Un (1) Cable de red urbana
- Una (1) Cuerda con ganchos de tracción 20 m
- Un (1) Rueda de repuesto original del vehículo.

Atentamente;

Quien Entrega

JORGE LOPEZ SIERRA
CC: 79'292.472 Btá.
Gerente Arcron SAS

Quien Recibe

28/AGOSTO/2021 7013AM

Nombre: Julio Cesar
C.C: 7108060 D
Cargo: AUX Aseo

Tel: 238 0614 - Cel: 315 315 7190
Fax: 403 9211
www.arcron.com.co
j.lopez@arcron.com.co
Calle 34 Sur Nº 69 - 73
Barrio Carvajal - Bogotá, D.C.

HOSPITAL
NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN
¡Trabajamos con el CORAZÓN!

ORDEN DE SUMINISTROS

ORDEN No.020	07 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CLASE DE ORDEN	SUMINISTROS
CONTRATISTA	**RADAR GPS COLOMBIA SAS**
VALOR	$663.950
PLAZO	OCHO (08) DÍAS
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO GPS PARA VEHÍCULO AMBULANCIA QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIONES 3100 DE 2019 "SISTEMA DE GEORREFERENCIACIÓN Y COMUNICACIÓN, QUE PERMITA EL MONITOREO Y CONTACTO CON LA ENTIDAD TERRITORIAL EN SALUD A TRAVÉS DEL CRUET" Y 926 DE 2017. AMBULANCIA GRS-557 DEL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.

Entre los suscritos YEIMY CAROLINA MURILLO GUARNIZO mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 28.980.258 expedida en Venadillo, actuando en nombre y representación del **HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN E.S.E.** y quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE Y/O HOSPITAL** y por la otra, **RADAR GPS COLOMBIA SAS,** representada legalmente por **CARLOS HUMBERTO OLARTE ARIAS** identificado con la C.C. 1.022.351.481 quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** domiciliado en Calle 47 No 4-61 Barrio Piedra pintada Ibagué, y quien para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar la presente Orden de suministro, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **Primera. – Objeto. EL CONTRATISTA** se obliga para con **EL CONTRATANTE** al SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO GPS PARA VEHÍCULO AMBULANCIA QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIONES 3100 DE 2019 "SISTEMA DE GEORREFERENCIACIÓN Y COMUNICACIÓN, QUE PERMITA EL MONITOREO Y CONTACTO CON LA ENTIDAD TERRITORIAL EN SALUD A TRAVÉS DEL CRUET" Y 926 DE 2017. AMBULANCIA GRS-557 DEL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN – **OBLIGACIONES: - DEL CONTRATISTA,** 1. realizar el suministro de un equipo GPS TELTONIKA -comunicación datos, con botón de pánico, apagado remoto y botón de disponibilidad con garantía de un año por defectos del

dispositivo. 2. realizar la instalación del mismo en la ambulancia TAB de placas grs-557 de propiedad de la ese, 3. Realizar los soportes requeridos para las actualizaciones del software sin costos adicionales. 4. programar el equipo AVL suministrado conforme la normatividad "resoluciones 3100 de 2019 "sistema de georreferenciación y comunicación, que permita el monitoreo y contacto con la entidad territorial en salud a través del CRUET" y 926 de 2017". 5. garantizar el cubrimiento a nivel nacional del dispositivo suministrado, 6. Realizar las pruebas del producto, 7. Realizar capacitación sobre el manejo del sistema al personal indicado por el hospital 7. Realizar soporte 7x24, 8. Realizar las revisiones necesarias del equipo suministrado, 9. Realizar y garantizar las demás actividades y beneficios contenidos en la propuesta entregada por el contratista, **PLAZO DE LA ORDEN** El plazo para la ejecución de la presente Orden de suministro, será de OCHO (08) días, a partir del 07 de Septiembre de 2021 hasta el 15 de Septiembre de 2021 Tercera. – Valor. El valor de la orden es por la suma SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS ($663.950). **ESTAMPILLAS.** El Contratista deberá cancelar él (6.5%) sobre el valor del contrato antes de IVA por concepto de estampillas así: PROCULTURA, valor de la Consignación él (1%), PROANCIANOS, valor de la Consignación él (4%), PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN valor de la Consignación él (1.5%) requisitos que se entienden cumplidos con la presentación de las respectivas estampillas Cuarta. – **FORMA DE PAGO**. El valor pactado en la cláusula anterior será cancelado con la certificación de cumplimiento de los elementos suministrados, previa la presentación de la factura de venta y entrada almacén en la institución. Quinta. - Obligaciones de EL CONTRATANTE. Solicitar los suministros requeridos y señalados y estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. Sexta. - Obligaciones de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los suministros requeridos y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del suministro. Séptima. – Vigilancia de la orden. EL CONTRATANTE o su representante supervisarán que los elementos contratados en cantidad y calidad. Octava. – Imputación. Para efectos de la cancelación del suministro contratado, se imputa a cargo del presupuesto 2021, según certificado de disponibilidad presupuestal Anexa. Novena. - Terminación. La presente orden podrá darse por terminado por mutuo acuerdo entre las dos partes, o en forma unilateral por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la orden, por cualquiera de ellas. Décima. Independencia de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA, actuará por su propia cuenta, con absoluta autonomía y no estará sometido a subordinación laboral con EL CONTRATANTE y sus derechos se limitarán, de acuerdo con la naturaleza de la orden, a exigir el cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATANTE y al pago de las sumas equivalentes a los suministros entregados. Décima primera. – Cesión de la orden. EL CONTRATISTA, no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución de la presente orden a un tercero salvo previa autorización expresa y escrita del CONTRATANTE. Décima segunda. – Domicilio contractual. Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será el Municipio del Carmen de Apicalá y las notificaciones serán recibidas por las partes

en las siguientes direcciones: por EL CONTRATANTE en: El Hospital Nuestra Señora del Carmen E. S. E, Calle 47 No 4-61 Barrio Piedra pintada Ibagué. EL CONTRATISTA en: Cra 6 No. 2-02 Barrio Lusitania Carmen de Apicalá. Décima tercera. – Cláusula compromisoria. Toda controversia o diferencia relativa a esta orden, su ejecución y liquidación, se resolverá por el mecanismo de Conciliación extrajudicial. Décima cuarta. – Declaración. EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad de las legalmente establecidas para celebrar contratos con el Hospital Nuestra Señora del Carmen E. S. E. De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el presente documento a los Siete (07) días del mes de Septiembre del año Dos Mil Veintiún (2021), en el Carmen de Apicalá Tolima.

EL CONTRATANTE

YEIMY CAROLINA MURILLO G
GERENTE

EL CONTRATISTA

RADAR GPS COLOMBIA SAS
CARLOS HUMBERTO OLARTE
Rte Legal

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
¡Trabajamos con el CORAZÓN!

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN E.S.E.

HOJA DE VIDA DE EQUIPO



INFORMACION DEL EQUIPO	
EQUIPO: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	MARCA: MINDRAY
MODELO: BENEHEART D1	SERIE / TIPO: FQ-13056592
Nº INVENTARIO / ACTIVO: NO REGISTRA	REGISTRO INIVIMA: 2020EBC-0005463-R1
SERVICIO: TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	UBICACIÓN: T.A.B GRS-557

REGISTRO DE COMPRA			
FORMA DE ADQUISICION: COMPRA [X] COMODATO [ ] DONACION [ ]			
FECHA DE ADQUISICION	AGOSTO 2021		
FECHA DE INSTALACION	AGOSTO 2021		
FECHA VENC. GARANTIA	AGOSTO 2022		
PROVEEDOR	ARCRON	VIDA UTIL (Años)	N/R
FABRICANTE	NO REGISTRA		

REGISTRO TECNICO	
VOLTAJE: 14.8V DC	FRECUENCIA: NO APLICA
CORRIENTE: 3Ah	POTENCIA: NO REGISTRA
PRESION: 57,0 a 106,2 kPa	TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO: 0 -50° C
TECNOLOGIA PREDOMINANTE: ELECTRONICO	

REGISTRO DE COMPONENTES / ACCESORIOS			
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE
Bateria	Mindray	LM34S001A	N/R
Electrodos para desfibrilación adu/ped	Mindray	N/R	N/R

REGISTRO DE APOYO TECNICO			
CLASIFICACION SEGÚN RIESGO		CLASIFICACION BIOMEDICA	
I [ ] IIA [ ] IIB [X] III [ ]		DIAGNOSTICO	
		PREVENCION	
		REHABILITACION	
MANUALES		ANALISIS DE LABORATORIO	
OPERACIÓN	X	TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA	X
MANTENIMIENTO			

RECOMENDACIONES DE FABRICANTE

PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO				CALIBRACION	
BIMESTRAL		TRIMESTRAL	X	REQUIERE CALIBRACION	NO
SEMESTRAL		ANUAL		PERIODICIDAD CALIBRACION	NO APLICA

Elaborado por: EQUIMEDICAS MANTENIMIENTO	Revisado por: Calidad	Aprobado por: Gerencia

RESOLUCIÓN No. 2020015754 DE 19 de Mayo de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Permiso de Comercialización

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2010006457 del 19 de Marzo de 2010 el INVIMA concedió Permiso de comercialización No. INVIMA2010EBC-0005463 para el producto DESFRIBILADOR CARDIACO MINDRAY ACCESORIOS Y REPUESTOS a favor de SHENZHEN MINDRAY BIO - MEDICAL ELECTRONICS CO .LTD. CON DOMICILIO EN CHINA en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante escrito 20191230539 del 22 de Noviembre de 2019, el Doctor XIAO HUAMING actuando en calidad de Representante Legal de la empresa SHENZHEN MINDRAY BIO - MEDICAL ELECTRONICS CO .LTD. , solicita Renovación al Permiso de Comercialización para el producto DESFIBRILADOR.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la Concesión de Renovación de un Permiso de Comercialización con base en la documentación allegada, previo estudio técnico y legal de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, en cumplimiento de los requisitos preceptuados en el Decreto 4725 de 2005, modificado por el Decreto 582 de 2017, se emitió concepto favorable para la autorización de este Permiso de Comercialización.

En consecuencia, LA DIRECTORA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Renovar PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN por el término de 10 años al

PRODUCTO:	DESFRIBILADOR
MARCA(S):	MINDRAY
PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN No.:	**INVIMA 2020EBC-0005463-R1**
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO.,LTD con domicilio en CHINA
FABRICANTE(S):	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO.,LTD con domicilio en CHINA
IMPORTADOR(ES):	MINDRAY MEDICAL COLOMBIA S.A.S. con domicilio en BOGOTA - D.C.; DISTRIBUCIONES CLINICAS SOCIEDAD ANONIMA - DISCLINICA S.A. con domicilio en BARRANQUILLA - ATLANTICO; JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS S.A.S - JOMEDICAL S.A.S con domicilio en BOGOTA - D.C.; SUMINISTROS INTEGRALES DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS "SUMINTEGRALES S.A.S." con domicilio en MONTERIA - CORDOBA; FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA SAS con domicilio en PIEDECUESTA - SANTANDER; INVERSIONES PROMEDCO SAS con domicilio en BOGOTA - D.C.; TECNICA ELECTRO MEDICA S.A. con domicilio en BOGOTA - D.C.; PROGRAL MEDICAL S.A.S. con domicilio en CARTAGENA - BOLIVAR; LAS ELECTROMEDICINA S.A.S. con domicilio en BOGOTA - D.C.; GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. con domicilio en BOGOTA - D.C.; INVERMEDICA LTDA con domicilio en CALI - VALLE; NOVA MEDICA

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020015754 DE 19 de Mayo de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Permiso de Comercialización

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	LTDA con domicilio en BARRANQUILLA - ATLANTICO; RP MEDICAS S.A. con domicilio en MEDELLIN - ANTIOQUIA
ACONDICIONADOR(ES):	LINE SERVICE ZONA FRANCA S.A.S. con domicilio en COTA - CUNDINAMARCA; DISTRIBUCIONES CLINICAS SOCIEDAD ANONIMA - DISCLINICA S.A. con domicilio en BARRANQUILLA - ATLANTICO; MINDRAY MEDICAL COLOMBIA SAS con domicilio en BOGOTA - D.C.; BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA S.L LTDA con domicilio en BOGOTA - D.C.; TECNICA ELECTRO MEDICA S.A. con domicilio en BOGOTA - D.C.; TECNICA ELECTRO MEDICA S.A. con domicilio en BOGOTA - D.C.; FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA S.A.S. A TRAVES DE LEASING BANCO DE COLOMBIA S.A. con domicilio en PIEDECUESTA - SANTANDER; PROGRAL MEDICAL SAS con domicilio en CARTAGENA - BOLIVAR; LAS ELECTROMEDICINA S.A.S. con domicilio en BOGOTA - D.C.; PHAREX S.A. con domicilio en BOGOTA - D.C.; SUMINISTROS INTEGRALES DE EQUIPOS BIOMEDICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS "SUMINTEGRALES S.A.S" con domicilio en MONTERIA - CORDOBA; JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS S.A.S - JOMEDICAL S.A.S con domicilio en BOGOTA - D.C.; NOVA MEDICA LTDA con domicilio en BARRANQUILLA - ATLANTICO; RP MEDICAS S.A. con domicilio en MEDELLIN - ANTIOQUIA; LOGICALL S.A. con domicilio en BOGOTA - D.C.
TIPO DE DISPOSITIVO	EQUIPO BIOMÉDICO PARA TRATAMIENTO Y SOPORTE DE VIDA
RIESGO:	IIb
SISTEMAS:	ELECTRICOS Y ELECTRONICOS
SUBSISTEMAS:	UNIDAD PRINCIPAL, PALETAS PARA DESFIBRILADOR, CABLES ACCESORIOS COMO ECG, SPO2, ETC
USOS:	ESTE EQUIPO SE ENCUENTRA INDICADO PARA EL TRATAMIENTO INICIAL DE LA FIBRILACIÓN VENTRICULAR Y LA TAQUICARDIA VENTRICULAR EN PACIENTES QUE ESTÁN SIN PULSO Y NO RESPONDEN Y PARA LA TERMINACIÓN DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	PRESENTACIÓN INDIVIDUAL
OBSERVACIONES:	ESTE PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN AMPARA ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS DE LOS MODLEOS Y/O REFERENCIAS: BENEHEART D6 BENEHEART D3 BENEHEART D1

EXPEDIENTE No.: 20014779
RADICACIÓN: 20191230539
FECHA RADICADO INICIAL: 22/11/2019

ARTICULO SEGUNDO.- SE APRUEBAN ETIQUETAS DE FABRICA Y ETIQUETA DE IMPORTADOR APORTADAS MEDIANTE RADICADO 20191230539.

ARTICULO TERCERO: AUTORIZAR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS DEL PRODUCTO QUE SE ENCUENTRE MARCADO CON EL PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN ANTERIOR No. **INVIMA2010EBC-0005463**

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020015754 DE 19 de Mayo de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Permiso de Comercialización

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

ARTICULO CUARTO.- Contra la presente Resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la Dirección de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías, del INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA.

ARTÍCULO QUINTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 19 de Mayo de 2020
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: anaranjoa, Técnico: ysanchezo Revisó: cordina_varios

Signature Not Verified
Firmado digitalmente por LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Fecha: 2020/05/21 17:08:29 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

352021000219375-9

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
860526809	1	L.A.S. ELECTROMEDICINA S.A.S

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CL 26 96 J 66 LC 23 LC 24	7467278	35	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
901076655	9	INTERLACE AGENCIA DE ADUANAS SAS NIVEL DOS (2)	26	578

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
1078637112	CORREA GRAJALES LEIDY JOHANA

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BUN	25578	No. 116575011505372	2021 - 05 - 01	No. CPSE21030769	2021 - 03 - 28

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
MR GLOBAL (HK) LIMITED	MONGKOK	351

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
FLAT/RM 1115-6 BLOCK 1 11/F CENTURY PLACE 193	85225110705

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
30236008	2021 - 03 - 15	351	1	434	11	NAVES S.A.	

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	9018901000	XX	XX	C130	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
08	01	351	832.50	576.50	PK	220	2	U	120.00

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 0.00	98	99 0	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 0		126 0

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
3	2021	XXXXXXXXXX	0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

D.O. 28286/2021-03169. DECLARACION 2 DE 2;FACTURA(S):30236008; NOS ACOGEMOS AL DECRETO 551 DE 5/04/2020, BIENES CUBIERTOS POR LA EXENCIÓN DELIMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA CON BASE EN LA RES 738 DE MAY/26/2021. VISTO BUENO INVIMA No VINVIMA-21-0043159 DE 21/4 /2021 VBO SUP VIG VSVS-21-01716 DE 21/04/2021. LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS ELECTROMÉDICOS. // (70) PRODUCTO: DESFIBRILADOR. MARCA: MINDRAY, MODELO: BENEHEART D1, REFERENCIA: 0653B-PA00124, S/N. FQ-13056542; FQ-13056543; FQ-13056544; FQ-13056545; FQ-130 56546; FQ-13056547; FQ-13056548; FQ-13056549; FQ-13056550; FQ-13056551; FQ-13056552; FQ-13056553; FQ-13056554; FQ-13056555; FQ-1 3056556; FQ-13056557; FQ-13056558; FQ-13056559; FQ-13056560; FQ-13056561; FQ-13056562; FQ-13056563; FQ-1305(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 352021000219375 133. Feha: 2021 06 11

134. Levante No. 352021000192802	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
	2021 - 06 - 11		

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	**980. Pago Total $** 0 996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo) SYGA Autoadhesivo 92352101044848 Fecha presentación 2021-06-11 08:39:43 Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2021-06-11 08:41:52

20211619902485

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **352021000219375-9**
Subpartida : **9018901000**

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

6564; FQ-13056565; FQ-13056566; FQ-13056567; FQ-13056568; FQ-13056569; FQ-13056570; FQ-13056571; FQ-13056572; FQ-13056573; FQ-130
56574; FQ-13056575; FQ-13056576; FQ-13056577; FQ-13056578; FQ-13056579; FQ-13056580; FQ-13056581; FQ-13056582; FQ-13056583; FQ-13
056584; FQ-13056585; FQ-13056586; FQ-13056587; FQ-13056588; FQ-13056589; FQ-13056590; FQ-13056591; FQ-13056592; FQ-13056593; FQ-1
3056594; FQ-13056595; FQ-13056596; FQ-13056597; FQ-13056598; FQ-13056599; FQ-13056600; FQ-13056601; FQ-13056602; FQ-13056603; FQ-
13056604; FQ-13056605; FQ-13056606 ;FQ-13056607; FQ-13056608; FQ-13056609; FQ-13056610; FQ-13056611; TECNICA DE DIAGNOSTIO: REANI
MACION CARDIACA, USO O DESTINO: ESTE EQUIPO SE ENCUENTRA INDICADO PARA EL TRATAMIENTO INICIAL DE LA FIBRILACION VENTRICULAR Y LA
TAQUICARDIA VENTRICULAR EN PACIENTES QUE ESTAN SIN PULSO Y NO RESPONDEN Y PARA LA TERMINACION DE LA FIBRILACION AURICULAR . SUBSI
STEMAS: UNIDAD PRINCIPAL, PALETAS PARA DESFIBRILADOR, CABLES ACCESORIOS COMO ECG, SPO2, ETC Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU NORMAL Y C
OMPLETO FUNCIONAMIENTO.. ANO DE FABRICACION: 2021, FABRICANTE: SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO.,LTD CON DOMICILIO EN
CHINA, PERMISO DE COMERCIALIZACION NO: INVIMA 2020EBC-0005463-R1, VIGENTE:19/05/2030, EXPEDIENTE: 20014779, MERCANCIA NUEVA., //
(50) PRODUCTO: DESFIBRILADOR. MARCA: MINDRAY, MODELO: BENEHEART D3, REFERENCIA: 0652B-PA00234. S/N. EZ-13057516; EZ-13057517; EZ-
13057518; EZ-13057519; EZ-13057520; EZ-13057521; EZ-13057522; EZ-13057523; EZ-13057524; EZ-13057525; EZ-13057526; EZ-13057527; E
Z-13057528; EZ-13057529; EZ-13057530; EZ-13057531; EZ-13057532; EZ-13057533;EZ-13057534; EZ-13057535; EZ-13057536; EZ-13057537; E
Z-13057538; EZ-13057539; EZ-13057540; EZ-13057541; EZ-13057542; EZ-13057543; EZ-13057544; EZ-13057545; EZ-13057546; EZ-13057547;
 EZ-13057548; EZ-13057549; EZ-13057550; EZ-13057551; EZ-13057552; EZ-13057553; EZ-13057554; EZ-13057555; EZ-13057556; EZ-13057557
; EZ-13057558; EZ-13057559; EZ-13057560; EZ-13057561; EZ-13057562; EZ-13057563; EZ-13057564; EZ-13057565; TECNICA DE DIAGNOSTIO:
REANIMACION CARDIACA USO O DESTINO:ESTE EQUIPO SE ENCUENTRA INDICADO PARA EL TRATAMIENTO INICIAL DE LA FIBRILACION VENTRICULAR Y
LA TAQUICARDIA VENTRICULAR EN PACIENTES QUE ESTAN SIN PULSO Y NO RESPONDEN Y PARA LA TERMINACION DE LA FIBRILACION AURICULAR . SU
BSISTEMAS: UNIDAD PRINCIPAL, PALETAS PARA DESFIBRILADOR, CABLES ACCESORIOS COMO ECG, SPO2, ETC Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU NORMAL
Y COMPLETO FUNCIONAMIENTO.. ANO DE FABRICACION: 2021, FABRICANTE: SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO.,LTD CON DOMICILIO
EN CHINA, PERMISO DE COMERCIALIZACION NO: INVIMA 2020EBC-0005463-R1, VIGENTE:19/05/2030, EXPEDIENTE: 20014779, MERCANCIA NUEVA.XX
XXXX

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CONSECUTIVO DE CALIBRACIÓN N° 20216434 **Fecha de Calibración:** 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CLIENTE

NOMBRE	ARCRON	**TELEFONO**	315 315 7190
DIRECCIÓN	CALLE 34 SUR NO. 69 - 73	**CIUDAD**	BOGOTÁ

DATOS GENERALES

EQUIPO	DESFIBRILADOR AUTOMATICO EXTERNO	**MARCA**	MINDRAY
MODELO	BENEHEART D1	**SERIE**	FQ-13056592
SERVICIO	AMBULANCIA	**UBICACIÓN**	MOVIL

EQUIPO PATRÓN

NO. CERTIFICADO	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	MAGNITUDES EVALUADAS	SERIE	FECHA DE CALIBRACIÓN	PROXIMA CALIBRACIÓN
J6307-20	ANALIZADOR DE DESFIBRILACIÓN IMPULSE 6000D	ENERGIA FRECUENCIA CARDIACA RESISTENCIA A CARGA MARCAPASOS	1208014	2020/09/10	2021/09
J6603-21	ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA ESA 612	VOLTAJE CORRIENTE RESISTENCIA	4163743	2021/03/11	2022/03

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN

1. La verificación de calibración se realiza utilizando equipos de medición certificados, con certificado de calibración vigente a la fecha, realizada bajo los parámetros establecidos por el fabricante y con normatividad internacional, el equipo de medición utilizado es; analizador de desfibrilador marca: FLUKE modelo:IMPULSE 6000D, serie: 1208014.

2. Se verifica inicialmente toda la parte de integridad física de accesorios y elementos externos al equipo, los cuales deben estar adecuados para su correcto funcionamiento, las paletas no pueden presentar fisuras que puedan presentar chisporroteos o saltos de corriente, su cable debe ser homogéneo y sin añadiduras, el equipo debe contar con papel de impresora recomendado u original, debe presentar un teclado homogéneo sin partiduras ni enmendaduras de acceso inmediato al ítem solicitado. El equipo debe tener la posibilidad de seleccionar en su software aspectos básicos necesarios como: Selección de detección de frecuencia cardiaca por paletas o derivadas, selección de carga de energía de carga en teclado y paletas, selección de modo sincrónico, selección de modo de descarga en paletas y desarme en teclado. Debe tener batería de respaldo en buen estado y que soporte mínimo 10 cargas de energía seguidas en valores diferentes y crecientes. Visualización de la energía entregada en display y mínimo una energía de verificación. Las descargas de energía del equipo deben estar dentro de los rangos de medición estipulados, al igual que el tiempo de carga con corriente externa y batería.

Este certificado expresa el resultado de las mediciones al momento y condiciones referenciados y no podrá ser reproducido sin permiso, la periodicidad de verificación queda sujeta a términos apropiados según la recomendación de la empresa ejecutante y el usuario contratante.

La empresa GyC Medicals SAS. No autoriza la reproducción parcial ni total de este documento sin permiso escrito.

RESPONSABLE DE LAS MEDICIONES
Ing- Donnadine Velandia

COORDINADOR DE METROLOGÍA
Ing. Edwin Canizales

CONSECUTIVO DE CALIBRACIÓN N° 20216434 **Fecha de Calibración:** 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONDICIONES AMBIENTALES

PRESIÓN ATMOSFÉRICA	TEMPERATURA AIRE	HUMEDAD RELATIVA
540 – 660 mmHg	20 - 40 °C	40,5 – 70,5%

CONDICIONES DE SEGURIDAD ELECTRICA

VOLTAJE ENTRADA	CORRIENTE	POTENCIA	RESISTENCIA	CORRIENTE DE FUGA TIERRA	CORRIENTE DE FUGA CHASIS	CORRIENTE DE FUGA LEAD 1	CORRIENTE DE FUGA LEAD 2	CORRIENTE DE FUGA LEAD 3
N/A V	N/A A	N/A W	N/A Ohm	N/A µA	N/A µA	N/A µA	N/A µA	N/A µA

RANGOS DE MEDICIÓN

1. Medición de Energia Sincrónica:

Valores Patrón

ENERGIA	RETARDO	Medida 1		Medida 2		Medida 3		Promedio		Error Prom		Incertidumbre	
		ENERGIA	RETARDO	ENERGIA	RETARDO	ENERGIA	RETARDO	ENERGIA	RETARDO	ENERGIA	RETARDO	ENERGIA	RETARDO
50	60	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
100	60	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
150	60	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
200	60	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
300	60	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Valores Patrón

BPM	Medida 1	Medida 2	Medida 3	Promedio	Error Prom	Incertidumbre
60	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
90	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
120	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. Medición de Energia Asincronica:

Valores Patrón

Energía	Medida 1	Medida 2	Medida 3	Promedio	Error Prom	Incertidumbre
50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
150	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. DEA:

Valores Patrón

Energía	Medida 1	Medida 2	Medida 3	Promedio	Error Prom	Incertidumbre
200,00	191,20	189,10	186,60	188,97	11,03	1,33
300,00	285,60	286,40	284,30	285,43	14,57	0,61

Tolerancias:

ENERGIA SELECCIONADA	TIEMPO DE CARGA	RETARDO CARDIOVERSION	BPM
+/- 10%	+/- 5%	60 mS	+/- 1

FIN DEL CERTIFICADO

SET GAD SAS
METROLOGIA

NVLAP CALIBRATION
NVLAP LAB CODE 201065-0

Certificado de Calibración

Certificado #
J6307-20

PGT-LAB-013 V 2 2019 / 11 / 04 Rev. 2

Laboratorio de Metrología Set y Gad S.A.S. — Bogotá

Procedimiento de calibración:	INS-LAB-IMPULSE-7000-DP
Descripción del equipo:	ANALIZADOR DE DESFIBRILACION
Fabricante:	FLUKE BIOMEDICAL
Modelo:	IMPULSE 6000D
Serie:	1208014
Código:	0060
Orden de trabajo:	21265
Condición recibido:	Operable
Datos de calibración:	Calibración
Lugar de calibración:	Laboratorio de Metrología Set y Gad S.A.S.

Fecha de recepción:	2020 / 09 / 09
Fecha de calibración:	2020 / 09 / 10
Fecha de emisión:	2020 / 09 / 10
Fecha próxima calibración:	N/A
Temperatura:	21,35 ± 0,05 ° C
Humedad relativa:	46,35 ± 0,15 % HR
Presión barométrica:	752,5 ± 0,1 hPa

Nombre del cliente:	PROCESOS MEDICOS SAS
Dirección:	CL 82 43 B 12 OF 2A — BARRANQUILLA

Los resultados de este certificado de calibración son trazables al SI a través de un instituto de medición reconocido nacionalmente o acorde a constantes físicas naturales y cumple con la norma ISO 17025:2017 y NIST Handbook 150 (NVLAP) y con la norma ISO 17025:2005. (ONAC)

El instrumento fué calibrado usando el método de comparación directa. La calibración se ha completado de acuerdo a las guías del sistema de calidad de Set y Gad S.A.S. para documentos de Certificados de Calibración.

Los certificados de calibración sin firma no serán validos. Este certificado aplica únicamente a los ítems identificados. La reproducción parcial o completa debe hacerse con la aprobación escrita de Set y Gad S.A.S. Este certificado no podrá ser usado para reclamar endoso de un producto ante el ente acreditador.

Este certificado puede contener datos que no están dentro del alcance de la acreditación. Los puntos de prueba no acreditados, cuando aplique, son indicados por un asterisco (*) para NVLAP y un signo de admiración (!) para ONAC, o contornados a áreas claramente marcadas. Las pruebas de funcionamiento no son acreditadas. un certificado sin los logos de un ente acreditador no cuenta con acreditación.

El tipo de datos que pueden ser encontrados en este certificado deben ser interpretados así:
- Calibración Antes de Ajuste – Datos de calibración obtenidos antes de que el equipo bajo prueba sea ajustado y/o reparado.
- Calibración después de Ajuste – Datos de calibración obtenidos después de que el equipo bajo prueba sea ajustado y/o reparado.
- Calibración – Datos de calibración obtenidos sin haber realizado ninguna clase de ajustes y/o reparación.

La incertidumbre medida al momento de la prueba es dada donde aplica. Es calculada de acuerdo con el documento de sistema de calidad de Set y Gad S.A.S. P-LAB-004, y está relacionado con la guía para la expresión de la incertidumbre en mediciones GUM. La incertidumbre expandida de la medición reportada es descrita como la incertidumbre estándar de la medida multiplicada por un factor de cobertura k tal que la probabilidad de cobertura corresponda a aproximadamente 95%, y esta se indica en cada una de las mediciones.

Cuando se hace declaración de cumplimiento, el laboratorio hace referencia a las especificaciones del fabricante, norma, o requisitos declarados por el cliente. La suma del valor absoluto del error más la incertidumbre deben estar dentro de los límites de especificación para que la medición se tome como conforme. La regla de decisión aplicado en estos casos sera de aceptación o rechazo simple segun la ASME B89.7.3.1 numerales 3 y 4.1. La probabilidad de dar una aceptación Falsa o un rechazo Falso no lo determina el Laboratorio de Metrología de Set y Gad S.A.S., sin embargo se puede calcular de acuerdo a la guía JCGM 106:2012 según su numeral 8. La regla aplica a los resultados numéricos que muestren la columna Pasa/Falla.

El certificado de calibración no debe ser usado para la certificación, aprobación, o respaldo de un producto por NVLAP, NIST o cualquier agencia del Gobierno de USA

Revisó y autorizó calibración
Ing. Luis Felipe Uribe Agudelo

SET Y GAD SAS
Carrera 48 # 101 A - 69, Bogotá, Colombia
PBX: 571.755.9277
www.setgad.com

DIOS AYUDA A QUIEN CONFÍA EN ÉL

SET GAD SAS
METROLOGIA

Certificado de Calibración

Certificado #
J6307-20

P-T-LAB-013 V.2 2019 / 11 / 04 Rev. 2

Patrones de calibración

Instrumento	Serie	Validez	ID certificado
IMPULSE 7000 GS	1551005	2021 / 05 / 31	2020002158
MULTIMETRO	3031008	2021 / 03 / 31	JP099-20
MARCAPASOS	PFG051145P	0	0

* Los patrones utilizados han sido calibrados con laboratorios competentes acreditados conforme a la Norma ISO 17025

Información Adicional

Declaración de cumplimiento según:
Manual de fabricante. Numeral/Sección: Especificaciones técnicas

Adiciones, desviaciones o exclusiones del método:
N/A

Datos suministrados por el cliente:
N/A

Comentarios:
N/A

* El Laboratorio de Metrología de Set y Gad S.A.S. no se hace responsable por cómo la información suministrada por el cliente afecta los resultados de la medición.

Resultados de la Medición

Pruebas Funcionales

	Especificación	Pasa/Falla	
Firmware	Evaluado por el operador	Pasa	*
Ventilador	Evaluado por el operador	Pasa	*
Prueba de Bateria	Evaluado por el operador	Pasa	*
Teclado	Evaluado por el operador	Pasa	*

Calibración Resistencia a Carga

Nominal	EBC	Patrón	Corrección	Incertidumbre	Tolerancia	Pasa/Falla	k
	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω		
50 Ω — APEX (+) – STERNUM (–)	50,0	50,2591	0,2591	0,0090	1,0	Pasa	2,00
—							
—							
—							
—							
—							
—							
—							
—							
—							
—							

SET Y GAD SAS
Carrera 48 # 101 A - 69, Bogotá, Colombia
PBX: 571.755.9277
www.setgad.com

DIOS AYUDA A QUIEN CONFÍA EN ÉL

2

SET GAD SAS
METROLOGIA

Certificado de Calibración

Certificado #
J6307-20

PET-LAB-013 V.2 2019/11/04 Rev. 2

Resultados de la Medición

Calibración de ECG

High level ECG sine wave	EBC Hz	Patrón Hz	Corrección Hz	Incertidumbre Hz	Tolerancia Hz	Pasa/Falla	k
200 Hz	200,0	200,0016000	0,0016	0,0015	2,000	Pasa	2,00

Nominal	EBC Lat/min	Patrón Lat/min	Corrección Lat/min	Incertidumbre Lat/min	Tolerancia Lat/min	Pasa/Falla	k
60 Lat/min	60,0	60,000	0,0000	0,0017	0,6	Pasa	2,00
120 Lat/min	120,0	120,000	0,0000	0,0017	1,2	Pasa	2,00
180 Lat/min	180,0	180,000	0,0000	0,0017	1,8	Pasa	2,00
240 Lat/min	240,0	240,000	0,0000	0,0017	2,4	Pasa	2,00
300 Lat/min	300,0	300,000	0,0000	0,0021	3,0	Pasa	2,00

Calibración de Energía

Nominal — Monofásica	Especificación J	EBC J	Corrección J	Incertidumbre J	Tolerancia J	Pasa/Falla	k
10 J	10,1	10,1	0,00	0,11	0,2	Pasa	2,00
50 J	48,7	48,8	-0,10	0,21	0,6	Pasa	2,00
100 J	97,0	97,0	0,00	0,35	1,1	Pasa	2,00
200 J	194,9	194,7	0,20	0,65	2,0	Pasa	2,00
360 J	338,1	338,3	-0,2	1,2	3,5	Pasa	2,00

Nominal — Bifásica	Especificación J	EBC J	Corrección J	Incertidumbre J	Tolerancia J	Pasa/Falla	k
15 J	14,3	14,3	0,00	0,12	0,2	Pasa	2,00
50 J	48,7	48,9	-0,20	0,21	0,6	Pasa	2,00
100 J	96,7	96,8	-0,10	0,35	1,1	Pasa	2,00
170 J	165,4	165,3	0,10	0,56	1,8	Pasa	2,00

FIN DEL CERTIFICADO

SET Y GAD SAS
Carrera 48 # 101 A - 69, Bogotá, Colombia
PBX: 571.755.9277
www.setgad.com

DIOS AYUDA A QUIEN CONFÍA EN ÉL

No es claro

Certificado de Calibración

Certificado #
J5003-21

Laboratorio de Metrología Set y Gad S.A.S. — Bogotá

Procedimiento de calibración:	INS-LAB-IMPULSE-7000 DP		
Descripción del equipo:	ANALIZADOR DE DESFIBRILACIÓN		
Fabricante:	DATREND SYSTEMS	**Fecha de recepción:**	2021 / 03 / 11
Modelo:	PHASE 3	**Fecha de calibración:**	2021 / 03 / 12
Serie:	PH1403042R	**Fecha de emisión:**	2021 / 03 / 12
Código:	N/A	**Fecha próxima calibración:**	N/A
Orden de trabajo:	19345	**Temperatura:**	22.50 ± 0.80 °C
Condición recibido:	Operable	**Humedad relativa:**	40.60 ± 1.30 % HR
Datos de calibración:	Calibración	**Presión barométrica:**	750.4 ± 0.1 hPa
Lugar de calibración:	Laboratorio de Metrología Set y Gad S.A.S.		

Nombre del cliente:	G Y C MEDICAL SAS
Dirección:	CL 40 25 07 — BOGOTA

Los resultados de este certificado de calibración son trazables al SI a través de un laboratorio de medición reconocido nacionalmente o acorde a constantes físicas naturales y cumple con la norma ISO 17025: 2017 ; NIST Handbook 150 (NVLAP) y con la norma ISO 17025: 2005 (IDEAM).

El instrumento fue calibrado usando el método de comparación directa. La calibración se ha completado de acuerdo a un guía del sistema de calidad de Set y Gad S.A.S. para dar emisión de Certificados de Calibración.

Los certificados de calibración sin firma no serán válidos. Este certificado aplica exclusivamente a los ítems identificados. La reproducción parcial o completa debe hacerse con la aprobación escrita de Set y Gad S.A.S. Este certificado no puede ser usado para cualquier producto de un producto, sólo al cual se refiere.

Este certificado puede contener datos que no están dentro del alcance de la acreditación. Los puntos de prueba con acreditación, cuando aplique, son indicados por un asterisco (*) para NVLAP y un signo de admiración (!) para IDEAM. Si realizamos a datos completamente opcionales. Los puntos de calibración no son acreditados, un certificado con los logos de un(os) acreditador no cuenta con acreditación.

El tipo de datos que pueden ser encontrados en este certificado deben ser identificados así:
– Calibración Antes de Ajuste – Datos de calibración obtenidos antes cualquier ajuste, limpieza o reparación.
– Calibración después de Ajuste – Datos de calibración obtenidos después de que el equipo haya pasado por ajustado o reparación.
– Calibración – Datos de calibración obtenidos en donde no ha sido realizado ningún tipo de ajustes y/o reparación.

La incertidumbre medida en mediciones de la prueba es dada donde aplica. La calibración fue realizada con el documento de sistema de calidad de Set y Gad S.A.S. P-LAB-0004 y está relacionado con la guía para la expresión de la incertidumbre en medición GUM. La incertidumbre expandida de la tabla fue reportada en duración como la incertidumbre estándar de la medición multiplicada por un factor de cobertura k tal que la probabilidad de cobertura corresponde a aproximadamente 95%, y está establecida en cada una de las condiciones.

Cuando se hace declaración de cumplimiento, el laboratorio hace referencia a las especificaciones del fabricante, acorde, o requisitos declarados por el cliente. La regla del valor absoluto del error más la incertidumbre define cómo decide en los límites de especificación para que la conformidad se tome como conforme. La regla de decisión aplicada en cómo cumple de aceptación o rechazo simple según la ANSI/ NCSL Z 540.3 numerales 5.1 c 4.1. La probabilidad de dar una aceptación falsa o un rechazo falso no ha determinado el Laboratorio de Metrología de Set y Gad S.A.S., sin embargo se puede consultar la guía IECEE OD-2053 según su numeral 9.1 la regla aplica a los resultados numéricos que muestren la columna resultado.

El certificado de calibración no debe ser usado para la certificación, aprobación o respaldo de un producto por NVLAP, NIST o cualquier agencia del Gobierno de USA.

Revisó y autorizó calibración
Ing. Luis Felipe Uribe Agudelo

SET GAD
METROLOGIA

Certificado de Calibración

Certificado #
J5003-21

Patrones de calibración

Instrumento	Serie	Validez	ID certificado
IMPULSE 7000 GS	1551005	2021 / 04 / 25	2019001730
MULTIMETRO	3011008	2021 / 03 / 14	JP025-19
CONTADOR UNIVERSAL	MY47001582	2021 / 12 / 31	5-CRMA-20-5
MARCAPASOS	PFG0511458		

Información Adicional

Declaración de cumplimiento según:
N/A

Adiciones, desviaciones o exclusiones del método:
N/A

Datos suministrados por el cliente:
N/A

Comentarios:
N/A

Resultados de la Medición

Calibración Resistencia a Carga

Nominal	EBC Ω	Patrón Ω	Corrección Ω	Incertidumbre Ω	k
50 Ω — APEX (+) – STERNUM (-)	50,0	50,3693	0,3693	0,0090	2,00
50 Ω	50,0	50,2243	0,2243	0,0090	2,00
100 Ω	100,0	100,1639	0,163	0,014	2,00
150 Ω	150,0	150,193	0,193	0,025	2,00
200 Ω	200,0	200,132	0,132	0,040	2,00
450 Ω	450,0	450,201	0,201	0,055	2,00
800 Ω	800,0	800,043	0,043	0,090	2,00
1600 Ω	1600,0	1599,81	-0,19	0,26	2,00

Calibración de ECG

Nominal	EBC Lat/min	Patrón Lat/min	Corrección Lat/min	Incertidumbre Lat/min	k
60 Lat/min	60,0	60,000	0,0000	0,0017	2,00
120 Lat/min	120,0	120,000	0,0000	0,0017	2,00
180 Lat/min	180,0	180,000	0,0000	0,0017	2,00
240 Lat/min	240,0	240,000	0,0000	0,0017	2,00
300 Lat/min	300,0	300,000	0,0000	0,0018	2,00

SET GAD
METROLOGIA SAS

Certificado de Calibración

Certificado #
J5003-21

Resultados de la Medición

Calibración de Marcapasos

Ferecuencia — 50 Ω	Especificación ppm	EBC ppm	Corrección ppm	Incertidumbre ppm	k
80 ppm	80,0	80,0	0,00	0,12	2,00
120 ppm	120,0	120,0	0,00	0,16	2,00
200 ppm	200,0	200,6	-0,60	0,65	2,00

Amplitud — 50 Ω	Especificación mA	EBC mA	Corrección mA	Incertidumbre mA	k
10 mA	9,90	9,8	0,10	0,12	2,00
15 mA	14,85	14,7	0,15	0,17	2,00
25 mA	24,70	24,6	0,10	0,13	2,00

Ferecuencia — 200 Ω	Especificación ppm	EBC ppm	Corrección ppm	Incertidumbre ppm	k
80 ppm	80,0	80,0	0,00	0,12	2,00
120 ppm	120,0	120,2	-0,20	0,26	2,00
200 ppm	200,0	200,6	-0,60	0,65	2,00

Amplitud — 200 Ω	Especificación mA	EBC mA	Corrección mA	Incertidumbre mA	k
10 mA	9,90	9,8	0,10	0,12	2,00
15 mA	14,85	14,7	0,13	0,15	2,00
25 mA	24,70	24,6	0,10	0,13	2,00

Calibración de Energía

Nominal — Monofásica	Especificación J	EBC J	Corrección J	Incertidumbre J	k
10 J	10,0	9,8	0,20	0,12	2,00
50 J	48,7	48,4	0,30	0,21	2,00
100 J	97,2	96,8	0,40	0,35	2,00
200 J	195,3	194,3	1,00	0,65	2,00
360 J	338,1	336,8	1,3	1,2	2,00

Nominal — Bifásica	Especificación J	EBC J	Corrección J	Incertidumbre J	k
15 J	14,9	14,7	0,20	0,12	2,00
50 J	47,8	47,7	0,20	0,21	2,00
100 J	96,4	96,0	0,40	0,45	2,00
170 J	164,4	163,5	0,90	0,56	2,00

FIN DEL CERTIFICADO

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
¡Trabajamos con el CORAZÓN!

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN E.S.E.

HOJA DE VIDA DE EQUIPO



INFORMACION DEL EQUIPO	
EQUIPO: FONENDOSCOPIO ADULTO	MARCA: GMD
MODELO: GMD30-DC	SERIE / TIPO: N/R
Nº INVENTARIO / ACTIVO: NO REGISTRA	REGISTRO INIVIMA: 2020DM-0021212
SERVICIO: TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	UBICACIÓN: T.A.B GRS-557

REGISTRO DE COMPRA			
FORMA DE ADQUISICION: COMPRA [X] COMODATO [ ] DONACION [ ]			
FECHA DE ADQUISICION	AGOSTO 2021		
FECHA DE INSTALACION	AGOSTO 2021		
FECHA VENC. GARANITIA	AGOSTO 2022		
PROVEEDOR	ARCRON	VIDA UTIL (Años)	N/R
[redacted]ANTE	GMD DIAGNOSTICS		

REGISTRO TECNICO	
VOLTAJE: NO APLICA	FRECUENCIA: NO APLICA
CORRIENTE: NO APLICA	POTENCIA: NO APLICA
PRESION: NO APLICA	TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO: 0-40° C
TECNOLOGIA PREDOMINANTE: MECÁNICO	

REGISTRO DE COMPONENTES / ACCESORIOS

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE

REGISTRO DE APOYO TECNICO

CLASIFICACION SEGÚN RIESGO			
[X] I	[ ] IIA	[ ] IIB	[ ] III

MANUALES			
OPERACIÓN		MANTENIMIENTO	

CLASIFICACION BIOMEDICA	
DIAGNOSTICO	X
PREVENCION	
REHABILITACION	
ANALISIS DE LABORATORIO	
TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA	

RECOMENDACIONES DE FABRICANTE

PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO			
BIMESTRAL		TRIMESTRAL	
SEMESTRAL	X	ANUAL	

CALIBRACION	
REQUIERE CALIBRACION	NO
PERIODICIDAD CALIBRACION	NO APLICA

Elaborado por: EQUIMEDICAS MANTENIMIENTO	Revisado por: Calidad	Aprobado por: Gerencia

KIT DE TENSIÓMETRO Y FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA ESTUCHE GMD COLORS

Este kit cuenta con un tensiómetro aneroide y fonendoscopio para realizar toma de presión arterial y auscultaciones en general. Tiene además un diseño atractivo y está disponible en colores innovadores en su presentación de estuche. Resulta ideal para personal médico y estudiantil.

- Para estudiantes y profesionales de la salud
- Manómetro de fácil lectura
- Fonendoscopio con doble campana
- Manómetro resistente a golpes
- Manguera para mejor acústica
- Práctica maleta fabricada en nailon
- Servicio al cliente
- 1 AÑO DE GARANTÍA



- GMD50-DC-T2
- GMD50-DC-T4
- GMD50-DC-T10
- GMD50-DC-T11
- GMD50-DC-T13
- GMD50-DC-T14
- GMD50-DC-T15
- GMD50-DC-T16
- GMD50-DC-T17
- GMD50-DC-T18
- GMD50-DC-T20

SKU	D01ID06129 - D01ID06130 - D01ID06131 - D01ID06449 - D01ID06234 - D01ID06235 - D01ID06132 - D01ID06133 D01ID06134 - D01ID06135 - D01ID06136
Dimensiones caja master	48 cm X 44 cm X 39 cm
Cantidad por caja master	30 unidades
Peso neto caja master	15 kg
Peso bruto caja master	16 kg
Dimensión caja primaria	23 cm x 14 cm x 7 cm
Peso neto unidad	0,5 kg
Material de la vejiga	Látex
Tipo de pera	Látex con filtro
Clasificación de riesgo	clase I (riesgo bajo)
Registro Sanitario	2017DM-0016962

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
¡Trabajamos con el CORAZÓN!

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN E.S.E.

HOJA DE VIDA DE EQUIPO



INFORMACION DEL EQUIPO	
EQUIPO: TENSIOMETRO ADULTO	MARCA: GMD
MODELO: GMD20	SERIE / TIPO: N/R
Nº INVENTARIO / ACTIVO: NO REGISTRA	REGISTRO INIVIMA: 2020DM-0021211
SERVICIO: TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	UBICACIÓN: T.A.B GRS-557

REGISTRO DE COMPRA			
FORMA DE ADQUISICION: COMPRA [X] COMODATO [ ] DONACION [ ]			
FECHA DE ADQUISICION	AGOSTO 2021		
FECHA DE INSTALACION	AGOSTO 2021		
FECHA VENC. GARANTIA	AGOSTO 2022		
PROVEEDOR	ARCRON	VIDA UTIL (Años)	N/R
FABRICANTE	GMD DIAGNOSTICS		

REGISTRO TECNICO	
VOLTAJE: NO APLICA	FRECUENCIA: NO APLICA
CORRIENTE: NO APLICA	POTENCIA: NO APLICA
PRESION: 0-300mmHg	TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO: 0-40° C
TECNOLOGIA PREDOMINANTE: MECÁNICO	

REGISTRO DE COMPONENTES / ACCESORIOS

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE

REGISTRO DE APOYO TECNICO

CLASIFICACION SEGÚN RIESGO			
I [X]	IIA [ ]	IIB [ ]	III [ ]
MANUALES			
OPERACIÓN		MANTENIMIENTO	

CLASIFICACION BIOMEDICA	
DIAGNOSTICO	X
PREVENCION	
REHABILITACION	
ANALISIS DE LABORATORIO	
TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA	

RECOMENDACIONES DE FABRICANTE

PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO			
BIMESTRAL		TRIMESTRAL	
SEMESTRAL	X	ANUAL	

CALIBRACION	
REQUIERE CALIBRACION	SI
PERIODICIDAD CALIBRACION	ANUAL

Elaborado por: EQUIMEDICAS MANTENIMIENTO	Revisado por: Calidad	Aprobado por: Gerencia

La salud es de todos | Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020005451 DE 17 de Febrero de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

CONSIDERANDO

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMATICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.

EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARA EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS A

PRODUCTO: FONENDOSCOPIOS (ESTETOSCOPIO) PARTES ACCESORIOS Y REPUESTOS
MARCA: GMD
REGISTRO SANITARIO NO.: **INVIMA 2020DM-0021212**
TIPO DE REGISTRO: IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES): IMPORMEDICAL EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS S.A. CON DOMICILIO EN PALMIRA - VALLE
FABRICANTE(S): WENZHOU LONGWAN MEDICAL DEVICE FACTORY CON DOMICILIO EN CHINA
IMPORTADOR(ES): IMPORMEDICAL EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS S.A CON DOMICILIO EN PALMIRA - VALLE
ACONDICIONADOR(ES): IMPORMEDICAL EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS S.A CON DOMICILIO EN PALMIRA - VALLE
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO: NO INVASIVO
I
COMPOSICIÓN:

PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO	COMPOSICIÓN CUALITATIVA
DOBLE CAMPANA	ACERO INOXIDABLE
MEMBRA	ALEACIÓN DE ACETATO Y FIBRA DE CELULOSA
OLIVAS	SILICONA
MANGUERA	PVC
ARO CORTA FRÍO	

USOS: USADO EN LA EXPLORACION CLINICA PARA LA AUSCULTACIÓN DE LOS SONIDOS CARDÍACOS Y RESPIRATORIOS, PARA DETERMINAR SONIDOS INTESTINALES O SOPLOS POR FLUJOS SANGUÍNEOS EN ARTERIAS Y VENAS.

PRESENTACIÓN COMERCIAL: EMPAQUE INDIVIDUAL
OBSERVACIONES: EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS:

FAMILIA	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA
FONENDOSCOPIOS (ESTETOSCOPIOS)	TY-S01、TY-S02、TY-S03, TY-S04、TY-S05、TY-S06, TY-S07、TY-S08 SE COMERCILIZARAN EN COLOMBIA BAJO LOS MODELOS GMD30-RP. GMD30-DCK. GMD30-DC REFERENCIAS: GMD30-RP1-ST2,GMD30-RP1-ST3,GMD30-RP1-ST4,GMD30-RP1-ST9,GMD30-RP1-ST12,GMD30-RP1-ST13, GMD30-RP1-ST15, GMD30-RP1-ST17, GMD30-RP1-ST20, GMD30-DCK-ST20, GMD30-DCK-T13, GMD30-DCK-ST13, GMD30-DCK-T14, GMD30-DCK-T4, GMD30-DCK-ST19, GMD30-DCK-T11, GMD30-DC-

	Invima

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017009405 DE 7 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

CONSIDERANDO

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMATICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.
EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARA EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS A

PRODUCTO:	KIT DE FONENDOSCOPIO Y TENSIOMETRO ANEROIDE
MARCA:	GMD
REGISTRO SANITARIO NO.:	INVIMA 2017DM-0015978
TIPO DE REGISTRO:	*IMPORTAR Y VENDER*
TITULAR(ES):	IMPORMEDICAL EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS S.A. CON DOMICILIO EN PALMIRA - VALLE
FABRICANTE(S):	WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD CON DOMICILIO EN CHINA
IMPORTADOR(ES):	IMPORMEDICAL EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS S.A. CON DOMICILIO EN PALMIRA - VALLE
ACONDICIONADOR(ES):	IMPORMEDICAL EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS S.A. CON DOMICILIO EN PALMIRA - VALLE
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO:	NO INVASIVO I
COMPOSICIÓN:	UN ESTUCHE COMPUESTO POR FONENDOSCOPIO Y TENSIOMETRO PRODUCTOS IDENTIFICADOS BAJO LOS REGISTROS SANITARIOS: 2015DM-0014070 E 2015DM0014068 BINAURAL,OLIVAS, ARCO METALICO, MEMBRANA DE DOBLE FRECUENCIA,TUBO, VASTAGO, CAMPANA, BRAZALETE ANEROIDE, MANÓMETRO,CÁPSULA DE ALEACIÓN COBRE/BERILIO DE ELASTICIDAD CONSTANTE, ESFERA: ESCALA: 0-300 MM HG, SOPORTE DE MANÓMETRO: SERRAJE, PERA COMPLETA PVC NEGRO - 50 MM, LLAVE: EL MODELO CLASSIC - LATÓN CROMADO - VÁLVULA DE DESINFLADO CONSTANTE Y ULTRA PRECISA, TUBO DOBLE: DE CAUCHO DE "ALTA RESISTENCIA" A LA CAPA DE OZONO Y A LOS RAYOS UV - SIN LÁTEX
USOS:	ESTUCHE DISEÑADO PARA OIR LOS SONIDOS INTERNOS DEL CUERPO HUMANO, GENERALMENTE SE USA EN LA AUSCULTACIÓN DE LOS RUIDOS CARDIACOS O RUIDOS RESPIRATORIOS Y A VECES PARA OBJETIVAR RUIDOS INTESTINALES Y LA MEDICIÓN INDIRECTA DE LA PRESIÓN ARTERIAL, CON EL OBJETIVO DE DETERMINAR LA TENSIÓN ARTERIAL SISTÓLICA Y DIASTÓLICA EN HUMANOS.
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	EMPAQUE INDIVIDUAL
OBSERVACIONES:	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: GMD50-DC, GMD50-RP
VIDA UTIL:	5 AÑOS
EXPEDIENTE NO.:	20124025
RADICACIÓN NO.:	2017028473

Información del Documento Original

	invima

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017009405 DE 7 de Marzo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005


ARTICULO SEGUNDO.- CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

ARTICULO TERCERO.- LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

ARTICULO CUARTO.- LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 2005.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN BOGOTÁ D.C. A LOS 7 DE MARZO DE 2017
ESTE ESPACIO, HASTA LA FIRMA SE CONSIDERA EN BLANCO.



ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: salbam , Técnico: msandovalc, Revisó: cordina_varios

Información de Documento Original

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año 2021

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

4820210004802 47-3

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830138248 | 5.DV.: 4 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: DATASAVE MEDICAL S.A.S

13. Dirección: CL 86 B 49 A 21 | 14. Teléfono: 6230040 | 12. Cód. Admón.: 46 | 16. Cód. Oper.: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830096132 | 25. DV.: 6 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS INTERLOGISTICA S.A. NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 442

29. Número documento de identificación: 1143395269 | 30. Apellidos y nombres: CRUZ BALLESTERO EMILY MICHELL

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	38. Cod. Admón.
02	(inicial)	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	7201	No. 116575011667923	2021 - 07 - 31	No. AMIGL210251981A	2021 - 06 - 26

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: HONSUN (NANTONG) CO.,LTD. | 47. Ciudad: NANTONG | 48. Cod.País Exportador: 215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: NO.8 TONGXING ROAD ECONOMIC & TECHNOLOGICAL DEVELO | 50. E-mail: 021-63056696

51. No. de Factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Aduana	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cus.
21YF1T068	2021 - 05 - 26	215	1	467	11	FRONTIER AGENCIA MARITIMA	

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
		XX	XX	C130	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país vendor	71. Peso bruto kgs.	72. Peso neto kgs.	73. Código servicio	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad items
08	01	215	950.00	890.00	YY	309	2	LI	2.000,00

78. Valor FOB USD | 78. Valor fletes USD | 80. Valor Seguros USD | 81. Valor Otros Gastos USD | 82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD | 83. Ajuste valor USD | 84. Valor Aduana USD | 85. Código régimen | 86. Número Declaración

R | 50101243

87. Cod. oficina: 3 | 88. Año: 2021 | 89. Programa No: 0000000000 | 90. Cód. Interno del Producto: 0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	5.00			0	0
IVA	0.00			0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Peruale	0	0	0	0	
		Total			0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con la señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, serie(s) y otros) (Si el espacio es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 21010588 PEDIDO TRAMITE: CTG-62093 DECLARACION(6-8) MERCANCIA NUEVA, CUENTA CON VISTO BUENO INVIMA VIINVIMA-21-0079243 DEL 2021-07-26, REGISTRO SANITARIO INVIMA: INVIMA 20XDM-0022495 CON FECHA DE VIGENCIA: 2030-11-23, REGISTRO SANITARIO INVIMA: INVIMA 202 0DM-0022582 CON FECHA DE VIGENCIA:2030-11-30, NOS ACOGEMOS AL DECRETO 551 DEL 15 DE ABRIL DEL 2020 ART 2, BIENES CUBIERTOS POR LA EXENCION DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, IVA. PRODUCTO: TENSIOMETRO ANEROIDE ESFINGOMANÓMETRO / TENSIOMETRO, MARCA: HONSUN-DM, MO S: HS-20C, REFERENCIA: HS-20C, USO O DESTINO: UN TENSIOMETRO ANEROIDEESUTILIZADO POR PROFESIONALES DE LA SALUD OPERSONAL ENTRE SN LA TÉCNICA DE PRESTÓN ARTERIAL AUSCULTATORIA PARA DETERMINAR LA PRESTÓN ARTERIAL SISTÓLICAY DIASTÓL(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0 | 128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración: 4820210004802 47 | 133. Fecha: 2021 08 11

134. Levante No. 4820210004313 70 | 135. Fecha: 2021 - 08 - 11 | Firma funcionario responsable | 136. Nombre | 137. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

998. Pago Total $

996. Espacio para Número autoadhesivo

910480168541 75

Fecha de Impresión: 2021-08-11 17:14:39

20210742949564

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 482021000480247-3

Subpartida : 9018909000

Página 1 de 3

(16) Continuación descripción mercancías (incluya marcas, estilos y otros)

ICA EN LOS SERES HUMANOS, TECNICA DE DIAGNOSTICO: TECNICA MANUAL, SERIAL: 210400001, 210400002, 210400003, 210400004, 210400005, 210400006, 210400007, 210400008, 210400009, 210400010, 210400011, 210400012, 210400013, 210400014, 210400015, 210400016, 21040001 7, 210400018, 210400019, 210400020, 210400021, 210400022, 210400023, 210400024, 210400025, 210400026, 210400027, 210400028, 21040 0029, 210400030, 210400031, 210400032, 210400033, 210400034, 210400035, 210400036, 210400037, 210400038, 210400039, 210400040, 21 0400041, 210400042, 210400043, 210400044, 210400045, 210400046, 210400047, 210400048, 210400049, 210400050, 210400051, 210400052, 210400053, 210400054, 210400055, 210400056, 210400057, 210400058, 210400059, 210400060, 210400061, 210400062, 210400063, 2104000 64, 210400065, 210400066, 210400067, 210400068, 210400069, 210400070, 210400071, 210400072, 210400073, 210400074, 210400075, 2104 000076, 210400077, 210400078, 210400079, 210400080, 210400081, 210400082, 210400083, 210400084, 210400085, 210400086, 210400087, 2 10400088, 210400089, 210400090, 210400091, 210400092, 210400093, 210400094, 210400095, 210400096, 210400097, 210400098, 210400099 , 210400100, 210400101, 210400102, 210400103, 210400104, 210400105, 210400106, 210400107, 210400108, 210400109, 210400110, 210400 111, 210400112, 210400113, 210400114, 210400115, 210400116, 210400117, 210400118, 210400119, 210400120, 210400121, 210400122, 210 0400123, 210400124, 210400125, 210400126, 210400127, 210400128, 210400129, 210400130, 210400131, 210400132, 210400133, 210400134, 210400135, 210400136, 210400137, 210400138, 210400139, 210400140, 210400141, 210400142, 210400143, 210400144, 210400145, 21040014 6, 210400147, 210400148, 210400149, 210400150, 210400151, 210400152, 210400153, 210400154, 210400155, 210400156, 210400157, 21040 0158, 210400159, 210400160, 210400161, 210400162, 210400163, 210400164, 210400165, 210400166, 210400167, 210400168, 210400169, 21 0400170, 210400171, 210400172, 210400173, 210400174, 210400175, 210400176, 210400177, 210400178, 210400179, 210400180, 210400181, 210400182, 210400183, 210400184, 210400185, 210400186, 210400187, 210400188, 210400189, 210400190, 210400191, 210400192, 2104001 93, 210400194, 210400195, 210400196, 210400197, 210400198, 210400199, 210400200, 210400201, 210400202, 210400203, 210400204, 2104 00205, 210400206, 210400207, 210400208, 210400209, 210400210, 210400211, 210400212, 210400213, 210400214, 210400215, 210400216, 2 10400217, 210400218, 210400219, 210400220, 210400221, 210400222, 210400223, 210400224, 210400225, 210400226, 210400227, 210400228 , 210400229, 210400230, 210400231, 210400232, 210400233, 210400234, 210400235, 210400236, 210400237, 210400238, 210400239, 210400 240, 210400241, 210400242, 210400243, 210400244, 210400245, 210400246, 210400247, 210400248, 210400249, 210400250, 210400251, 210 0400252, 210400253, 210400254, 210400255, 210400256, 210400257, 210400258, 210400259, 210400260, 210400261, 210400262, 210400263, 210400264, 210400265, 210400266, 210400267, 210400268, 210400269, 210400270, 210400271, 210400272, 210400273, 210400274, 210400275 , 210400276, 210400277, 210400278, 210400279, 210400280, 210400281, 210400282, 210400283, 210400284, 210400285, 210400286, 210400 0287, 210400288, 210400289, 210400290, 210400291, 210400292, 210400293, 210400294, 210400295, 210400296, 210400297, 210400298, 21 0400299, 210400300, 210400301, 210400302, 210400303, 210400304, 210400305, 210400306, 210400307, 210400308, 210400309, 210400310, 210400311, 210400312, 210400313, 210400314, 210400315, 210400316, 210400317, 210400318, 210400319, 210400320, 210400321, 2104003 22, 210400323, 210400324, 210400325, 210400326, 210400327, 210400328, 210400329, 210400330, 210400331, 210400332, 210400333, 2104 00334, 210400335, 210400336, 210400337, 210400338, 210400339, 210400340, 210400341, 210400342, 210400343, 210400344, 210400345, 2 10400346, 210400347, 210400348, 210400349, 210400350, 210400351, 210400352, 210400353, 210400354, 210400355, 210400356, 210400357 , 210400358, 210400359, 210400360, 210400361, 210400362, 210400363, 210400364, 210400365, 210400366, 210400367, 210400368, 210400 369, 210400370, 210400371, 210400372, 210400373, 210400374, 210400375, 210400376, 210400377, 210400378, 210400379, 210400380, 210 0400381, 210400382, 210400383, 210400384, 210400385, 210400386, 210400387, 210400388, 210400389, 210400390, 210400391, 210400392, 210400393, 210400394, 210400395, 210400396, 210400397, 210400398, 210400399, 210400400, 210400401, 210400402, 210400403, 21040040 4, 210400405, 210400406, 210400407, 210400408, 210400409, 210400410, 210400411, 210400412, 210400413, 210400414, 210400415, 21040 0416, 210400417, 210400418, 210400419, 210400420, 210400421, 210400422, 210400423, 210400424, 210400425, 210400426, 210400427, 21 0400428, 210400429, 210400430, 210400431, 210400432, 210400433, 210400434, 210400435, 210400436, 210400437, 210400438, 210400439, 210400440, 210400441, 210400442, 210400443, 210400444, 210400445, 210400446, 210400447, 210400448, 210400449, 210400450, 2104004 51, 210400452, 210400453, 210400454, 210400455, 210400456, 210400457, 210400458, 210400459, 210400460, 210400461, 210400462, 2104 00463, 210400464, 210400465, 210400466, 210400467, 210400468, 210400469, 210400470, 210400471, 210400472, 210400473, 210400474, 2 10400475, 210400476, 210400477, 210400478, 210400479, 210400480, 210400481, 210400482, 210400483, 210400484, 210400485, 210400486 , 210400487, 210400488, 210400489, 210400490, 210400491, 210400492, 210400493, 210400494, 210400495, 210400496, 210400497, 210400 498, 210400499, 210400500, 210400501, 210400502, 210400503, 210400504, 210400505, 210400506, 210400507, 210400508, 210400509, 210 0400510, 210400511, 210400512, 210400513, 210400514, 210400515, 210400516, 210400517, 210400518, 210400519, 210400520, 210400521, 210400522, 210400523, 210400524, 210400525, 210400526, 210400527, 210400528, 210400529, 210400530, 210400531, 210400532, 21040053 3, 210400534, 210400535, 210400536, 210400537, 210400538, 210400539, 210400540, 210400541, 210400542, 210400543, 210400544, 21040 0545, 210400546, 210400547, 210400548, 210400549, 210400550, 210400551, 210400552, 210400553, 210400554, 210400555, 210400556, 21 0400557, 210400558, 210400559, 210400560, 210400561, 210400562, 210400563, 210400564, 210400565, 210400566, 210400567, 210400568, 210400569, 210400570, 210400571, 210400572, 210400573, 210400574, 210400575, 210400576, 210400577, 210400578, 210400579, 2104005 80, 210400581, 210400582, 210400583, 210400584, 210400585, 210400586, 210400587, 210400588, 210400589, 210400590, 210400591, 2104 00592, 210400593, 210400594, 210400595, 210400596, 210400597, 210400598, 210400599, 210400600, 210400601, 210400602, 210400603, 2 10400604, 210400605, 210400606, 210400607, 210400608, 210400609, 210400610, 210400611, 210400612, 210400613, 210400614, 210400615 , 210400616, 210400617, 210400618, 210400619, 210400620, 210400621, 210400622, 210400623, 210400624, 210400625, 210400626, 210400 627, 210400628, 210400629, 210400630, 210400631, 210400632, 210400633, 210400634, 210400635, 210400636, 210400637, 210400638, 210 0400639, 210400640, 210400641, 210400642, 210400643, 210400644, 210400645, 210400646, 210400647, 210400648, 210400649, 210400650, 210400651, 210400652, 210400653, 210400654, 210400655, 210400656, 210400657, 210400658, 210400659, 210400660, 210400661, 210400662 , 210400663, 210400664, 210400665, 210400666, 210400667, 210400668, 210400669, 210400670, 210400671, 210400672, 210400673, 21040067 4, 210400675, 210400676, 210400677, 210400678, 210400679, 210400680, 210400681, 210400682, 210400683, 210400684, 210400685, 21 0400686, 210400687, 210400688, 210400689, 210400690, 210400691, 210400692, 210400693, 210400694, 210400695, 210400696, 210400697, 210400698, 210400699, 210400700, 210400701, 210400702, 210400703, 210400704, 210400705, 210400706, 210400707, 210400708, 2104007 09, 210400710, 210400711, 210400712, 210400713, 210400714, 210400715, 210400716, 210400717, 210400718, 210400719, 210400720, 2104 00721, 210400722, 210400723, 210400724, 210400725, 210400726, 210400727, 210400728, 210400729, 210400730, 210400731, 210400732, 2 10400733, 210400734, 210400735, 210400736, 210400737, 210400738, 210400739, 210400740, 210400741, 210400742, 210400743, 210400744 , 210400745, 210400746, 210400747, 210400748, 210400749, 210400750, 210400751, 210400752, 210400753, 210400754, 210400755, 210400 756, 210400757, 210400758, 210400759, 210400760, 210400761, 210400762, 210400763, 210400764, 210400765, 210400766, 210400767, 210 0400768, 210400769, 210400770, 210400771, 210400772, 210400773, 210400774, 210400775, 210400776, 210400777, 210400778, 210400779, 210400780, 210400781, 210400782, 210400783, 210400784, 210400785, 210400786, 210400787, 210400788, 210400789, 210400790, 2104007 91, 210400792, 210400793, 210400794, 210400795, 210400796, 210400797, 210400798, 210400799, 210400800, 210400801, 210400802, 2104 00803, 210400804, 210400805, 210400806, 210400807, 210400808, 210400809, 210400810, 210400811, 210400812, 210400813, 210400814, 21 0400815, 210400816, 210400817, 210400818, 210400819, 210400820, 210400821, 210400822, 210400823, 210400824, 210400825, 210400826, 210400827, 210400828, 210400829, 210400830, 210400831, 210400832, 210400833, 210400834, 210400835, 210400836, 210400837, 2104008 38, 210400839, 210400840, 210400841, 210400842, 210400843, 210400844, 210400845, 210400846, 210400847, 210400848, 210400849, 2104 00850, 210400851, 210400852, 210400853, 210400854, 210400855, 210400856, 210400857, 210400858, 210400859, 210400860, 210400861, 2 10400862, 210400863, 210400864, 210400865, 210400866, 210400867, 210400868, 210400869, 210400870, 210400871, 210400872, 210400873

482021000480247-3

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 4820210004802 47-3

Subpartida : 9018909000

186. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, modelos y otros)

, 210400874, 210400875, 210400876, 210400877, 210400878, 210400879, 210400880, 210400881, 210400882, 210400883, 210400884, 210400
885, 210400886, 210400887, 210400888, 210400889, 210400890, 210400891, 210400892, 210400893, 210400894, 210400895, 210400896, 210
400897, 210400898, 210400899, 210400900, 210400901, 210400902, 210400903, 210400904, 210400905, 210400906, 210400907, 210400908,
210400909, 210400910, 210400911, 210400912, 210400913, 210400914, 210400915, 210400916, 210400917, 210400918, 210400919, 210400920
0, 210400921, 210400922, 210400923, 210400924, 210400925, 210400926, 210400927, 210400928, 210400929, 210400930, 210400931, 21040
0932, 210400933, 210400934, 210400935, 210400936, 210400937, 210400938, 210400939, 210400940, 210400941, 210400942, 210400943, 21
0400944, 210400945, 210400946, 210400947, 210400948, 210400949, 210400950, 210400951, 210400952, 210400953, 210400954, 210400955,
210400956, 210400957, 210400958, 210400959, 210400960, 210400961, 210400962, 210400963, 210400964, 210400965, 210400966, 2104009
67, 210400968, 210400969, 210400970, 210400971, 210400972, 210400973, 210400974, 210400975, 210400976, 210400977, 210400978, 2104
00979, 210400980, 210400981, 210400982, 210400983, 210400984, 210400985, 210400986, 210400987, 210400988, 210400989, 210400990, 2
10400991, 210400992, 210400993, 210400994, 210400995, 210400996, 210400997, 210400998, 210400999, 210401000, DESCRIPCION FACTURA:
ITEM HS-20C CHILD KIT TYPE SPHYGMOMANOMETER CANT (1000) U (ITEM 1). PRODUCTO: TENSIOMETRO ANEROIDE ESFINGMANÓMETRO / TENSIOMETR
O, MARCA: HONSUN-DM, MODELO: HS-20A, REFERENCIA: HS-20A, USO O DESTINO: UN TENSIOMETRO ANEROIDEESUTILIZADO POR PROFESIONALES DE L
A SALUD OPERSONAL ENTRENADO EN LA TÉCNICA DE PRESIÓN ARTERIAL AUSCULTATORIA PARA DETERMINAR LA PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICAY DIASTÓ
LICA EN LOS SERES HUMANOS, TECNICA DE DIAGNOSTICO: TECNICA MANUAL, SERIAL: 210409581, 210409582, 210409583, 210409584, 210409585,
210409586, 210409587, 210409588, 210409589, 210409590, 210409591, 210409592, 210409593, 210409594, 210409595, 210409596, 2104095
97, 210409598, 210409599, 210409600, 210409601, 210409602, 210409603, 210409604, 210409605, 210409606, 210409607, 210409608, 2104
09609, 210409610, 210409611, 210409612, 210409613, 210409614, 210409615, 210409616, 210409617, 210409618, 210409619, 210409620, 2
10409621, 210409622, 210409623, 210409624, 210409625, 210409626, 210409627, 210409628, 210409629, 210409630, 210409631, 210409632
, 210409633, 210409634, 210409635, 210409636, 210409637, 210409638, 210409639, 210409640, 210409641, 210409642, 210409643, 210409
644, 210409645, 210409646, 210409647, 210409648, 210409649, 210409650, 210409651, 210409652, 210409653, 210409654, 210409655, 210
409656, 210409657, 210409658, 210409659, 210409660, 210409661, 210409662, 210409663, 210409664, 210409665, 210409666, 210409667,
210409668, 210409669, 210409670, 210409671, 210409672, 210409673, 210409674, 210409675, 210409676, 210409677, 210409678, 210409679
9, 210409680, 210409681, 210409682, 210409683, 210409684, 210409685, 210409686, 210409687, 210409688, 210409689, 210409690, 21040
9691, 210409692, 210409693, 210409694, 210409695, 210409696, 210409697, 210409698, 210409699, 210409700, 210409701, 210409702, 21
0409703, 210409704, 210409705, 210409706, 210409707, 210409708, 210409709, 210409710, 210409711, 210409712, 210409713, 210409714,
210409715, 210409716, 210409717, 210409718, 210409719, 210409720, 210409721, 210409722, 210409723, 210409724, 210409725, 210409726,
210409727, 210409728, 210409729, 210409730, 210409731, 210409732, 210409733, 210409734, 210409735, 210409736, 210409737, 210409738,
210409738, 210409740, 210409741, 210409742, 210409743, 210409744, 210409745, 210409746, 210409747, 210409748, 210409749, 210409750,
210409750, 210409751, 210409752, 210409753, 210409754, 210409755, 210409756, 210409757, 210409758, 210409759, 210409760, 210409761
210409762, 210409763, 210409764, 210409765, 210409766, 210409767, 210409768, 210409769, 210409770, 210409771, 210409772, 210409773,
210409774, 210409775, 210409776, 210409777, 210409778, 210409779, 210409780, 210409781, 210409782, 210409783, 210409784, 210409785,
210409786, 210409787, 210409788, 210409789, 210409790, 210409791, 210409792, 210409793, 210409794, 210409795, 210409796, 210409797,
210409798, 210409799, 210409800, 210409801, 210409802, 210409803, 210409804, 210409805, 210409806, 210409807, 210409808, 210409809,
210409810, 210409811, 210409812, 210409813, 210409814, 210409815, 210409816, 210409817, 210409818, 210409819, 210409820, 210409821,
210409822, 210409823, 210409824, 210409825, 210409826, 210409827, 210409828, 210409829, 210409830, 210409831, 210409832, 210409833,
210409834, 210409835, 210409836, 210409837, 210409838, 210409839, 210409840, 210409841, 210409842, 210409843, 210409844, 210409845,
210409846, 210409847, 210409848, 210409849, 210409850, 210409851, 210409852, 210409853, 210409854, 210409855, 210409856, 210409857,
210409858, 210409859, 210409860, 210409861, 210409862, 210409863, 210409864, 210409865, 210409866, 210409867, 210409868, 210409869,
210409870, 210409871, 210409872, 210409873, 210409874, 210409875, 210409876, 210409877, 210409878, 210409879, 210409880, 210409881,
210409882, 210409883, 210409884, 210409885, 210409886, 210409887, 210409888, 210409889, 210409890, 210409891, 210409892, 210409893,
210409894, 210409895, 210409896, 210409897, 210409898, 210409899, 210409900, 210409901, 210409902, 210409903, 210409904, 210409905,
210409906, 210409907, 210409908, 210409909, 210409910, 210409911, 210409912, 210409913, 210409914, 210409915, 210409916, 210409917,
210409918, 210409919, 210409920, 210409921, 210409922, 210409923, 210409924, 210409925, 210409926, 210409927, 210409928, 210409929,
210409930, 210409931, 210409932, 210409933, 210409934, 210409935, 210409936, 210409937, 210409938, 210409939, 210409940, 210409941,
210409942, 210409943, 210409944, 210409945, 210409946, 210409947, 210409948, 210409949, 210409950, 210409951, 210409952, 210409953,
210409954, 210409955, 210409956, 210409957, 210409958, 210409959, 210409960, 210409961, 210409962, 210409963, 210409964, 210409965,
210409966, 210409967, 210409968, 210409969, 210409970, 210409971, 210409972, 210409973, 210409974, 210409975, 210409976, 210409977,
210409978, 210409979, 210409980, 210409981, 210409982, 210409983, 210409984, 210409985, 210409986, 210409987, 210409988, 210409989,
210409990, 210409991, 210409992, 210409993, 210409994, 210409995, 210409996, 210409997, 210409998, 210409999, 210410000, 210410001,
210410002, 210410003, 210410004, 210410005, 210410006, 210410007, 210410008, 210410009, 210410010, 210410011, 210410012, 210410013,
210410014, 210410015, 210410016, 210410017, 210410018, 210410019, 210410020, 210410021, 210410022, 210410023, 210410024, 210410025,
210410026, 210410027, 210410028, 210410029, 210410030, 210410031, 210410032, 210410033, 210410034, 210410035, 210410036, 210410037,
210410038, 210410039, 210410040, 210410041, 210410042, 210410043, 210410044, 210410045, 210410046, 210410047, 210410048, 210410049,
210410050, 210410051, 210410052, 210410053, 210410054, 210410055, 210410056, 210410057, 210410058, 210410059, 210410060, 210410061,
210410062, 210410063, 210410064, 210410065, 210410066, 210410067, 210410068, 210410069, 210410070, 210410071, 210410072, 210410073,
210410074, 210410075, 210410076, 210410077, 210410078, 210410079, 210410080, 210410081, 210410082, 210410083, 210410084, 210410085,
210410086, 210410087, 210410088, 210410089, 210410090, 210410091, 210410092, 210410093, 210410094, 210410095, 210410096, 210410097,
210410098, 210410099, 210410100, 210410101, 210410102, 210410103, 210410104, 210410105, 210410106, 210410107, 210410108, 210410109,
210410110, 210410111, 210410112, 210410113, 210410114, 210410115, 210410116, 210410117, 210410118, 210410119, 210410120, 210410121,
210410122, 210410123, 210410124, 210410125, 210410126, 210410127, 210410128, 210410129, 210410130, 210410131, 210410132, 210410133,
210410134, 210410135, 210410136, 210410137, 210410138, 210410139, 210410140, 210410141, 210410142, 210410143, 210410144, 210410145,
210410146, 210410147, 210410148, 210410149, 210410150, 210410151, 210410152, 210410153, 210410154, 210410155, 210410156, 210410157,
210410158, 210410159, 210410160, 210410161, 210410162, 210410163, 210410164, 210410165, 210410166, 210410167, 210410168, 210410169,
210410170, 210410171, 210410172, 210410173, 210410174, 210410175, 210410176, 210410177, 210410178, 210410179, 210410180, 210410181,
210410182, 210410183, 210410184, 210410185, 210410186, 210410187, 210410188, 210410189, 210410190, 210410191, 210410192, 210410193,
210410194, 210410195, 210410196, 210410197, 210410198, 210410199, 210410200, 210410201, 210410202, 210410203, 210410204, 210410205,
210410206, 210410207, 210410208, 210410209, 210410210, 210410211, 210410212, 210410213, 210410214, 210410215, 210410216, 210410217,
210410218, 210410219, 210410220, 210410221, 210410222, 210410223, 210410224, 210410225, 210410226, 210410227, 210410228, 210410229,
210410230, 210410231, 210410232, 210410233, 210410234, 210410235, 210410236, 210410237, 210410238, 210410239, 210410240, 210410241,
210410242, 210410243, 210410244, 210410245, 210410246, 210410247, 210410248, 210410249, 210410250, 210410251, 210410252, 210410253,
210410254, 210410255, 210410256, 210410257, 210410258, 210410259, 210410260, 210410261, 210410262, 210410263, 210410264, 210410265,
210410266, 210410267, 210410268, 210410269, 210410270, 210410271, 210410272, 210410273, 210410274, 210410275, 210410276, 210410277,
210410278, 210410279, 210410280, 210410281, 210410282, 210410283, 210410284, 210410285, 210410286, 210410287, 210410288, 210410

4820210004802 47-3

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 482021000480247-3

Subpartida : 9018909000

106. Continuación descripción mercancías (incluye marcas, modelos y otros)

289, 210410290, 210410291, 210410292, 210410293, 210410294, 210410295, 210410296, 210410297, 210410298, 210410299, 210410300, 210
4410301, 210410302, 210410303, 210410304, 210410305, 210410306, 210410307, 210410308, 210410309, 210410310, 210410311, 210410312,
210410313, 210410314, 210410315, 210410316, 210410317, 210410318, 210410319, 210410320, 210410321, 210410322, 210410323, 21041032
4, 210410325, 210410326, 210410327, 210410328, 210410329, 210410330, 210410331, 210410332, 210410333, 210410334, 210410335, 21041
0336, 210410337, 210410338, 210410339, 210410340, 210410341, 210410342, 210410343, 210410344, 210410345, 210410346, 210410347, 21
0410348, 210410349, 210410350, 210410351, 210410352, 210410353, 210410354, 210410355, 210410356, 210410357, 210410358, 210410359,
210410360, 210410361, 210410362, 210410363, 210410364, 210410365, 210410366, 210410367, 210410368, 210410369, 210410370, 2104103
71, 210410372, 210410373, 210410374, 210410375, 210410376, 210410377, 210410378, 210410379, 210410380, 210410381, 210410382, 2104
10383, 210410384, 210410385, 210410386, 210410387, 210410388, 210410389, 210410390, 210410391, 210410392, 210410393, 210410394, 2
10410395, 210410396, 210410397, 210410398, 210410399, 210410400, 210410401, 210410402, 210410403, 210410404, 210410405, 210410406
, 210410407, 210410408, 210410409, 210410410, 210410411, 210410412, 210410413, 210410414, 210410415, 210410416, 210410417, 210410
418, 210410419, 210410420, 210410421, 210410422, 210410423, 210410424, 210410425, 210410426, 210410427, 210410428, 210410429, 210
4410430, 210410431, 210410432, 210410433, 210410434, 210410435, 210410436, 210410437, 210410438, 210410439, 210410440, 210410441,
210410442, 210410443, 210410444, 210410445, 210410446, 210410447, 210410448, 210410449, 210410450, 210410451, 210410452, 21041045
3, 210410454, 210410455, 210410456, 210410457, 210410458, 210410459, 210410460, 210410461, 210410462, 210410463, 210410464, 21041
0465, 210410466, 210410467, 210410468, 210410469, 210410470, 210410471, 210410472, 210410473, 210410474, 210410475, 210410476, 21
0410477, 210410478, 210410479, 210410480, 210410481, 210410482, 210410483, 210410484, 210410485, 210410486, 210410487, 210410488,
210410489, 210410490, 210410491, 210410492, 210410493, 210410494, 210410495, 210410496, 210410497, 210410498, 210410499, 2104105
00, 210410501, 210410502, 210410503, 210410504, 210410505, 210410506, 210410507, 210410508, 210410509, 210410510, 210410511, 2104
10512, 210410513, 210410514, 210410515, 210410516, 210410517, 210410518, 210410519, 210410520, 210410521, 210410522, 210410523, 2
10410524, 210410525, 210410526, 210410527, 210410528, 210410529, 210410530, 210410531, 210410532, 210410533, 210410534, 210410535
, 210410536, 210410537, 210410538, 210410539, 210410540, 210410541, 210410542, 210410543, 210410544, 210410545, 210410546, 210410
547, 210410548, 210410549, 210410550, 210410551, 210410552, 210410553, 210410554, 210410555, 210410556, 210410557, 210410558, 210
4410559, 210410560, 210410561, 210410562, 210410563, 210410564, 210410565, 210410566, 210410567, 210410568, 210410569, 210410570,
210410571, 210410572, 210410573, 210410574, 210410575, 210410576, 210410577, 210410578, 210410579, 210410580, DESCRIPCION FACTURA
: ITEM HS-20A SPHYGMOMANOMETER CANT (1000) U (ITEM 7).XXXX

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CONSECUTIVO DE CALIBRACIÓN N° 20216429

Fecha de Calibración: 25 DE AGOSTO DE 2021

CLIENTE

NOMBRE	ARCRON	**TELEFONO**	315 315 71 90
DIRECCIÓN	CALLE 34 SUR NO. 69 - 73	**CIUDAD**	BOGOTÁ

DATOS GENERALES

EQUIPO	TENSIOMETRO	**MARCA**	GMD DIAGNOSTIC
MODELO	ADULTO	**SERIE**	NO REGISTRA
SERVICIO	AMBULANCIA	**UBICACIÓN**	MOVIL

EQUIPO PATRÓN

NO. CERTIFICADO	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	MAGNITUDES EVALUADAS	SERIE	FECHA DE CALIBRACIÓN	PROXIMA CALIBRACIÓN
J4402-21	PROSIM 4	PRESIÓN NO INVASIVA (NIBP) FRECUENCIA CARDIACA ELECTROCARDIOGRAFÍA RESPIRACIÓN	4164043	2021/04/10	2022/04

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN

La verificación de calibración se realiza utilizando equipos de medición certificados, con certificado de calibración vigente a la fecha, realizada bajo los parámetros establecidos por el fabricante y con normatividad internacional, los procedimientos específicos son:

Para la medición de la presión no invasiva en sangre (NIBP) en tensiómetros portátiles o de pared ya sean análogos o digitales, se utiliza un equipo marca: FLUKE modelo: PROSIM 4 serie: 4164043, el cual mide las presiones que se colocan en el mesurando las lecturas son registradas y entregadas en el reporte.

Este certificado expresa el resultado de las mediciones al momento y condiciones referenciados y no podrá ser reproducido sin permiso, la periodicidad de verificación queda sujeta a términos apropiados según la recomendación de la empresa ejecutante y el usuario contratante.

La empresa GyC Medicals SAS. No autoriza la reproducción parcial ni total de este documento sin permiso escrito.

RESPONSABLE DE LAS MEDICIONES
Ing- Donnadine Velandia

COORDINADOR DE METROLOGÍA
Ing. Edwin Canizales

CONSECUTIVO DE CALIBRACIÓN N° 20216429

Fecha de Calibración: 25 DE AGOSTO DE 2021

CONDICIONES AMBIENTALES

PRESIÓN ATMOSFÉRICA	TEMPERATURA AIRE	HUMEDAD RELATIVA
540 – 660 mmHg	20 - 40 °C	40,5 – 70,5%

RANGOS DE MEDICIÓN

1. **Medición de presión Ascendente (mmHg): Tolerancias +/- 2**

Valores Patrón mmHg	Medida 1	Medida 2	Medida 3	Promedio	Error Prom	Incertidumbre
50,00	51,7	51,7	51,7	51,70	1,70	0,00
100,00	102,0	102,0	102,0	102,00	2,00	0,00
150,00	152,0	152,0	152,0	152,00	2,00	0,00
200,00	202,0	202,0	202,0	202,00	2,00	0,00
250,00	252,0	252,0	252,0	252,00	2,00	0,00
300,00	298,0	301,0	302,0	300,33	0,33	1,20

2. **Medición de presión Descendente (mmHg): Tolerancias +/- 2**

Valores Patrón mmHg	Medida 1	Medida 2	Medida 3	Promedio	Error Prom	Incertidumbre
300,00	295,3	295,3	295,3	295,30	4,70	0,00
250,00	243,1	243,1	243,1	243,10	6,90	0,00
200,00	198,5	198,5	198,5	198,50	1,50	0,00
150,00	146,5	146,5	146,5	146,50	3,50	0,00
100,00	96,6	96,6	96,6	96,60	3,40	0,00
50,00	49,2	49,2	49,2	49,20	0,80	0,00

FIN DEL CERTIFICADO

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CONSECUTIVO DE CALIBRACIÓN N° 20216430

Fecha de Calibración: 25 DE AGOSTO DE 2021

CLIENTE

NOMBRE	ARCRON	**TELEFONO**	315 315 71 90
DIRECCIÓN	CALLE 34 SUR NO. 69 - 73	**CIUDAD**	BOGOTÁ

DATOS GENERALES

EQUIPO	TENSIOMETRO	**MARCA**	GMD DIAGNOSTIC
MODELO	ADULTO	**SERIE**	NO REGISTRA
SERVICIO	AMBULANCIA	**UBICACIÓN**	MOVIL

EQUIPO PATRÓN

NO. CERTIFICADO	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	MAGNITUDES EVALUADAS	SERIE	FECHA DE CALIBRACIÓN	PROXIMA CALIBRACIÓN
14402-21	PROSIM 4	PRESIÓN NO INVASIVA (NIBP) FRECUENCIA CARDIACA ELECTROCARDIOGRAFÍA RESPIRACIÓN	4164043	2021/04/10	2022/04

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN

La verificación de calibración se realiza utilizando equipos de medición certificados, con certificado de calibración vigente a la fecha, realizada bajo los parámetros establecidos por el fabricante y con normatividad internacional, los procedimientos específicos son:

Para la medición de la presión no invasiva en sangre (NIBP) en tensiómetros portátiles o de pared ya sean análogos o digitales, se utiliza un equipo marca: FLUKE modelo: PROSIM 4 serie: 4164043, el cual mide las presiones que se colocan en el mesurando las lecturas son registradas y entregadas en el reporte.

Este certificado expresa el resultado de las mediciones al momento y condiciones referenciados y no podrá ser reproducido sin permiso, la periodicidad de verificación queda sujeta a términos apropiados según la recomendación de la empresa ejecutante y el usuario contratante.

La empresa G&C Medicals SAS. No autoriza la reproducción parcial ni total de este documento sin permiso escrito.

RESPONSABLE DE LAS MEDICIONES
Ing- Donnadine Velandia

COORDINADOR DE METROLOGÍA
Ing. Edwin Canizales

CONSECUTIVO DE CALIBRACIÓN N° 20216430

Fecha de Calibración: 25 DE AGOSTO DE 2021

CONDICIONES AMBIENTALES

PRESIÓN ATMOSFÉRICA	TEMPERATURA AIRE	HUMEDAD RELATIVA
540 – 660 mmHg	20 - 40 °C	40,5 – 70,5%

RANGOS DE MEDICIÓN

1. **Medición de presión Ascendente (mmHg): Tolerancias +/- 2**

Valores Patrón mmHg	Medida 1	Medida 2	Medida 3	Promedio	Error Prom	Incertidumbre
50,00	51,7	51,7	51,0	51,47	1,47	0,23
100,00	102,0	102,0	101,0	101,67	1,67	0,33
150,00	152,0	152,0	151,0	151,67	1,67	0,33
200,00	202,0	202,0	200,0	201,33	1,33	0,67
250,00	252,0	252,0	250,0	251,33	1,33	0,67
300,00	298,0	301,0	300,0	299,67	0,33	0,88

2. **Medición de presión Descendente (mmHg): Tolerancias +/- 2**

Valores Patrón mmHg	Medida 1	Medida 2	Medida 3	Promedio	Error Prom	Incertidumbre
300,00	304,1	304,1	304,1	304,10	4,10	0,00
250,00	250,3	250,3	250,3	250,30	0,30	0,00
200,00	200,6	200,6	200,6	200,60	0,60	0,00
150,00	154,1	154,1	154,1	154,10	4,10	0,00
100,00	101,4	101,4	101,4	101,40	1,40	0,00
50,00	50,1	50,1	50,1	50,10	0,10	0,00

FIN DEL CERTIFICADO

Certificado de Calibración

Certificado #
J4402-21

PLANTILLA: FO-2019-17-CAL-Rev.2

Laboratorio de Metrología Set y Gad S.A.S. — Bogotá

Procedimiento de calibración:	INS-LAB-MAST-201		
Descripción del equipo:	SIMULADOR DE SIGNOS VITALES		
Fabricante:	FLUKE BIOMEDICAL	**Fecha de recepción:**	2021 / 04 / 10
Modelo:	PROSIM 4	**Fecha de calibración:**	2021 / 04 / 10
Serie:	4164043	**Fecha de emisión:**	2021 / 04 / 10
Código:	N/A	**Fecha próxima calibración:**	N/A
Orden de trabajo:	19341	**Temperatura:**	23,05 ± 0,15 °C
Condición recibido:	Operable	**Humedad relativa:**	51,80 ± 0,10 % HR
Datos de calibración:	Calibración	**Presión barométrica:**	749,0 ± 0,8 hPa
Lugar de calibración:	Laboratorio de Metrología Set y Gad S.A.S.		

Nombre del cliente:	G Y C MEDICAL SAS
Dirección:	CL 40 25 07 — BOGOTA

Los resultados de este certificado de calibración son trazables al SI a través de un instituto de calibración reconocido (o directamente a través a nacional), fuentes naturales y cumplen con la norma ISO 17025:2017 y NIST Handbook 150 (NVLAP) y con la norma ISO 17025:2005, (INAC).

El instrumento fue calibrado usando el método de comparación directa. La calibración se ha completado de acuerdo a las guías del sistema de calidad de Set y Gad S.A.S. para documentos de Certificados de Calibración.

Los certificados de calibración sin firma no serán válidos. Este certificado aplica únicamente a los ítems identificados. La reproducción parcial o completa debe hacerse con la aprobación escrita de Set y Gad S.A.S. Este certificado no podrá ser usado para sostener ensayos de un producto ante el ente acreditador.

Este certificado puede contener datos que no están dentro del alcance de la acreditación. Los puntos de ajustes no acreditados, cuando aplique, son indicados por un asterisco (*) para NVLAP y un signo de admiración (!) para ONAC, o combinados a ambos claramente identificados. Las pruebas de funcionamiento no son acreditadas. Un certificado en las logos de un ente acreditador no cuenta con acreditación.

El tipo de datos que pueden ser encontrados en este certificado deben ser interpretados así:
– Calibración Antes de Ajuste – Datos de calibración obtenidos antes de que el equipo haya pasado sin ajustarlo y/o reparado.
– Calibración después de Ajuste – Datos de calibración obtenidos después de que el equipo haya pasado sin ajustarlo y/o reparado.
– Calibración – Datos de calibración obtenidos sin haber realizado ninguna clase de ajustes y/o reparación.

La incertidumbre asociada al momento de la prueba es dada donde aplica. Es calculada de acuerdo con el documento de sistema de calidad de Set y Gad S.A.S. P-LAB-0004, y está relacionado con la guía para la expresión de la incertidumbre en mediciones (JCGM). La incertidumbre expandida de la medición reportada se declara como la incertidumbre estándar de la medida multiplicada por un factor de cobertura k tal que la probabilidad de cobertura corresponda a aproximadamente 95%, y esta se indica en cada una de las mediciones.

Cuando se hace declaración de cumplimiento, el laboratorio hace referencia a las especificaciones del laboratorio, normas o requisitos declarados por el cliente. La toma del valor absoluto del error más la incertidumbre deben estar dentro de los límites de especificación para que la medición se tome como conforme. La regla de decisión aplicada en estos casos sera de aceptación o rechazo simple según el ASME B89.7.3.1 numerales 3 y 4.1. La probabilidad de dar una aceptación falsa o un rechazo falso no es determinada al laboratorio de metrología de Set y Gad S.A.S., sin embargo se puede calcular de acuerdo a la guía JCGM 106:2012 según su numeral 8. La regla aplica a los resultados numéricos que muestran la columna Resultado.

El certificado de calibración no debe ser usado para la certificación, aprobación o rechazo de un producto por NVLAP, NIST o cualquier agencia del Gobierno de USA.

Revisó y autorizó calibración
Ing. Luis Felipe Uribe Agudelo

SET GAD S.A.S
METROLOGIA

Certificado de Calibración

Certificado #
J4402--21

PROCEDIMIENTO V2 (MRO-P1) Versión 2

Patrones de calibración

Instrumento	Serie	Validez	ID certificado
FUENTE DE VOLTAJE	MY40010397	2021 / 09 / 30	JP088-19
MULTIMETRO	1468006	2021 / 03 / 31	JP074-19
CONTADOR UNIVERSAL	MY47001582	2021 / 12 / 31	5-CSW4A-20-1
PATRON DE PRESION	6Z2635-2	2021 / 10 / 31	173052

* Los valores utilizados han sido calibrados con trazabilidad a patrones nacionales o internacionales que realizan la realización de las unidades del SI (1998)

Información Adicional

Declaración de cumplimiento según:
Manual de fabricante. Numeral/Sección: Especificaciones técnicas

Adiciones, desviaciones o exclusiones del método:
N/A

Datos suministrados por el cliente:
N/A

Comentarios:
N/A

* El Laboratorio de Metrología SET-GAD S.A.S. no se hace responsable por cualquier información suministrada por el cliente que afecte los resultados de la medición.

Resultados de la Medición

Calibración de NIBP

Nominal	EBC mmHg	Medido mmHg	Corrección mmHg	Incertidumbre mmHg	Tolerancia mmHg	Pasa/Falla	k
0,0 mmHg	0,00000	0,0	0,000	0,058	1,0	Pasa	2,00
50,0 mmHg	50,0000	50,1	-0,100	0,058	1,5	Pasa	2,00
100,0 mmHg	100,0000	100,0	0,000	0,058	2,0	Pasa	2,00
150,0 mmHg	150,000	149,8	0,200	0,058	2,5	Pasa	2,00
200,0 mmHg	200,000	199,7	0,300	0,058	3,0	Pasa	2,00
250,0 mmHg	250,000	249,5	0,500	0,058	3,5	Pasa	2,00
300,0 mmHg	300,000	299,4	0,600	0,058	4,0	Pasa	2,00
350,0 mmHg	350,000	349,3	0,700	0,058	4,5	Pasa	2,00
400,0 mmHg	400,000	399,3	0,700	0,058	5,0	Pasa	2,00
50,0 mmHg	50,0000	50,1	-0,100	0,058	1,5	Pasa	2,00
0,0 mmHg	0,00000	0,0	0,000	0,058	1,0	Pasa	2,00

SET GAS METROLOGÍA

Certificado de Calibración

Certificado #
J4402-21

Resultados de la Medición

Calibración de Respiración

Nominal	EBC Resp/min	Medido Resp/min	Corrección Resp/min	Incertidumbre Resp/min	Tolerancia Resp/min	Pasa/Falla	k
30,0 Resp/min	30,0	30,0	0,0000	0,0021	1,5	Pasa	2,00
40,0 Resp/min	40,0	40,0	0,0000	0,0021	2,0	Pasa	2,00
60,0 Resp/min	60,0	60,0	0,0000	0,0021	3,0	Pasa	2,00
100,0 Resp/min	100,0	100,0	0,0000	0,0021	5,0	Pasa	2,00

Calibración de ECG

Nominal	EBC BPM	Medido BPM	Corrección BPM	Incertidumbre BPM	Tolerancia BPM	Pasa/Falla	k
60,0 BPM	60,0	60,0	0,0000	0,0021	0,6	Pasa	2,00
120,0 BPM	120,0	121,0	-1,0000	0,0021	1,2	Pasa	2,00
180,0 BPM	180,0	181,8	-1,8000	0,0021	1,8	Pasa	2,00
240,0 BPM	240,0	240,0	0,0000	0,0021	2,4	Pasa	2,00
300,0 BPM	300,0	300,0	0,0000	0,0021	3,0	Pasa	2,00

Calibración de IBP

Nominal	EBC mmHg	Medido mmHg	Corrección mmHg	Incertidumbre mmHg	Tolerancia mmHg	Pasa/Falla	k
0,0 mmHg	0,0	0	0,00	0,11	1	Pasa	2,00
80,0 mmHg	80,0	80	0,00	0,23	2	Pasa	2,00
160,0 mmHg	160,0	160	0,00	0,39	3	Pasa	2,00
250,0 mmHg	250,0	250	0,00	0,57	4	Pasa	2,00

FIN DEL CERTIFICADO

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
¡Trabajamos con el CORAZÓN!

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN E.S.E.

HOJA DE VIDA DE EQUIPO



INFORMACION DEL EQUIPO	
EQUIPO: FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	MARCA: BOKANG
MODELO: GMD30-DC	SERIE / TIPO: N/R
Nº INVENTARIO / ACTIVO: NO REGISTRA	REGISTRO INIVIMA: 2011DM-0007887
SERVICIO: TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	UBICACIÓN: T.A.B GRS-557

REGISTRO DE COMPRA			
FORMA DE ADQUISICION: COMPRA [X]	COMODATO [ ]	DONACION [ ]	
FECHA DE ADQUISICION	AGOSTO 2021		
FECHA DE INSTALACION	AGOSTO 2021		
FECHA VENC. GARANTIA	AGOSTO 2022		
PROVEEDOR	ARCRON	VIDA UTIL (Años)	N/R
[redacted]ANTE	WENZHOU BOKANG INTRUMENTS CO. LTD		

REGISTRO TECNICO	
VOLTAJE: NO APLICA	FRECUENCIA: NO APLICA
CORRIENTE: NO APLICA	POTENCIA: NO APLICA
PRESION: NO APLICA	TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO: 0-40° C
TECNOLOGIA PREDOMINANTE: MECÁNICO	

REGISTRO DE COMPONENTES / ACCESORIOS

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE

REGISTRO DE APOYO TECNICO

CLASIFICACION SEGÚN RIESGO			
[X] I	[ ] IIA	[ ] IIB	[ ] III

MANUALES			
OPERACIÓN		MANTENIMIENTO	

CLASIFICACION BIOMEDICA	
DIAGNOSTICO	X
PREVENCION	
REHABILITACION	
ANALISIS DE LABORATORIO	
TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA	

RECOMENDACIONES DE FABRICANTE


PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO			
BIMESTRAL		TRIMESTRAL	
SEMESTRAL	X	ANUAL	

CALIBRACION	
REQUIERE CALIBRACION	NO
PERIODICIDAD CALIBRACION	NO APLICA

Elaborado por: EQUIMEDICAS MANTENIMIENTO	Revisado por: Calidad	Aprobado por: Gerencia

ARCRON

FICHA TECNICA

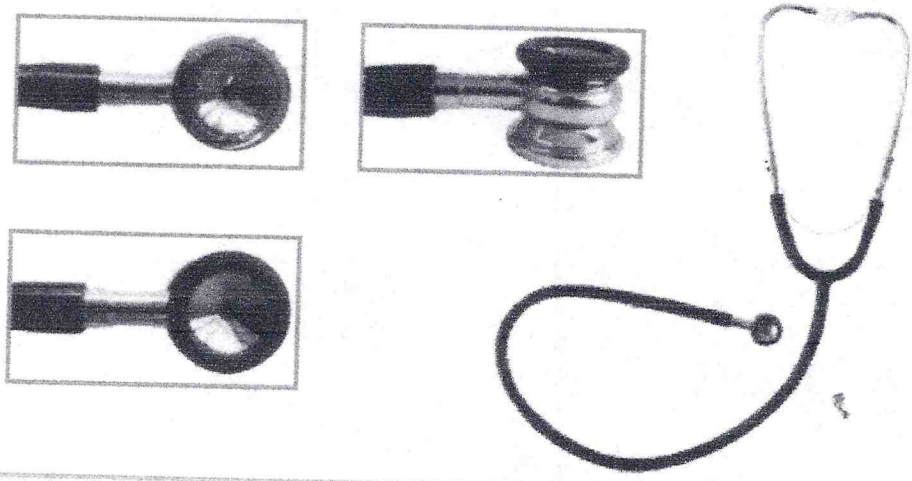

Producto: Fonendoscopio de doble servicio uso infantil - neonatal
Nombre Genérico: Fonendoscopio de doble servicio
Marca Comercial: BOKANG
Fabricante: WENZHOU BOKANG INSTRUMENTS CO. LTD
Origen: China

REGISTRO SANITARIO INVIMA

Registro Sanitario: 2011DM-0007887
Titular: Coralmedica Ltda.
Vigencia: 21/09/2021
Vida útil: 5 Años
Clasificación: I
Importador: Coralmedica
Modalidad: Importar y Vender
Unidad Empaque: Unidad
Unidad Venta: Unidad
Material: Aluminio / Polipropileno
Indicaciones uso: Uso profesional
Sistemas calidad: Prueba de estabilidad yaspecto físico en la línea de producción
Condiciones de Almacenamiento:
Almacenamiento en lugar seco y lejos de olores fuertes.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Campana doble para alta y baja frecuencia, tipo enfermera, tubo binocular en aluminio, tubo en ye
Fabricado en PVC, olivas fijas, colores surtidos.

ACCESORIOS

No Aplica

TAMAÑOS / USOS

Ref. BK3005	Uso infantil - neonatal (40 semana)	Doble Servicio

Tel: 238 0614 - Cel: 315 315 7190
Fax: 403 9211
www.arcron.com.co
j.lopez@arcron.com.co
Calle 34 Sur Nº 69 - 73
Barrio Carvajal - Bogotá, D.C.

<< Atras

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20038768	Nombre producto	ESTETOSCOPIO / FONENDOSCOPIO - BOKANG INSTRUMENTS				
Registro Sanitario	INVIMA 2011DM-0007887	Vencimiento	2021/09/21	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LOS SIGUIENTES MODELOS: BK3001 / BK3002 / BK3003 / BK3004 / BK3005 / BK3006 / BK3007 / BK3008 / BK3009 / BK3010 / BK3012 / BK3013. REPUESTOS: OLIVAS AUDITIVAS, TUBO BINOULAR, MEMBRANA DE FRECUENCIA, TUBO AUDITIVO Y CAMPANA.						
Marcas	BOKANG INSTRUMENTS						

Datos de Interes

Vida Util	0	Miembros Comprometidos	CUERPO HUMANO
Usos	PARA ESCUCHAR Y DETECTAR RUIDOS FISIOLOGICOS DE ORGANOS EN EL CUERPO HUMANO.	Riesgo	I

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
EMPAQUE UNITARIO CON O SIN ACCESORIOS.

Roles por Producto

Rol	Tipo Iden	Identificacion	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	Nit	8300132344	CORALMEDICA LTDA.	CALLE45C BIS No 25-35	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	ventas12@coralmedica.com
FABRICANTE	Consecutivo	7864	WENZHOU BOKANG INSTRUMENTS CO . LTD	No. 1500 Haining Road Haibin, Longwan 325024 Wenzhou China	CHINA			
IMPORTADOR	Nit	8300132344	CORALMEDICA LTDA.	CALLE45C BIS No 25-35	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	ventas12@coralmedica.com
TITULAR REGISTRO SANITARIO	Nit	8300132344	CORALMEDICA LTDA.	CALLE45C BIS No 25-35	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	ventas12@coralmedica.com

Imprimir << Atras

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
¡Trabajamos con el CORAZÓN!

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN E.S.E.

HOJA DE VIDA DE EQUIPO



INFORMACION DEL EQUIPO	
EQUIPO: TENSIOMETRO PEDIATRICO	MARCA: HONSUN
MODELO: HS-20C	SERIE / TIPO: 210400924
Nº INVENTARIO / ACTIVO: NO REGISTRA	REGISTRO INIVIMA: 2020DM-0022495
SERVICIO: TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	UBICACIÓN: T.A.B GRS-557

REGISTRO DE COMPRA			
FORMA DE ADQUISICION: COMPRA [X] COMODATO [ ] DONACION [ ]			
FECHA DE ADQUISICION	AGOSTO 2021		
FECHA DE INSTALACION	AGOSTO 2021		
FECHA VENC. GARANTIA	AGOSTO 2022		
PROVEEDOR	ARCRON	VIDA UTIL (Años)	5
FABRICANTE	HONSUN (NANTONG) CO., LTD		

REGISTRO TECNICO	
VOLTAJE: NO APLICA	FRECUENCIA: NO APLICA
CORRIENTE: NO APLICA	POTENCIA: NO APLICA
PRESION: 0-200mmHg	TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO: 0-35° C
TECNOLOGIA PREDOMINANTE: MECÁNICO	

REGISTRO DE COMPONENTES / ACCESORIOS			
NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE

REGISTRO DE APOYO TECNICO					
CLASIFICACION SEGÚN RIESGO				CLASIFICACION BIOMEDICA	
[X] I	[ ] IIA	[ ] IIB	[ ] III	DIAGNOSTICO	X
				PREVENCION	
				REHABILITACION	
MANUALES				ANALISIS DE LABORATORIO	
OPERACIÓN		MANTENIMIENTO		TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA	

RECOMENDACIONES DE FABRICANTE


PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO				CALIBRACION	
BIMESTRAL		TRIMESTRAL		REQUIERE CALIBRACION	SI
SEMESTRAL	X	ANUAL		PERIODICIDAD CALIBRACION	ANUAL

Elaborado por: EQUIMEDICAS MANTENIMIENTO	Revisado por: Calidad	Aprobado por: Gerencia

ARCRON

TENSIOMETRO PEDIATRICO HONSUN

Marca: HONSUN
Tensiómetro pediátrico y neonatal, tensiómetro aneroide con brazaletes pediátrico y neonatal fabricados en nailon, el cual cuenta con un sujetador para el manómetro. Incluye estuche con cierre de cremallera del mismo color motivos pediátricos.
Especificaciones:

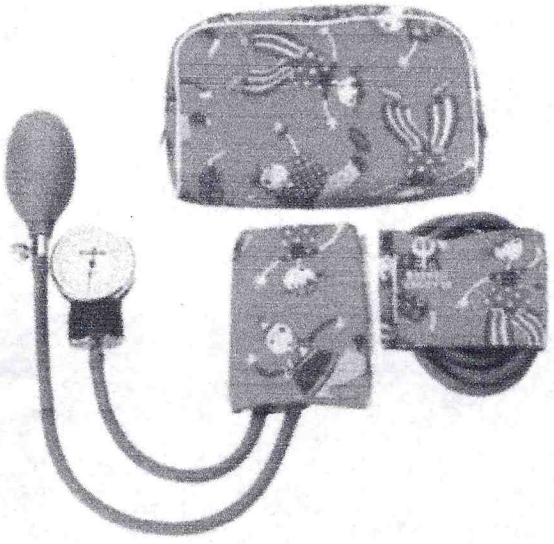

-2 Brazaletes fabricado en nylon (pediátrico y neonatal).
-Bolsa de insuflación libres de látex reutilizable, con cierre en velcro.
-Manómetro tipo reloj.
-Escala graduada de 0 a 200.
-Rango de error de ± 3 mmHg.
-Con mínimo de división de ± 2 mmHg.
-Pera con válvula de liberación de aire libre de látex.
-Manguera fabricada en PVC con longitud de 50cm.
-Incluye maletín de transporte fabricado en Nylon, cierre tipo cremallera.

Tel: 238 0614 - Cel: 315 315 7190
Fax: 403 9211
www.arcron.com.co
j.lopez@arcron.com.co
Calle 34 Sur Nº 69 - 73
Barrio Carvajal - Bogotá, D.C.

La salud es de todos | Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020041773 DE 1 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

CONSIDERANDO

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMATICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.
EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARA EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS A

PRODUCTO:	TENSIOMETRO ANEROIDE PARTES ACCESORIOS Y REPUESTOS - ESFINGOMANÓMETRO / TENSIOMETRO
MARCA:	HONSUN - DM
REGISTRO SANITARIO NO.:	**INVIMA 2020DM-0022495**
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	DATASAVE MEDICAL SAS CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
FABRICANTE(S):	HONSUN (NANTONG) CO., LTD CON DOMICILIO EN CHINA
IMPORTADOR(ES):	DATASAVE MEDICAL SAS CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
ACONDICIONADOR(ES):	DATASAVE MEDICAL SAS CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO:	NO INVASIVO I

COMPOSICIÓN:

PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO	COMPOSICIÓN CUALITATIVA
BOLSO	
BRAZALETE	NYLON - ALGODÓN - PVC
MANGUERA	BOLSA INTERNA EN PVC / LATEX / POLIURETANO
PERA	CON VALVULA EN LATEX
MANOMETRO	ALEACION DE ZINC
LLAVE DE AJUSTE DE MANOMETRO	

USOS: UN TENSIOMETRO ANEROIDE ES UTILIZADO POR PROFESIONALES DE LA SALUD O PERSONAL ENTRENADO EN LA TÉCNICA DE PRESIÓN ATERIAL AUSCULTATORIA PARA DETERMINAR LA PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA Y DIASTÓLICA EN LOS SERES HUMANOS.

PRESENTACIÓN COMERCIAL: CAJA X UNIDAD

OBSERVACIONES: EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LOS MODELOS, PARTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS DEL EQUIPO CODIGO, MODELO O REFERENCIA

FAMILIA	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA
	HS-20A
	HS-20B
	HS-20C

Copia Documento Original

La salud es de todos | Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020041773 DE 1 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

FAMILIA	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA
	HS-20J
	HS-20G
	HS-20F
	HS-20M
	HS-20K
	HS-201A1
	HS-201M1
	HS-201N1
	HS-201J1
	HS-201K1
	HS-201K2
	HS-201Q1
	HS-201Q2
	HS-201T
	HS-201U
	HS-201V
	HS-60A
	HS-60D
	HS-60B
	HS-60C
	HS-60E
	HS-70A
	HS-70B
	HS-70C
	HS-70D
ACCESORIOS	MANOMETRO
ACCESORIOS	ESTUCHE
ACCESORIOS	BOLSA EN LATEX
ACCESORIOS	BOLSA EN PVC
ACCESORIOS	BOLSA EN POLIURETANO
ACCESORIOS	BOLSA LIBRE DE DEHP
ACCESORIOS	BRAZALETE ESTÁNDAR
ACCESORIOS	BRAZALETE CLASICO
ACCESORIOS	PERA CON VALVULA
ACCESORIOS	BRAZALETE PEDIATRICO
ACCESORIOS	LLAVE DE AJUSTE DEL MANOMETRO

VIDA UTIL: 5 AÑOS
EXPEDIENTE NO.: 20192908

Documento Original

La salud es de todos | Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020041773 DE 1 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

ARTICULO SEGUNDO.- CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE LA DIRECCION DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y, DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

ARTICULO TERCERO.- LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

ARTICULO CUARTO.- LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 2005.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN BOGOTÁ D.C. A LOS 1 DE DICIEMBRE DE 2020
ESTE ESPACIO, HASTA LA FIRMA SE CONSIDERA EN BLANCO.

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTOR(A) TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
PROYECTO: LEGAL: ELOPEZ, TÉCNICO: MSANDOVALC, REVISÓ:CORDINA_VARIOS

rmación del Documento Original

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CONSECUTIVO DE CALIBRACIÓN N° 20216428 **Fecha de Calibración:** 25 DE AGOSTO DE 2021

CLIENTE

NOMBRE	ARCRON	TELEFONO	315 315 71 90
DIRECCIÓN	CALLE 34 SUR NO. 69 - 73	CIUDAD	BOGOTÁ

DATOS GENERALES

EQUIPO	TENSIOMETRO	MARCA	HONSUN
MODELO	PEDIATRICO	SERIE	841
SERVICIO	AMBULANCIA	UBICACIÓN	MOVIL

EQUIPO PATRÓN

NO. CERTIFICADO	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	MAGNITUDES EVALUADAS	SERIE	FECHA DE CALIBRACIÓN	PROXIMA CALIBRACIÓN
J4402-21	PROSIM 4	PRESIÓN NO INVASIVA (NIBP) FRECUENCIA CARDIACA ELECTROCARDIOGRAFÍA RESPIRACIÓN	4164043	2021/04/10	2022/04

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN

La verificación de calibración se realiza utilizando equipos de medición certificados, con certificado de calibración vigente a la fecha, realizada bajo los parámetros establecidos por el fabricante y con normatividad internacional, los procedimientos especificos son:

Para la medición de la presión no invasiva en sangre (NIBP) en tensiómetros portátiles o de pared ya sean análogos o digitales, se utiliza un equipo marca: FLUKE modelo: PROSIM 4 serie: 4164043, el cual mide las presiones que se colocan en el mesurando las lecturas son registradas y entregadas en el reporte.

Este certificado expresa el resultado de las mediciones al momento y condiciones referenciados y no podrá ser reproducido sin permiso, la periodicidad de verificación queda sujeta a términos apropiados según la recomendación de la empresa ejecutante y el usuario contratante.

La empresa GyC Medicals SAS. No autoriza la reproducción parcial ni total de este documento sin permiso escrito.

RESPONSABLE DE LAS MEDICIONES
Ing- Donnadine Velandia

COORDINADOR DE METROLOGÍA
Ing. Edwin Canizales

CONSECUTIVO DE CALIBRACIÓN N° 20216428 **Fecha de Calibración:** 25 DE AGOSTO DE 2021

CONDICIONES AMBIENTALES

PRESIÓN ATMOSFÉRICA	TEMPERATURA AIRE	HUMEDAD RELATIVA
540 – 660 mmHg	20 - 40 °C	40,5 – 70,5%

RANGOS DE MEDICIÓN

1. Medición de presión Ascendente (mmHg): Tolerancias +/- 2

Valores Patrón mmHg	Medida 1	Medida 2	Medida 3	Promedio	Error Prom	Incertidumbre
50,00	51,7	51,8	51,6	51,70	1,70	0,06
100,00	100,3	100,3	100,0	100,20	0,20	0,10
150,00	150,0	150,2	150,1	150,10	0,10	0,06
200,00	200,0	200,1	200,2	200,10	0,10	0,06
250,00	250,1	250,2	250,1	250,13	0,13	0,03
300,00	300,2	300,1	300,2	300,17	0,17	0,03

2. Medición de presión Descendente (mmHg): Tolerancias +/- 2

Valores Patrón mmHg	Medida 1	Medida 2	Medida 3	Promedio	Error Prom	Incertidumbre
300,00	298,2	298,2	298,2	298,20	1,80	0,00
250,00	248,8	248,8	248,8	248,80	1,20	0,00
200,00	199,3	199,3	199,3	199,30	0,70	0,00
150,00	150,9	150,9	150,9	150,90	0,90	0,00
100,00	98,6	98,6	98,6	98,60	1,40	0,00
50,00	50,6	50,6	50,6	50,60	0,60	0,00

FIN DEL CERTIFICADO

SET & GAD SAS
METROLOGIA

NVLAP
CALIBRATION
NVLAP LAB CODE 201092-0

Certificado de Calibración

Certificado #
J4402–21

PÁGINA 1 DE 3 | FORMATO 2

Laboratorio de Metrología Set y Gad S.A.S. — Bogotá

Procedimiento de calibración:	INS-LAB-MAST-201		
Descripción del equipo:	SIMULADOR DE SIGNOS VITALES		
Fabricante:	FLUKE BIOMEDICAL	**Fecha de recepción:**	2021 / 04 / 10
Modelo:	PROSIM 4	**Fecha de calibración:**	2021 / 04 / 10
Serie:	4164043	**Fecha de emisión:**	2021 / 04 / 10
Código:	N/A	**Fecha próxima calibración:**	N/A
Orden de trabajo:	19341	**Temperatura:**	23,05 ± 0,15 °C
Condición recibido:	Operable	**Humedad relativa:**	51,50 ± 0,10 % HR
Datos de calibración:	Calibración	**Presión barométrica:**	749,0 ± 0,0 hPa
Lugar de calibración:	Laboratorio de Metrología Set y Gad S.A.S.		

Nombre del cliente:	G Y C MEDICAL SAS
Dirección:	CL 40 25 07 — BOGOTA

Los resultados de este certificado de calibración son trazables al SI a través de un mesurando nacionalmente o acorde a constantes físicas naturales y cumple con la norma ISO 17025:2017 y NIST Handbook 150 (NVLAP) y con la norma ISO 17025:2005 (ONAC).

El instrumento fue calibrado usando el método de comparación directa. La calibración se ha completado de acuerdo a las guías del sistema de calidad de Set y Gad S.A.S. para documentos de Certificados de Calibración.

Los certificados de calibración sin firma no serán válidos. Este certificado aplica únicamente a los ítems identificados. La reproducción parcial o completa debe hacerse con la aprobación escrita de Set y Gad S.A.S. Este certificado no podrá ser usado para reclamar avalúo de un producto bajo el ente acreditador.

Este certificado puede contener datos que no estén dentro del alcance de la acreditación. Los puntos de prueba no acreditados cuando aplique, son indicados por un asterisco (*) para NVLAP y un signo de admiración (!) para ONAC, o contenidos a áreas claramente marcadas. Los puntos de funcionamiento no son acreditados, un certificado sin los logos de un ente acreditador no cuenta con acreditación.

El tipo de datos que pueden ser encontrados en este certificado deben ser interpretados así:
- *Calibración Antes de Ajuste* – Datos de calibración obtenidos antes de que el equipo bajo prueba sea ajustado y/o reparado.
- *Calibración después de Ajuste* – Datos de calibración obtenidos después de que el equipo bajo prueba sea ajustado y/o reparado.
- *Calibración* – Datos de calibración obtenidos sin haber realizado ninguna clase de ajuste y/o reparación.

La incertidumbre medida al momento de la prueba es dada donde aplica. El calculo de acuerdo con el documento de sistema de calidad de Set y Gad S.A.S. P-LAB-006, y está relacionado con la guía para la expresión de la incertidumbre en mediciones GUM. La incertidumbre expandida de la medición reportada es descrita como la incertidumbre estándar de la medida multiplicada por un factor de cobertura k tal que la probabilidad de cobertura corresponde a aproximadamente 95%, a este se indica en cada uno de los mesurandos.

Cuando se hace declaración de cumplimiento, el laboratorio hace referencia a las especificaciones del fabricante, autor, o requisito declarados por el cliente. La regla del valor absoluto del error más la incertidumbre deben estar dentro de los límites de especificación para que la medición se tome como conforme. La regla de decisión aplicada en estos casos es de aceptación o rechazo simple según la ASME B89.7.3.1 numerales 5.1 y 5.3. La probabilidad de dar una aceptación falsa o un rechazo falso no le pertenece al Laboratorio de Metrología de Set y Gad S.A.S., sin embargo se puede calcular de acuerdo a la guía JCGM 106:2012 anglo su numeral 8. La regla aplica a los resultados numéricos que muestran la columna Pass/Fail.

El certificado de calibración no debe ser usado para la certificación, aprobación, o respaldo de un producto por NVLAP, NIST o cualquier agencia del Gobierno de USA.

Revisó y autorizó calibración
Ing. Luis Felipe Uribe Agudelo

SET GAD
METROLOGÍA

Certificado de Calibración

Certificado #
J4402-21

Patrones de calibración

Instrumento	Serie	Validez	ID certificado
FUENTE DE VOLTAJE	MY40010397	2021 / 09 / 30	JP088-19
MULTIMETRO	1468806	2021 / 03 / 31	JP074-19
CONTADOR UNIVERSAL	MY47001582	2021 / 12 / 31	5-C5W4A-20-1
PATRON DE PRESION	622635-2	2021 / 10 / 31	173052

Información Adicional

Declaración de cumplimiento según:
Manual de fabricante. Numeral/Sección: Especificaciones técnicas

Adiciones, desviaciones o exclusiones del método:
N/A

Datos suministrados por el cliente:
N/A

Comentarios:
N/A

Resultados de la Medición

Calibración de NIBP

Nominal	EBC mmHg	Medido mmHg	Corrección mmHg	Incertidumbre mmHg	Tolerancia mmHg	Pasa/Falla	k
0,0 mmHg	0,00000	0,0	0,000	0,058	1,0	Pasa	2,00
50,0 mmHg	50,0000	50,1	-0,100	0,058	1,5	Pasa	2,00
100,0 mmHg	100,0000	100,0	0,000	0,058	2,0	Pasa	2,00
150,0 mmHg	150,000	149,8	0,200	0,058	2,5	Pasa	2,00
200,0 mmHg	200,000	199,7	0,300	0,058	3,0	Pasa	2,00
250,0 mmHg	250,000	249,5	0,500	0,058	3,5	Pasa	2,00
300,0 mmHg	300,000	299,4	0,600	0,058	4,0	Pasa	2,00
350,0 mmHg	350,000	349,3	0,700	0,058	4,5	Pasa	2,00
400,0 mmHg	400,000	399,3	0,700	0,058	5,0	Pasa	2,00
50,0 mmHg	50,0000	50,1	-0,100	0,058	1,5	Pasa	2,00
0,0 mmHg	0,00000	0,0	0,000	0,058	1,0	Pasa	2,00

SET GAD
METROLOGÍA

Certificado de Calibración

Certificado #
J4402--21

Resultados de la Medición

Calibración de Respiración

Nominal	EBC Resp/min	Medido Resp/min	Corrección Resp/min	Incertidumbre Resp/min	Tolerancia Resp/min	Pasa/Falla	k
30,0 Resp/min	30,0	30,0	0,0000	0,0021	1,5	Pasa	2,00
40,0 Resp/min	40,0	40,0	0,0000	0,0021	2,0	Pasa	2,00
60,0 Resp/min	60,0	60,0	0,0000	0,0021	3,0	Pasa	2,00
100,0 Resp/min	100,0	100,0	0,0000	0,0021	5,0	Pasa	2,00

Calibración de ECG

Nominal	EBC BPM	Medido BPM	Corrección BPM	Incertidumbre BPM	Tolerancia BPM	Pasa/Falla	k
60,0 BPM	60,0	60,0	0,0000	0,0021	0,6	Pasa	2,00
120,0 BPM	120,0	121,0	-1,0000	0,0021	1,2	Pasa	2,00
180,0 BPM	180,0	181,0	-1,0000	0,0021	1,8	Pasa	2,00
240,0 BPM	240,0	240,0	0,0000	0,0021	2,4	Pasa	2,00
300,0 BPM	300,0	300,0	0,0000	0,0021	3,0	Pasa	2,00

Calibración de IBP

Nominal	EBC mmHg	Medido mmHg	Corrección mmHg	Incertidumbre mmHg	Tolerancia mmHg	Pasa/Falla	k
0,0 mmHg	0,0	0	0,00	0,11	1	Pasa	2,00
80,0 mmHg	80,0	80	0,00	0,23	2	Pasa	2,00
160,0 mmHg	160,0	160	0,00	0,39	3	Pasa	2,00
250,0 mmHg	250,0	250	0,00	0,57	4	Pasa	2,00

FIN DEL CERTIFICADO