Hospital Centro E.S.E.
Dispuestos a Servir!!

HOJA DE VIDA EQUIPO BIOMÉDICO

VERSIÓN:	
CODIGO:	
AÑO:	
PAG.	

EQUIPO BIOMÉDICO [X] **EQUIPO INDUSTRIAL** [ ]

1. REGISTRO HISTÓRICO

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo:	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED	Activo/Placa:	1264
Marca:	WELCH ALLYN	Fabricante:	WELCH ALLYN
Modelo:	GS777	Año de fab.:	
Serie:	17117	Pais origen:	USA

UBICACIÓN

Unidad de atención:	HOSPITAL CENTRO E.S.E PLANADAS		
Servicio:	PUESTO DE SALUD BILBAO		
Área:	URGENCIAS	Piso	1
Fijo:	X	Movil:	

2. FORMA DE ADQUISICIÓN

Compra directa:	X
Comodato	
Arriendo:	
Donación	
Con:	

3. ANÁLISIS HISTÓRICO

Fecha de compra:	31	10	2021
Finaliza de instalacion:	11	11	2021
Inicio de operación:	12	11	2021
Finaliza garantia:	11	11	2022
Vida util:			2028

4. DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre/razon social:	EBIOCOL S.A.S
Dirección:	CALLE 66A #57-26
Teléfono	3158746243
Fax:	
Ciudad:	MOSQUERA, CUNDINAMARCA

5. REGISTRO TÉCNICO

Voltaje:	100/240	V	Temperatura :	15 A 40	ºC	Dimensiones		cm/mts	5. FUENTE DE ALIMENTACIÓN					
Corriente:	1	A	Humedad relativa	15 A 95	%	Presión	700 A 1060 kPa	psi	Aire:		Electricidad:	X	Oxigeno	
Potencia:		W	Capacidad	NO APLICA		Velocidad	NO APLICA	m/s	Agua:		Derivado del petróleo:		Gas:	
Frecuencia:	50/60	Hz	Peso	1,5 Kg		Presición	NO APLICA		Vapor:		Energía solar:		Otro:	

Accesorios: OTOSCOPIO CON ILUMINADOR DE GARGANTA, OFTALMOSCOPIO DIRRECTO, ADAPTADOR DE VOLTAJE, CONOS

REGISTRO INVIMA: 2012DM-0009186

6. REGISTRO DE APOYO TÉCNICO

MANUALES		PLANOS	USO			RIESGO			CLASE DE TECNOLOGÍA			CLASIFICACIÓN SEGÚN COMPLEJIDAD		CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	
Operación:	X	Electrónicos:	NA	Médico:		Muy Alto	III		Electrónico:	X	Elec/mecánico			Diagnóstico:	X
Mantenimiento		Eléctricos:	NA	Básico:					Eléctrico:		Solar:			Tratamiento y mantenimiento de la vida:	
Partes:		Neumáticos:	NA	Apoyo:	X	Alto	IIB		Neumático:		Vapor:		Alta tecnología	Análisis de laboratorio:	
Despieces:		Mecánicos:	NA			Medio	IIA	X	Mecánico:				Media Tecnología	Rehabilitación:	
		Hidráulicos:	NA			Bajo	I		Hidráulico:				Baja tecnología X	Prevención:	

7. REGISTRO DE MANTENIMIENTO

TIPO DE MANTENIMIENTO				FREC. DE MANT. PREVENTIVO			VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS			
Propio		Garantía	X	Mensual:	Semestral		Mensual		Tetramest	
Contratado		Comodato		Trimestral: X	Anual	X	Trimestral		ANUAL	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
SEGÚN PROTOCOLOS DEL HOSPITAL.

REALIZADO POR: ING. CAMILO ANDREI CASTRO R.
APROVADO POR: CALIDAD

Ebiocol
Metrología Biomédica
Nit. 900695181-1

FICHA TECNICA EQUIPO BIOMÉDICO


EQUIPO:	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED	MARCA:	WELCH ALLYN
MODELO:	GS777	SERIE:	17117
REGISTRO INVIMA:	2012DM-0009186		
ESPECIFICACIONES			
VOLTAJE:	100 V - 240 V	CORRIENTE:	0,18 A max.
FECUENCIA:	50 Hz / 60 Hz	PRESIÓN:	700 kPa a 1060 kPa
TRANSFORMADOR	5V	CORRIENTE:	1A
PESO:	Aprox 1,5 kg	CAPACIADAD:	NO APLICA
TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO	De +15° C A 40 °C (de +59°F~104°F)	HUMEDAD FUNCIONAMIENTO	15 %HR A 95%HR
FUENTE DE ALIMENTACIÓN			
ELECTRICIDAD:	X	AGUA:	
VAPOR:		AIRE:	
NEUMATICO:		OTROS:	
CLASIFICACIÓN			
TIPO ANTIELECTROCHOQUE	Equipo clase II con fuente de alimentación interna.		
GRADO DE SEGURIDAD EN PRESENCIA DE GASES INFLAMABLES	No es apto para su uso en presencia de gases inflamables		
SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO	Equipo de funcionamiento intermitente		

Ebiocol

Metrología Biomédica
Nit. 900695181-1

GUÍA RÁPIDA
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED
Welch Allyn

VISTA FRONTAL
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED

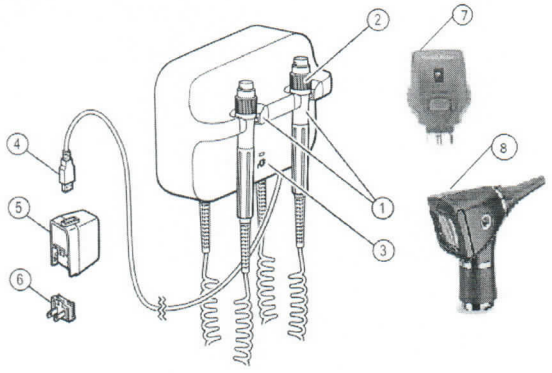

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES DEL EQUIPO

1. Instrumentos de evaluación física -Asas para manijas. Los mangos aceptan cualquier cabezal de instrumento Welch Allyn de 3,5 V. Los soportes de las manijas se apoyan usando una manija a la vez. La manija se enciende automáticamente cuando la quita de un cuna y se apaga cuando lo devuelve.
2. Reóstato: Ubicado en cada mango. Gire en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la luz y gire en sentido antihorario para disminuir la salida de luz.
3. Indicador LED: Indica que hay energía.
4. Cable de alimentación USB.
5. Fuente de alimentación con indicador LED: Fuente de alimentación de plataforma. Indica que hay energía
6. Conector de adaptador.
7. CABEZA DEL OFTALMOSCOPIO DIRECTO: Análisis de estructuras internas del ojo.

A. CABEZA DE OTOSCOPIO CON ILUMINADOR DE GARGANTA

INSTRUCCIONES DE USO

Verificar la funcionalidad:

- Conecte la alimentación al dispositivo y asegúrese de que el indicador LED de alimentación esté encendido.
- Coloque un cabezal (oftalmoscopio directo/otoscopio) de instrumento de trabajo en cada conjunto de mango.
- Retire un asa de la base y verifique la iluminación.
- Pruebe el reóstato de la manija para asegurarse de que la iluminación se ajuste de la salida mínima a la máxima.
- Vuelva a colocar el asa en la base.
- Repita para el mango restante.
- Los cabezales de los instrumentos deben apagarse automáticamente cuando se devuelven a la base.
- Verifique que el indicador este encendido.
- Verifique que al retirar los mangos de la unidad estén encendiendo.
- Al retirar el mango verifique que encienda el bombillo del cabezote 7 correspondiente al oftalmoscopio.
- Al retirar el mango verifique que encienda el bombillo del cabezote 8 correspondiente al otoscopio con iluminador de garganta.
- Al finalizar el procedimiento por favor dejar el equipo en condiciones iniciales, verificando su estado físico y operativo. Si después de realizar las indicaciones mencionadas anteriormente al equipo no funciona alguno de sus parámetros, por favor comunicarse con el departamento de activos fijos o a quien corresponda en el Hospital.

LIMPIEZA

Todas las superficies pueden limpiarse con un paño suave humedecido en alcohol o según protocolos de desinfección del hospital. Se recomienda realiza la desinfección por paciente.

RECOMENDACIONES DE SUMINISTRO DE ELECTRICAS

Conectar el equipo a tomas reguladas (color naranja) de 110/120 Volts.

MANTENIMIENTO

Este equipo debe ser inspeccionado por lo menos una vez cada seis meses, más a menudo si se usa bajo condiciones adversas.


Ingeniería al Servicio de la Salud
Tel. 315 874 6243
E-Mail: operaciones@ebiocol.com

Ebiocol

Metrología Biomédica
Nit. 900695181-1

GUÍA RÁPIDA
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED
Welch Allyn

VISTA FRONTAL
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED

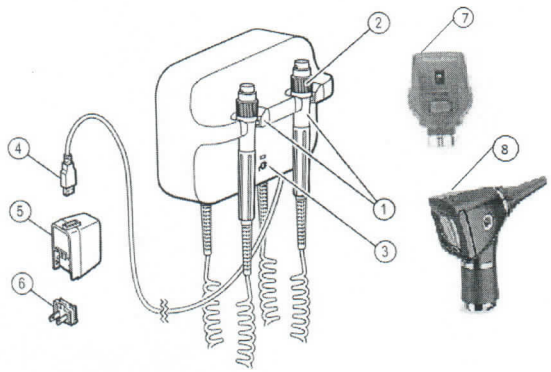

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES DEL EQUIPO

1. Instrumentos de evaluación física -Asas para manijas. Los mangos aceptan cualquier cabezal de instrumento Welch Allyn de 3,5 V. Los soportes de las manijas se apoyan usando una manija a la vez. La manija se enciende automáticamente cuando la quita de un cuna y se apaga cuando lo devuelve.
2. Reóstato: Ubicado en cada mango. Gire en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la luz y gire en sentido antihorario para disminuir la salida de luz.
3. Indicador LED: Indica que hay energía.
4. Cable de alimentación USB.
5. Fuente de alimentación con indicador LED: Fuente de alimentación de plataforma. Indica que hay energía
6. Conector de adaptador.
7. CABEZA DEL OFTALMOSCOPIO DIRECTO: Análisis de estructuras internas del ojo.

A. CABEZA DE OTOSCOPIO CON ILUMINADOR DE GARGANTA

INSTRUCCIONES DE USO

Verificar la funcionalidad:

- Conecte la alimentación al dispositivo y asegúrese de que el indicador LED de alimentación esté encendido.
- Coloque un cabezal (oftalmoscopio directo/otoscopio) de instrumento de trabajo en cada conjunto de mango.
- Retire un asa de la base y verifique la iluminación.
- Pruebe el reóstato de la manija para asegurarse de que la iluminación se ajuste de la salida mínima a la máxima.
- Vuelva a colocar el asa en la base.
- Repita para el mango restante.
- Los cabezales de los instrumentos deben apagarse automáticamente cuando se devuelven a la base.
- Verifique que el indicador este encendido.
- Verifique que al retirar los mangos de la unidad estén encendiendo.
- Al retirar el mango verifique que encienda el bombillo del cabezote 7 correspondiente al oftalmoscopio.
- Al retirar el mango verifique que encienda el bombillo del cabezote 8 correspondiente al otoscopio con iluminador de garganta.
- Al finalizar el procedimiento por favor dejar el equipo en condiciones iniciales, verificando su estado físico y operativo. Si después de realizar las indicaciones mencionadas anteriormente al equipo no funciona alguno de sus parámetros, por favor comunicarse con el departamento de activos fijos o a quien corresponda en el Hospital.

LIMPIEZA

Todas las superficies pueden limpiarse con un paño suave humedecido en alcohol o según protocolos de desinfección del hospital. Se recomienda realiza la desinfección por paciente.

RECOMENDACIONES DE SUMINISTRO DE ELECTRICAS

Conectar el equipo a tomas reguladas (color naranja) de 110/120 Volts.

MANTENIMIENTO

Este equipo debe ser inspeccionado por lo menos una vez cada seis meses, más a menudo si se usa bajo condiciones adversas.

Ingeniería al Servicio de la Salud
Tel. 315 874 6243
E-Mail: operaciones@ebiocol.com

DIAN

Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

03201700140929 2-9

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
860070078	3	IMCOLMEDICA S.A

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CL 36 15 42	2889858	03	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
860028026	3	AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA GRANCOLOMBIANA SA NIVEL 1	26	0010

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
80470372	JAVIER RAMIREZ RIAÑO

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9192766902	2017 - 08 - 26	No. 148645	2017 - 08 - 18

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
WELCH ALLYN INC		

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
93719581	2017 - 07 - 31	249	4	249	11	AMERIJET INTERNATIONAL COLOMBIA	2,907.96

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
9018190000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	249	096

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	249	373.04	335.73	PK	14	13	U	340,060.00

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 1T173386 DECLARACION(3-29) (PEDIDO 7241 IMP. 170122) NOS ACOGEMOS A LAS PREFERENCIAS ARANCELARIAS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CONFORME AL DECRETO 0730 DEL 13-ABR-2012 SUS ADICIONES, MODIFICACIONES Y REGLAMENTOS MATERIAL Y/O EQUIPO MEDICO. REGISTRO SANITARIO INVIMA 2008DM-0001451, VIGENCIA 29/01/2018, EXPEDIENTE 19988336, RIESGO I // REGISTRO SANITARIO INVIMA 2012DM-0009186, VIGENCIA 01/10/2022, EXPEDIENTE 20053063 RIESGO IIA FABRICANTE WELCH ALLYN INC. ORIGEN ESTADOS UNIDOS MERCANCIA NUEVA AÑO 2017. PRODUCTO: ESPECULO DESECHABLE, MARCA: WELCH ALLYN, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 52432-U, USO O DESTINO: EXCLUSIVO PARA USO EN OTOSCOPIO WELCH ALLYN, TECNICA DE DIAGNOSTICO: NO APLICA, SERIAL: NO TIENE, PRESENTA(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 03201700140929 2 133. Feha: 2017 09 15

134. Levante No. 032017001073697	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
	2017 - 09 - 15		

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	**980. Pago Total $**
		996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo) BOGOTA Autoadhesivo 01165082011711 Fecha presentación 2017-09-15 19:19:00 Valor pagado

Fecha de Impresión: 2017-09-26 08:44:22

20173466168685

DIAN REPÚBLICA DE COLOMBIA	Declaración de Importación	Aceptación : **032017001409292-9** Subpartida : **9018190000** Página 1 de 1

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

CION COMERCIAL CAJA CON 10 PAQUETES X 850 UNDS C/U CANT (40) CAJAS (ITEM 27). PRODUCTO: TRANSFORMADOR DE PARED YDISPENSADOR DE ES
PECULOS GS777, MARCA: WELCH ALLYN, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 77710-71, USO O DESTINO: EL TRANSFORMADOR DE PARED SERIE GS 777
ESTA DISEÑADO PARA PROPORCIONAR ENERGÍA A LOS INSTRUMENTOS WELCH ALLYN DE 3.5V. EL DISPOSITIVO TIENE DOS MANGOS A LOS CUALES SE C
ONECTAN LOS INSTRUMENTOS DE DIAGNOSTICO DE 3.5V TALES COMO LOS OTOSCOPIOS, OFTALMOSCOPIOS Y EL EPISCOPIO. EL SISTEMA DE PARED EST
A DISEÑADO PARA SER USADO EN CENTROS AMBULATORIOS Y ÁREAS DE CUIDADO INTENSIVO. ESTE DISPOSITIVO DEBE SER USADO POR PROFESIONALES
DEL CUIDADO DE LA SALUD ENTRENADOS EN EL CUIDADO DE PACIENTES NEONATALES, PEDIÁTRICOS Y ADULTOS, TECNICA DE DIAGNOSTICO: OFTALMO
SCOPIA / OTOSCOPIA / EPISCOPIA, SERIAL: NO TIENE, (100-240V, 50-60HZ) CANT (60) UNIDADES O ARTICULOS (ITEM 29).XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2012027355 DE 11 de Septiembre de 2012
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Subdirector de Registros Sanitarios del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto Reglamentario 4725 de 2005 y la Resolución Número 251280 de 2000,.

CONSIDERANDO

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN ALLEGADA, PREVIO ESTUDIO TÉCNICO Y LEGAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS, SE EMITIÓ CONCEPTO FAVORABLE PARA LA AUTORIZACIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS A

PRODUCTO: TRANSFORMADOR DE PARED GS 777 PARA SISTEMAS DE DIAGNOSTICO WELCH ALLYN, ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS - TRANSFORMADOR DE PARED GRADO MÉDICO PARA SUMINISTRO DE ENERGIA A INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO DE 3,5 V - WELCH ALLYN

REGISTRO SANITARIO NO.: INVIMA 2012DM-0009186 VIGENTE HASTA: 01 OCT 2022

TIPO DE REGISTRO: IMPORTAR Y VENDER

TITULAR(ES): WELCH ALLYN INC CON DOMICILIO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

FABRICANTE(S): WELCH ALLYN INC CON DOMICILIO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

IMPORTADOR(ES): AT MEDICAS S.A. CON DOMICILIO EN MEDELLIN – ANTIOQUIA
VHF LTDA CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
G BARCO S.A CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
IMCOLMEDICA S.A. CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
ALLERS S.A CON DOMICILIO EN CALI - VALLE

EQUIPO BIOMÉDICO: EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO

RIESGO: IIA

SUBSISTEMAS: MANGOS, KIT DE MONTAJE, OFTALMOSCOPIOS 3,5 V, OTOSCOPIOS 3,5 V, EPISCOPIOS 3,5 V, PANELES DE SOPORTE DE PARED - VARIOS, TAMAÑOS - PLATAFORMA DE FUENTE DE 5 W, CABLES USB VARIOS TAMAÑOS, BASE RODANTE, AROS DE SEGURIDAD CUBIERTA PRINCIPAL, COMPONENTES ELECTRONICOS, MANUAL DE USUARIO

USOS: EL TRANSFORMADOR DE PARED SERIE GS 777 ESTA DISEÑADO PARA PROPORCIONAR ENERGÍA A LOS INSTRUMENTOS WELCH ALLYN DE 3.5V. EL DISPOSITIVO TIENE DOS MANGOS A LOS CUALES SE CONECTAN LOS INSTRUMENTOS DE DIAGNOSTICO DE 3.5V TALES COMO LOS OTOSCOPIOS, OFTALMOSCOPIOS Y EL EPISCOPIO. EL SISTEMA DE PARED ESTA DISEÑADO PARA SER USADO EN CENTROS AMBULATORIOS Y ÁREAS DE CUIDADO INTENSIVO. ESTE DISPOSITIVO DEBE SER USADO POR PROFESIONALES DEL CUIDADO DE LA SALUD ENTRENADOS EN EL CUIDADO DE PACIENTES NEONATALES, PEDIÁTRICOS Y ADULTOS.

PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD

OBSERVACIONES: EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LOS SIGUIENTES MODELOS:
TRANSFORMADOR DE PARED GS 777

77510	GS 777 TRANSFORMADOR DE PARED CON DISPENSADOR DE ESPECULOS
77516	GS 777 TRANSFORMADOR DE PARED CON 52401
77710	GS 777 TRANSFORMADOR DE PARED
77712	GS 777 TRANSFORMADOR DE PARED
77714	GS 777 TRANSFORMADOR DE PARED
77716	GS 777 TRANSFORMADOR DE PARED
77718	GS 777 TRANSFORMADOR DE PARED
77742	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO PROFESIONAL
77744	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO PROFESIONAL
77747	GS 777 SISTEMA DE DIAGNOSTICO PROFESIONAL, DE PARED
77754	GS 777 TRANSFORMADOR DE PARED CON OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO
77764	GS 777 TRANSFORMADOR DE PARED CON OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO
77798	GS 777 TRANSFORMADOR DE PARED CON OTOSCOPIO NEUMATICO
77910	GS 777 TRANSFORMADOR DE PARED CON ANEROIDES Y DISPENSADOR DE ESPECULOS
77710-71	GS 777 TRANSFORMADOR DE PARED, 11710, 25020
77710-71M	GS 777 TRANSFORMADOR DE PARED, 11720, 23810
77710-72M2	GS 777 TRANSFORMADOR DE PARED 11720 OPH, 23810 OTO
77710-72MA	GS 777 11720 OPH, 23810 OTO

RESOLUCIÓN No. 2012027355 DE 11 de Septiembre de 2012
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Subdirector de Registros Sanitarios del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto Reglamentario 4725 de 2005 y la Resolución Número 251280 de 2000,.

77710-82M2	GS 777, 11820 PO, 23810 OTO
77710-82M4	GS 777, 11820 PO, 23810 OTO
77710-TAKX	GS 777 TRANSFORMADOR DE PARED CON ANEROIDES Y DISPENSADOR DE ESPECULOS
77712-RO	GS 777 ELITE STREAK
77716-COMP	GS 777 CON 11720, 25020 & 76700
77716-71M	GS 777 SISTEMA INTEGRADO 11720/23810/76700
77716-82M	GS 777 SISTEMA INTEGRADO 11820/23810/76700
77717-72M2	GS 777 SET DE FIJACION EN PARED
77717-82M2	GS 777 SET DE FIJACION EN PARED PANOPTICO
77735-2X	GS 777 SISTEMA DE PARED 3,5 V, SIN PANEL
77742-1	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO PROFESIONAL CON 11710 OPH
77754-P20	GS 777 TRANSFORMADOR DE PARED CON OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO
77781-MX	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO ESPECIAL 40" CON STP
77782-16M	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO ESPECIAL 40" CON CABLE DE 16"
77782-1MP	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO ESPECIAL 40" CON PANOPTICO
77782-M	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO ESPECIAL 40"
77790-3	GS 777 PANEL DE 34" PARA STP
77790-3	GS 777 PANEL DE 34" PARA STP
77790-4	GS 777 PANEL DE 34" PARA SPOT
77790-5	GS 777 PANEL DE 34" PARA LXI
77790-6	GS 777 PANEL ESPECIAL DE 40" PARA STP
77791-1MPX	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON PANOPTICO/STP
77791-2MP2X	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO ELITE CON STP
77791-2MPX	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON PANOPTICO/STP
77791-2MPX	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON PANOPTICO/STP
77791-MPXLED	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON PANOPTICO/STP/LED
77791-2MPXPROBP	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON PROBP/PANOPTICO/STP
77791-2MPXPROBP2	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON PROBP/STP
77791-2MPXPROBP4	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON PROBP/STP
77791-2X	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO 11720 CON STP
77791-4X	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO 11720 CON STP
77791-MX	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON PROBP/PANOPTICO/STP
77791-MXLED	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON STP/LED
77791-MXNOBP	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON STP/NOBP
77791-MXPROBP	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON PROBP/STP
77791-MXPROBP2	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON PROBP/PANOPTICO/STP
77791-MXPROBP4	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON PROBP/PANOPTICO/STP
77791X	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO 11710 CON STP
77792-16M	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO
77792-1MP	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON PANOPTICO
77792-2	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO 11710
77792-2MP	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON

República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

Prosperidad para todos

RESOLUCIÓN No. 2012027355 DE 11 de Septiembre de 2012
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Subdirector de Registros Sanitarios del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto Reglamentario 4725 de 2005 y la Resolución Número 251280 de 2000,.

77792-2MP4	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO ELITE
77792-2MPSPOT	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO PARA SPOT
77792-4	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO
77792-4P20	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON 11821
77792-M	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO
77792-MNOBP	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO NOBP
77793-M2X	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO ELITE CON STP
77794-2MPLXI	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON PANOPTICO PARA LXI
77794-2MPSPOT	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON PANOPTICO PARA SPOT
77794-4	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO
77794-MLXI	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO PARA LXI
77794-MSPOT	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO PARA SPOT
77795-2MPX	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON PANOPTICO/STP
77795-MX	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON 11720/23820/STP
77796-2MP	GS 777 TABLERO TRANSFORMADOR DE PARED, 11820, 23810
77796-2MPX	GS 777 TABLERO TRANSFORMADOR DE PARED, 11720, 23810
77796-M	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON 11720/23820
77796-MX	GS 777 TABLERO TRANSFORMADOR DE PARED, 11720, 23810
77796-MXNOBP	GS 777 TABLERO TRANSFORMADOR DE PARED, 11720, 23810
77797-2MP2	GS 777 SISTEMA DE DIAGNOSTICO DE PARED ELITE
77797-2MP2X	GS 777 SISTEMA DE DIAGNOSTICO DE PARED ELITE CON STP
77797-2PX	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON PANOPTICO/ OTOSCOPIO NEUMATICO/STP
77797-2X	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON STP
77797-M2	GS 777 SISTEMA DE DIAGNOSTICO DE PARED ELITE
77797-M2X	GS 777 SISTEMA DE DIAGNOSTICO DE PARED ELITE CON STP
77797-X	GS 777 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO CON OTOSCOPIO NEUMATICO/STP

EXPEDIENTE NO.: 20053063
RADICACIÓN NO.: 2012107181
FECHA DE RADICACION: 2012 09 11

ARTICULO SEGUNDO.- CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE LA SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

ARTICULO TERCERO.-LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EJECUTORIA.

ARTICULO CUARTO.- LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 2005.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN BOGOTÁ D.C. A LOS 11 DE SEPTIEMBRE DE 2012

ESTE ESPACIO, HASTA LA FIRMA SE CONSIDERA EN BLANCO.

LUZ HELENA FRANCO CHAPARRO
SUBDIRECTOR(A) DE REGISTROS SANITARIOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS

INVIMA

SUBDIRECCION DE REGISTROS SANITARIOS

A la fecha notifiqué personalmente ... con No. 2012023355

De fecha 11/09/2012 a ... HERNAN MALAGON

identificado con C.C. No. 80829340 de ... T.P. ...

... se le hace saber que contra el ... proferida dentro ... siguiente a la ...

notificación, quedando ...

Bogotá 17 SEP 2012

Notificado

Entregado