
Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

FIJADOR CIRCULAR TIPO HIBRIDO, FEMUR Y TIBIA

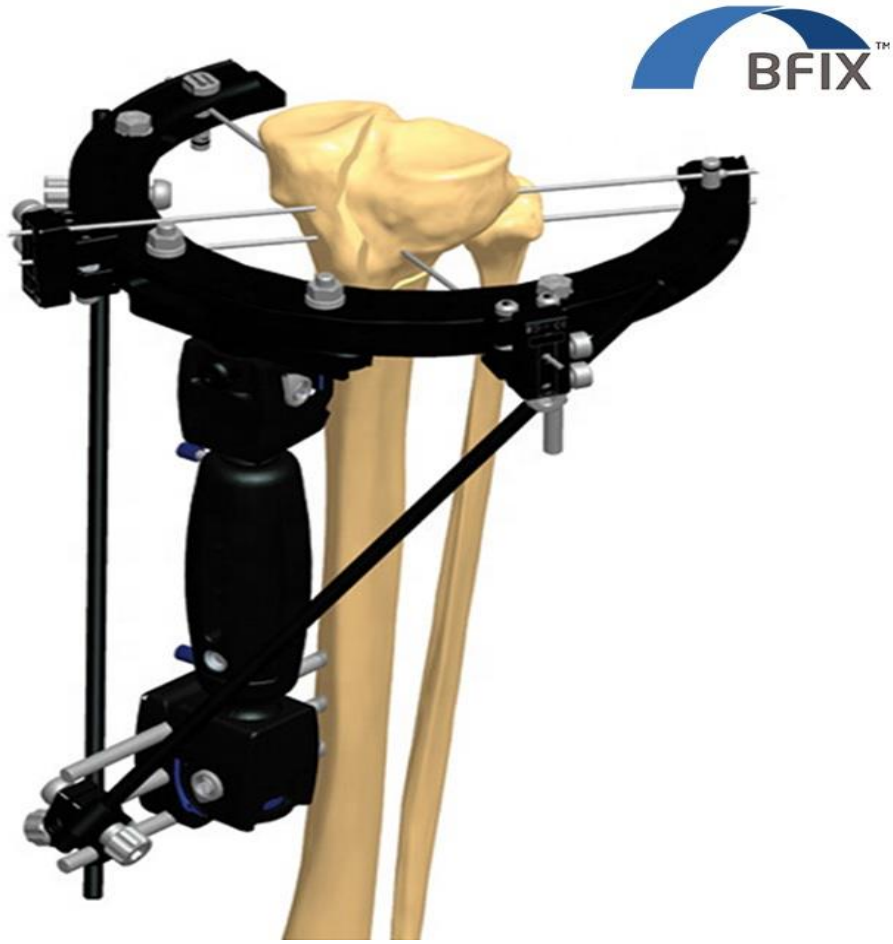

IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

CARÁCTERÍSTICAS:

- Variedad en aros.
- Variedad en agujas, dependiendo el tipo de fractura.
- Se puede realizar diferentes tipos de montaje.
- Se puede acoplar peek hibrido, transporte, micromovimiento, clamp Sheffield.
- Único uso.

INDICACIONES

- Estabilización de fracturas, alargamientos óseos en fémur y tibia.
- Transportes óseos, fémur y tibia.

CONTRAINDICACIONES

- Paciente inadecuado fisiológico y psicológicamente.

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
QH7001	ARO DE 2/3 ACERO DE 150
QH7002	ARO DE 2/3 ACERO DE 175
QH7003	ARO DE 2/3 ACERO DE 190
QH7004	ARO DE 2/3 ACERO DE 220
QH7010	CLAMP AGUJA DOS AGUJEROS
QH7009	CLAMP AGUJA TRES AGUJEROS
QH8001	ACOPLE HIBRIDO
QH7013	CLAMP SHEFFIELD
QH7011	POSTE ESTÁNDAR
QH7168	POSTE 150 MM
D6010Cr	BARRA REFORZADA DE 300
D6011Cr	BARRA REFORZADA DE 200
QSHO20400	AGUJA SIN OLIVA 2,0 X 400
QD6028	CABEZAL PARA TORNILLO SUPLEMENTARIO
QH7140	BARRA ROSCADA DE 60
QH7142	BARRA ROSCADA DE 110
QH7144	BARRA ROSCADA DE 150
QH7088	CLAMP SENCILLO DE TORNILLO
QGNO20400	AGUJA CON OLIVA LATERAL DE 2,0X400
QGMO20400	AGUJA CON OLIVA CENTRAL DE 2,0X400
QH7146	BARRA ROSCADA DE 200

REGISTRO SANITARIO

- 2019DM-0020145

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- El equipo hibrido, se encuentra disponible en caja metálica, debe ser esterilizado por cada institución.

- Esterilización a vapor o bajas temperaturas, parámetros establecidos por cada entidad.

MATERIAL

- Aleación de aluminio
- Acero

NÚMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

El equipo hibrido debe ir acompañado con equipo básico de fijación externa, pieza de mano, y según requerimiento del especialista y por indicación quirúrgica, puede ir acompañado de transporte, Peek hibrido y equipo de micromivimiento.

El equipo trae sus respectivos acoples para adaptar los sistemas mencionados.

Tornillos de hidroxiapatita de 6,0 de diámetro, como se mencionan a continuación:

REFERENCIA	DESCRIPCION
Q126013-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 130/30
Q136013-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 130/40
Q116015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/30
Q146015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/40
Q156015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/50
Q186060-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 180/60
Q146015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/40
Q156015-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 150/50
Q116018-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 180/30
Q156018-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 180/40
Q136018-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 180/50
Q186060-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 180/60
Q126022-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 220/50
Q156021-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 200/70
Q156022-CHA	TORNILLO DE SCHANZ HA 6.0 DE 200/80