NANNING BAOLAI MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD
Address: 7th Floor , General Building, Hetai Sci. &Tech. Park,
No.9 Gaoxin 4th RD., Nanning,Guangxi, 530007, China
Tel:0086-771-3815998 Web:www.booool.com
Fax :0086-771-3217883 Email: info@booool.com
PA-BL-X-E-5 A8

# Escarificador Ultrasónico LED

## Scaler, Periodoncia, Endodoncia

## Modelo: P7L

3 Programas: Scaler, Perio, Endo
Pieza de mano en aluminio anodizado desmontable y autoclavable a alta temperatura (135ºC)
Diseño compacto y ergonómico
Iluminación LED

Potencia nominal: 30VDC
Frecuencia: 28KHz – 32 KHz




135°C Incluye 6 puntas intercambiables

CE 0197



FDA
Registration No.3008615394
510K No.K140233


CE 0197

NANNING BAOLAI MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD
Address: 7th Floor , General Building, Hetai Sci. &Tech. Park,
No.9 Gaoxin 4th RD., Nanning,Guangxi, 530007, China
Tel:0086-771-3815998 Web:www.booool.com
Fax :0086-771-3217883 Email: info@booool.com
PA-BL-X-E-5 A8

# Especificaciones Técnicas

| | |
|---|---|
| Alimentación Eléctrica | 100-240 VAC / 50-60 Hz |
| Potencia Nominal | 30VDC – 1.2A |
| Fusible de protección principal | 250V/T 1.6AL |
| Potencia de trabajo | Graduable (3W – 20W) |
| Vibración primaria de salida | < 200 µm |
| Frecuencia de trabajo | 28 KHz – 32 KWz |
| Fuerza de semi extrusión de salida | <2N |
| Presión de agua | 1bar – 5bar |
| Peso de la unidad principal | 0,65 Kg |
| Peso del adaptador AC | 0,34 Kg |
| Modo de operación | Continuo |
| Clasificación 93/42/EEC | Clase IIa |
| Tipo de protección contra descargas | Clase II |
| Grado de protección contra choque eléctrico | B |
| Grado de protección contra fugas e ingreso de agua | Equipo (IPX0), Pedal de control (IPX1) |
| Grado de seguridad de uso en presencia de mezcla de antestésicos inflamables con aire, con oxígeno u óxido nitroso | Equipo no apto para ser utilizado en presencia de mezcla de anestésicos inflamables con aire, oxígeno u óxido nitroso |

# Accesorios Incluidos

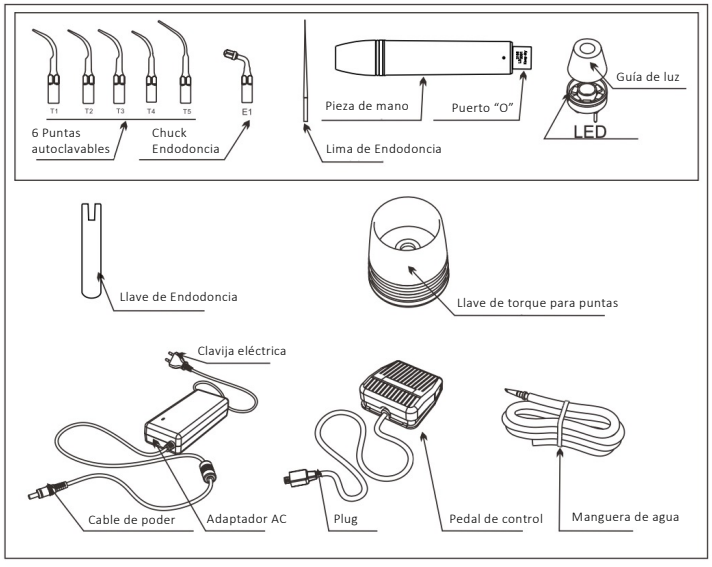


Registration No.3008615394
510K No.K140233
0197