Control de Temperatura en la Bodega

Fecha	Control de Temperatura				Control de Humedad			
	Actual	Mínima	Máxima	Observación	Actual	Mínima	Máxima	Observación
21/11/22	18.3	16	21		54	51	57	
21/11/22	17.3	15	19		53	49	56	
22/11/22	18.2	16	19		54	50	58	
22/11/22	19.2	16	22		52	48	55	
23/11/22	17	15	20		51	49	54	
23/11/22	19	17	22		53	50	57	
24/11/22	18.1	16	20		54	51	56	
24/11/22	19.1	17	20		52	49	55	
25/11/22	17.8	15	21		54	52	57	
25/11/22	16.4	14	19		55	52	58	
26/11/22	17.0	15	19		50	47	54	
26/11/22	18.9	17	20		53	51	56	
28/11/22	18.9	16	22		55	54	56	
28/11/22	19.2	17	22		51	49	53	
29/11/22	18.4	16	22		53	50	55	
29/11/22	17.6	15	22		50	47	53	
30/11/22	18.1	15	22		49	47	53	
30/11/22	17.4	15	19		53	51	56	
01/12/22	17.6	15	20		45	43	48	
01/12/22	18.6	15	21		50	48	53	
02/12/22	18	16	20		49	47	52	
02/12/22	19.1	17	22		48	46	51	
03/12/22	17	15	19		48	46	52	
03/12/22	18	16	20		50	47	53	
05/12/22	17	15	19		45	43	49	
05/12/22	19	17	21		48	46	51	
06/12/22	18	16	21		45	43	48	
06/12/22	17	15	19		48	46	51	
07/12/22	19	17	22		50	48	51	
07/12/22	18	17	20		48	46	51	

INTERARCHIVOS SAS
Nit. 900.360.373-0

INTERARCHIVOS

Recomendaciones: El control se debe efectuar dos veces al día. En la mañana entre las 7:00 y las 7:30 y en la tarde entre las 4:30 y 5:00.

El termómetro se puede transportar a cualquier área de la bodega para realizar las mediciones.

El finalizar las mediciones se debe dejar colocado en la base.

No golpearlo, No mojarlo y No dejarlo en posiciones a las cuales no corresponde el equipo.

INTERARCHIVOS

INTERARCHIVOS

MEDICION DE ILUMINACION EN DEPOSITOS DE CUSTODIA

(Para radiación visible lumínica, menor o igual a 100 lux.)

FECHA	ACTUAL	MINIMA	MAXIMA	OBSERVACIONES
01/11/22	14	14	15	
01/11/22	12	12	12	
04/11/22	13	13	14	INTERARCHIVOS SAS. Nit. 900.360.373-0
04/11/22	15	15	15	
09/11/22	16	15	17	
09/11/22	17	16	19	
11/11/22.	17	15	12	
11/11/22.	14	14	14	
15/11/22	16	15	15	
15/11/22	16	13	18	
16/11/22	17	16	16	
16/11/22	12	12.	13	INTERARCHIVOS SAS. Nit. 900.360.373-0
17/11/22	17	15	15	
17/11/22	15	15	17	
18/11/22	13	13	12	
18/11/22	16	16	16	
21/11/22	14	16	17	
21/11/22	15	14	19	
22/11/22	13	13	18	
22/11/22	12	12	15	
23/11/22	16	13	16	
23/11/22	14	14	14	INTERARCHIVOS SAS. Nit. 900.360.373-0
24/11/22	12	13	13	
24/11/22	13	15	15	
25/11/22	15	12	12	
25/11/22	14	14	14	
28/11/22.	14	13	13	
28/11/22	14	13	13	
29/11/22	15	12	12	
29/11/22	14	14	14	
30/11/22	15	12	12	
30/11/22	14	13	13	
01/12/22	15	12	12	
01/12/22	15	13	13	
02/12/22	14	13	13	
05/12/22	15	13	13	

Recomendaciones: El control se debe efectuar dos veces a la semana en la mañana y en la tarde.

El Equipo de medicion se puede transporat a cualquier lugar de la bodega.

Al finalizar las mediciones apagar el equipo y guardarlo en su caja.

No mojarlo, no golpearlo y no dejarlo encendido.

INTERARCHIVOS

MEDICION DE ILUMINACION EN DEPOSITOS DE CUSTODIA

(Para radiación visible lumínica, menor o igual a 100 lux.)

FECHA	ACTUAL	MINIMA	MAXIMA	OBSERVACIONES
05/12/22	15	12	12	
06/12/22	14	13	12	
06/12/22	15	12	12	
07/12/22	14	13	13	
07/12/22	15	14	13	

Equipos & Mediciones Técnicas

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17025:2017
19-LAC-017

Eq&Md ¡Su aliado en Metrología!

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

calibration certificate

CERTIFICADO No. / *Certificate No.*	TE-2022-0214
MAGNITUD / *Magnitude*	TEMPERATURA
SOLICITANTE / *Customer*	INTERNACIONAL DE ARCHIVOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA-INTERARCHIVOS SAS
DIRECCIÓN / *Address*	CALLE 12 # 79 A 25
CIUDAD / *City:*	BOGOTÁ
INSTRUMENTO / *Instrument:*	TERMOHIGROMETRO
FABRICANTE / *Manufacturer*	AMBIENT
MODELO / *Model*	WS-3000-X5 / WH31E
SERIAL /*Serial*	A7886
IDENTIFICACIÓN / *Identification*	No Porta
INTERVALO DE MEDICIÓN /*Interval of measurement*	-10 °C a 60 °C
RESOLUCIÓN / *Resolution*	0,1 °C
ESTADO DEL ÍTEM / *Item status*	Buen estado
FECHA DE RECEPCIÓN / *Reception date*	2022-06-28
FECHA DE CALIBRACIÓN / *Calibration date*	**2022-06-29**
LUGAR DE CALIBRACIÓN / *Calibration place:*	Laboratorio Equipos y Mediciones Técnicas S.A.S., Avenida Troncal de Occidente No. 1-59 Este, Centro Logístico y Empresarial El Portal Bodega 19, Mosquera.

CONDICIONES AMBIENTALES / *Environmental conditions*

TEMPERATURA AMBIENTE	MAX.	22,7 °C	MIN.	19,7 °C
HUMEDAD RELATIVA		64,0 % hr		56,5 % hr

MÉTODO DE CALIBRACIÓN / *Method used*

El objeto descrito anteriormente fue calibrado por el método de comparación directa contra equipo patrón dentro de un medio isotermo controlado bajo los lineamientos contenidos en la guía técnica NORDTEST METHOD NT VVS 103:1994. CALIBRATION THERMOMETERS, CONTACT, DIRECT READING

The object described previously was calibrated by direct comparison method whit reference instrument against master, team within a controlled isothermal environment under guidelines contents in guide NORDTEST MÉTODO NT VVS 103:1994. CALIBRATION THERMOMETERS, CONTACT, DIRECT READING

TRAZABILIDAD / *Traceability*

Éstas mediciones son trazables al sistema internacional de unidades (S.I.) mediante el uso de patrones calibrados por laboratorios acreditados.

These measurements are traceable to the international units system (S.I.) through calibrated standards with accredited laboratories.

Descripción *Description*	Calibrado por *calibrated by*	No. Certificado *No Certificate*	Fecha de calibración *calibration date*
Termómetro digital Vaisala	METROLABOR	MET-LT-CC-32824	2021-07-31
Cámara de humedad Binder	UNIÓN METROLÓGICA	MI-0538/MI-0539	2020-11-17

INCERTIDUMBRE DE MEDIDA / *measurement uncertainty*

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95 % y no menor a este valor.

The expanded uncertainty of the reported measurement is established as the standard measurement uncertainty multiplied by the coverage factor "k" and the coverage probability, which should be approximately 95 % and not less than this value.

Páginas del certificado /*Certificate pages* 2 (Dos)

Calibrado por / *Calibrated by:*

Alveiro Nope
Técnico de laboratorio

Aprobado por / *Approved by:*

Milton G. Yanquen Niño
Director técnico de laboratorio

Fecha de emisión / *date issued*

2022-06-30

TE-2022-0214


Resultados de medición / *measurement results*

Promedio Ref (°C)	Indicación IBC (°C)	Corrección (°C)	Factor de cobertura	Incertidumbre expandida *U* (°C)
5,23	5,3	-0,07	2,0	0,80
29,68	29,1	0,58	2,0	0,80
50,00	49,1	0,90	2,0	0,80

tabla 1: datos de exactitud

IBC: instrumento bajo calibración

Gráfica de exactitud / *Accuracy chart*

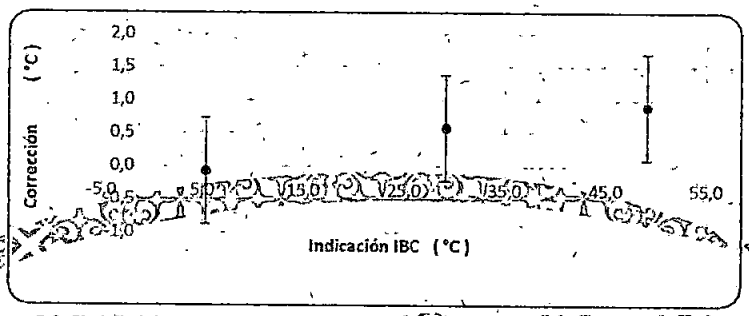

Grafica 1: grafico de exactitud

OBSERVACIONES / *Remarks*

Los resultados obtenidos en el presente documento se refieren al momento y condiciones existentes en el momento de las mediciones y para el ítem descrito, en este cálculo no está contenida la estabilidad a largo plazo del ítem bajo calibración.

The results obtained in this document refer to the moment and conditions existing at the time of the measurements and for the item described, in this calculation the long-term stability of the item under calibration is not contained.

El laboratorio de metrología de Equipos y mediciones técnicas S.A.S., no se responzabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos.

The Equipos y mediciones técnicas metrology laboratory S.A.S., is not responsible for any damage that may result from improper use of the instruments.

Este certificado de calibración expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas, sólo podra ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos o cambios requieren la autorización del laboratorio de calibración otorgante. Certificados sin firma y sello carecen de validez.

This calibration certificate faithfully expresses the results of the measurements made, it can only be disseminated completely and without modifications. Excerpts or changes require authorization from the granting calibration laboratory. Unsigned certificates are invalid.

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

The user is responsible for the calibration of their instruments at appropiate intervals.

***FIN DEL CERTIFICADO** / end of certificate*

Higielectronix

ONAC ACREDITADO

ilac-MRA

ISO/IEC 17025:2017
15-LAC-047

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN HIGIELECTRONIX SAS. - Calibration Laboratory

DATOS DEL CLIENTE - Information Customer

NUMERO DE CERTIFICADO - Certificate number:	HX-CC-LX-24592
NUMERO ORDEN SERVICIO - Service Order Number:	HX-L-17683
NOMBRE - Name:	INTERARCHIVOS S.A.S.
DIRECCION - Address:	CALLE 12 N° 79A - 25 / BOGOTA

DATOS DEL INSTRUMENTO A CALIBRAR - Information Instrument to calibrate

TIPO DE INSTRUMENTO - Type or instrument:	LUXOMETRO
FABRICANTE - Manufacturer:	UNIT
NUMERO DE SERIE - Serial Number:	C201023676
MODELO - Model:	UT383
INVENTARIO/CODIGO - Inventory/Code:	NO IDENTIFICADO
RESOLUCIÓN - Resolution:	0-10000 (lux) = 1 (lux)

CONDICIONES AMBIENTALES - Enviromental conditions

Las condiciones ambiéntales se refieren al sitio y al momento de la calibración del instrumento.

Temperatura en °C	22,0
Humedad Relativa en %	54,1

FECHA DE RECEPCION - Date of Receipt:	2022-07-11
FECHA DE CALIBRACION - Calibration Date:	2022-07-26
LUGAR DE CALIBRACIÓN - place of Calibration:	LABORATORIO HIGIELECTRONIX SAS

PROCEDIMIENTO / METODO UTILIZADO - procedure / Method Used

Para llevar a cabo la calibración del instrumento, se utilizó una bombilla de referencia tipo Iluminante A y un luxometro de referencia según lo estipulado en la norma BS-667: 2005 para la calibración de Luxometros "Illuminance meters - Requirements and test methods". Los datos del fabricante del instrumento sometido a prueba y procedimiento para calibración de luxometros acorde a documento "Special Publication 250-37: NIST Measurement services: Photometric Calibrations" de NIST "National Institute of Standards and Technology".

PATRONES UTILIZADOS - Standard Used

Luxometro de referencia:	RADIOMETRO DELTA OHM
Bombilla patrón:	GE MODELO FEL-1000

Las mediciones realizadas son trazables al sistema internacional de unidades segúnb se evidencia en los certificados referidos anteriormente.

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN - Uncertainty of Measurement.

La incertidumbre combinada que se reporta es una función del valor a medir según documento JCGM 100:2008 GUM 1995 con ligeras correcciones Guia para la expresión de incertidumbre en las mediciones y para ello se ha tenido en cuenta factores como la desviación estándar, división de escala , la incertidumbre del MRC material de referencia certificado, incertidumbre del simulador de temperatura.La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura K=2 y la probabilidad de cobertura,la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

FIRMAS AUTORIZADAS

Authorized Signatu

Higielectronix S.A.S. Laboratorio de Metrología

Calibró:	*ING. LILI ESCOBAR*	**Aprobó:**	*ING. DIANA SANTAMARIA*
Calibrated by	***Metrologo***	**Approved by:**	***Coordinador De Calidad y Laboratorio***

Fecha de Emisión - date Issued 2022-07-29

Este certificado de calibración no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización escrita del laboratorio que lo emite, los resultados, consignados en este certificado se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, al momento y condiciones en las que se realizaron las mediciones, el laboratorio no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los objetos calibrados o de este certificado.

This certificate of calibration could not be reproduced partially without written authorization of the issuing laboratory; the result of this certificate is for the object of calibration, at the conditions in which the measurements were made, the Laboratory does not take responsibility from the inadequate use of the calibrated objects or this certificate.

ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17025:2017 15-LAC-047 — CALIBRACIÓN HX SN: C201023676 CERTIFICADO No. HX-CC-LX-24592 2022-07-26

Higielectronix

ONAC ACREDITADO

ilac-MRA


ISO/IEC 17025:2017
15-LAC-047

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN HIGIELECTRONIX SAS. - Calibration Laboratory

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN. - Results of the calibration

Resultado	Valor referencia (lx)	Valor leído (lx)	Error		Incertidumbre expandida	
			Lectura (lx)	Porcentual (%)	lx	%
Punto 1	3795	4053	258	6,8	81	3,1
Punto 2	2505	2678	173	6,9	70	3,1
Punto 3	1502,0	1653	151	10,1	35	2,9
Punto 4	698,7	756	58	8,3	18	2,9
Punto 5	50,00	41	-9,3	-18,7	1,8	4,5
Punto Cero	0,00	0	0,0	0,0	---	---

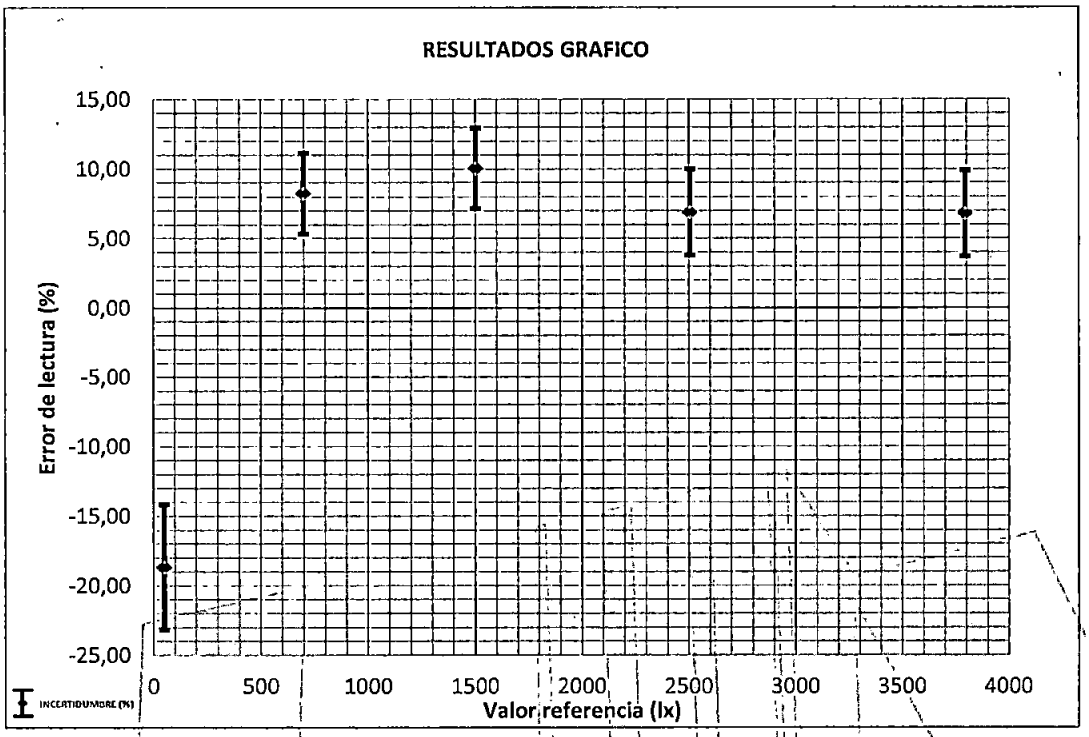

OBSERVACIONES - Comments


1- El usuario, con base en el historial del equipo, es el que debe definir el programa de calibración. El presente certificado solo ampara las mediciones reportadas en el momento, condiciones ambientales y de uso en que se realizo esta calibración. La validez de los resultados contenidos en este certificado depende tanto de las características del elemento certificado como de las practicas de su manejo y uso

2. El certificado sin las firmas autorizadas no tiene validez.

ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17025:2017 15-LAC-047

CALIBRACIÓN HX SN: (2010236/6 CERTIFICADO No. HX-CC-LX-24592 2022-07-26

-Fin del Certificado-



Equipos industriales fénix SAS
NIT: 901.146.454 - 6

INFORMACION GENERAL Y ENTRADA

1.1 Fecha	11/07/2022
1.2 Numero de Diagnostico	1

2. Datos del solicitante

2.1 Remisión o salida del solicitante	Mantenimiento
2.2 Solicitante	Internacional de Archivos Sociedad
2.3 Contacto	Sebastian Casallas Bernal
2.4 Factura de Venta Numero	11548
2.5 Correo Electrónico contacto	'proyectos@interarchivos.com.co'
2.6 Teléfono Contacto	3183638347
2.7 Fecha Factura de venta	11/07/2022

3. Datos del(los) equipo(s)

3.1 Código	P243637
3.2 Modelo	DH70PW / ADR70A2G (2 und)
3.3 Serial	0297 / 0137 / 2591
3.4 Descripción	Deshumidificadores 70 pintas /30L/H
3.5 Marca	
3.6 Estado del equipo	Buen estado


DIAGNOSTICO Y PROCEDIMIENTO

4.Diagnostico

4.1 Falla reportada por el solicitante	Mantenimiento General
4.2 Procedimiento de revisión	Se realiza prueba de funcionamiento inicial, lo equipos funcionan botan bastante polvo
4.3 Diagnostico	Se realiza mantenimiento preventivo limpieza en todos los compartimentos, y la rejilla del evaporador, en la sección del ventilador, verificación de cableado. En la unidad SN 2591 se realiza ajuste de compresor pues los puntos de apoyo estaban rotos, se realiza arreglo con Pegante Epóxico de alta resistencia para asegurar la estabilidad del equipo, no fue requerido ningún repuesto externo.

CONCLUSION

5 Conclusión



Equipos industriales fénix SAS
NIT: 901.146.454 - 6

5.1 El departamento técnico concluye	• Se realiza prueba de funcionamiento continua de 30 min a 1hr los equipo realizan la recolección de humedad efectivamente, es decir funcionan según requerimientos técnicos. • El dispositivo se debe recoger en nuestras instalaciones o en su defecto, se enviará a la dirección referenciada en la factura con guía contra entrega. • En caso de ser enviada a la dirección referenciada en la factura con guía contra entrega se recomienda **REVISAR EL CONTENIDO EN PRESENCIA DEL TRANSPORTADOR** con el fin de evitar percances a futuro.

Angela Gonzalez
Instrumentista
Instrumentista2@viaindustrial.com
Equipos industriales fenix SAS

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ÁREAS COMUNES

GH-2021-01
Versión: 01
Fecha Ver: 01-07-21

SEDE	LUGAR
ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	Avenida Calle 12 No. 79 a 25 Bodega Nº6 - Parque Industrial Villa alsacia

LAS SIGUIENTES ÁREAS SE ENCUENTRAN LIMPIOS Y EN FUNCIONAMIENTO:	FRECUENCIA	SEMANAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN																							OBSERVACIONES
		SEMANA Del 14 Noviembre 2022 a 19 Noviembre 2022						SEMANA Del 21 Noviembre 2022 a 26 Noviembre 2022						SEMANA Del 28 Noviembre 2022 a 03 Diciembre 2022						SEMANA Del 05 Diciembre 2022 a 10 Diciembre 2022						
		L	M	X	J	V	S	L	M	X	J	V	S	L	M	X	J	V	S	L	M	X	J	V	S	
Limpieza y desinfección Entrada principal (Corredores, paredes, puerta de ingreso).	Diaria.	FESTIVO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	FESTIVO			
Limpieza y desinfección áreas de trabajo primer piso (Descanecar, barrer, trapear, puestos de trabajo, computador, mouse y teclado).	Diaria.	FESTIVO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							FESTIVO			
Limpieza y desinfección áreas de trabajo primer piso Call center (Descanecar, barrer, trapear, puestos de trabajo, computador, mouse y teclado).	Diaria.	FESTIVO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	FESTIVO			
Limpieza y desinfección áreas de trabajo segundo piso (Descanecar, barrer, trapear, puestos de trabajo, computador, mouse y teclado).	Diaria.	FESTIVO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	FESTIVO			
Limpiar vidrios y ventanas del primer y segundo piso.	Una (1) vez por semana.	FESTIVO	X					X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	FESTIVO			
Desinfección y limpieza baños primer piso (sanitarios, lavamanos, espejos, paredes, canecas, pisos, puertas y divisiones)	Diaria.	FESTIVO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	FESTIVO			
Dotar, jabón de manos, toallas desechables, papel higiénico a los dispensadores baños del primer piso.	Tres (3) veces a la semana.	FESTIVO	X		X			X	X	X	X	X	X	X		X		X		X		X	FESTIVO			
Dotar, alcohol, gel antibacterial a las areas de trabajo del primer piso.	Una (1) vez por semana.	FESTIVO			X					X						X						X	FESTIVO			
Limpieza y desinfección bodega principal (Estantería y pisos)	Cada quince (15) días.	FESTIVO								X												X	FESTIVO			
Desinfección ambiental a través del ozono eliminando virus, bacterias y todo tipo de microorganismos.	Dia intermedio.	FESTIVO		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	FESTIVO			
Utilizar la aspiradora en zonas de gestión documental o custodia, eliminando el exceso de polvo.	Semestral	FESTIVO																					FESTIVO			
Nombre del Responsable que ejecuto		FESTIVO	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	Amparo	FESTIVO			
Nombre de quien supervisa		FESTIVO																					FESTIVO			

Detallar condiciones y/o recomendaciones (si aplica)

Certificado Número:	49728	Fecha de Expedición:	30/07/2022	Ciudad:	BOGOTA D.C.
Razón Social:	INTERNACIONAL DE ARCHIVOS SAS	Nit:	900.360.393-0	Dirección:	Avenida calle 12 No. 79A - 25 Bodega 6 Parque Empresarial Villa Alsacia
Teléfono:	3183638347	Sucursal:	PRINCIPAL	Contacto:	Milena Barreto

SERVICIO

Fumigación Insectos Rastreros	X	Lavado y desinfeccion de tanque			Desinfeccion de ambiente		
Fumigación Insectos Voladores	X	Subterraneo		Aereo			
Control de Roedores	X	Partes por Millón					

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

*Servicio de desinsectacion contra insectos rastreros, voladores y control de roedores correspondiente al mes de julio de 2022

FECHA DEL SERVICIO	PLAGAS A TRATAR	PRODUCTO APLICADO	METODO
30 de julio de 2022	*INSECTOS RASTREROS *INSECTOS VOLADORES *ROEDORES	*INSECTICIDA RUTTO E.C *RODENTICIDA KLERAT	*ASPERSION Y/O NEBULIZACION *MANUAL

OBSERVACIONES

* Se recomienda a nuestros clientes llevar un programa integrado de plagas preventivo y/o correctivo, para pode reducir a un nivel tolerable la prolifereación de plagas. Según resolución 2190 de 1991, se debe realizar el lavado y desinfeción del tanque de agua potable como minímo 2 veces en el año.

ANEXO COPIA DE: Fichas tecnicas de productos aplicados.

IMPORTANTE PARA SALUD PUBLICA: Contamos con CONCEPTO SANITARIO emitido por los entes de control para la prestación de servicio de lavado de tanques y control plagas; en cada una de nuestras sedes.

FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA NIT. 900.353.140-2 DOCUMENTO CONTROLADO

MARIA F. PARRA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

ESTE DOCUMENTO SIN SELLO [illegible] ES [illegible]
24 HORAS LTDA
CEL.: 313 [illegible] 1304

Milena Barreto
CC 52451 480

SGS CO136247

Fumigaciones 24 HORAS LTDA.

ORDEN DE TRABAJO PLAGAS

PRESTACIÓN DEL SERVICIO
CÓDIGO: J_F/PS-14

ORDEN DE TRABAJO No. 49728

CLIENTE	**INTERNACIONAL DE ARCHIVOS SAS**
NI	**900.360.393-0**
SU AL	**PRINCIPAL**
CONTACTO	**Milena Barreto**
CIUDAD	**BOGOTA D.C.**
DIRECCION	**Avenida calle 12 No. 79A - 25 Bodega 6 Parque Empresarial Villa Alsacia**
BARRIO	**BOGOTA D.C.**
TELEFONO	**3183638347**

FECHA	30/07/2022
HORA PROGRAMADA	10:00 a. m.
HORA DE INGRESO	9:43am
HORA DE SALIDA	

FECHA REPROGRAMACION DE SERVICIO: _____

DIAGNOSTICO DEL SERVICIO			
DIAGNOSTICO INCICIAL		DIAGNOSTICO DE SEGUIMIENTO	

SERVICIO A REALIZAR			
INSECTOS RASTREROS	X	INSECTOS VOLADORES	X
CONTROL DE ROEDORES	X	OTRO. CUAL?	
DESINFECCION DE AMBIENTE			

CONDICIONES LOCATIVAS	**SI**	**NO**
PAREDES LIMPIAS Y SIN RANURAS	✓	
PISOS EN BUEN ESTADO	✓	
TOMAS ELECTRICAS SELLADAS	✓	
PUERTA CON LUZ INFERIOR A 0,5 CM	✓	
ALMACENAMIENTO SOBRE ESTIBAS	✓	
PUERTA EN MAL ESTADO		✓
AUSENCIA DE REJILLAS		✓
ESTANCAMIENTO DE AGUAS		✓
LOTES BALDIOS CERCA		✓

CONDICIONES SANITARIAS	**SI**	**NO**
RESIDUOS DE GRASA		✓
AREA LIBRE DE BASURA	✓	
CANECAS SIN TAPA		✓
PRODUCTOS DESCOMPUESTOS		✓
PRESENCIA DE MATERIAL EN DESUSO		✓
SUCIEDAD EN AREA DE PRODUCCION		✓
MESON RETIRADO DE LAS PAREDES	✓	
MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS	✓	
AREAS VERDES CORRECTAMENTE PODADAS	✓	

SE EVIDENCIAN PLAGAS ?	SI		NO	
CUAL?				

METODO DE CONTROL			
CONTROL FISICO	✓	CONTROL QUIMICO	✓
CONTROL MECANICO		CONTROL BIOLOGICO	
ARREGLOS LOCATIVOS		OTRO	

METODO DE APLICACIÓN:			
ASPERSION		NEBULIZACION	
DESRATIZACION		TERMO-NEBULIZACION	✓
MANUAL	✓	OTRO	

RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL TECNICO APLICADOR

Realizar cada 6meses

PRODUCTO APLICADO	**DOSIFICACION**
insecticida Ruto 6C Rodenticida Klevat	

TEMAS CULTURALES PARA TENER EN CUENTA:

- **E**liminar materiales inútiles o en desuso,(estibas, cartón, vidrio, chatarra, envases, etc.
- **R**ecolección y eliminación de basuras y residuos.
- **L**impieza constante de lugares internos, utensilios, equipos, electrodomesticos, enseres, etc.
- **P**erímetros exteriores sin malezas, charcos, basuras, etc.

AREAS A TRATAR

cocina
baño
Bodegas

Declaro que he leído la información contenida al reverso de este formato y el servicio ha sido a satisfacción y sin ninguna novedad, por parte de **FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA.**

SI		NO	

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

TIEMPO DE REINGRESO: _____

FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA
NIT. 900.353.140-2
DOCUMENTO CONTROLADO

Datos Cliente

Nombre Milena Barreto
C.C. 52451451
Cargo Auxiliar
Firma Milena Barreto

Datos del tecnico aplicador

Nombre Diego Cruz
C.C 80780697
Cargo T. Aplicador
Firma

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO13/5247

RECOMENDACIONES

ROEDORES

Antes

1. Realizar una limpieza profunda del lugar.
2. Corte el césped en intervalos de tiempo cortos para garantizar la efectividad de los productos aplicados.

Durante

1. Se debe realizar acompañamiento para el conrtol de roedores, para que el cliente sepa si hay roedores o en que estaciones se coloca producto o cambio de lamina adhesiva.

Despues

1. Se debe realizar los arreglos locativos o de saneamineto que deja el tecnico en las recomendaciones.
2. Remoción de basuras - Mantenimiento de zonas verdes y vegetación - Eliminación de maquinaria en desuso - Remoción de chatarra.
3. Eliminación de áreas oscuras - buenas prácticas de almacenamiento - buen aseo interno - remoción de basuras, no dejar residuos de alimentos.

Antes

1. Realizar una limpieza profunda del lugar.
2. Cerrar todas las ventanas.
3. Apagar equipos electricos sobre todo aire acondicionado y ventiladores.
4. Desocupar áreas afectadas donde se observa la mayor actividad de plagas, esto es con el fin de aplicar a fondo el insecticida y llegar a los nidos que normalmente están en las partes más escondidas para atacar el problema de raíz.
5. Guardar o cubrir alimentos con bolsas plasticas o manteles.
6. Si es posible retire los muebles a unos 30 cms. de las paredes para poder realizar la aplicación en todos los perímetros.
7. Retirar el personal de las instalaciones para la prestación del servicio.
8. Corte el césped en intervalos de tiempo cortos para garantizar la efectividad de los productos aplicados.

Durante

1. No se debe ingresar por ningun motivo al area donde se esta realizando la fumigacion.

Despues

1. Las instalaciones deben permanecer cerradas por un periodo de tiempo de 2 / 4 horas.
2. Después de 2 horas., ventilar bien durante media hora (o más si queda olor) antes de volver a ingresar a las instalaciones.
3. Realizar lavado y/o limpieza de las areas intervenidas un día despúes de la prestación del servicios.

LAVADO DE TANQUES

Antes

1. Desocupar el tanque de agua el dia anterior para que sea consumida en las instalaciones y no se presente desperdicio de la misma, adicionalmnete debe dejar aproximadamente un de 50 litros para realizar el respectivo lavado.,
2. Cerrar la llave de ingreso de agua.

Durante

1. No se debe realizar la apertura de llave de agua hasta que el tecnico termine de realizar la limpieza.

Despues

1. El cliente debe realizar la verificacion del lavado de tanque y posteriormente realizar la apertura de la llave para el respectivo llenado y control del llenado de la misma por parte del cliente.

IMPORTANTE:

Realizar acompañamiento para el ingreso del tecnico aplicador a las instalaciones y para su retiro.

Se realiza la entrega de las hojas de seguridad de los productos utilizados en los servicios prestados