REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

DISTINTIVO DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS

Código y Nombre del Prestador		**2300102310 - LABORATORIO LORENA VEJARANO SAS**			
Código y Nombre de la Sede		**230010231001-LABORATORIOS LORENA VEJARANO MONTERIA**			
Departamento	**CÓRDOBA**	**Municipio**	**MONTERÍA**	**Dirección**	**CALLE 34 # 14 - 26. Barrio: EL EDEN.**
Grupo del Servicio		**Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica**			

706 - LABORATORIO CLÍNICO

Número Único del Distintivo de Habilitación de Servicios: ***DHSS0494790***

Verifique la información de este documento, ingresando a: https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultadistintivo_dhss.aspx y posteriormente digitando el Número Único del Distintivo de Habilitación de Servicios:DHSS0494790

En caso de cualquier inquietud con el DISTINTIVO DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS comuníquese con la Secretaría Desarrollo de la Salud de Córdoba - Dirección:Calle 10 Nº 25-105 C.C. Suricentro Piso 2 - Telefono(s):7915505 EXT 148 7915505 EXT 148 - Correo Electronico:prestacion.servicios@cordoba.gov.co

Fecha de apertura del servicio: 09 - 11 - 2022 (DD-MM-AAAA).

Fecha de impresión: martes 15 de noviembre de 2022 (2:32 p.m.).

El presente documento se expide de conformidad con lo previsto en la Parte 5, Título 1, Capítulo 1 del Decreto 780 de 2016 y la Resolución 3100 de 2019, o las normas que la modifiquen o sustituyan.

Código interno MinSalud_PS:1206847285

Versión 3.0.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

DISTINTIVO DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS

Código y Nombre del Prestador		**1100127346 - LABORATORIO LORENA VEJARANO SAS**			
Código y Nombre de la Sede		**110012734601-LABORATORIO CLINICO E INMUNOLOGICO LORENA VEJARANO IPS BOGOTA**			
Departamento	**Distrito:BOGOTÁ**	**Municipio**	**Distrito:BOGOTÁ**	**Dirección**	**Calle 25G # 85B-89. Barrio: SANTA CECILIA.**
Grupo del Servicio		**Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica**			

712 - TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO

Número Único del Distintivo de Habilitación de Servicios: ***DHSS0017795***

Verifique la información de este documento, ingresando a: https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultadistintivo_dhss.aspx y posteriormente digitando el Número Único del Distintivo de Habilitación de Servicios:DHSS0017795

En caso de cualquier inquietud con el DISTINTIVO DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS comuníquese con la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá - Dirección:Carrera 32 No.12-81 - Telefono(s):3649090 3649090 EXT 9769 - 9586 - Correo Electronico:habilitacionsds@saludcapital.gov.co

Fecha de apertura del servicio: 16 - 06 - 2015 (DD-MM-AAAA).

Fecha de impresión: martes 25 de mayo de 2021 (10:41 a. m.).

El presente documento se expide de conformidad con lo previsto en la Parte 5, Título 1, Capítulo 1 del Decreto 780 de 2016 y la Resolución 3100 de 2019, o las normas que la modifiquen o sustituyan.

Código interno MinSalud_PS:-560183314

Versión 3.0.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

DISTINTIVO DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS

Código y Nombre del Prestador		**1100127346 - LABORATORIO LORENA VEJARANO SAS**			
Código y Nombre de la Sede		**110012734601-LABORATORIO CLINICO E INMUNOLOGICO LORENA VEJARANO IPS BOGOTA**			
Departamento	**Distrito:BOGOTÁ**	**Municipio**	**Distrito:BOGOTÁ**	**Dirección**	**Calle 25G # 85B-89. Barrio: SANTA CECILIA.**
Grupo del Servicio		**Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica**			

706 - LABORATORIO CLÍNICO

Número Único del Distintivo de Habilitación de Servicios: ***DHSS0017794***

Verifique la información de este documento, ingresando a: https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultadistintivo_dhss.aspx y posteriormente digitando el Número Único del Distintivo de Habilitación de Servicios:DHSS0017794

En caso de cualquier inquietud con el DISTINTIVO DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS comuníquese con la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá - Dirección:Carrera 32 No.12-81 - Telefono(s):3649090 3649090 EXT 9769 - 9586 - Correo Electronico:habilitacionsds@saludcapital.gov.co

Fecha de apertura del servicio: 16 - 10 - 2014 (DD-MM-AAAA).

Fecha de impresión: martes 25 de mayo de 2021 (10:41 a. m.).

El presente documento se expide de conformidad con lo previsto en la Parte 5, Título 1, Capítulo 1 del Decreto 780 de 2016 y la Resolución 3100 de 2019, o las normas que la modifiquen o sustituyan.

Código interno MinSalud_PS:68980765

Versión 3.0.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

DISTINTIVO DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS

Código y Nombre del Prestador		**1900108441 - LABORATORIO LORENA VEJARANO S.A.S.**			
Código y Nombre de la Sede		**190010844101-LABORATORIO CLINICO E INMUNOLOGICO LORENA VEJARANO IPS SEDE PRINCIPAL**			
Departamento	**CAUCA**	**Municipio**	**POPAYÁN**	**Dirección**	**CARRERA 5A Nº10N-09. Barrio: BOLIVAR.**
Grupo del Servicio		**Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica**			

706 - LABORATORIO CLÍNICO

Número Único del Distintivo de Habilitación de Servicios: ***DHSS0019472***

Verifique la información de este documento, ingresando a: https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultadistintivo_dhss.aspx y posteriormente digitando el Número Único del Distintivo de Habilitación de Servicios:DHSS0019472

En caso de cualquier inquietud con el DISTINTIVO DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS comuníquese con la Secretaría Departamental de Salud del Cauca - Dirección:Calle 5a No. 15-57 - Telefono(s):8209614 Ext. 205 - 3218117428 8209614 Ext. 205 - 3218117428 - Correo Electronico:grupo.calidad@saludcauca.gov.co

Fecha de apertura del servicio: 31 - 05 - 2011 (DD-MM-AAAA).

Fecha de impresión: lunes 24 de mayo de 2021 (8:36 a. m.).

El presente documento se expide de conformidad con lo previsto en la Parte 5, Título 1, Capítulo 1 del Decreto 780 de 2016 y la Resolución 3100 de 2019, o las normas que la modifiquen o sustituyan.

Código interno MinSalud_PS:60335665

Versión 3.0.

Proasecal®
La calidad es un compromiso personal

PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL LABORATORIO
PROASECAL S.A.S.
NIT 830079375-8

HACE CONSTAR QUE:

LABORATORIO LORENA VEJARANO S.A.S. - SEDE PRINCIPAL

KR 5 A No. 10 N - 09 BR Bolivar, Popayan, Colombia

está inscrito en el Programa de Control de Calidad Externo ProgBA
que nuestra empresa representa, en el módulo de

Pesquisa Neonatal

Programa Mensual

correspondiente a la vigencia: Octubre 2022 a Septiembre 2023

RONDA 37

Se expide en Bogotá, D.C., Enero 26 de 2023

Ana Lucía Aguirre Mejía
Director Técnico

La autenticidad de este documento puede ser verificada comunicándose a los teléfonos de contacto de Proasecal SAS, registrados en este certificado.

icontec ISO 9001 SC 6195-1

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

PROASECAL20111673202301261

PR-INS-DOC 001 V1

ESfEQA
European Society for
External Quality Assessment

Certificate of Participation

The laboratory

LABORATORIO LORENA VEJARANO

POPAYAN

CO5893a

participated in the following survey:

Dengue Virus

Deadline of result submission

21/11/2022

Analytes

anti-Dengue virus IgG, anti-Dengue virus IgM

Dieter Groche

Coordinator of ESfEQA GmbH

ESfEQA GmbH, Siemensstraße 38, 69123 Heidelberg, Germany, Phone + 49 (0)6221 4166-700, Fax + 49 (0)6221 4166-790
info@esfeqa.eu, www.esfeqa.eu

ESfEQA
European Society for
External Quality Assessment

Certificate of Participation

The laboratory

LABORATORIO LORENA VEJARANO

POPAYAN

CO5893a

participated in the following survey:

Infectious Disease Combination Control / INF 4

Deadline of result submission

07/11/2022

Analytes

Anti-HBc, Anti-HCV, Anti-HIV I/II, HBsAg

Dieter Groche

Coordinator of ESfEQA GmbH

ESfEQA GmbH, Siemensstraße 38, 69123 Heidelberg, Germany, Phone + 49 (0)6221 4166-700, Fax + 49 (0)6221 4166-790
info@esfeqa.eu, www.esfeqa.eu

ESfEQA
European Society for
External Quality Assessment

Certificate of Participation

The laboratory

LABORATORIO LORENA VEJARANO

POPAYAN

CO5893a

participated in the following survey:

Syphilis 4 / Treponema pallidum

Deadline of result submission

07/11/2022

Analytes

anti-Treponema pallidum Total qual., non-trep. Lipoid antibodies Total qual., non-trep. Lipoid antibodies Total titer semi-quant

Dieter Groche

Coordinator of ESfEQA GmbH

ESfEQA GmbH, Siemensstraße 38, 69123 Heidelberg, Germany, Phone + 49 (0)6221 4166-700, Fax + 49 (0)6221 4166-790
info@esfeqa.eu, www.esfeqa.eu

ESfEQA
European Society for
External Quality Assessment

Certificate of Participation

The laboratory

LABORATORIO LORENA VEJARANO

POPAYAN

CO5893a

participated in the following survey:

ToRCH

Deadline of result submission

07/11/2022

Analytes

anti-CMV IgG, anti-CMV IgG quant., anti-CMV IgM qual., anti-HSV 1 IgG qual., anti-HSV 1 IgM qual., anti-HSV 2 IgG qual., anti-HSV 2 IgM qual., anti-Rubella IgG, anti-Rubella IgG quant., anti-Rubella IgM qual., anti-Toxo IgG, anti-Toxo IgG quant., anti-Toxo IgM qual.

Dieter Groche

Coordinator of ESfEQA GmbH

ESfEQA GmbH, Siemensstraße 38, 69123 Heidelberg, Germany, Phone + 49 (0)6221 4166-700, Fax + 49 (0)6221 4166-790
info@esfeqa.eu, www.esfeqa.eu

Proasecal®
La calidad es un compromiso personal

PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL LABORATORIO
PROASECAL S.A.S.
NIT 830079375-8

HACE CONSTAR QUE:

LABORATORIO LORENA VEJARANO S.A.S. - SEDE PRINCIPAL

KR 5 A No. 10 N - 09 BR Bolivar, Popayan, Colombia

participó en el Programa de Control de Calidad Externo en nuestra empresa cumpliendo con el reporte mínimo del 80% de las muestras contratadas, en

PARASITOLOGÍA

correspondiente a la vigencia de: Enero 2022 a Diciembre 2022

Se expide en Bogotá, D.C., Enero 26 de 2023

Ana Lucía Aguirre Mejía
Director Técnico

PROASECAL8P167320230126-P
PR-INS-DOC 005 V1

La autenticidad de este documento puede ser verificada comunicándose a los teléfonos de contacto de Proasecal SAS, registrados en este certificado.

ema
PROVEEDOR DE
ENSAYOS DE APTITUD
ACREDITADO PEA-CLI-07

icontec
ISO 9001
SC 6195-1

IQNET
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Cra. 13 N° 98 - 70 Oficina 604 Bogotá D.C. PBX: 57 (601) 6914847
Celulares: (57) 313 4204018 - 301 4077981 - 315 2368224
Página Web: www.proasecal.com

Proasecal®
La calidad es un compromiso personal

PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL LABORATORIO
PROASECAL S.A.S.
NIT 830079375-8

HACE CONSTAR QUE:

LABORATORIO LORENA VEJARANO S.A.S. - SEDE PRINCIPAL

KR 5 A No. 10 N - 09 BR Bolivar, Popayan, Colombia

participó en el Programa de Control de Calidad Externo en nuestra empresa cumpliendo con el reporte mínimo del 80% de las muestras contratadas, en

MICROBIOLOGÍA

correspondiente a la vigencia de: Enero 2022 a Diciembre 2022

Se expide en Bogotá, D.C., Enero 26 de 2023

Ana Lucía Aguirre Mejía
Director Técnico

PROASECAL6MB167320230126-P
PR-INS-DOC 005 V1

La autenticidad de este documento puede ser verificada comunicándose a los teléfonos de contacto de Proasecal SAS, registrados en este certificado.

ema
PROVEEDOR DE ENSAYOS DE APTITUD
ACREDITADO PEA-CLI-07

icontec ISO 9001 SC 6195-1

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Cra. 13 N° 98 - 70 Oficina 604 Bogotá D.C. PBX: 57 (601) 6914847
Celulares: (57) 313 4204018 - 301 4077981 - 315 2368224
Página Web: www.proasecal.com

RIQAS

Certificate of Participation

COAGULATION PROGRAMME
January 2022 - December 2022

Laboratorio Lorena Vejarano SAS

Stephen Doherty
RIQAS Manager

UKAS PROFICIENCY TESTING 0010

Randox International Quality Assessment Scheme
Randox Laboratories Ltd., 55 Diamond Road, Crumlin, Co. Antrim, BT29 4QY, United Kingdom

DISCLAIMER
The personal information on this certificate has been supplied by the participant and Randox Laboratories Ltd. takes no responsibilty for its content.

Randox International Quality Assessment Scheme • RIQAS

RIQAS

Certificate of Participation

GLYCATED HAEMOGLOBIN PROGRAMME

January 2022 - December 2022

Laboratorio Lorena Vejarano SAS
NIT 900435146-9

Stephen Doherty
RIQAS Manager

UKAS PROFICIENCY TESTING
0010

Randox International Quality Assessment Scheme
Randox Laboratories Ltd., 55 Diamond Road, Crumlin, Co. Antrim, BT29 4QY, United Kingdom

Randox International Quality Assessment Scheme • RIQAS

DISCLAIMER
The personal information on this certificate has been supplied by the participant and Randox Laboratories Ltd. takes no responsibilty for its content.

RIQAS

Certificate of Participation

MONTHLY IMMUNOASSAY PROGRAMME

January 2022 - December 2022

Laboratorio Lorena Vejarano SAS
NIT 900435146-9

Stephen Doherty
RIQAS Manager

UKAS PROFICIENCY TESTING
0010

Randox International Quality Assessment Scheme
Randox Laboratories Ltd., 55 Diamond Road, Crumlin, Co. Antrim, BT29 4QY, United Kingdom

Randox International Quality Assessment Scheme
RIQAS

DISCLAIMER
The personal information on this certificate has been supplied by the participant and Randox Laboratories Ltd. takes no responsibilty for its content.

RIQAS

Certificate of Participation

SPECIFIC PROTEINS PROGRAMME

March 2022 - August 2022

Laboratorio Lorena Vejarano SAS

NIT 900435146-9



Stephen Doherty

RIQAS Manager

UKAS PROFICIENCY TESTING 0010

Randox International Quality Assessment Scheme

Randox Laboratories Ltd., 55 Diamond Road, Crumlin, Co. Antrim, BT29 4QY, United Kingdom

Randox International Quality Assessment Scheme • RIQAS

DISCLAIMER

The personal information on this certificate has been supplied by the participant and Randox Laboratories Ltd. takes no responsibilty for its content.

RIQAS

Certificate of Participation

MONTHLY CLINICAL CHEMISTRY PROGRAMME

January 2022 - December 2022

Laboratorio Lorena Venarano Sas Sede Popayan
calidadanalitica@lorenavejarano.com

Stephen Doherty
RIQAS Manager

UKAS PROFICIENCY TESTING
0010

Randox International Quality Assessment Scheme
Randox Laboratories Ltd., 55 Diamond Road, Crumlin, Co. Antrim, BT29 4QY, United Kingdom

Randox International Quality Assessment Scheme • RIQAS

DISCLAIMER

The personal information on this certificate has been supplied by the participant and Randox Laboratories Ltd. takes no responsibilty for its content.

RIQAS

Certificate of Participation

MONTHLY HAEMATOLOGY PROGRAMME

January 2022 - December 2022

Laboratorio Lorena Venarano Sas Sede Popayan

Stephen Doherty
RIQAS Manager

UKAS PROFICIENCY TESTING
0010

Randox International Quality Assessment Scheme
Randox Laboratories Ltd., 55 Diamond Road, Crumlin, Co. Antrim, BT29 4QY, United Kingdom

Randox International Quality Assessment Scheme
RIQAS

DISCLAIMER
The personal information on this certificate has been supplied by the participant and Randox Laboratories Ltd. takes no responsibilty for its content.

EL SUSCRITO REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEL:
LABORATORIO CLINICO LORENA VEJARANO SAS
NIT. 900435146-9

CERTIFICA

Que el **LABORATORIO CLINICO LORENA VEJARANO SAS** con NIT 900435146-9 cuenta un programa de Rectivovigilancia conforme lo dispone la normativa vigente, además cuenta con un referente del programa en cada sede. Y cuentas con los siguientes son los principios que rigen el Programa Institucional de Reactivovigilancia.

1. Articulación del programa: El Programa de Reactivovigilancia involucra la participación de diferentes actores que trabajan de manera conjunta y articulada basados en los principios del modelo de inspección, vigilancia y control establecidos en la Resolución número 1229 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.

2. Sensibilidad: Representa la capacidad para detectar correctamente los eventos objeto de vigilancia.

3. Oportunidad: Tiempo que transcurre entre la ocurrencia del evento objeto de vigilancia, recepción y su notificación, tiempo en el que el sistema detecta los hechos, y tiempo en el que se transforman las sugerencias en medidas de control y prevención.

4. Transparencia: El modelo garantizará un ambiente de confianza, seguridad y veracidad entre la autoridad pública competente y la sociedad, de tal forma que los ciudadanos estén informados sobre los riesgos y conozcan las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y medidas que se adopten para prevenir, reducir o eliminar el riesgo, dependiendo de su naturaleza, gravedad y envergadura.


5. Eficacia y eficiencia: El modelo desarrollará capacidad para alcanzar resultados con el uso racional de recursos en el tiempo determinado.

6. Calidad: El modelo dará garantía de veracidad, oportunidad y confianza.

7. Unidad: El modelo promoverá la integración funcional de actores y operación en red de modo coordinado y articulado.

8. Complementariedad y concurrencia: El modelo desarrollará la capacidad de actuar sinérgicamente en dirección al logro de resultados.

Adjunto evidencia del documento debidamente normalizado en el sistema de gestión de calidad

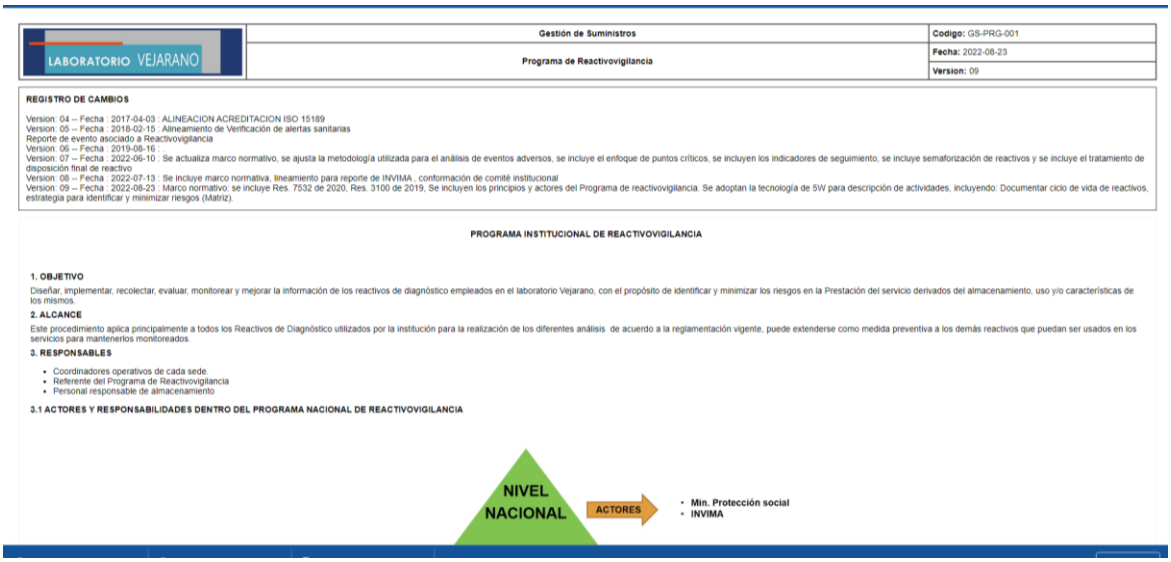

LABORATORIO VEJARANO	Gestión de Suministros	**Codigo:** GS-PRG-001
	Programa de Reactivovigilancia	**Fecha:** 2022-08-23
		Version: 09

REGISTRO DE CAMBIOS

Version: 04 -- Fecha : 2017-04-03 : ALINEACION ACREDITACION ISO 15189
Version: 05 -- Fecha : 2018-02-15 : Alineamiento de Verificación de alertas sanitarias
Reporte de evento asociado a Reactivovigilancia
Version: 06 -- Fecha : 2019-08-16 :
Version: 07 -- Fecha : 2022-06-10 : Se actualiza marco normativo, se ajusta la metodología utilizada para el análisis de eventos adversos, se incluye el enfoque de puntos críticos, se incluyen los indicadores de seguimiento, se incluye semaforización de reactivos y se incluye el tratamiento de disposición final de reactivo
Version: 08 -- Fecha : 2022-07-13 : Se incluye marco normativa, lineamiento para reporte de INVIMA , conformación de comité institucional
Version: 09 -- Fecha : 2022-08-23 : Marco normativo: se incluye Res. 7532 de 2020, Res. 3100 de 2019, Se incluyen los principios y actores del Programa de reactivovigilancia. Se adoptan la tecnología de SW para descripción de actividades, incluyendo: Documentar ciclo de vida de reactivos, estrategia para identificar y minimizar riesgos (Matriz).

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE REACTIVOVIGILANCIA

1. OBJETIVO

Diseñar, implementar, recolectar, evaluar, monitorear y mejorar la información de los reactivos de diagnóstico empleados en el laboratorio Vejarano, con el propósito de identificar y minimizar los riesgos en la Prestación del servicio derivados del almacenamiento, uso y/o características de los mismos.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica principalmente a todos los Reactivos de Diagnóstico utilizados por la institución para la realización de los diferentes análisis de acuerdo a la reglamentación vigente, puede extenderse como medida preventiva a los demás reactivos que puedan ser usados en los servicios para mantenerlos monitoreados.

3. RESPONSABLES

- Coordinadores operativos de cada sede.
- Referente del Programa de Reactivovigilancia
- Personal responsable de almacenamiento

3.1 ACTORES Y RESPONSABILIDADES DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REACTIVOVIGILANCIA

Se expide en Popayán a los veinticuatro (23) días del mes de Enero de 2023.

LABORATORIO VEJARANO
Angélica María Torres Martínez
Dirección de Calidad
Móvil: 3102268081
E-mail: direcciodecalidad@laboratoriovejarano.com

Recuerda estamos comprometidos con tu salud

CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

A continuación se relaciona el cronograma con la fecha estipulada para la instalación de los siguientes equipo biomédicos:

Nombre del equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Instalación
CELLDYN RUBY	ABBOTT	RUBY	54995BG	5/02/2023
ACL TOP 350	WERFEN	350	17080687	5/02/2023
ARCHITEC	ABBOTT	C4000	C401777	5/02/2023
ARCHITEC	ABBOTT	i1000	i1SR56113	5/02/2023
PHOENIX 100	BECTON DICKINSON	100	PX2471	5/02/2023
INCUBADORA	C4	INDUCELL	141536	5/02/2023
NEVERA	INDURAMA	VFV-520	E001531248001260199	5/02/2023
BAÑO SEROLOGICO	LW SCIENTIFIC	DSB-1000	14100078	5/02/2023
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	HALTHEN	TTH-002	22555	5/02/2023
TERMOMETRO	DIGITAL TERMOMETER	TEM50	10012989	5/02/2023
CENTRIFUGA HORIZON	DRUCKER	755VES	181160AC857	5/02/2023

Cordialmente,

DIANA OLIVETH LÓPEZ DAZA
Ing. Biomédica
RH-201907-390

EXAMEN	REMISION
HEMOGRAMA TIPO IV (ELECTRONICO - HIST	PROPIO
PROTEÍNA C REACTIVA (PCR) PRUEBA SEMI	PROPIO
UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD	PROPIO
CREATININA EN SUERO, ORINA U OTROS	PROPIO
POTASIO (K)	PROPIO
SODIO (NA)	PROPIO
CLORO(CLORURO)	PROPIO
NITROGENO UREICO (BUN)	PROPIO
GLUCEMIA EN SUERO, LCR, U OTRO FLUIDO	PROPIO
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL TPT	PROPIO
TIEMPO DE PROTROMBINA TP	PROPIO
HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO Y FACTO	PROPIO
TRANSAMINASA ASPARTATO AMINOTRANS	PROPIO
TRANSAMINASA ALANINO AMINOTRANSFER	PROPIO
PRUEBA DE EMBARAZO, GONADOTROPINA	PROPIO
BILIRRUBINA DIRECTA	PROPIO
BILIRRUBINA TOTAL	PROPIO
SEROLOGIA (PRUEBA NO TREPONEMICA) VD	PROPIO
UROCULTIVO Y ANTIBIOGRAMA MIC MANUAL	PROPIO
DESHIDROGENASA LACTICA LDH	PROPIO
VIH 1/2 ANTICUERPOS (VIRUS DE INMUNOD	PROPIO
HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFÍCIE (AG	PROPIO
HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES (TS	PROPIO
HEPATITIS C ANTICUERPOS (ANTI-HVC)	PROPIO
UREA	PROPIO
AMILASA SERICA	PROPIO
DENGUE ANTICUERPOS TOTALES	PROPIO
EXTENDIDO DE SANGRE PERIFERICA ESTUD	PROPIO
PRUEBA DE COMPATIBILIDAD CRUZADA MAY	PROPIO
HEMOCULTIVO SERIADO 1RA MUESTRA	PROPIO
HEMOCULTIVO SERIADO 2DA MUESTRA	PROPIO
COPROLOGICO	PROPIO
HEMOPARASITOS FROTIS (EXTENDIDO DE G	PROPIO
FOSFATASA ALCALINA	PROPIO
DENGUE ANTICUERPOS IGM	PROPIO
DENGUE ANTICUERPOS IGG	PROPIO
ACIDO URICO	PROPIO
LEPTOSPIRA ANTICUERPOS IGG	EXTERNO
LEPTOSPIRA ANTICUERPOS IGM	EXTERNO
HEMOCULTIVO SERIADO 3RA MUESTRA	PROPIO
CULTIVO Y A/B PARA MICROORGANISMOS E	PROPIO
PROTEÍNAS EN ORINA DE 24 HORAS	PROPIO
SECRECION VAGINAL MICROSCOPICO	PROPIO
ALBUMINA EN SUERO	PROPIO
ERITROSEDIMENTACION VELOCIDAD SEDIM	PROPIO

ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA (PSA)	PROPIO
COLESTEROL TOTAL	PROPIO
TRIGLICERIDOS	PROPIO
PROTEÍNAS TOTALES EN SUERO Y OTROS F	PROPIO
TOXOPLASMA GONDII	PROPIO
GONADOTROPINA CORIONICA SUBUNIDAD B	PROPIO
HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES (TS	PROPIO
RECUENTO DE RETICULOCITOS METODO MA	PROPIO
HEMOGLOBINA GLICOSILADA POR CROMAT	PROPIO
TOXOPLASMA GONDII ANTICUERPOS IGG PO	PROPIO
COOMBS DIRECTO PRUEBA CUALITATIVA	PROPIO
CREATININA DEPURACION	PROPIO
BACILOSCOPIA (BAAR)	PROPIO
COLESTEROL HDL	PROPIO
COLESTEROL LDL	PROPIO
CREATIN QUINASA TOTAL CK-CPK	PROPIO
RECUENTO DE PLAQUETAS METODO MANU	PROPIO
TIROXINALIBRET4L	PROPIO
NUCLEARES, ANTICUERPOS (ANA) POR IFI	PROPIO
CREATIN QUINASA (FRACCION MB) POR ESP	PROPIO
GLUCEMIA CURVA DE TOLERANCIA 3 HORAS	PROPIO
TROPONINA T CUANTITATIVA	PROPIO
ANTIGENOS FEBRILES (VIDAL O WEIL FELIX)	PROPIO
HIERRO TOTAL	PROPIO
LIQUIDO PLEURAL (EXAMEN FISICO Y CITOQ	EXTERNO
SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL DETE	PROPIO
COOMBS INDIRECTO PRUEBA CUALITATIVA	PROPIO
POTASIO EN ORINA PARCIAL	EXTERNO
SODIO EN ORINA PARCIAL	EXTERNO
TRIYODOTIRONINA TOTAL (T3)	PROPIO
TRIYODOTIRONINA TOTAL (T3)	PROPIO
BACILOSCOPIA SERIADA 1RA MUESTRA	PROPIO
CLORO EN ORINA PARCIAL	EXTERNO
EXAMEN DIRECTO PARA HONGOS KOH	PROPIO
HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM (ANTI HVA-	PROPIO
HEPATITIS A ANTICUERPOS TOTALES (ANTI	PROPIO
PROTEÍNAS DIFERENCIADAS	PROPIO
SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL (GUA	PROPIO
TIROXINATOTAL T4	PROPIO
COLORACION DE GRAM Y LECTURA PARA C	PROPIO
CREATININA EN ORINA	PROPIO
CREATININA EN ORINA DE 24 HORAS	PROPIO
NITROGENO UREICO (BUN) EN ORINA DE 24	PROPIO
RECUENTO DE PLAQUETAS METODO AUTOM	PROPIO
ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (ANA)	PROPIO

BACILOSCOPIA SERIADA 3RA MUESTRA	PROPIO
CALCIO AUTOMATIZADO	PROPIO
MAGNESIO (MG)	PROPIO
MICROALBUMINURIA POR EIA	PROPIO
PROTEÍNAS DIFERENCIADAS (ALBUMINA/GL	PROPIO
RECUENTO DE RETICULOCITOS POR CITOM	PROPIO
TREPONEMA PALLIDIUM ANTICUERPOS (FT	EXTERNO
UROCULTIVO RTO DE COLONIAS Y ANTIBIOG	PROPIO
ALBUMINA EN ORINA	EXTERNO
ANTIGENOS BACTERIANOS EN LCR, SANGRE	EXTERNO
BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA	PROPIO
CALCIO POR COLORIMETRIA ÇSERICO)	PROPIO
CALCIO AUTOMATIZADO	PROPIO
CLORO (CLORURO) EN ORINA DE 24 HORAS	EXTERNO
CLORO EN ORINA PARCIAL	EXTERNO
COPROCULTIVO	PROPIO
CUERPOS CETONICOS O CETONAS EN ORIN	EXTERNO
DIMERO D POR EIA	PROPIO
EXAMEN DIRECTO FRESCO DE CUALQUIER	PROPIO
FACTOR REUMATOIDEO	PROPIO
FACTOR REUMATOIDEO LATEX	PROPIO
GLICEMIA PRE Y POST CARGA DE GLUCOSA	PROPIO
HEMOCLASIFICACION FACTOR RH (FACTOR	PROPIO
HEMOCULTIVO AEROBIO POJ2.MERO.DORIVLan	PROPIO
LIQUIDO ASCITICO (EXAMEN FISICO Y CITO	EXTERNO
LIQUIDO AMNIOTICO EXAMEN FISICO Y CITO	EXTERNO
LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO (LCR EXAMEN	EXTERNO
POTASIO EN ORINA DE 24	EXTERNO
RECUENTO DE RETICULOCITOS CONTADOR	PROPIO
SODIO EN ORINA DE 24 HORAS	EXTERNO
TROPONINA T CUANTITATIVA	PROPIO
UREA EN ORINA	EXTERNO

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

acreditada INSTITUCIONALMENTE

ACTA DE GRADO No.896228

EN LA CIUDAD DE MONTERÍA, A LOS **17** DÍAS DEL MES **AGOSTO** DE **2021** SE CELEBRÓ EL ACTO DE GRADUACIÓN DEL SEÑOR (A):

CESAR ANDRES BRAVO DEMOYA

CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO **1.067.960.164** EXPEDIDA EN **MONTERÍA,** A QUIEN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE:

CIENCIAS DE LA SALUD

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL LE OTORGÓ EL TÍTULO DE:

BACTERIÓLOGO

Y SE LE HIZO ENTREGA DEL DIPLOMA CORRESPONDIENTE. EN FE DE LO ANTERIOR, SE FIRMA LA PRESENTE ACTA DE GRADO EN LA CIUDAD DE MONTERÍA, A LOS **17** DÍAS DEL MES DE **AGOSTO** DE **2021.**

FIRMADO POR:

CELY FIGUEROA BANDA
SECRETARIA GENERAL

WINSTON CALE GARCES HERRERA
JEFE (E) DE ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO

MONTERÍA, 17 DE AGOSTO DE 2021

REGISTRADO AL FOLIO 84 DEL LIBRO DE REGISTRO DE ACTAS No. 5
32226

Escaneado con CamScanner

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 178086513

WEB
06:53:10

Bogotá DC, 28 de septiembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CESAR ANDRES BRAVO DEMOYA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1067960164:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 19 de agosto de 2021, a las 19:37:29, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	1067960164
Código de Verificación	1067960164210819193729

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 19:32:21 horas del 19/08/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 1067960164

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Volver al Inicio



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.067.960.164
BRAVO DEMOYA
APELLIDOS
CESAR ANDRES
NOMBRES

César Bravo
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-JUN-1998
MONTERIA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

08-JUN-2016 MONTERIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-1300100-00840014-M-1067960164-20160714 0050470624A 1 46594523

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 26/01/2023 12:48:37 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1067960164 .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **51492082** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA

NIT. 901366232-1

Verificación

Aprobado por Decreto No.1075 del 26/05/2015. Educación no formal Art. 2.6.6.8.

Certifica

Cesar Andrés Bravo De Moya

c.c. 1067960164 de Montería

Realizó y aprobó el Curso Protocolos en la Toma y Transporte de Muestras de Laboratorio con un total de 60 Horas.

Fecha de emisión: 2022-07-14
Fecha de vencimiento: 2024-07-14

FUNDACION NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA
verifique la autenticidad de su certificado en la pagina
www.fundacionnuestrasenoradelaesperanza.org

ING. SOLANLLY COVALEDA
Representante Legal.

DEIBIE STEVENS BRAVO OBANDO
Jefe de Enfermería
TP 3206
Docente.

ROSA GUZMAN
ESP. Orientación Educativa y Desarrollo Humano
Docente Especialista

FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA

NIT. 901366232-1

Verificación

Aprobado por Decreto No.1075 del 26/05/2015. Educación no formal Art. 2.6.6.8.

Certifica

Cesar Andrés Bravo De Moya

c.c. 1067960164 de Montería

Realizó y aprobó el Curso de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual - Código Fucsia - Resolución 3100 / 2019
con un total de 80 Horas.

Fecha de emisión: 2022-07-16
Fecha de vencimiento: 2024-07-16

FUNDACION NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA
verifique la autenticidad de su certificado en la pagina
www.fundacionnuestrasenoradelaesperanza.org

ING. SOLANLLY COVALEDA
Representante Legal.

DEIBIE STEVENS BRAVO OBANDO
Jefe de Enfermería
TP 3206
Docente.

ROSA GUZMAN
ESP. Orientación Educativa y Desarrollo Humano
Docente Especialista

NIT 891080031-3

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
y en su nombre

LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CONFIERE EL TÍTULO DE

BACTERIÓLOGO

A

CESAR ANDRES BRAVO DEMOYA

C.C. No. 1.067.960.164 DE MONTERÍA

POR HABER CUMPLIDO LOS REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS
Y EN TESTIMONIO DE ELLO LE OTORGA EL PRESENTE DIPLOMA

En la ciudad de Montería, a los 17 días del mes de AGOSTO de 2021

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

SECRETARIO GENERAL

DECANO DE LA FACULTAD

Registrado al folio No. 84 del Libro de Registros de Diplomas No. 11


42123

THOMAS GREG & SONS.

Escaneado con CamScanner

César Andres BRAVO DÉ MOYA

23 Años
Villa Margarita, Monteria, Colombia
Manzana 19 Lote 8
Tel : 3136005033
Email : cesarbravo2004@gmail.com

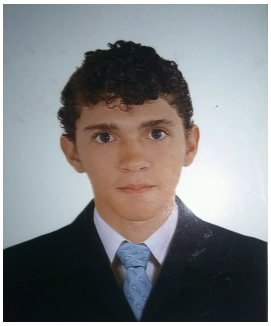

ESTUDIOS

2013 **Bachiller**
Montería Institución Educativa Villa Margarita

2021 **Bacteriologo**
Montería Universidad de Cordoba

OTROS CURSOS

2020 **Humanizacion en la Prestacion de Servicios de Salud**
Montería Sena

2020 **Rastreo de los contactos de la COVID-19**
Montería Johns Hopkins University

Idiomas: **Español:** Natal
Ingles: Medio

Programas manejados: Word, Excel, Power Point, Publisher, ente otros.

EXPERIENCIA LABORAL

Ene. 2020 – Jun. 2020 **BANCO DE SANGRE E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO**
Monteria - Colombia **Pasante Bacteriologo**

REFERENCIAS FAMILIARES

Lorena Andrea BRAVO DE MOYA
Hermana
Auxiliar en Deporte y Entrenamiento Fisico
Teléfono : 301 3119174

Cledys Margoth PETRO DE DE MOYA
Abuela
Madre Comunitaria
Teléfono : 300 7729493

REFERENCIAS PERSONALES

Valentina Judith ROMERO CASTILLO
Amiga
Bacteriologa
Teléfono : 300 2490261

Sindy Paola GALVAN ZAPA
Amiga
Estudiante
Teléfono : 300 4643847

SISPRO - APLICATIVOS MISIONALES
Sistema Integral de Información de la Protección Social

ReTHUS

A continuación diligencie la identificación o nombre y apellido de la persona a consultar en el Registro Unico Nacional de Talento Humano en Salud.


Tipo de Identificación *: Cedula de Ciudadania

Número de Identificación *: 1067960164

Primer Nombre *: CESAR

Primer Apellido *: BRAVO

Confirme los números de la Imagen *



Cambiar

5313

Verificar Registro en ReTHUS Limpiar

Resultado General -2022-06-21→3:06:27 PM

Tipo Identificación	Nro. Identificación	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Estado Identificación:	Detalles
CC	1067960164	CESAR	ANDRES	BRAVO	DEMOYA	Vigente	Ver

Atención telefónica a través del Centro de Contacto:
En Bogotá: +57(1) 3305043 Resto del país: 018000960020
Horario de atención:
Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. y sábados de 8:00a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua.
Solicitudes, sugerencias y reclamos PQRSD
Notificaciones judiciales
Términos y condiciones de uso.

La salud es de todos

Minsalud

Colegio Nacional de Bacteriología
CNB - Colombia

IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL TALENTO HUMANO EN SALUD

BACTERIÓLOGO



CESAR ANDRES BRAVO DEMOYA

C.C.1.067.960.164

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

MONTERÍA

Fecha de expedición del diploma: 2021-08-17

Fecha de inscripción en el ReTHUS: 2021-11-08

Escaneado con CamScanner

FIRMA TITULAR

"Esta tarjeta es un documento público y se expide de conformidad con la Ley 1164 de 2007 y el Decreto 4192 de 2010".

"Si esta tarjeta es encontrada, favor devolverla al Colegio Nacional de Bacteriología - CNB Colombia. Carrera 15 BIS A No 33- 03 Tel: 2886084".

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

10149

Escaneado con CamScanner

LABORATORIO VEJARANO

CERTIFICACION

El suscrito a saber, CLAUDIA LORENA VEJARANO en calidad de representante Legal del LABORATORIO LORENA VEJARANO SAS NIT 900.435.146-9 certifica que está en la capacidad de prestar el servicio pre - transfusional a la ESE Hospital San Diego de Cerete

Dada en Bogotá el día veintisiete (27) del mes de enero 2023



CLAUDIA LORENA VEJRANO R.
CC 34.551.801
Representante Legal
LABORATORIO LORENA VEJARANO SAS

CERTIFICA

Que el LABORATORIO LORENA VEJARANO SAS con NIT 900435146-9, cuenta con equipos de tecnología de punta, con disponibilidad de ficha técnica de cada uno de los equipos biomédicos relacionados a continuación:

Nombre del equipo	Marca	Modelo	Serie	Disponibilidad Ficha Técnica
CELLDYN RUBY	ABBOTT	RUBY	54995BG	si
ACL TOP 350	WERFEN	350	17080687	si
ARCHITEC	ABBOTT	C4000	C401777	si
ARCHITEC	ABBOTT	i1000	i1SR56113	si
PHOENIX 100	BECTON DICKINSON	100	PX2471	si
INCUBADORA	C4	INDUCELL	141536	si
NEVERA	INDURAMA	VFV-520	E001531248001260199	si
NEVERA	CHALLENGER	CR152 TITANIUM	17013-01469	si
NEVERA	INDURAMA	VF-5019	E000423918000161105	si
BAÑO SEROLOGICO	LW SCIENTIFIC	DSB-1000	14100078	si
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	HALTHEN	TTH-002	22555	si
TERMOMETRO	DIGITAL TERMOMETER	TEM50	10012989	si
TERMOMETRO	DIGITAL THERMOMETER	N.R.	10011043	si
TERMOMETRO	DIGITAL TERMOMETER	TEM50	10011311	si
TERMOMETRO	FRIDGE/FREEZER	N.R.	MC-036413	si
TERMOMETRO	DIGITAL THERMOMETER	N.R	10011111	si
CENTRIFUGA HORIZON	DRUCKER	755VES	181160AC857	si
TERMOHIGROMETRO	TEMPERATURE	HTC-2	SEN-755	si
TERMOHIGROMETRO	HYGRO-THERMOMETER	TEMCA300	10012126	si

Nombre del equipo	Marca	Modelo	Serie	Disponibilidad Ficha Técnica
PIPETA AUTOMATICA 50ul	HAMILTON	SOFTGRIP	91740	si
PIPETA AUTOMATICA 25ul	BOECO	SA SERIES	MH924608	si
PIPETA 100-1000ul	BOECO	BOECO	PG216867	si
PIPETA 5-50ul	BOECO	BOECO	PC153772	si
PIPETA 20 - 200ul	BOECO	BOECO	PG217190	si
PIPETA 10-100ul	BOECO	BOECO	PC153432	si
XN 350	SYSMEX	350	N/R	si
COBAS C111	ROCHE	C111	N/R	si
HORNO	HACEB	309	K133155506	si
CENTRIFUGA DIGITAL	SCIENTIFIC	TD4	N/R	si
CENTRIFUGA ANALOGA	SCIENTIFIC	N/R	N/R	si
TERMOHIGROMETRO	HALTHEN	TTH-002	29279	si

Se expide en Popayán a los VEINTICINCO (25) días del mes de Enero de 2023.

Cordialmente,

DIANA OLIVETH LÓPEZ DAZA
Ing. Biomédica
RH-201907-390

LABORATORIO VEJARANO

VALIDACIÓN DE EQUIPOS PARA LICITACIÓN

CODIGO	NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE	ÁREA	DISPONIBLE	ITEM		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
119	CELLDYN RUBY	ABBOTT	RUBY	54995BG	HEMATOLOGIA	5-feb	**a.Analizador de Hematología**	**HEMATOLOGÍA**	Analizador de hematología automatizado multiparamétrico, Parámetros: 22: 5-pt Diferencial Hemograma completo con diferencial. Parámetros leucocitarios: WBC: Concentración de leucocitos.NEU: Concentración absoluta de neutrófilos.% NEU: Porcentaje de neutrófilos del recuento de WBC. LYM: Concentración absoluta de linfocitos. % L: Porcentaje de linfocitos del recuento de WBC. MONO: Concentración absoluta de monocitos. %M: Porcentaje de monocitos del recuento de WBC. EOS: Concentración absoluta de eosinófilos. % EOS: Porcentaje de eosinófilos del recuento de WBC. BASO: Concentración absoluta de basófilos.% B: Porcentaje de basófilos del recuento de WBC Parámetros plaquetarios: PLT: Concentración plaquetaria.MVP: Volumen plaquetario medio. Parámetros eritrocitarios: RBC: Concentración de eritrocitos. HCT: Hematocrito. MVC: Volumen corpuscular medio. RDW: Amplitud en el tamaño de distribución de eritrocitos. % R: Porcentaje de reticulocitos. RETC: Concentración absoluta de reticulocitos. Parámetros de hemoglobina: HGB: Hemoglobina. MCH: Hemoglobina corpuscular media. MCHC: Concentración media corpuscular de hemoglobina. Este analizador tiene cuatro formas de procesamiento para una misma muestra: El hemograma completo (CBC), hemograma completo mas conteo óptico de núcleos (CBC + NOC), hemograma completo mas eritrocitos resistentes (CBC + RRBC) y finalmente el conteo de reticulocitos (RETIC) BENEFICIOS: Metodología MAPSS, La tecnología de medición óptica garantiza un rendimiento fiable y preciso en la carga de trabajo de hematología. METODOLOGÍA: Análisis óptico multiángulo. TIPO DE MUESTRA: Sangre entera. Rendimiento: Hasta 84 hem / hr. Voltaje nominal: 100 - 240 Vac (+/-10%),Frecuencia: 50/60 Hz, Consumo eléctrico Máx: 230 VA, Temperatura ambiente: 16 ºC - 34 ºC Humedad Relativa máx: 80%, Polo a tierra: Si,Potencia max: 550 W - Una sola computadora con pantalla táctil a color, teclado y mouse: Dimensiones: Altura 19.25 pulgadas (49.9 cm), Ancho: 34 pulgadas (86,4 cm),Profundidad: 30,25 pulgadas (76,8 cm) Peso 232 libras (105.2 kilogramos),Requisitos eléctricos: * VAC 100-240V, 50 / 60Hz, Consumo máximo de energía * 550 vatios* Solo analizador. - Capacidad de rendimiento max modo carga automático: 84/hora - Dimensiones (Al x An x Pr): Altura: 49,9 cm Anchura: 86,4 cm Profundidad: 76,8 cm - Peso: 105,2 kg (232 lb) - Reactivos Solo 4 reactivos incluidos reticulocitos - Gestión de datos Sistema operativo basado en Windows®. Anotaciones de resultados basadas en reglas. - Paquete de control de calidad completo en el sistema. - Gráficos de Levey-Jennings. - Promedios móviles. Reglas de Westgard. - 10 000 resultados almacenados con gráficos. - Guía en línea de calibración automática. -Volumen de muestra : Modo abierto 150 µL, cargador de muestras 230 µL
119	CELLDYN RUBY	ABBOTT	RUBY	54995BG	HEMATOLOGIA	5-feb	**b.Analizador de Hematología**		Analizador de hematología automatizado multiparamétrico, Parámetros: 22: 5-pt Diferencial Hemograma completo con diferencial. Parámetros leucocitarios: WBC: Concentración de leucocitos.NEU: Concentración absoluta de neutrófilos.% NEU: Porcentaje de neutrófilos del recuento de WBC. LYM: Concentración absoluta de linfocitos. % L: Porcentaje de linfocitos del recuento de WBC. MONO: Concentración absoluta de monocitos. %M: Porcentaje de monocitos del recuento de WBC. EOS: Concentración absoluta de eosinófilos. % EOS: Porcentaje de eosinófilos del recuento de WBC. BASO: Concentración absoluta de basófilos.% B: Porcentaje de basófilos del recuento de WBC Parámetros plaquetarios: PLT: Concentración plaquetaria.MVP: Volumen plaquetario medio. Parámetros eritrocitarios: RBC: Concentración de eritrocitos. HCT: Hematocrito. MVC: Volumen corpuscular medio. RDW: Amplitud en el tamaño de distribución de eritrocitos. % R: Porcentaje de reticulocitos. RETC: Concentración absoluta de reticulocitos. Parámetros de hemoglobina: HGB: Hemoglobina. MCH: Hemoglobina corpuscular media. MCHC: Concentración media corpuscular de hemoglobina. Este analizador tiene cuatro formas de procesamiento para una misma muestra: El hemograma completo (CBC), hemograma completo mas conteo óptico de núcleos (CBC + NOC), hemograma completo mas eritrocitos resistentes (CBC + RRBC) y finalmente el conteo de reticulocitos (RETIC) BENEFICIOS: Metodología MAPSS, La tecnología de medición óptica garantiza un rendimiento fiable y preciso en la carga de trabajo de hematología. METODOLOGÍA: Análisis óptico multiángulo. TIPO DE MUESTRA: Sangre entera. Rendimiento: Hasta 84 hem / hr. Voltaje nominal: 100 - 240 Vac (+/-10%),Frecuencia: 50/60 Hz, Consumo eléctrico Máx: 230 VA, Temperatura ambiente: 16 ºC - 34 ºC Humedad Relativa máx: 80%, Polo a tierra: Si,Potencia max: 550 W - Una sola computadora con pantalla táctil a color, teclado y mouse: Dimensiones: Altura 19.25 pulgadas (49.9 cm), Ancho: 34 pulgadas (86,4 cm),Profundidad: 30,25 pulgadas (76,8 cm) Peso 232 libras (105.2 kilogramos),Requisitos eléctricos: * VAC 100-240V, 50 / 60Hz, Consumo máximo de energía * 550 vatios* Solo analizador. - Capacidad de rendimiento max modo carga automático: 84/hora - Dimensiones (Al x An x Pr): Altura: 49,9 cm Anchura: 86,4 cm Profundidad: 76,8 cm - Peso: 105,2 kg (232 lb) - Reactivos Solo 4 reactivos incluidos reticulocitos - Gestión de datos Sistema operativo basado en Windows®. Anotaciones de resultados basadas en reglas. - Paquete de control de calidad completo en el sistema. - Gráficos de Levey-Jennings. - Promedios móviles. Reglas de Westgard. - 10 000 resultados almacenados con gráficos. - Guía en línea de calibración automática. -Volumen de muestra : Modo abierto 150 µL, cargador de muestras 230 µL

904	ACL TOP 350	WERFEN	350	17080687	COAGULACIÓN	5-feb	**c.Equipo de Coagulación**		Equipo diseñado para volumenes mediano. Para medir, monitorear y analizar APTT, PT, Fibrinógeno, Dímero D, Heparina, DOACs, Síndrome Antifosfolipidico , Enfermedad de Von Willebrand, Fibrinólisis, Trombofilia, Factores de coagulación, entre otros. El más compacto para pruebas de rutina o especiales •Perforador de tubos. •40 muestras a bordo y 26 reactivos a bordo refrigerados. •Pantalla sensible al tacto (touch screen). •Realiza pruebas coagulométricas, cromogénicas e inmunológicas de manera simultánea. •Lector de código de barras para muestras y reactivo. •Utiliza copa y tubo primario. •Velocidad: 110 pruebas/hora medidos a partir del TP. •Especial para laboratorios de media carga de trabajo •Integridad pre-analítica que verifica el correcto llenado de los tubos, y detecta tubos con muestra insuficiente, aspiración de muestra anormal, e interferencia por hemólisis, bilirrubina y lipemia. •Nuevas herramientas sobre los documentos de acreditación en los laboratorios para los estándares de calidad. •Reportes de auditoria avanzados y automatizados con opción de firma electrónica. •Reportes de mantenimiento, calibraciones y temperaturas del analizador. •Sistema log-off automático, segundo nivel de contraseña y signatura electrónica, expiración de contraseña automática. Voltaje nominal: 100 - 240 Vac Corriente: 10/5 A Frecuencia: 50/60 Hz Fusible: 100 - 115 V/10 A - 220 V/5 A MUESTRA: 40 10/(RACK DE MUESTRA) REACTIVOS EN MAQUINA: 26(REFRIGERADOS) ENSAYOS/MUESTRA 30 CUNETAS EN MAQUINA : 800 Reactivos con códigos de barras:SI (el código de barras incluye núm. lote, fecha cad. y tamaño del vial) (Ampl. x Prof. x Alt.) : 81 x 84 x 73 cm Peso (analizador) 91 Kg Base de datos de resultados 20.000 MUESTRAS Autovalidación de resultados SI RANGO DE TEMPERATURA 18 GRADOS 30GRADOS RANGO DE HUMEDAD RELATIVA 20 % A 90 % Teclado: si (externo) Ratón: si (externo) Impresora: si (externo)
118	ARCHITEC	ABBOTT	C4000	C401777	INMUNOQUIMICA	5-feb	**a..Analizador automatico de quimica sanguinea**	**QUIMICA SANGUINEA**	Métodos Fotometría, potenciometría, turbidimetría Rendimiento máximo Hasta 800 pruebas/hora Tubos de muestra: Altura: 72 a 102 mm , Diámetro: 9,6 a 16,1 mm Tipos de muestras Suero, plasma, sangre completa, orina, LCR Tipo de reactivos: >97 % de líquido listo para usar Almacenamiento de resultados de muestras 50 000 Hasta 90 posiciones refrigeradas e ISE patentados (Na+, K+ y Cl-) Medición de interferencias de la muestra: Si: hemólisis, ictericia y lipidemia Lector de codigo de barras: Carrusel de reactivos y gestor tridimensional de muestras. Volumen de dispensacion: (Muestras 2-200 uL), (Reactivos 5-90 uL), (Solucion preactivadora 100uL), (Solucion activadora 300 uL). Temperaturas: (Reactivos 2 ºC - 12 ºC), (Muestras 36.4 ºC - 37.6 ºC) Salida media de desechos liquidos: 5.5 L/hora Carrusel reactivos: 25 posiciones Volumen cubeta: 1000 uL Alimentador de cubetas: 1200 cuebtas Capacidad de procesamiento general: 200 determinaciones/hora Tiempo primer resultado: 29 min Dimensiones(AltoxAnchoxProfundidad): 121.9 cm x 154.9 cm x 124.5 cm Peso: 490.3 Kg Tension nominal: 200 -240 Vac +/-10 Vac Frecuencia: 50/60 Hz Tomacorriente: NEMA L6-20R Longitud cable alimentacion: 4.6 m Consumo energia: 3kVA Calor generado: 8539 BTU/Hora Nivel ruido: 85 dB maximo Temperatura ambiente: 15 ºC - 30 ºC
118	ARCHITEC	ABBOTT	C4000	C401777	INMUNOQUIMICA	5-feb	**b.Analizador automatico de quimica sanguinea**		Métodos Fotometría, potenciometría, turbidimetría Rendimiento máximo Hasta 800 pruebas/hora Tubos de muestra: Altura: 72 a 102 mm , Diámetro: 9,6 a 16,1 mm Tipo de reactivos: >97 % de líquido listo para usar Almacenamiento de resultados de muestras 50 000 Hasta 90 posiciones refrigeradas e ISE patentados (Na+, K+ y Cl-) Medición de interferencias de la muestra: Si: hemólisis, ictericia y lipidemia Lector de codigo de barras: Carrusel de reactivos y gestor tridimensional de muestras. Volumen de dispensacion: (Muestras 2-200 uL), (Reactivos 5-90 uL), (Solucion preactivadora 100uL), (Solucion activadora 300 uL). Temperaturas: (Reactivos 2 ºC - 12 ºC), (Muestras 36.4 ºC - 37.6 ºC) Salida media de desechos liquidos: 5.5 L/hora Carrusel reactivos: 25 posiciones Volumen cubeta: 1000 uL Alimentador de cubetas: 1200 cuebtas Capacidad de procesamiento general: 200 determinaciones/hora Tiempo primer resultado: 29 min Dimensiones(AltoxAnchoxProfundidad): 121.9 cm x 154.9 cm x 124.5 cm Peso: 490.3 Kg Tension nominal: 200 -240 Vac +/-10 Vac Frecuencia: 50/60 Hz Tomacorriente: NEMA L6-20R Longitud cable alimentacion: 4.6 m Consumo energia: 3kVA Calor generado: 8539 BTU/Hora Nivel ruido: 85 dB maximo Temperatura ambiente: 15 ºC - 30 ºC Humedad: (10 - 85) %

118	ARCHITEC	ABBOTT	C4000	C401777	INMUNOQUIMICA	5-feb	**C.Analizador de Electrolitros**		***Incluye modulo integrado ISE analizador de elecrolitros*** Métodos Fotometría, potenciometría, turbidimetría Rendimiento máximo Hasta 800 pruebas/hora Tubos de muestra: Altura: 72 a 102 mm , Diámetro: 9,6 a 16,1 mm Tipos de muestras Suero, plasma, sangre completa, orina, LCR Tipo de reactivos: >97 % de líquido listo para usar Almacenamiento de resultados de muestras 50 000 Hasta 90 posiciones refrigeradas e ISE patentados (Na+, K+ y Cl-) Medición de interferencias de la muestra: Si: hemólisis, ictericia y lipidemia Lector de codigo de barras: Carrusel de reactivos y gestor tridimensional de muestras. Volumen de dispensacion: (Muestras 2-200 uL), (Reactivos 5-90 uL), (Solucion preactivadora 100uL), (Solucion activadora 300 uL). Temperaturas: (Reactivos 2 ºC - 12 ºC), (Muestras 36.4 ºC - 37.6 ºC) Salida media de desechos liquidos: 5.5 L/hora Carrusel reactivos: 25 posiciones Volumen cubeta: 1000 uL Alimentador de cubetas: 1200 cuebtas Capacidad de procesamiento general: 200 determinaciones/hora Tiempo primer resultado: 29 min Dimensiones(AltoxAnchoxProfundidad): 121.9 cm x 154.9 cm x 124.5 cm Peso: 490.3 Kg Tension nominal: 200 -240 Vac +/-10 Vac Frecuencia: 50/60 Hz Tomacorriente: NEMA L6-20R Longitud cable alimentacion: 4.6 m Consumo energia: 3kVA Calor generado: 8539 BTU/Hora Nivel ruido: 85 dB maximo
118	ARCHITEC	ABBOTT	i1000	i1SR56113	INMUNOQUIMICA	5-feb	**a.Analizador de Inmunoensayo**	**INMUNOLOGÍA**	ARCHITECT i1000sr esta diseñado para soluciones Preactivadora y Activadora La solución preactivadora prepara el complejo de microparticulas para la reacción de quimioluminiscencia. La solución activadora genera la reacción de quimioluminiscencia cuando se la añade mezclada en el agitador tipo vórtex de la vía de procesamiento BENEFICIOS: Prioriza las muestras STAT sin comprometer las muestras de rutina,Certeza y confianza en los resultados clínicos,Acceso a carga de reactivos y muestras durante el procesamiento. METODOLOGÍA: Quimioluminiscencia. TIPO DE MUESTRA: Suero, plasma, orina y otros líquidos biológicos. Tension nominal: 110-120 Vac / 200-240 Vac +/-10% Frecuencia: 50/60 Hz Potencia max: 1760 Nivel ruido: 85 dB maximo Temperatura ambiente: 15 ºC - 30 ºC Humedad: (10 - 85) % Carga: Continua Hasta 100 pruebas / hora Capacidad muestras: 65 Tipo de muestra Suero, Plasma, Sangre total, orina Dimensiones del tubo Altura: 72-102 mm Diámetro: 9,6–16,1 mm Taza de muestra (volumen muerto) si 50ul Volumen de la muestra 10-160ul Transferencia de sonda de muestra ≤0.1 parts per million Capacidad de ensayos a bordo 25 Tipo de reactivo 100% liquido listo para usar Estabilidad a bordo del reactivo 14 a 30 dias Frecuencia de calibración: Calibre con un nuevo número de lote, si los controles están fuera de rango o si se especifica lo contrario dentro del paquete insertar Dimensiones: 49" x 59" x 30" 124.5 x 149.9 x 76.2 cm
113	PHOENIX 100	BECTON DICKINSON	100	PX2471	MICROBIOLOGIA	5-feb	**b.Equipo de Microbiología**		El analizador BD Phoenix 100 entrega resultados rápidos, precisos y confiables en identificación y susceptibilidad. BD Phoenix 100 es un sistema automatizado de microbiología con unidad de AP Equipo y maquinaria industrial, cuidado de salud y laboratorio. Los resultados de Identificación están disponibles desde las primeras 3 horas y la mayoría de pruebas de susceptibilidad entre 6 a 10 horas. Capacidad hasta de 100 paneles a bordo. Características: Capacidad de 99 paneles. Paneles de identificación, sensibilidad y combo ID/AST. PANEL PMIC/ID -108 único en el mercado que identifica cocos y bacilos gram positivos. Identificación en 4 horas. Sensibilidad MIC en 8 horas promedio. Minima Concentración Inhibitoria. Sistema BDExpert con reglas CLSI. Actualización de puntos de corte. Bioseguro: Fácil inoculación de los paneles sin necesidad de equipos adicionales. Conexión a LIS y Epicenter. Ofrece MIC (Concentración Mínima Inhibitoria) real con diluciones dobles, interpretadas por el Sistema BDXpert. Único Sistema con la Prueba Confirmatoria de BLEE (Beta Lactamasa de Expectro Extendido) incluida en cada panel de Gram Negativos, ahorrando tiempo y dinero en hacer otras pruebas complementarias. En un solo tipo de Panel para Gram Positivos se incluyen todos los géneros de: Streptococos, Staphylococos, Enterococos y Bacillus.MIC REAL, Detección de confianza La tecnología Advanced Minimum Inhibitory Concentration (Concentración Inhibitoria Mínima Avanzada o MIC) detecta el surgimiento de resistencia mientras se produce y, gracias a ello, proporciona resultados exactos sin recurrir a datos anteriores o a MIC virtual. 6. ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO Dimensiones ANCHO: 115,0 cm. PROFUNDIDAD: 75,0 cm. ALTO 106,0 cm. ALTO (CON ESPACIO PARA MTTO.): 150,0 cm. PESO 152 Kg. Vacío / 160 Kg Lleno
110	INCUBADORA	C4	INDUCELL	141536	MICROBIOLOGIA	5-feb	**c.Incubadora**		Voltaje nominal: 110 Vac Fases: 1 Programas: 3 programas configurables Conexion: Interfaz RS-232 Alarmas: Acustica/Visual Intervalos: 99 horas/59 minutos Termostato: Digital Control manual de valvula de aire Configuracion revoluciones: Digital Volumen interior: 22,55,111,222,404,707 Litros Rango temperatura: 5 ºC - 99.9 ºC Puerta de cristal: acero inoxidable DIN 1.4301 (AISI 304)

118	ARCHITEC	ABBOTT	i1000	i1SR56113	INMUNOQUIMICA	5-feb	**a.Analizador de Inmunoensayo**	**ÁREA PRUEBAS ESPECIALIZADAS**	ARCHITECT i1000sr esta diseñado para soluciones Preactivadora y Activadora La solución preactivadora prepara el complejo de microparticulas para la reacción de quimioluminiscencia. La solución activadora genera la reacción de quimioluminiscencia cuando se la añade mezclada en el agitador tipo vórtex de la vía de procesamiento BENEFICIOS: Prioriza las muestras STAT sin comprometer las muestras de rutina,Certeza y confianza en los resultados clínicos,Acceso a carga de reactivos y muestras durante el procesamiento. METODOLOGÍA: Quimioluminiscencia. TIPO DE MUESTRA: Suero, plasma, orina y otros líquidos biológicos. Tension nominal: 110-120 Vac / 200-240 Vac +/-10% Frecuencia: 50/60 Hz Potencia max: 1760 Nivel ruido: 85 dB maximo Temperatura ambiente: 15 ºC - 30 ºC Humedad: (10 - 85) % Carga: Continua Hasta 100 pruebas / hora Capacidad muestras: 65 Tipo de muestra Suero, Plasma, Sangre total, orina Dimensiones del tubo Altura: 72-102 mm Diámetro: 9,6–16,1 mm Taza de muestra (volumen muerto) si 50ul Volumen de la muestra 10-160ul Transferencia de sonda de muestra ≤0.1 parts per million Capacidad de ensayos a bordo 25 Tipo de reactivo 100% líquido listo para usar Estabilidad a bordo del reactivo 14 a 30 dias Frecuencia de calibración: Calibre con un nuevo número de lote, si los controles están fuera de rango o si se especifica lo contrario dentro del paquete insertar Dimensiones: 49" x 59" x 30" 124.5 x 149.9 x 76.2 cm Peso 636 lbs 288 Kg
1054	NEVERA	INDURAMA	VFV-520	E00153124800126019 9	CUARTO DE NEVERAS	5-feb	**A.NEVERA**		Modelo: VFV-520 Color: Blanco Material: Acero Inoxidable Puerta tipo mostrador: Cristal Transparente Volumen nominal bruto total: 380 Litros Volumen nominal almacenamiento total: 344 Litros Voltaje:115 V Frecuencia: 60 Hz Dimensiones: Ancho (74 am) x Alto (195 cm) x Profundidad (62 cm)
927	BAÑO SEROLOGICO	LW SCIENTIFIC	DSB-1000	14100078	MICROSCOPIA	5-feb	**b. BAÑO DE MARIA**		Especificaciones Técnicas: Ajuste de temperatura: Análogo. Lectura de temperatura: Mediante termómetro de alcohol. Control de temperatura: On / Off. Sensor de temperatura: Análogo IC. Rango de temperatura: 0°C – 100°C. Temperatura de trabajo: Temperatura ambiente + 5°C – 100°C. Estabilidad: 0.5°C. Capacidad del tanque: 20 Litros. Dimensiones internas del tanque: W490 x D 290 x H 150mm. Dimensiones externas: W540 x D340 x H190mm. Peso Neto: 10Kgs. Peso de envío: 11Kgs. Suministro eléctrico: 220V 50/60Hz. Accesorio incluido: 01 tapa en acero inoxidable
1373	TERMOHIGROMETRO DIGITAL	HALTHEN	TTH-002	22555	PROCESAMIENTO	5-feb	**c.TERMOHIGROMETRO**	**EQUIPOS ADICIONALES**	RANGO DE MEDICION: Temperatura indoor de 0 a 50 °C (32 a 122 °F). Temperatura outdoor de -50 a70°C (-58a 158 °F). Humedad relativa de 15 a 95 % HR EXACTITUD: Temperatura in/out: +/-1°C (+/-2°F) en el rango de temperatura de 15 a 35 °C (59 a 95 °F). +/-2 °C (+/-4°F) en el resto del rango de temperatura. HUMEDAD RELATIVA: +/-5% en el rango de humedad de 40 a 80 %HR. +/-8% en el resto del rango. RESOLUCION: Temperatura: 0,1 °C (0,1°F) Humedad: 1 %HR DIMENCIONES: Pantalla: 80x60 mm Tamaño del equipo: 108x100x21 mm
139	TERMOMETRO	DIGITAL THERMOMETER	N.R	10011111	NEVERA #1	5-feb	**d. TERMOMETRO**		Dispositivo diseñado para monitorear temperaturas de un recinto determinado ENTRADA-Temperatura: 0°C - 50°C SALIDA-Temperatura: -30°C - +70°C VOLTAJE:1.5 PRECISION: 0.1°C
137	TERMOMETRO	FRIDGE/FREEZER	N.R.	MC-036413	BAÑO SEROLOGICO	5-feb			Especificaciones -Rango: -50°C+70°C / -58°F+158°F Sonda cable (1 m) -Precisión: ±1°C -Resolución: 0.1 °C -Alarma programable. -Funciones MAX/MIN -Con imán -Alimentación: 1 batería (1.5VDC) AAA (incluida)
							e. SOFTWARE		***24- 7 analisis de control de calidad interno Winsislab (Sistemas)***
N.A	XN 350	SYSMEX	350	N/R	N/R		**a.Analizador de Hematología**		Especificaciones: **Principios y tecnologías:** Citometría de flujo fluorescente: WBC, DIFF, RET, IRF, diferencial de 2 partes para el análisis de fluidos corporales; Método de impedancia con enfoque hidrodinámico: PLT-I, RBC, HCT; Método SLS-hemoglobina libre de cianuro: HGB. **Parámetros Analizados**: Parámetros reportables en sangre entera y modo prediluido. WBC, RBC, HGB, HCT, VCM, HCM, CHCM, PLT-I, RDW-SD, RDW-CV, MPV, NEUT #, LINFO #, MONO #, EO #, BASO #, NEUT%, LINFO%, MONO%, EO%, BASO%, IG #, IG%. Parámetros de investigación en sangre entera y modo prediluido. PDW, P-LCR, PCT Parámetros reportables en el modo de fluidos corporales (opcional) WBC-BF, RBC-BF, MN#, PMN#, MN%, PMN%, TC-BF#. Parámetros reportables en el canal de reticulocitos (opcional): RET#, RET%, IRF, RET-He Parámetros de investigación del canal de reticulocitos (opcional): LFR, MFR, HFR, PLT-O **Rendimiento:** Sangre entera: CBC: hasta 60 muestras por hora; Hasta 70 muestras por hora con licencia Speed-up opcional. CBC + DIFF: hasta 60 muestras por hora; Hasta 70 muestras por hora con licencia Speed-up opcional. CBC + DIFF + RET: hasta 35 muestras por hora. Fluidos corporales: hasta 30 muestras por hora. **Modo de Aspiración:** XN-350: análisis de tubo abierto **Volumen de aspiración de muestras:** Sangre entera / modo Low WBC: 25 µl; Modo pre diluido: 70 µl; Modo de fluidos corporales: 70 µl. **Almacenamiento de datos:** Resultados: 100.000 muestras; Información de pacientes: 10.000 registros; Archivos de control de calidad: 99 archivos por analizador; Gráficas de control de calidad: 300 datos por archivo; Histórico de reemplazo de reactivos: 5.000 registros; Histórico de mantenimiento: 5.000 registros. **Control de Calidad:** Tres niveles de material de control de calidad para todos los parámetros; Dos niveles de material de control de calidad para fluidos corporales

N.A	COBAS C111	ROCHE	C111	N/R	N/R		**b.Analizador automatico de quimica sanguinea**	**Velocidad:** Tests fotométricos: 60-85/hora ISE: 180 tests/hora Menú mixto: 60-100 tests/hora **Tipos de Muestra:** Suero, plasma, orina. Sangre entera para determinación de HbA1c **Acceso de muestras:** Continuo. 8 posiciones de muestra, con prioridad real para determinaciones de urgencia **Tiempo de Medición:** 5 -10 minutos para tests fotométricos 2 minutos para mediciones ISE **Contenedores de muestra:** Tubos primarios 5-10mL: 16x100, 16x75, 13x100, 13x75 Copas de muestras 2,5 ml Micro copas 1,5 ml **Volumen mínimo de muestras:** Tubo primario 500 microlitros Copas 75 microlitros Microcopas 50 micro litros **Código de barras compatible:** Code 128, Codabar 2 - 7, Interleaved 2-5, Code 3-9 **Dilución de muestras:** Automática. Opciones 1:2, 1:5 y 1:10 **Unidad de fotómetro:** 12 longitudes de onda. Lámpara Halógena de 20W, mediciones Monocromáticas y policromáticas **Principios de Medición**: Espectrofotometría de absorbancia (para enzimas, sustratos y proteínas) mediciones indirectas con dilución 1:5. ISE: indirecto con dilución 1:6 **Reactivos:** ISE: Na+,K+,Cl – Botellas con códigos de barras bidimensionales, para 50-200 tests 27 botellas a bordo, aproximadamente 14 ensayos. Hasta 8 discos intercambiables **Cubetas de Reacción:** Micro-cubetas descartables **Pantalla:** Color, sensible al tacto, LCD (1/4 VGA) **Interfases:** 2 puertos seriales R232. Protocolo ASTM 2 puertos USB **Requerimiento Eléctrico:** 100-105 V y 200-240 V AC (-15%, +10%) 50 Hz (+/- 5%) y 60 Hz (+/-5%) Consumo 250 V (320 V con ISE) Categoría de instalación II (IEC 61010-1) **Dimensiones con ISE:** Ancho: 590 mm (720 mm) Profundidad: 550 mm (550 mm) Altura: 480 mm (480 mm) Peso: 32,3 kg (35 kg) **Impresora:** Integrada. Software disponible pata transmisión de datos a PC, y posterior impresión con impresora externa **Requerimientos de Agua:** Hasta 2 litros/día. NCCLS tipo II (conductividad menor **Regulaciones:** GS, CE, UL, C-UL **Apertura de Canales:** 1, 3 o 5 canales posibles. Solo disponibles para aplicaciones faltantes
57	HORNO	HACEB	309	K133155506	Procesamiento	5-feb	**a.HORNO**	
133	NEVERA	INDURAMA	VF-5019	E00042391800016110 5	AREA DE PROCESAMIENTO	5-feb	**b.NEVERA**	ESPECIFICACIONES Profundo: 68CM Alto: 1.69CM Referencia: VF 5019 Ancho: 73CM CARACTERISTICAS » 412 lts » Sistema multiflow garantiza uniformidad en la temperatura diferentes alturas refrigerador » 5 parrillas metalicas regulables reforzadas y preciador » Control de temperatura » Ahorro de energia » Interior blanco en lamina galvanizada » Disponible en blanco » Desempañador » Controles independientes para la luz y el desempañador
1032	PIPETA AUTOMATICA 50ul	HAMILTON	SOFTGRIP	91740	MICROBIOLOGIA	5-feb	**c. PIPETAS AUTOMATICAS**	Totalmente esterilizable en autoclave a 121 ° C. Diseño ergonomico. Eyector de punta, para una expulsión suave de la punta. El ajuste preciso del volumen seleccionado garantiza una aspiración y dispensación precisas del líquido. La empuñadura hecha de TPE (elastómero termoplástico) evita la transferencia de calor a los componentes internos, o que garantiza un funcionamiento preciso de la pipeta incluso en uso continuo. Buena resistencia química y a la luz ultravioleta.
1173	PIPETA 20 - 200ul	BOECO	BOECO	PG217190	PROCESAMIENTO	5-feb		-Totalmente autoclavable a 121°C (2 bar) - Diseño ergonómico - Diseño innovador de resorte y sello para uno de los requisitos de fuerza de inmersión más bajos - Pistón asistido por imán para resultados precisos -Experiencia sin fatiga potenciada por un ergonómico enfoque de diseño, exclusivo eyector de puntas con amortiguación y conveniente descanso para los dedos. - Fácil calibración interna & limpieza sin herramientas -Construido con material de alta durabilidad para mejor durabilidad y prevención contra la corrosión química y física. -Bloqueo de volumen para evitar ajustes de volumen no deseados
1172	PIPETA 10-100ul	BOECO	BOECO	PC153432	PROCESAMIENTO	5-feb		-Totalmente autoclavable a 121°C (2 bar) - Diseño ergonómico - Diseño innovador de resorte y sello para uno de los requisitos de fuerza de inmersión más bajos - Pistón asistido por imán para resultados precisos -Experiencia sin fatiga potenciada por un ergonómico enfoque de diseño, exclusivo eyector de puntas con amortiguación y conveniente descanso para los dedos. - Fácil calibración interna & limpieza sin herramientas -Construido con material de alta durabilidad para mejor durabilidad y prevención contra la corrosión química y física. -Bloqueo de volumen para evitar ajustes de volumen no deseados
N/R	CENTRIFUGA DIGITAL	SCIENTIFIC	TD4	N/R	N/R	5-feb	**d. CENTRIFUGA**	CONTROL DE VELOCIDAD DIGITAL HASTA 4000 RPM Rcf max.: 2500 x g Rotor angular para 24 tubos 10 ml Portatubos plásticos Control de tiempo digital de 0 a 99 minutos Controlada por microcomputador Motor libre de mantenimiento Puerta mecánica con switch de seguridad Sistema avanzado de ventilación Fácil manejo y programación Voltaje 110 v – 50/60 hz Dimensiones (mm): 510x420x370 mm - peso: 15 kilos Control de ruido igual o menos a 65 db Consumo 200w
143	TERMOHIGROMETRO	TEMPERATURE	HTC-2	SEN-755	ALMACEN	5-feb	**e. TERMOHIGROMETRO**	- Menor consumo de energía - Interior / Temperatura al aire libre, la humedad interior y la exhibición del reloj de manera simultánea -2 modos de visualización de temperatura: ° C / ° F - 2 modos de visualización de tiempo: 12 / 24H - Función Max / Min en temperatura y memoria de humedad - Función de hora -Función de Alarma diaria -La función de visualización de calendario (mes y fecha) Rango de Temperatura: -50 ° C ~ + 70 ° C (-58 ° F ~ + 158 ° F) Precisión de Temperatura:± ° C (1.8 ° F) Resolución de Temperatura:0.1 ° C (0.2 ° F) Rango de Humedad:10% ~ 99% RH Precisión de Humedad: ± 5% de humedad relativa Resolución de Humedad: 1% RH Fuente de Alimentación: 1 ° AAA (1.5V) batería (incluido) Dimensiones: 105x97x23mm, (4 3/16 "H x 3 7/8" W x 8.7 "de espesor) Peso: 150 g

SEDE SAN CARLOS

134	TERMOMETRO	DIGITAL THERMOMETER	N.R.	10011043	NEVERA STOCK	5-feb	**f. TERMOMETRO**		Dispositivo diseñado para monitorear temperaturas de un recinto determinado ENTRADA-Temperatura: 0°C - 50°C SALIDA-Temperatura: -30°C - +70°C VOLTAJE:1.5 PRECISION: 0.1°C
							g. SOFTWARE		***24- 7 analisis de control de calidad interno Winsislab (Sistemas)***
939	NEVERA	CHALLENGER	CR152 TITANIUM	17013-01469	AREA DE NEVERAS	5-feb	**a. NEVERAS**	**EQUIPOS ADICIONALES**	Dimensiones: 48,5x60x85, 1 (Ancho x Alto x Profundidad) Peso real (Kg): 24.2 Volumen de almacenamiento (L): 121 Clasificación Energética: B Consumo de Energía (Kwh/dia): 0.590 Puertas: 1 Accesorios: 2 bandejas en vidrio templado, 2 anaqueles translucidos y removibles, 2 niveladores frontales, 1 Bandeja de vegetales, Empaque magnético removible para facilitar su limpieza. Tensión Eléctrica (V): 120
927	BAÑO SEROLOGICO	LW SCIENTIFIC	DSB-1000	14100078	MICROSCOPIA	5-feb	**b. BAÑO DE MARIA**		Ajuste de temperatura: Análogo. Lectura de temperatura: Mediante termómetro de alcohol. Control de temperatura: On / Off. Sensor de temperatura: Análogo IC. Rango de temperatura: 0°C – 100°C. Temperatura de trabajo: Temperatura ambiente + 5°C – 100°C. Estabilidad: 0.5°C. Capacidad del tanque: 20 Litros. Dimensiones internas del tanque: W490 x D 290 x H 150mm. Dimensiones externas: W540 x D340 x H190mm. Peso Neto: 10Kgs. Peso de envío: 11Kgs. Suministro eléctrico: 220V 50/60Hz. Accesorio incluido: 01 tapa en acero inoxidable.
141	TERMOHIGROMETRO	HYGRO-THERMOMETER	TEMCA300	10012126	MICROBIOLOGIA	5-feb	**c. TERMOHIGROMETROS**		• Display Grandes Digitos -Monitoreo Temperatura Exterior e Interior -Registro Temp y Humedad Máximas y Mínimas -Rango de Temp. Interna Interno: -10°C a 50°C - Rango de Temp. Externa Externo: -50°C a 70°C -Rango de Humedad 20-99%RH - Resolución 1 RH y 0,1°C -Sonda 3 Metros -Tamaño 98mm x 110mm x 21mm
135	TERMOMETRO	DIGITAL TERMOMETER	TEM50	10012989	MALETIN DE TRASNPORTE	5-feb	**d. TERMOMETROS**		Dispositivo diseñado para monitorear temperaturas de un recinto determinado ENTRADA-Temperatura: 0°C - 50°C SALIDA-Temperatura: -30°C - +70°C VOLTAJE:1.5 PRECISION: 0.1°C
							e. SOFTWARE		***24- 7 analisis de control de calidad interno Winsislab (Sistemas)***
57	HORNO	HACEB	309	K133155506	Procesamiento	5-feb	**a. HORNO**		
939	NEVERA	CHALLENGER	CR152 TITANIUM	17013-01469	AREA DE NEVERAS	5-feb	**b. NEVERAS**		Dimensiones: 48,5x60x85, 1 (Ancho x Alto x Profundidad) Peso real (Kg): 24.2 Volumen de almacenamiento (L): 121 Clasificación Energética: B Consumo de Energía (Kwh/dia): 0.590 Puertas: 1 Accesorios: 2 bandejas en vidrio templado, 2 anaqueles translucidos y removibles, 2 niveladores frontales, 1 Bandeja de vegetales, Empaque magnético removible para facilitar su limpieza. Tensión Eléctrica (V): 120
1171	PIPETA 100-1000ul	BOECO	BOECO	PG216867	PROCESAMIENTO	5-feb	**c. PIPETAS AUTOMATICAS**		- Completamente autoclavable, en adición a 121°C (2 bars), según DIN EN 285. - Diseño ergonómico. - Ajuste sencillo de volumen para diestros y zurdos. - Función de calibración integrada para un ajuste fácil sin herramientas. - Buena resistencia química y a la luz UV. - Cuentan con certificación de conformidad según DIN 12600 y son CE/IVD conformes. Especificaciones técnicas: - Pipeta automática de volumen variable capacidad 100-1000ul - Punta desechable azul - Completamente autoclavable - 1 ch - División 5 µl - Volumen de prueba 1000 µl 500 µl 100 µl - Inexactitud ±0,60% ±1,00% ±2,00% - Imprecisión ±0,20% ±0,40% ±0,70% - Puntas G,H,I
1174	PIPETA 5-50ul	BOECO	BOECO	PC153772	PROCESAMIENTO	5-feb			Características: - Micropipeta de volumen variable - Autoclavable - Volumen variable - Serie SA - Volumen 5 - 50 µl Especificaciones: - Canales 8 - Incremento 10,5 µl - Volumen de prueba 50 µl, 25 µl, 5 µl - Inexactitud ± 1,00%, ± 1,50%, ± 3,00% - Imprecisión ± 0,70%, ± 1,00%, ± 2,00% - Para usar con puntas desechables amarillas

1031	PIPETA AUTOMATICA 25ul	BOECO	SA SERIES	MH924608	MICROBIOLOGIA	5-feb		**SEDE SAN CARLOS EQUIPOS ADICIONALES**	-Pipeta automatica de volumen fijo - Capacidad 25 ul - Punta desechable amarilla - Totalmente esterilizable en autoclave a 121 ° C - Diseño ergonomico - El ajuste preciso del volumen seleccionado garantiza una aspiración y dispensación precisas del líquido - La empuñadura hecha de TPE (elastómero termoplástico) evita a transferencia de calor a los componentes internos, lo que garantiza un funcionamiento preciso de la pipeta incluso en uso continuo - Buena resistencia química y a la luz ultravioleta - Inexactitud ± 0,50% - Imprecisión ± 0,30% - Tipo de punta D, E, F
N/R	CENTRIFUGA ANALOGA	SCIENTIFIC	N/R	N/R	N/R	5-feb	**d. CENTRIFUGA**		ESPECIFICACIONES Capacidad: 12 tuos hasta 15 mL Velocidad variable hasta 4000 rpm con tacómetro análogo Visualiza la velocidad exacta del equipo). Control de tiempo hasta 30 minutos. Control de estabilidad. Alta precisión en procesos dermatológicos y rutina de laboratorio. Excelente capacidad en un reducido espacio. Registro Sanitario Invima. Fuerte caja de plástico con tapa metalica Con interruptor de seguridad Volumen de suministro incluye el rotor Alta velocidad para que el tiempo de centrifugación sea corto Pequeño marco Tiene ajuste de velocidad
N/R	TERMOHIGROMETRO	HALTHEN	TTH-002	29279	STOCK/POPAYÁN	5-feb	**e. TERMOHIGROMETRO**		RANGO DE MEDICION: Temperatura indoor de 0 a 50 °C (32 a 122 °F). Temperatura outdoor de -50 a70°C (-58a 158 °F). Humedad relativa de 15 a 95 % HR EXACTITUD: Temperatura in/out: +/-1°C (+/-2°F) en el rango de temperatura de 15 a 35 °C (59 a 95 °F). +/-2 °C (+/-4°F) en el resto del rango de temperatura. HUMEDAD RELATIVA: +/-5% en el rango de humedad de 40 a 80 %HR. +/-8% en el resto del rango. RESOLUCION: Temperatura: 0,1 °C (0,1°F) Humedad: 1 %HR DIMENCIONES: Pantalla: 80x60 mm Tamaño del equipo: 108x100x21 mm
136	TERMOMETRO	DIGITAL TERMOMETER	TEM50	10011311	CONGELADOR	5-feb	**f. TERMOMETRO**		Dispositivo diseñado para monitorear temperaturas de un recinto determinado ENTRADA-Temperatura: 0°C - 50°C SALIDA-Temperatura: -30°C - +70°C VOLTAJE:1.5 PRECISION: 0.1°C
							g. SOFTWARE		***24- 7 analisis de control de calidad interno Winsislab (Sistemas)***

CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

A continuación se relaciona el cronograma con la fecha programada para la preinstalación, instalación y puesta en marcha de los siguientes equipo biomédicos:

Nombre del equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Preinstalación	Fecha de Instalación	Fecha Puesta en marcha
CELLDYN RUBY	ABBOTT	RUBY	54995BG	2/02/2023	5/02/2023	6/02/2023
ACL TOP 350	WERFEN	350	17080687	2/02/2023	5/02/2023	6/02/2023
ARCHITEC	ABBOTT	C4000	C401777	2/02/2023	5/02/2023	6/02/2023
ARCHITEC	ABBOTT	i1000	i1SR56113	2/02/2023	5/02/2023	6/02/2023
PHOENIX 100	BECTON DICKINSON	100	PX2471	2/02/2023	5/02/2023	6/02/2023
INCUBADORA	C4	INDUCELL	141536	2/02/2023	5/02/2023	6/02/2023
NEVERA	INDURAMA	VFV-520	E001531248001260199	2/02/2023	5/02/2023	6/02/2023
NEVERA	CHALLENGER	CR152 TITANIUM	17013-01469	2/02/2023	5/02/2023	6/02/2023
NEVERA	INDURAMA	VF-5019	E000423918000161105	2/02/2023	5/02/2023	6/02/2023
BAÑO SEROLOGICO	LW SCIENTIFIC	DSB-1000	14100078	2/02/2023	5/02/2023	6/02/2023
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	HALTHEN	TTH-002	22555	2/02/2023	5/02/2023	6/02/2023
TERMOMETRO	DIGITAL TERMOMETER	TEM50	10012989	2/02/2023	5/02/2023	6/02/2023
TERMOMETRO	DIGITAL THERMOMETER	N.R.	10011043	2/02/2023	5/02/2023	6/02/2023
TERMOMETRO	DIGITAL TERMOMETER	TEM50	10011311	2/02/2023	5/02/2023	6/02/2023
TERMOMETRO	FRIDGE/FREEZER	N.R.	MC-036413	2/02/2023	5/02/2023	6/02/2023
TERMOMETRO	DIGITAL THERMOMETER	N.R	10011111	2/02/2023	5/02/2023	6/02/2023
CENTRIFUGA HORIZON	DRUCKER	755VES	181160AC857	2/02/2023	5/02/2023	6/02/2023
TERMOHIGROMETRO	TEMPERATURE	HTC-2	SEN-755	2/02/2023	5/02/2023	6/02/2023

Nombre del equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Preinstalación	Fecha de Instalación	Fecha de Puesta en Marcha
TERMOHIGROMETRO	HYGRO-THERMOMETER	TEMCA300	10012126	2/02/2023	5/02/2023	6/02/2023
PIPETA AUTOMATICA 50ul	HAMILTON	SOFTGRIP	91740	2/02/2023	5/02/2023	6/02/2023
PIPETA AUTOMATICA 25ul	BOECO	SA SERIES	MH924608	2/02/2023	5/02/2023	6/02/2023
PIPETA 100-1000ul	BOECO	BOECO	PG216867	2/02/2023	5/02/2023	6/02/2023
PIPETA 5-50ul	BOECO	BOECO	PC153772	2/02/2023	5/02/2023	6/02/2023
PIPETA 20 - 200ul	BOECO	BOECO	PG217190	2/02/2023	5/02/2023	6/02/2023
PIPETA 10-100ul	BOECO	BOECO	PC153432	2/02/2023	5/02/2023	6/02/2023
XN 350	SYSMEX	350	N/R	2/02/2023	5/02/2023	6/02/2023
COBAS C111	ROCHE	C111	N/R	2/02/2023	5/02/2023	6/02/2023
HORNO	HACEB	309	K133155506	2/02/2023	5/02/2023	6/02/2023
CENTRIFUGA DIGITAL	SCIENTIFIC	TD4	N/R	2/02/2023	5/02/2023	6/02/2023
CENTRIFUGA ANALOGA	SCIENTIFIC	N/R	N/R	2/02/2023	5/02/2023	6/02/2023
TERMOHIGROMETRO	HALTHEN	TTH-002	29279	2/02/2023	5/02/2023	6/02/2023

Cordialmente,



DIANA OLIVETH LÓPEZ DAZA
Ing. Biomédica
RH-201907-390

ANA VICTORIA GALVAN ZAPA

C.C:1.067.942.619 DE MONTERIA
CELULAR: 3022476151
E-MAIL: toyitagalvan@gmail.com

REGIONAL CÓRDOBA
CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA

ACTA DE GRADO

No Y FECHA REGISTRO 14279637 - 24/03/2015

EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CONSIDERANDO

Que: ANA VICTORIA GALVAN ZAPA, Con Cedula de Ciudadania No. 1.067.942.619

CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS POR EL SENA, RESUELVE OTORGARLE EL TÍTULO DE:

TÉCNICO EN ENFERMERÍA

En constancia de lo anterior se firma la presente en Montería, a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de dos mil quince (2015)

Firmado Digitalmente por
AURA JOSEFINA MIRANDA MENDOZA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

AURA JOSEFINA MIRANDA MENDOZA
SUBDIRECTORA(E) CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA
REGIONAL CÓRDOBA

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 952300533633CC1067942619A.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 194278730

WEB
14:57:51

Bogotá DC, 12 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ANA VICTORIA GALVAN ZAPA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1067942619:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 12 de abril de 2022, a las 15:06:11, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	1067942619
Código de Verificación	1067942619220412150611

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 02:41:14 PM horas del 12/04/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **1067942619**

Apellidos y Nombres: GALVAN ZAPA ANA VICTORIA

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45 Zona Industrial, barrio Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112

ANA VICTORIA GALVAN ZAPA

C.C:1.067.942.619 DE MONTERIA
CELULAR: 3022476151
E-MAIL: toyitagalvan@gmail.com



Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 26/01/2023 12:27:34 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1067942619 .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **51490021** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

ANA VICTORIA GALVAN ZAPA

C.C:1.067.942.619 DE MONTERIA
CELULAR: 3022476151
E-MAIL: toyitagalvan@gmail.com

FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA
NIT. 901366232-1

Aprobado por Decreto No.1075 del 26/05/2015. Educación no formal Art. 2.6.6.8.

Certifica

Ana Victoria Galván Zapa

c.c. 1067942619 de Montería - Córdoba

Realizó y aprobó el Curso Protocolos en la Toma y Transporte de Muestras de Laboratorio con un total de 60 Horas.

Fecha de emisión: 2022-03-30
Fecha de vencimiento: 2024-03-30

FUNDACION NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA
confirma la autenticidad de su certificado en la página
www.fundacionnuestrasenoradelaesperanza.org

ING. SOLANLLY COVALEDA
Representante Legal.

DEIBIS STEVENS BRAVO OBANDO
Jefe de Enfermería
TP 3208
Docente.

ROSA GUZMAN
ESP. Orientación Educativa y Desarrollo Humano
Docente Especialista

FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA

NIT. 901366232-1

Aprobado por Decreto No.1075 del 26/05/2015. Educación no formal Art. 2.6.6.8.

Certifica

Ana Victoria Galván Zapa

c.c. 1067942619 de Montería - Córdoba

Realizó y aprobó el Curso de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual - Código Fucsia - Resolución 3100 / 2019
con un total de 80 Horas.

Fecha de emisión: 2022-06-23
Fecha de vencimiento: 2024-06-23

FUNDACION NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA
verifique la autenticidad de su certificado en la pagina
www.fundacionnuestrasenoradelaesperanza.org

ING. SOLANLLY COVALEDA
Representante Legal.

DEIBIE STEVENS BRAVO OBANDO
Jefe de Enfermería
TP 3206
Docente.

ROSA GUZMAN
ESP. Orientación Educativa y Desarrollo Humano
Docente Especialista

Escaneado con CamScanner

ANA VICTORIA GALVAN ZAPA
C.C:1.067.942.619 DE MONTERIA
CELULAR: 3022476151
E-MAIL: toyitagalvan@gmail.com

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994 y en atención a que

ANA VICTORIA GALVAN ZAPA

Con Cedula de Ciudadania No. 1.067.942.619

Cursó y aprobó el programa de Formación Profesional Integral
y cumplió con las condiciones requeridas por la entidad, le confiere el

Título de

TÉCNICO EN

ENFERMERÍA

En testimonio de lo anterior, se firma el presente Titulo en Montería,
a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de dos mil quince (2015)

Firmado Digitalmente por
AURA JOSEFINA MIRANDA MENDOZA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

AURA JOSEFINA MIRANDA MENDOZA
SUBDIRECTORA(E) CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA
REGIONAL CÓRDOBA

14279637 - 24/03/2015
No y FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 952300533633CC1067942619C.

ANA VICTORIA GALVAN ZAPA

C.C:1.067.942.619 DE MONTERIA
CELULAR: 3022476151
E-MAIL: toyitagalvan@gmail.com



➢ PERFIL

Yo ANA VICTORIA GALVAN ZAPA soy una persona responsable, respetuosa, puntual, cumplida con mis obligaciones, capaz de desempeñarme laboralmente individual o en grupos de trabajo. Dispuesta a aprender y dejarme guiar por personas profesionales…

I. DATOS PERSONALES

NOMBRE:	ANA VICTORIA GALVAN ZAPA
DOC. DE IDENTIDAD:	C.C 1067942619
FECHA / NACIMIENTO:	16 DE AGOSTO DE 1995
LUGAR /NACIMIENTO:	CARACAS - VENEZUELA
ESTADO CIVIL:	SOLTERA
CIUDAD:	Montería
DIRECCION:	Digo 20 tranv2 # 2-97
BARRIO:	La granja
TELEFONO:	3022476151
E-MAIL:	TOYITAGALVAN@GMAIL.COM

ANA VICTORIA GALVAN ZAPA
C.C:1.067.942.619 DE MONTERIA
CELULAR: 3022476151
E-MAIL: toyitagalvan@gmail.com

II. ESTUDIOS REALIZADOS

- **PRIMARIA:** COLEGIO VILLA MARGARITA

- **SECUNDARIA:**

INSTITUCIÓN: INST. EDU. VILLA MARGARITA

FECHA / TERMINACIÓN: 07 DICIEMBRE 2012

TÍTULO OBTENIDO: BACHILLER ACADÉMICO

SUPERIORES

- **SENA:**

Técnico en enfermería

- **OTROS**

CERTIFICADA EN:

Toma y Transporte de Muestras de laboratorio
Educación en salud
Básico en reanimación cardiopulmonar
Primeros auxilios
Protocolo de atención integral en salud a
Víctimas de violencia sexual
Vigilancia comunitaria de la estrategia AIEPI
Agente comunitario en salud
Administración en recursos humanos

ANA VICTORIA GALVAN ZAPA

C.C:1.067.942.619 DE MONTERIA
CELULAR: 3022476151
E-MAIL: toyitagalvan@gmail.com

IV. REFERENCIAS PERSONALES

NOMBRE:	VICTOR RAMOS GALINDO
OCUPACION:	Tecnólogo en equipos de cómputo
CELULAR:	3007325495

NOMBRE:	ANA MARIA RUIZ
OCUPACION:	Auxiliar de enfermería
CELULAR:	3116807952

V. REFERENCIA FAMILIARES

NOMBRE:	VIRGINIA ANDREA ZAPA
OCUPACIO:	MADRE COMUNITORIA
CELULAR:	3022482037

NOMBRE:	MANUELA GALVAN
OCUPACION:	ABOGADA
CELULAR:	3126516736

V. REFERENCIA LABORALES

NOMBRE:	MAGDALENA BOHORQUEZ
OCUPACIÓN:	AUX DE ENFERMERIA
CELULAR:	3144515924

ANA VICTORIA GALVAN ZAPA
C.C: 1067942619

60 años
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA SALUD

Gobernación DE CÓRDOBA
Unidos por la Prosperidad

RESOLUCION No.23 000980

EL SECRETARIO SECCIONAL DE SALUD DE CORDOBA
En uso de sus atribuciones legales y en ejercicio de la delegación conferida por la Resolución Nº 8211 de 1989 emanada del Ministerio de Salud, y

CONSIDERANDO

Que ANA VICTORIA GALVAN ZAPA, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. **1.067.942.619** expedida en Montería (Córdoba), ha solicitado el registro de su TITULO de TECNICO EN ENFERMERIA que le otorgó la EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA de Montería, el día 24 de Marzo de 2015.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a ANA VICTORIA GALVAN ZAPA para ejercer la Profesión de TECNICO EN ENFERMERIA en el Territorio Nacional.

ARTICULO SEGUNDO: Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Montería a los, 22 ABR 2015

EDWIN DE JESUS PRECIADO LORDUY
Secretario de Salud Departamental (E)

Escaneado con CamScanner

SISPRO - APLICATIVOS MISIONALES
Sistema Integral de Información de la Protección Social

ReTHUS

A continuación diligencie la identificación o nombre y apellido de la persona a consultar en el Registro Unico Nacional de Talento Humano en Salud.

Tipo de Identificación * Cedula de Ciudadania

Número de Identificación * 1067942619

Primer Nombre * ANA

Primer Apellido * GALVAN

Confirme los números de la Imagen *



Cambiar

8304

Verificar Registro en ReTHUS Limpiar

Resultado General -2022-06-21→3:06:27 PM -2022-06-21→3:08:52 PM -2022-06-21→3:09:47 PM

Tipo Identificación	Nro. Identificación	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Estado Identificación:	Detalles
CC	1067942619	ANA	VICTORIA	GALVAN	ZAPA	Vigente	Ver

Search

SISPRO

Principal

SIDAM- SI Estandares de Medicam… 1

Atención telefónica a través del Centro de Contacto:
En Bogotá: +57(1) 3305043 Resto del país: 018000960020
Horario de atención:
Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. y sábados de 8:00a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua.
Solicitudes, sugerencias y reclamos PQRSD
Notificaciones judiciales
Términos y condiciones de uso.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 214775044

WEB
14:44:29

Bogotá DC, 26 de enero del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LEIDIS PAOLA MORENO SERRANO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1047470872:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 26 de enero de 2023, a las 14:45:08, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1047470872
Código de Verificación	1047470872230126144508

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 02:45:17 PM horas del 26/01/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1047470872**
Apellidos y Nombres: **MORENO SERRANO LEIDIS PAOLA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.