HOSPITAL RICARDO ACOSTA E.S.E

809.004.280-9

Calle 5 No. 9-50 – Centro

3115218355 - 3135508070

administracion@hospitalpalocabildo.gov.co

FICHA TÉCNICA EQUIPO

CÓDIGO DE ALMACENAMIENTO		**SERVICIO**	Hospital Ricardo Acosta
REGISTRO INVIMA	No Requiere (cert 2019000802)	**UBICACIÓN**	Hospital Ricardo Acosta

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

EQUIPO	Báscula Digital Pesa Bebé				**FABRICANTE**	Seca GmbH & Co.	
MARCA	Seca				**TELÉFONO**	+49 40 20 00 00 0	
MODELO	354				**SITIO WEB**	ww.seca.com	
SERIE	8354006202046				**E-MAIL**	info@seca.com	
INGRESO	COMPRA	X	DONACIÓN		**CIUDAD - PAÍS**	Alemania	
FECHA DE COMPRA	2022-12-29				**PROVEEDOR**	Ingeniería MC S.A.S	
FECHA DE GARANTÍA	2024-12-29				**TELÉFONO**	601 626 9070	
FECHA DE INSTALACIÓN	2022-12-29				**SITIO WEB**	www.ingenieriamc.com.co	
TIPO DE EQUIPO	FIJO		MÓVIL	X	**E-MAIL**	Ingenieriamc.sas@gmail.com	
VIDA ÚTIL	No registra				**CIUDAD - PAÍS**	Ibagué – Colombia.	

REGISTRO TÉCNICO				CLASIFICACIÓN BIOMEDICA		FUENTES DE ALIMENTACIÓN				RIESGO D4725/05	
VOLTAJE	6 VDC	**FRECUENCIA**	No aplica	**DIAGNÓSTICO**	X	**ELÉCTRICO**		**ELECTROMECANICO**		**BAJO (I)**	X
CORRIENTE	0,5 A	**CAPACIDAD**	20 kg	**TRATAMIENTO**		ELECTRÓNICO		**HIDRÁULICO**		**MODERADO (IIa)**	
POTENCIA	No aplica	**TEMPERATURA**	10 A 40 °C	**ANÁLISIS DE LAB.**		**MECÁNICO**		**NEUMÁTICO**		**ALTO (IIb)**	
PRESIÓN	No aplica	**DIMENSIONES**	165 X 550 X 330 mmHg	**PREVENCIÓN**		**VAPOR**		**BATERÍA**	X	**MUY ALTO (III)**	
PESO	2,5 kg	**OTRA**	Batería AAA	**OTRA**		**GAS**		**OTRA**			

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

- No golpear el equipo.
- Limpiar y desinfectar con productos no abrasivos y/o corrosivos.
- Situar el equipo en una superficie plana y nivelada.
- No superar la capacidad máxima de pesaje del equipo.



ACCESORIOS Y/O PARTES

Display	Pulsadores	Batería AAA
Plataforma de carga.		

PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Mensual	Trimestral	Cuatrimestral	Semestral	Anual
			X	

PERIODICIDAD DE CALIBRACIÓN

Mensual	Trimestral	Cuatrimestral	Semestral	Anual	No Aplica
				X	

seca 354

Pesabebés electrónica de fina graduación con plataforma para el pesaje de niños

optimizadas



- Pesabebés y báscula de plataforma para niños.
- Bandeja fácilmente desmontable de la base.
- Función de Ingestión de Leche Materna.
- Móvil y robusta para el transporte.

seca®
Precisión para la salud

seca 354:

Versátil y robusta; calidad compacta con doble utilidad.



En el hogar, en el consultorio médico y en cualquier sitio del mundo donde empieza una vida, el control fiable del peso corporal es decisivo para un crecimiento sano. La seca 354 es una báscula multifunción desarrollada a partir de la práctica. Por una parte es una pesabebés, y por otra se puede utilizar como báscula de plataforma para niños pequeños.

Pesabebés y báscula de plataforma a la vez.

La artesa de la báscula seca 354 resguarda a los pequeños para un pesaje seguro y confortable; sus formas arqueadas, con laterales ligeramente elevados, brindan confianza y protección. Al desmontar la artesa de la base, se obtiene una báscula electrónica de plataforma lista para funcionar, con una capacidad de 20 kg.

El firme bloqueo de la artesa brinda un alto nivel de seguridad.

Con una sencilla maniobra, la pesabebés se convierte en una báscula de plataforma: la unión entre la artesa y la base se suelta con sólo pulsar una tecla. En estado bloqueado, la sólida unión entre la artesa y la base permite levantar la pesabebés y transportarla sin ningún inconveniente.

Fácil manejo con teclas de función que se explican por sí solas.

La facilidad en el uso de la báscula seca se debe a un concepto de manejo intuitivo, con teclas que se explican por sí solas. La función Auto-HOLD permite atender al bebé inmediatamente después del pesaje, incluso antes de leer el peso registrado. Con la función TARA, el peso de pañales o paños suaves se comprueba con eficacia. Y la función Breast Milk Intake (BMIF) permite comprobar la cantidad de leche materna ingerida por el lactante: con sólo pulsar una tecla, queda almacenado el peso del bebé antes de la lactancia; en un segundo pesaje realizado después de la ingestión de leche materna, éste se restará del peso actual.







La bandeja de pesaje se puede desmontar rápida y fácilmente, simplemente pulsando una tecla.

Móvil y robusta para el transporte.

Con su construcción compacta y sólida, la seca 354 está predestinada a ser la herramienta ideal de todos los que necesitan movilidad para atender la salud de los más pequeños. Gracias a un funcionamiento de bajo consumo a pilas que permite realizar hasta 20,000 pesajes con un solo juego, la báscula se puede usar en cualquier sitio.



seca 414



seca 413

seca 354

Datos técnicos

- Capacidad: 20 kg / 44 lbs
- División: 5 g < 10 kg > 10 g / 0.2 oz < 22 lbs > 0.5 oz
- Dimensiones (AxAxP): 552 x 156 x 332 mm / 21.7 x 6.1 x 13.1"
- Dimensiones / superficie de pesaje (AxAxP): 525 x 80 x 250 mm / 20.7 x 3.1 x 9.8"
- Dimensiones / plataforma (AxAxP): 280 x 65 x 235 mm / 11 x 2.6 x 9.3"
- Peso: 2.3 kg / 5 lbs
- Alimentación: batería
- Funciones: TARA, BMIF, Auto-HOLD, conmutación kg/lbs, desconexión automática
- Opcional: carritos seca 403 y seca 402, tabla de medición seca 417, mochila seca 409 (en combinación con la tabla de medición o el estadímetro), maleta de transporte seca 414 (para la combinación con la tabla de medición), seca 431 y seca 413

Reservado el derecho a realizar modificaciones.

201135404018

seca gmbh & co. kg • Hammer Steindamm 3 – 25 • 22089 Hamburgo • Alemania
Telefono +49 40 20 00 00 0 • Telefax +49 40 20 00 00 50 • info@seca.com • www.seca.com

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

CERTIFICACIÓN No. 2019000802

EL SUSCRITO DIRECTOR(A) TÉCNICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INVIMA CERTIFICA:

Que hasta la fecha y de conformidad con nuestra Legislación Sanitaria vigente, el producto: BASCULAS DE PRECISION PARA PESO CORPORAL – Marca: SECA

Está contemplado entre los productos que NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia

INTERESADO:	SECA GmbH & co. KG - Alemania
SOLICTANTE:	SECA S.A.S. - Colombia
RADICACIÓN:	**20181255120**
FECHA RADICACIÓN:	12/12/2018

OBSERVACIONES: *"INDICACIONES Y USOS: Equipo Médico de precisión para determinar peso corporal, peso y medida corporal de pacientes, con o sin software de control.*

PRESENTACIÓN COMERCIAL: Caja x 1 unidad

COMPONENTES: Bascula Electrónica o mecánica, Estructura Soporte, Censores, Visor, puerto USB, Conectores, Software de Control seca 115, Batería.

MODELOS: Básculas para peso corporal seca"

Lo anterior debido a que el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "*por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano*", por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos.

Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro.

Se expide en Bogotá D.C., el 18 de Enero de 2019 .
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.



Firma válida

Firmado digitalmente por LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Fecha: 2019.01.24 15:47:25 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTOR(A) TÉCNICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Proyectó: Legal: arojass, Técnico: Idiazc Revisó: cordina_varios

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2022**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario **8820220000706 31-2**

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
890312452	4	ALLERS S. A.

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CR 67 1 B 35	4893000	88	76	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
800254610	5	AGENCIA DE ADUANAS AGECOLDEX S.A NIVEL 1	26	0001

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
94492275	PEREZ GUTMAR ADOLFO

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cód.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cód. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cód. Admón.
02	Corrección	4	882022000068079	2022 - 06 - 28	88	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cód. lugar ingreso de las mercancías	41. Cód. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CLO	4	No. 657146	2022 - 06 - 24	No. SEAEXPJ30287	2022 - 04 - 07

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
SECA GMBH Y CO. KG.,	HAMBURG	023

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
POSTFACH 76 1180 22061	sabrina.vaas@seca.com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cva.
90418035	2022 - 03 - 28	023	1	434	76	DINAMICA LOGISTICA S.A.S	4,068,75

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8423100000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	023	1,428,19	833,97	YY	27	5	U	450.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número	87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No.	90. Cod interno del Producto
33,450.86	2,189.60	23.41	126.25	2,339.26	0.00	35,790.12	R	50092022	3	2022	XXXXXXXXX X	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	145,821,051	0	0	0
I.V.A.	19.00	145,821,051	27,668,000	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Sancion	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	27,668,000		0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, señales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO_ 01230227 PEDIDOS_ EXS-030-2_ SECA DI_ 3 DE 11 PRODUCTO: BASCULAS DE PRECISION PARA PESO CORPORAL / 803 BALANZA PESA PERSONAS DIGITAL. MARCA: SECA. MODELO: SECA 803. REFERENCIA: 8031321009. USO O DESTINO: EQUIPO MEDICO DE PRECISION PARA DETERMINAR PESO CORPORAL, PESO Y MEDIDA CORPORAL DE PACIENTES, CON O SIN SOFTWARE DE CONTROL.. CAPACIDAD: 200 KG. SENSIBILIDAD AL PESO: 50 A 100 G. . NOMBRE COMERCIAL: 803 BALANZA PESA PERSONAS DIGITAL CAP 150 KG. SECA. , CANTIDAD: 150 UNIDADES.NO REQUIERE REGISTRO SANITARI O. CERTIFICADO 2019000802 RADICADO 20181255120 FECHA DE RADICACION 12/12/2018.// INFORMACION ADICIONAL ACTA DE INSPECIÓN PREVIA N O. 0001-2022-7858, FECHA: 31/05/2022.//SEGÚN FACTURA: 8031321009. DATOS CAJA: SECA 803 MOD. 8031321009 EAN (continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 27,668,000	128. Recibo oficial de pago anterior No.: 91088011673835	129. Fecha: 2022 06- 29
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Inspección física No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 882022000070631 133. Feha: 2022 07 07
134. Levante No.: 882022000064970	135. Fecha: 11-07-2022	Firma funcionario responsable 136. Nombre 137. C.C. No.

Firma declarante

Agencia de Aduanas Agecoldex S.A Nivel 1 Edinson Javier Tello

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

998. Pago Total $ 0

996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

SYGA
Autoadhesivo 92882200431631
Fecha presentación 2022-07-07 17:02:16
Valor pagado $No se aplicó el pago

Fecha de Impresion: 2022-07-07 17:56:42

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **882022000070631-2**
Subpartida : **8423100000**

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, serailes y otros)

4012030005712 UPC 694151006716 JAN 4580290320737 DESIGNED IN GERMANY - MADE IN CHINA. DIGITAL SCALE. EXTRA ROBUST SECA CLARA 803 SECA PRECISION FOR HEALTH. DATOS PIEZA: SECA GMBH & CO. KG MAX 150 KG/330 LBS MIN 2 KG/4,4 LBS D= 100G/ 0.2LBS DESIGNED IN GERMANY - MADE IN CHINA, TRAE ACCESORIOS Y MANUAL. CODIGO DE BARRA PIEZA, SERIAL N°,REFERENCIA: 8031321009 CANTIDAD: 150 8803334210801 8803334210802 8803334212029 8803334212030 8803334212031 8803334212032 8803334212037 8803334212038 8803334212039 8803334212040 8803334212081 8803334212082 8803334212083 8803334212084 8803334212093 8803334212094 8803334212095 8803334212096 8803334212133 8803334212134 8803334212135 8803334212136 8803334212157 8803334212158 8803334212159 8803334212160 8803334212169 8803334212170 8803334212171 8803334212172 8803334212173 8803334212174 8803334212175 8803334212176 8803334212189 8803334212190 8803334212191 8803334212192 8803334212201 8803334212202 8803334212203 8803334212204 8803334212233 8803334212234 8803334212235 8803334212236 8803334212261 8803334212262 8803334212263 8803334212264 8803334212269 8803334212270 8803334212271 8803334212272 8803334212273 8803334212274 8803334212275 8803334212276 8803334212277 8803334212278 8803334212279 8803334212280 8803334212281 8803334212282 8803334212283 8803334212284 8803334212293 8803334212294 8803334212295 8803334212296 8803334212297 8803334212298 8803334212299 8803334212300 8803334212305 8803334212306 8803334212307 8803334212308 8803334212333 8803334212334 8803334212335 8803334212336 8803334212345 8803334212346 8803334212347 8803334212348 8803334212353 8803334212354 8803334212355 8803334212356 8803334212381 8803334212382 8803334212383 8803334212384 8803334212385 8803334212386 8803334212387 8803334212388 8803334212397 8803334212398 8803334212399 8803334212400 8803334212408 8803334212410 8803334212411 8803334212412 8803334212461 8803334212462 8803334212463 8803334212464 8803334212501 8803334212502 8803334212503 8803334212504 8803334212505 8803334212506 8803334212507 8803334212508 8803334212517 8803334212518 8803334212519 8803334212520 8803334212533 8803334212534 8803334212535 8803334212536 8803334212545 8803334212546 8803334212547 8803334212548 8803334212577 8803334212578 8803334212579 8803334212580 8803334212581 8803334212582 8803334212583 8803334212584 8803334212593 8803334212594 8803334212595 8803334212596 8803334212609 8803334212610 8803334212611 8803334212612 8803334212617 8803334212618 8803334212619 8803334212620.PRODUCTO: BASCULAS DE PRECISION PARA PESO CORPORAL / 354 BALANZA PESA BEBE DIGITAL. MARCA: SECA. MODELO: SECA 354.REFERENCIA: 3541317004. USO O DESTINO: EQUIPO MEDICO DE PRECISION PARA DETERMINAR PESO CORPORAL, PESO Y MEDIDA CORPORAL DE PACIENTES, CON O SIN SOFTWARE DE CONTROL.. CAPACIDAD: 20 KG. SENSIBILIDAD AL PESO: 5 G/10 G. . NOMBRE COMERCIAL: 354 BALANZA PESA BEBE DIGITAL KG/LBS CAP 20 KG/44 LBS CON BATERIAS REF. 3541317004 - SECA. , CANTIDAD: 300 UNIDADES.NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO. CERTIFICADO 2019000802 RADICADO 20181255120 FECHA DE RADICACION 12/12/2018.// INFORMACION ADICIONAL ACTA DE INSPECIÓN PREVIA NO. 0001-2022-7858, FECHA: 31/05/2022.//SEGÚN FACTURA: 3541317004. DATOS CAJA: SECA® SECA 354 DESIGNED IN GERMANY MADE IN CHINA MOD: 3541317004 EAN 4012030018586 UPC-CODE 694151018580. SECA PRECISION FOR HEALTH DIGITAL BABY SCALA SECA LENA 354. DATOS PIEZA: SECA 354 SECA SECA GMBH & CO. KG ART.NO: 3541317004 MAX. 10/20KG / 22/44LBS D = 5G/0.2OZ/0,01LBS D = 10G/0,5OZ/0.02LBS DESIGNED IN GERMANY MADE IN CHINA TRAE MANUAL. SERIAL: REFERENCIA: 3541317004 CANTIDAD: 300 8354058220019 8354058220020 8354058220022 8354058220024 8354058220025 8354058220048 8354058220049 8354058220061 8354058220067 8354058220068 8354058220069 8354058220070 8354058220071 8354058220080 8354058220085 8354058220086 8354058220089 8354058220090 8354058220091 8354058220093 8354058220101 8354058220102 8354058220103 8354058220104 8354058220108 8354058220110 8354058220111 8354058220112 8354058220114 8354058220117 8354058220119 8354058220128 8354058220129 8354058220130 8354058220135 8354058220136 8354058220137 8354058220138 8354058220160 8354058220162 8354058220163 8354058220164 8354058220166 8354058220183 8354058220184 8354058220186 8354058220198 8354058220199 8354058220200 8354058220216 8354058220226 8354058220346 8354058220348 8354058220350 8354058220352 8354058220353 8354058220354 8354058220355 8354058220357 8354058220359 8354058220360 8354058220363 8354058220366 8354058220367 8354058220370 8354058220371 8354058220372 8354058220373 8354058220374 8354058220375 8354058220376 8354058220378 8354058220380 8354058220382 8354058220384 8354058220385 8354058220387 8354058220388 8354058220391 8354058220392 8354058220394 8354058220395 8354058220403 8354058220404 8354058220407 8354058220410 8354058220412 8354058220414 8354058220415 8354058220417 8354058220419 8354058220421 8354058220422 8354058220424 8354058220425 8354058220426 8354058220427 8354058220428 8354058220429 8354058220430 8354058220433 8354058220434 8354058220435 8354058220436 8354058220437 8354058220438 8354058220446 8354058220448 8354058220452 8354058220456 8354058220456 8354058220458 8354058220466 8354058220469 8354058220476 8354058220477 8354058220478 8354058220479 8354058220482 8354058220487 8354058220488 8354058220489 8354058220490 8354058220492 8354058220493 8354058220495 8354058220496 8354058220497 8354058220498 8354058220499 8354058220500 8354058220502 8354058220503 8354058220504 8354058220506 8354058220507 8354058220508 8354058220509 8354058220510 8354058220511 8354058220512 8354058220513 8354058220514 8354058220515 8354058220516 8354058220517 8354058220519 8354058220520 8354058220521 8354058220522 8354058220523 8354058220524 8354058220525 8354058220526 8354058220530 8354058220533 8354058220539 8354058220541 8354058220544 8354058220549 8354058220551 8354058220552 8354058220553 8354058220558 8354058220559 8354058220561 8354058220562 8354058220564 8354058220566 8354058220567 8354058220570 8354058220571 8354058220572 8354058220573 8354058220576 8354058220583 8354058220587 8354058220713 8354058220716 8354058220718 8354058220720 8354058220721 8354058220724 8354058220725 8354058220726 8354058220728 8354058220729 8354058220730 8354058220732 8354058220733 8354058220734 8354058220735 8354058220736 8354058220737 8354058220738 8354058220739 8354058220740 8354058220743 8354058220746 8354058220747 8354058220753 8354058220755 8354058220756 8354058220757 8354058220758 8354058220759 8354058220763 8354058220764 8354058220765 8354058220766 8354058220768 8354058220771 8354058220772 8354058220773 8354058220774 8354058220784 8354058220788 8354058220797 8354058220798 8354058220805 8354058220807 8354058220808 8354058220830 8354058220835 8354058220838 8354058220846 8354058220871 8354058220884 8354058220892 8354058221110 8354058221148 8354058221150 8354058221165 8354058221166 8354058221167 8354058221172 8354058221177 8354058221182 8354058221185 8354058221187 8354058221188 8354058221189 8354058221190 8354058221191 8354058221193 8354058221194 8354058221196 8354058221198 8354058221199 8354058221200 8354336210754 8354336210755 8354336210781 8354336210782 8354336210793 8354336210794 8354336210798 8354336210800 8354336210805 8354336210807 8354336210808 8354336210809 8354336210810 8354336210817 8354336210818 8354336210957 8354336210958 8354336210958 8354336210969 8354336210970 8354336211071 8354336210977 8354336210978 8354336210980 8354336210982 8354336210988 8354336211043 8354336211045 8354336211046 8354336211049 8354336211050 8354336211053 8354336211060 8354336211070 8354336211072 8354336211073 8354336211097 8354336211098 8354336211101 8354336211102 8354336211107 8354336211108 8354336211109 8354336211110 8354336211113 8354336211114 8354336211115 8354336211117 8354336211135 8354336211137 .NOS ACOGEMOS AL DECRETO NÚMERO 1343 DE 2017, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, AL DECRETO NÚMERO 272 DE 2018, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMOY AL DECRETO NÚMERO 1881 DE 2021, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO ARTÍCULO 2°. ARANCEL 0 %.XXXX

INGENIERÍA MC S.A.S.

Guía rápida de operación de equipo biomédico

Bascula digital pesa bebes Seca 354



I. Descripción general del equipo biomédico.

- Dos básculas en una: para empezar, la báscula seca 354 es un pesabebés con artesa confortable y una fina graduación de 10 g. En unos pocos instantes, es capaz de convertirse en una báscula de plataforma con una capacidad de 20 kg, para el pesaje de niños pequeños. La artesa y la base, que sirve de báscula de plataforma, están unidas firme y sólidamente, ofreciendo absoluta seguridad para el pesaje del bebé.

II. Pruebas de verificación de funcionamiento preliminar.

- Retirar todos los elementos del embalaje e introducir las baterías conforme a lo descrito.
- Instalar la báscula sobre una base firme y plana. Colocar a continuación la bandeja según la figura sobre la parte inferior de la báscula y tirar de ella hacia adelante, hasta que se oiga el enclavamiento de la misma y hasta que el botón de desenclavamiento se encuentre en la posición superior.
- De esta forma, la bandeja queda fijamente enclavada con la parte superior.
- Para retirar la bandeja, pulsar el botón de desenclavamiento con fuerza y empujar la bandeja hacia atrás.
- El suministro de energía de la báscula se realiza mediante 4 baterías AA.
- Retirar la artesa y girar la báscula con cuidado de tal modo que el suelo de la báscula quede accesible.
- Abrir la tapa del compartimiento de baterías e insertar las baterías suministradas conforme a los datos de la polaridad en el compartimiento.
- Cerrar la tapa del compartimiento de pilas.



Instrucciones de uso del equipo.

- Conectar la báscula apretando la tecla verde. En la indicación debe aparecer ahora "0".
- Al pesar bebes: Colocar al bebe en la artesa. Cuidar que el niño se quede lo más quieto posible.
- Al pesar niños que pueden estar de pie: retirar la bandeja conforme a lo descrito. Comprobar la posición segura de la parte inferior. Subir al niño a la báscula y procurar que permanezca quieto.
- Leer el peso en la indicación. ¡No sobra cargar la báscula!
- Con ayuda de la función TARA, es posible tarar objetos situados encima de la báscula como mantas, pañales, etc.

1. Colocar primero el objeto a tarar sobre la báscula.
2. Apretar la tecla TARE. La indicación de la báscula se repone de nuevo a cero a "0" y se puede comenzar una pesada normal.

- La báscula puede ser desconectada pulsando el botón START.
- Es posible conmutar la indicación de peso entre kilogramos (kg) y libras (lbs:oz) y libras decimales (lbs), mediante la tecla kg/lbs.



seca
Precision para la salud

III. Recomendaciones.

- El equipo debe ser usado solo por personal capacitado.
- Realice periódicamente el mantenimiento preventivo del equipo. Debe ser realizado por personal capacitado.
- No utilice productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- No utilice disolventes orgánicos (p. ej., alcohol o gasolina.
- SI, su modelo de bascula es Seca 354M, recuerde que también cuenta con la posibilidad de utilizar el equipo conectando el adaptador de corriente en caso de que las baterías ya se encuentren descargadas o simplemente no tenga disponibles.
- Conecte el adaptador en la parte inferior de la báscula y conecte este a un toma de corriente.

IV. Limpieza del equipo.

- Limpiar la artesa y el exterior de la báscula, según fuera preciso, con un paño húmedo.
- No tirar las baterías al cubo de basura. Eliminar las pilas en los puntos de recogida más cercanos.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No. MC 0150

INSTRUMENTO BAJO PRUEBA		DATOS DEL SOLICITANTE	
INSTRUMENTO:	BÁSCULA PESA BEBES	**CLIENTE:**	HOSPITAL RICARDO ACOSTA E.S.E.
MARCA:	SECA	**NIT:**	809.004.280-9
MODELO:	354	**TELÉFONO:**	311 521 83 55
SERIE:	8354058220348	**DIRECCIÓN:**	CALLE 5 # 9-50
ID INSTITUCIÓN:	NO REGISTRA	**CIUDAD:**	PALOCABILDO-TOLIMA

CONDICIONES DE CALIBRACIÓN Y DEL ÍTEM

CARGA MÁXIMA:	20,0 kg	**INTERVALO DE CALIBRACIÓN:**	0 kg a 20 kg
RESOLUCIÓN:	0,01 kg	**CONDICIÓN DEL ÍTEM:**	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

LUGAR Y CONDICIONES AMBIENTALES DE LA CALIBRACIÓN:

LUGAR DE CALIBRACIÓN:	CONSULTA EXTERNA	**TEMPERATURA:**	25,3	± 0,2	**°C**
FECHA DE RECEPCIÓN:	2022-12-21	**HUMEDAD RELATIVA:**	68,0	± 0,4	**% hr**
FECHA DE CALIBRACIÓN:	2022-12-22	**PRESIÓN BAROMÉTRICA:**	866,7	± 0,0	**hPa**
FECHA DE EMISIÓN:	2022-12-22				

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de INGENIERÍA MC SAS. Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones, el laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. el usuario es responsable de la re calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Nota: *"Los resultados contenidos en este certificado, se relacionan solamente con los ítems sometidos de calibración"*

Las mediciones reportadas en el certificado de calibración son trazables al SI, a través del uso de instrumentos patrón calibrados por entidades acreditadas por ONAC, y cumple con los lineamentos de la norma NTC ISO/IEC17025 de 2017.

MÉTODO DE CALIBRACIÓN:

La calibración del instrumento se realizó mediante el método de comparación directa, de acuerdo con los lineamentos descritos en la Guía SIM MWG7/cg-01/V.00;, sin presentarse ninguna desviación al método.

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN:

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k", y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.
La incertidumbre medida fue estimada de acuerdo con la GUM " Guía para expresión de incertidumbres de medición" y la Guía SIM MWG7/cg-01/V.00. " Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático".

EQUIPO DE REFERENCIA UTILIZADO

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA DE CALIBRACIÓN	CERTIFICADO No.
BAROTERMOHIGRÓMETRO	EXTECH	SD700	A110508	2022-03-23	L33803-22
BARÓMETRO	EXTECH	SD700	A110508	2022-03-14	C3703-22
JUEGO DE PESA PATRÓN	DETECTO/ SERVIPESAS	OIML-M1 / 5 kg	(01 A 04)	2022-09-23	CAP-1074-22
JUEGO DE PESA PATRÓN	METROGLOBAL/ SERVIPESAS	OIML-M1 / 10 kg	(05 A 10)	2022-09-20	SP-017
JUEGO DE PESA PATRÓN	METROGLOBAL/ SERVIPESAS	OIML-M1 / 20 kg	(11 A 15)	2022-09-20	SP-016
PESA CILINDRICA	SERVIPESAS	OIML-M1 / 2 kg	(01 A 02)	2022-09-23	CAP-1075-22
PESA INDIVIDUAL CILINDRICA	LEXUS	OIML-M1 / 500 g	AQ150419	2022-02-03	CAP-128-22
JUEGO DE PESA PATRÓN	LEXUS	OIML-M1 / 10g - 500 g	AQ180319	2022-02-16	CAP-129-22

RESULTADO DE LA MEDICIÓN

PRUEBAS DE PRECARGA

CARGA (kg)	MEDICIÓN (kg)	ERROR (kg)	ERROR MÁXIMO (kg)
10,0	10,000	0,000	0
20,0	20,000	0,000	

PRUEBAS DE REPETIBILIDAD


CARGA	MEDICIÓN	ERROR	ERROR MÁXIMO (kg)	DESVIACIÓN ESTÁNDAR (kg)
10,0	10,000	0,000	89,9	40,20
10,0	10,000	0,000		
10,0	10,010	0,010		
10,0	99,900	89,900		
10,0	10,000	0,000		

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No. MC 0150

PRUEBAS DE EXCENTRICIDAD

CARGA (kg)		10	ΔI ecci Max (kg)
PUNTO	MEDICIÓN (kg)	ΔI (kg)	
E	10,000		
A	10,000	0,000	0,010
B	10,010	0,010	
C	10,010	0,010	
D	10,000	0,000	
E	10,000	0,000	

POSICIÓN DE CARGA

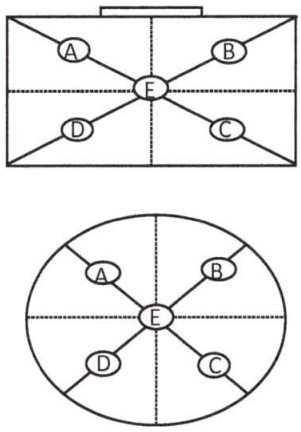


DESCRIPCIÓN DE POSICIÓN DE CARGA

- **E** Centro de la plataforma.
- **A** Frontal Izquierda.
- **B** Frontal Derecho.
- **C** Posterior Derecho.
- **D** Posterior Izquierdo.

PRUEBAS DE ERRORES DE INDICACIÓN

CARGA (kg) NOMINAL	INDICACIÓN (kg)	ERROR (kg)	FACTOR DE COBERTURA "k"	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA (kg)
0,0	0,00	0,00	2,87	51,6
2,0	2,00	0,00	2,87	51,6
4,0	4,00	0,00	2,87	51,6
6,0	6,00	0,00	2,87	51,6
8,0	8,00	0,00	2,87	51,6
10,0	10,00	0,00	2,87	51,6
12,0	12,00	0,00	2,87	51,6
14,0	14,00	0,00	2,87	51,6
16,0	16,00	0,00	2,87	51,6
18,0	18,00	0,00	2,87	51,6
20,0	20,00	0,00	2,87	51,6

GRAFICA DE ERRORES DE INDICACIÓN

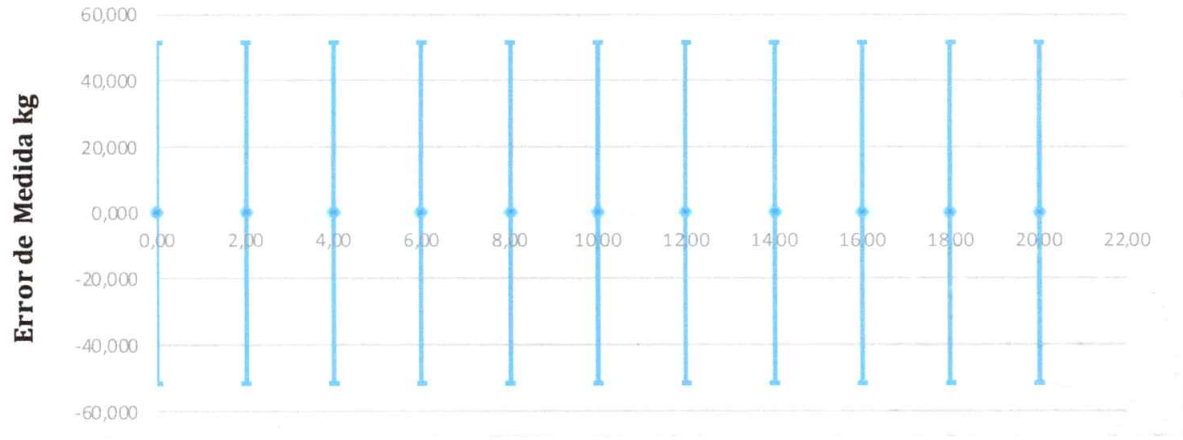

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No. MC 0150

INFORMACIÓN ADICIONAL

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SEGÚN:

NO REGISTRA

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

NO REGISTRA

OBSERVACIONES

NO REGISTRA

FIRMAS AUTORIZADAS

REALIZÓ

VICTOR MANUEL ROA
METRÓLOGO

REVISÓ Y APROBÓ

JOAQUÍN ELIAS BEDOYA H.
DIRECTOR TÉCNICO

FIN DEL CERTIFICADO

www.ingenieriamc.com.co
Tel: 601-6269070 Cel: 313 8636672 :: Cr 116 # 77B -42 Of: 161 / Bogotá D.C Cels: 350 4874674 / 350 8737394 :: Cra. 4B # 32B - 32 Barrio la Francia / Ibagué