

# Unidades odontológicas

Diseñamos y fabricamos Unidades Odontológicas



## Elite **Plus**



Asistencia Técnica Dental S.A.S.



## Sillón Eléctrico

- ▶ Moto reductores silenciosos en base y espaldar con capacidad de soportar hasta 220Kg con paciente.
- ▶ Tapicería en cordobán para alta asepsia sin costuras, con espuma de alta intensidad. variedad de colores y referencias para escoger.
- ▶ Apoya cabeza escualizable (modo pediátrico).
- ▶ Descansa brazos movibles escualizables para fácil acceso y salida del paciente.
- ▶ Circuito eléctrico protegido para humedad y chorro de agua por una caja plástica.
- ▶ Peso neto 91Kg, Peso bruto 129Kg
- ▶ Brazo con monitor de 17", visualiza imagenes de radiografía.
- ▶ Control de mando en módulo y pedal




## Módulo

- ▶ Módulo moderno amplio termo formado.
- ▶ Bandeja para instrumental removible en acero inoxidable.
- ▶ Módulo giratorio 150°

Módulo con cuatro servicios con Holder automático (01 servicio pieza de mano baja velocidad, 02 servicios pieza de mano alta velocidad, 01 servicios para jeringa triple) con conexión para los modulos tipo borden metálicos.

- ▶ Control digital con 7 funciones: ascenso y descenso del sillón, espaldar, con posición 0, irrigadores de agua en la taza de escupidera y el llena vaso.
- ▶ Mangueras pieza de mano lisas.
- ▶ Sistema regulación para el paso de agua.
- ▶ Manómetro indicador de presión de aire.
- ▶ Jeringa triple con punta metálica esterizable a 120°.
- ▶ Negatoscopio con tecnología tipo led de mayor duración.
- ▶ Toma eléctrica marca levinton 110 / 120 VAC / 60Hz.

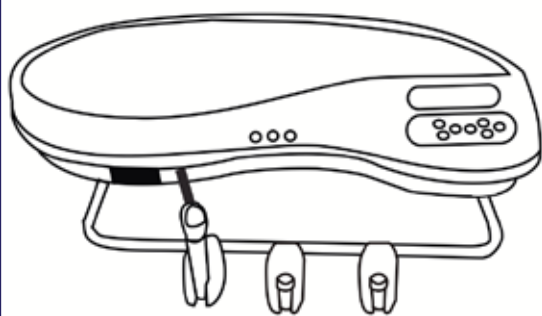



# Ficha Técnica **Elite Plus**


Código: **CME/D-03**

Versión: 001

Fecha: 25-11-2022

## Lámpara **Led**

- ▶ Lámpara moderna de tecnología LED.
- ▶ Intensidad de luz regulable (alta, media, baja).
- ▶ Brazo escualizable, altura y posición regulable.
- ▶ Sensor de proximidad.
- ▶ Lux: 8000 - 30000, Distancia Focal 70 cm, sin sombras, campo foco 20 cm.
- ▶ Manijas de fácil limpieza y desinfección.

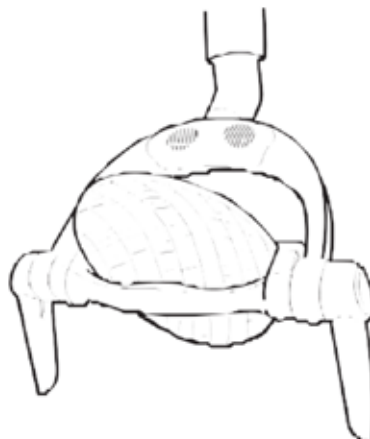

## Base

Base moderna y robusta, con altura y espacios internos para

- ▶ proteger de oxidación, circuito eléctrico AC 100-VAC /127 VAC 3.5 AMP.

- ▶ Caja de conexión / abastos interna o externa, desagües y mangueras no visibles.

Estructura en acero, Base fabricada en lámina 1/4 gruesa y

- ▶ soportes laterales de 8 milímetros con material antideslizante para mayor estabilidad sin necesidad de anclaje.


- ▶ Filtro regulador de presión de aire para piezas de mano.

- ▶ Opción ambidiestra.

Pedal manos libres de lujo que controla 7 funcines: ascenso y

- ▶ descenso de sillón, espaldar, encendido y apagado de negatoscopio, irrigadores de agua en la taza de escupidera y llenavaso.

- ▶ Pintura electrostática en los colores gris, blanco.

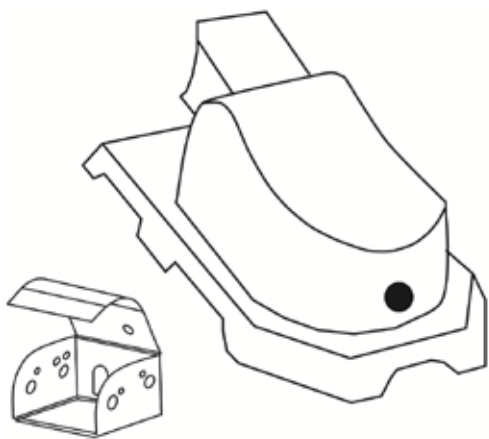



## Escupidera

- ▶ Diseño moderno desmontable.
- Irrigación de agua en la taza de escupidera y el porta vaso,
- ▶ desmontables y de fácil limpieza, controlado desde el modulo y pedal manos libres.
- ▶ Eyector (Alta) de saliva y otros residuos operado a aire, con su respectiva válvula de regulación en caja de conexión.
- ▶ Holder sencillo para jeringa triple y eyector baja. Eyector de baja, se activa desde el pedal manos libres de lujo.
- ▶ Jeringa triple auxiliar con punta metálica esterilizable a 120°.
- ▶ Taza de escupidera modernas en vidrio templado o porcelana blanca, desmontable.





## Butaco

- ▶ Ergonómico con sistema ajustable en ascenso y descenso, con pistón a gas.
- Tapicería en cordobán para alta asepsia sin costuras, con
- ▶ espuma inyectada en la silla con espaldar de espuma de alta intensidad, variedad de colores y referencias para escoger.
- ▶ Rueda de poliuretano extra suaves para reducir el nivel de ruido y fácil movilidad.
- ▶ Araña cromada.





# Elite Plus

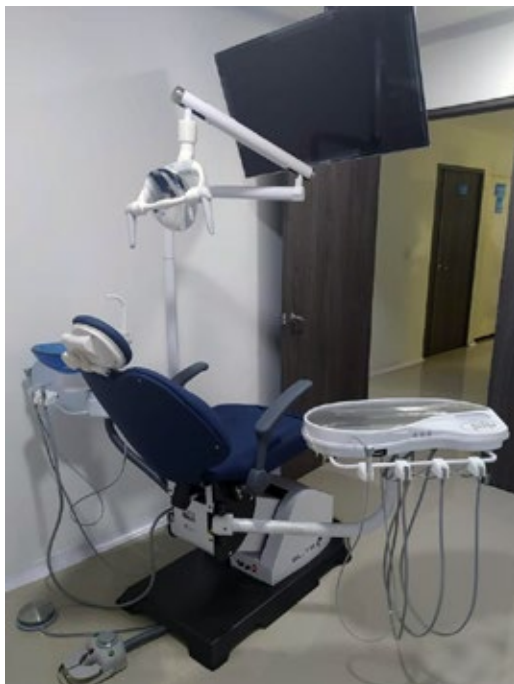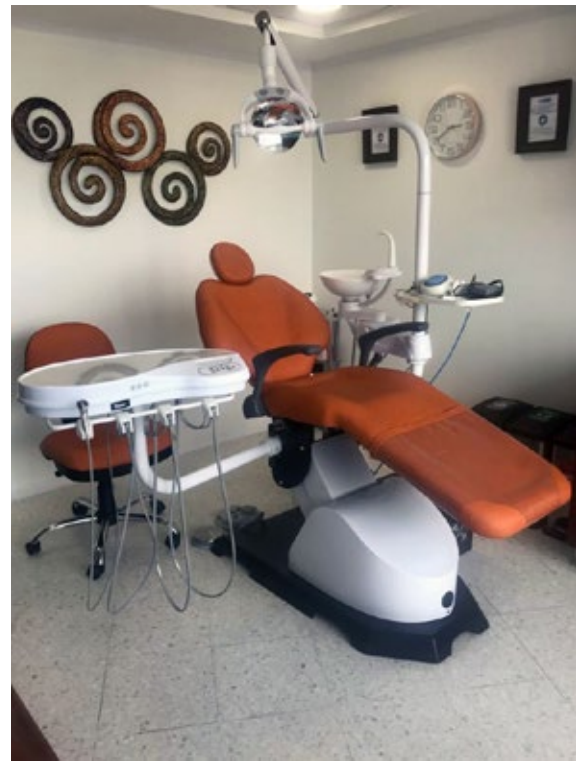



La salud  
es de todos

Minsalud

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

CERTIFICACIÓN No. 2019014629

**LA SUSCRITA DIRECTORA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS  
DEL INVIMA CERTIFICA QUE:**

Que hasta la fecha y de conformidad con nuestra Legislación Sanitaria vigente, el producto:  
**COMPONENTES MOBILIARIOS UNIDADES ODONTOLÓGICAS - UNIDADES ODONTOLÓGICAS,  
PORTATILES ODONTOLÓGICAS, COMPRESORES – Marca: ATD**

Está contemplado entre los productos que **NO** requiere Registro Sanitario para su fabricación,  
importación o comercialización en Colombia

<b>INTERESADO:</b>	<b>ASISTENCIA TECNICA DENTAL S.A.S</b>
<b>SOLICITANTE:</b>	<b>MARIO FERNANDO ARBELAEZ VILLARRAGA</b>
<b>RADICACIÓN:</b>	<b>20191090238</b>
<b>FECHA RADICACIÓN:</b>	<b>15/05/2019</b>

**OBSERVACIONES:**

**INDICACIONES Y USOS:**

***UNIDAD ODONTOLÓGICA:** El equipo dental o unidad odontológica es considerado como una serie de elementos que favorecen la recuperación dental a través de técnicas o método que realiza un higienista dental o en su efecto un odontólogo.*

***COMPRESOR:** Es una máquina de fluido que está construida para aumentar la presión y desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles.*

***UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTÁTIL:** El equipo portátil dental es considerado como un equipo básico movable que favorecen la recuperación dental a través de técnicas o método que realiza un higienista dental o en su efecto un odontólogo.*

***PRESENTACIÓN COMERCIAL:** Unidad Odontológica. Compresor, Unidad Odontológica Portátil.*

**COMPONENTES:**

***UNIDAD ODONTOLÓGICA:** Sillón (sillón y espaldar), escupidera (dos servicios, eyector de saliva), butaco (pistón a gas, tapicería en cordobán), lámpara (luz fría día), modulo (montado en brazo giratorio controla los movimientos del sillón, negatoscopio), unidades portátiles.*

***COMPRESOR:** Cabezal: es donde se comprime el aire. **Motor eléctrico:** hace que gire la bomba y comprima el aire. **Tanque:** almacena el aire comprimido. **Manómetros:** miden la presión del aire. **Regulador:** regula la salida y la presión de aire. **Automático:** permite el encendido y apagado cuando es necesario.*

Página 1 de 2





La salud  
es de todos

Minsalud

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**CERTIFICACIÓN No. 2019014629**

*UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTÁTIL: Maleta de viaje, Silla altura escualizable, Módulo de 3 servicios, Butuco plegable odontólogo, Bandeja porta instrumental acero inox, Escupidera acero inox, Lámpara led luz blanca*

**MODELOS:**

*UNIDADES ODONTOLÓGICAS MODELOS: Smart, Elite plus, Elite lite. UNIDADES PORTÁTILES: Smart by ATD, COMPRESORES: Compresores ATD."*

De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano", por lo tanto no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos.

Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA.

Se expide en Bogotá D.C., el 31 de Mayo de 2019 .  
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

**LUCIA AYALA RODRIGUEZ**  
**DIRECTOR(A) TÉCNICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS**  
Proyectó: Legal: ebarbosat, Técnico: Idíazc Revisó: cordina\_varios

**Firma válida**

Firmado digitalmente por  
LUCIA AYALA  
RODRIGUEZ  
Fecha: 2019.06.02  
09:29:23 COT  
Razón: Invima  
Locación: BOGOTÁ D.C.,  
Colombia

**invima**  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

**13 JUN 2019**

ESTE DOCUMENTO ES FIEL  
COPIA DEL QUE REPOSA EN  
EL ARCHIVO DE ESTA ENTIDAD

Página 2 de 2



## AUTORIZACIÓN DE BIEN OFERTADO PARA QUE EL PROPONENTE LO DISTRIBUYA Y/O COMERCIALICE.

Asistencia Técnica Dental SAS con Nit 900.143.883-5 y su representante legal el señor **Mario Fernando Arbeláez Villarraga** con cédula de ciudadanía No. 80.032.095 expedida en la ciudad de Bogotá, declara que es fabricante de las unidades Odontológicas marca ATD modelo Elite Plus, por tal motivo no necesitamos autorización para comercializar y/o distribuir los bienes ofertados.

Cordialmente,

MARIO FERNANDO ARBELAEZ VILLARRAGA

C.C. Nro. 80.032.095 de Bogotá D.C.

Representante Legal

ASISTENCIA TÉCNICA DENTAL S.A.S.

NIT. 900143883-5

Notificaciones judiciales: Cra 74b # 51a 06 de la ciudad de Bogotá D.C

Contacto: 601 3019777 - 311 297 1358

[www.asistenciatd.com](http://www.asistenciatd.com)

Correo electrónico: [licitaciones@asistenciatd.com](mailto:licitaciones@asistenciatd.com)



601 3019777  
3112971358



[licitaciones@asistenciatd.com](mailto:licitaciones@asistenciatd.com)  
[www.asistenciatd.com](http://www.asistenciatd.com)



Cra 74 b No 51 a 06  
Normandía  
Bogotá - Colombia



Atd.sas



ASISTENCIA TECNICA DENTAL