GERMAR GMG S.A.S.

Equipos Médicos e Insumos
www.germarmedical.com
Nit: 900.081.215-8

Electrocardiógrafos, Ecocardiógrafos, Desfibriladores, Pruebas de Esfuerzo, Holter ECG, Monitores, Mesa Tilt Test, Papelería Medica, Espirómetro MIR, Alcoholímetros, Oxímetros, Telemetría ECG, Electroencefalógrafos, Electromiógrafos, Cables y Sensores, Chupas y Clamps

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
03	AGOSTO	2020

REPORTE DE SERVICIO MANTENIMIENTO No. 6784

ENTIDAD: HOSPITAL SANTA CLARA / SAO HANA — UBICACIÓN: BOGOTA
RESPONSABLE: DR VACA — REPORTADO POR:

SOLICITUD DE SERVICIO — DIAGNOSTICO ☐ CONTRATO ☐ PREVENTIVO ☑ GARANTIA ☐ CORRECTIVO ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

EQUIPO PARA MANTENIMIENTO

EQUIPO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ID	HORA
DESFIBRILADOR	MINDRAY	D3	EZ-94018664		

LISTA DE CHEQUEO PARA MANTENIMIENTO

Verificaciones y pruebas de funcionamiento pre-mantenimiento:				Prueba de impresión.	✓
Estado físico externo del equipo.	B	R	M	Verificación de componentes eléctricos	✓
Encendido normal del equipo (Chequeo de LEDs, o pitidos característicos).			✓	Limpieza de los cables a paciente ECG.	✓
Transferencia de datos - Interface equipo medico Pc.			NA	Limpieza externa del equipo.	✓
Toma de mediciones de presión arterial.			NA	Lubricación de Tornillo sinfín para inclinación y rodamientos.	NA
Adquisición de señales ECG usando simulador de paciente.			✓	Verificación de parámetros de simulador: MV ✓ PPM ✓ PA ☐ T ✓ SPO2 ☐	✓
Prueba de teclado.			✓	Verificación de continuidad entre los terminales de los cables a paciente.	✓
Pruebas de velocidad.			NA	Verificación de obstrucciones o fugas en el circuito neumático.	NA
Pruebas de inclinación.			NA	Depuración de errores y/o fallas en el software.	NA
Prueba parada de emergencia.			NA	Pruebas de funcionamiento post-mantenimiento:	
Estado físico interno del equipo.			✓	Encendido normal del equipo (Chequeo de LEDs, o pitidos característicos).	✓
Verificación de errores en el software.			NA	Carga de información de paciente usando comunicación PC-Holter.	NA
Backup de la información.			NA	Muestreo de datos.	✓
Sincronización de la base de datos.			NA	Adquisición de señales ECG usando simulador de paciente.	✓
Verificación de configuraciones del software.			NA	Verificación modo prueba de PA _____	NA
Verificación de espacio suficiente en Disco Duro.			NA	Descarga de la información usando comunicación Holter-PC.	NA
Realización del mantenimiento del equipo:			✓	Prueba de velocidad e inclinación.	NA
Limpieza interna de la carcasa del equipo, contactos, tarjetas electrónicas				Verificación de sensor SpO2 y sensor de temperatura.	NA
Ajuste de conectores y verificación del circuito de alimentación.			✓	Comprobación de funcionamiento normal del Software.	NA
			NA	Asignación de Adhesivo ST. No. 8859	

DESCRIPCION: Se realiza revisión tecnica y funcional limpieza general carcasa cable de paciente, Pilas de adulto y pediatricas se hacen pruebas con simuladores de ECG y ANALizador de descarga de Julios se realizan descarga de 50, 150, 300 Julios y Mostrando traza de ECG y el equipo apto para su uso

SOPORTE TECNICO
GERMAR GMG S.A.S.
NIT. 900.081.215-8


FIRMA INGENIERO


FIRMA CLIENTE

PRUEBA DE DOSIMETRÍA SI ☐ NO ☐

Inf detall Prueba usuario

Nombre dispos		Batería	Normal
Ver. software sistema	03.03.00	Función desfib/marcap	Aprob
Tpo prueba	2020-07-31 11:34:52 AM	Función monitor	Aprob
		Placa princ	Aprob
EZ 94018664		Energía mediante palas	Aprob
		Energía mediante electrodos	Aprob
		Sumin. energía con batería	Aprob
		Prueba controles	Aprob
		Audio	Aprob
		Pantalla	Aprob
		Indicador servicio	
Institución			
Tiempo registro	2020-07-31 11:38:42 AM		

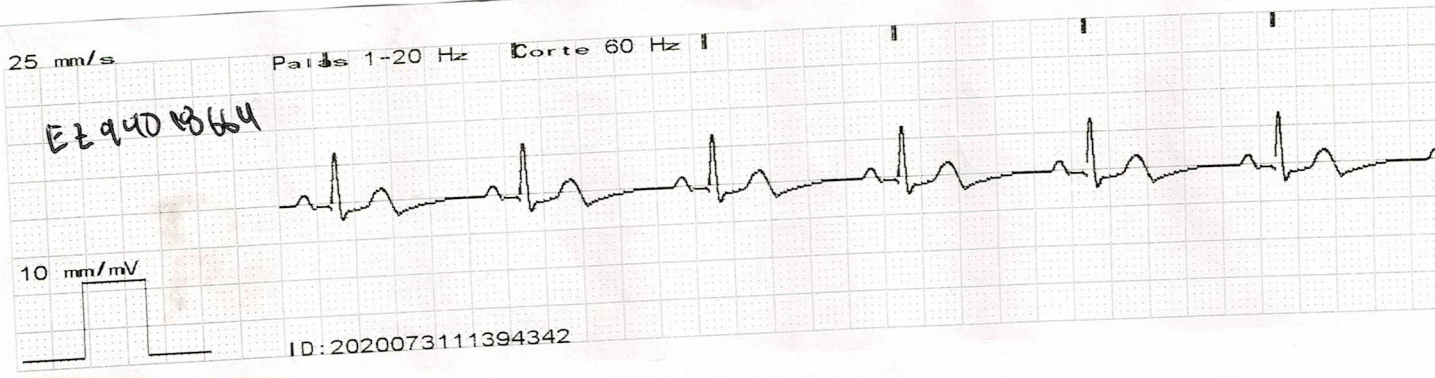

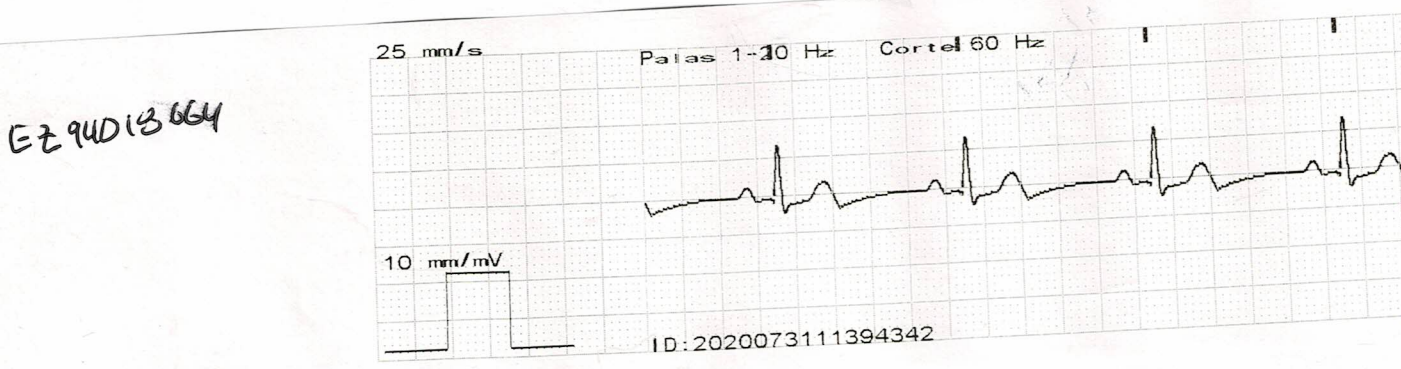

Prueba Prueba superada

