Código: P.CDF.001-R1
Versión: Segunda
Fecha: ABRIL 9 DE 2015

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Fecha Calibración:	**2023-01-26**	**No. Certificad**	**35500**

DATOS CLIENTE:

Nombre: Fundacion Salud
Teléfono: 3112157129
Dirección: Carrera 14B # 1-45 Sur
Ciudad: Bogotá

DATOS DEL EQUIPO BAJO PRUEBA


Equipo: Desfibrilador
Marca: Mindray
Modelo: D3
Serie: EZ-94018664
Placa: 097
Ubicación: Cardiologia
Condición del Equipo: Operativo

DATOS GENERALES

Lugar de Calibración: Hospital Santa Clara
Área de Calibración: Cardiologia
Dirección de Calibración: Carrera 14B # 1-45 Sur
Fecha Recepción: 2023-01-26
Datos de Calibración: Calibración
Actividad Planificada: PA-21-6
Número de Páginas: 3

Los resultados expuestos en este certificado se refieren únicamente del equipo sometido a calibración, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
Este certificado de calibración no podrá ser reproducido parcialmente o en su totalidad, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del laboratorio que lo emite. ALARIS MEDICA S.A.S.
ALARIS MEDICA S.A.S. no se responsabiliza por los perjuicios que pueden derivarse del uso inadecuado de los equipos calibrados.
El certificado de calibración no es válido sin las firmas y el sello de ALARIS MEDICA S.A.S.
El usuario es responsable de repetir la calibración de sus equipos a intervalos de tiempo apropiados.

FIRMAS AUTORIZADAS



Carolina fernandez
Metrologo



Lyda Leon Mateus
Directora Tecnica. Laboratorio de

Fecha Calibración:	**2023-01-26**	**No. Certificado:**	**35500**

Método de calibración

El equipo fue calibrado utilizando el método de comparación con el patrón de referencia, siguiendo el procedimiento ALARIS MEDICA P.CDF.001

Trazabilidad

El laboratorio de metrología de ALARIS MEDICA SAS garantiza la trazabilidad de sus patrones utilizados en estas mediciones hacia patrones Nacionales e Internacionales.

Patrón	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Calibración	Certificado
Analizador de Desfibriladores	*Fluke Biomedical*	*Impulse 4000*	*8920034*	*2022-04-29*	*S6504-22*

Incertidumbre


La incertidumbre de calibración se ha obtenido multiplicando la incertidumbre combinada por la constante dada por los grados efectivos de libertad (k), para que corresponda a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%.

Condiciones Ambientales

Temperatura (°C)	Humedad Relativa (%HR)
19.4	53


RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

PARÁMETRO DE ENERGÍA (Joules)					
Valor de Referencia	Valor Medido	Error	Corrección	Incertidumbre	
50	49.97	-0.03	0.03	±	1.19
100	100.17	0.17	-0.17	±	1.65
150	150.43	0.43	-0.43	±	0.58
200	199.93	-0.07	0.07	±	0.90
300	299.10	-0.90	0.90	±	1.99
360	361.33	1.33	-1.33	±	1.96

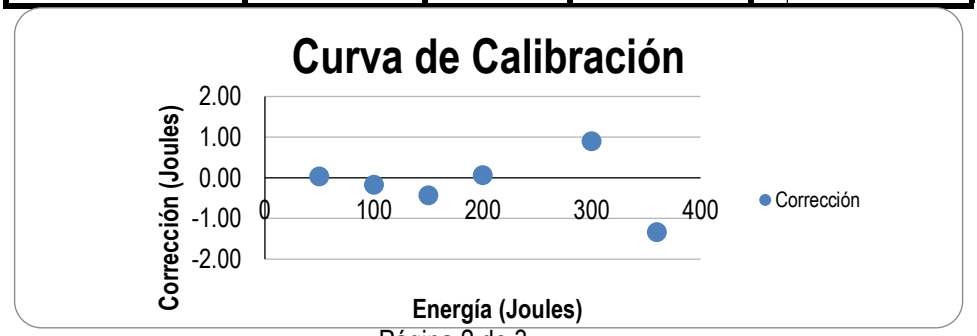

Fecha Calibración: **2023-01-26** **No. Certificado** **35500**

PARÁMETRO DE FRECUENCIA CARDÍACA (BPM)					
Valor de Referencia	Valor Medido	Error	Corrección	Incertidumbre	
30	30.00	0.00	0.00	±	0.58
60	60.00	0.00	0.00	±	0.58
120	120.00	0.00	0.00	±	0.58
240	240.00	0.00	0.00	±	0.58

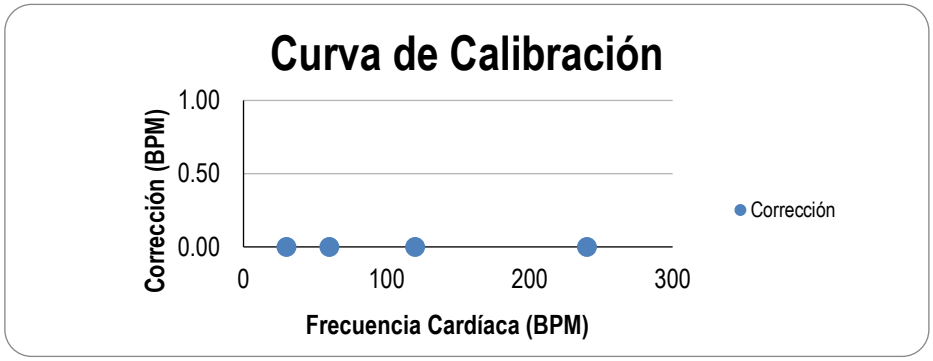

FIN DEL REPORTE