E.S.E. Hospital	GA - Gestión Asistencial * AD - Apoyo Diagnóstico * 714 -SERVICIO FARMACÉUTICO	CÓDIGO	GA.AD.SF-F-005
	CONTROL TEMPERATURA NEVERA	VERSIÓN	02
		CREACIÓN	2020-05-11
		REVISIÓN	2020-06-01


Registrar la temperatura en la mañana y en la tarde en el horario establecido. El registro de la mañana con un color diferente al del registro de la tarde. Verificar semanalmente estado de batería en equipos digitales.

Año: 2023

Dependencia: NEVERA - URG Mes: Julio Mañana: ☐ Tarde: △ Rango: 8 °C - 2 °C


FECHA CAMBIO BATERÍA																															
	CONTROL TEMPERATURA °C - CONGELADOR																														
DATOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LIMITE SUPERIOR	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
REAL (Mañana 8:00 a.m.)																															
REAL (Tarde 2:00 p.m.)																															
LIMITE INFERIOR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
RESPONSABLE MAÑANA																															
RESPONSABLE TARDE																															

Comportamiento Control Temperatura - CONGELADOR

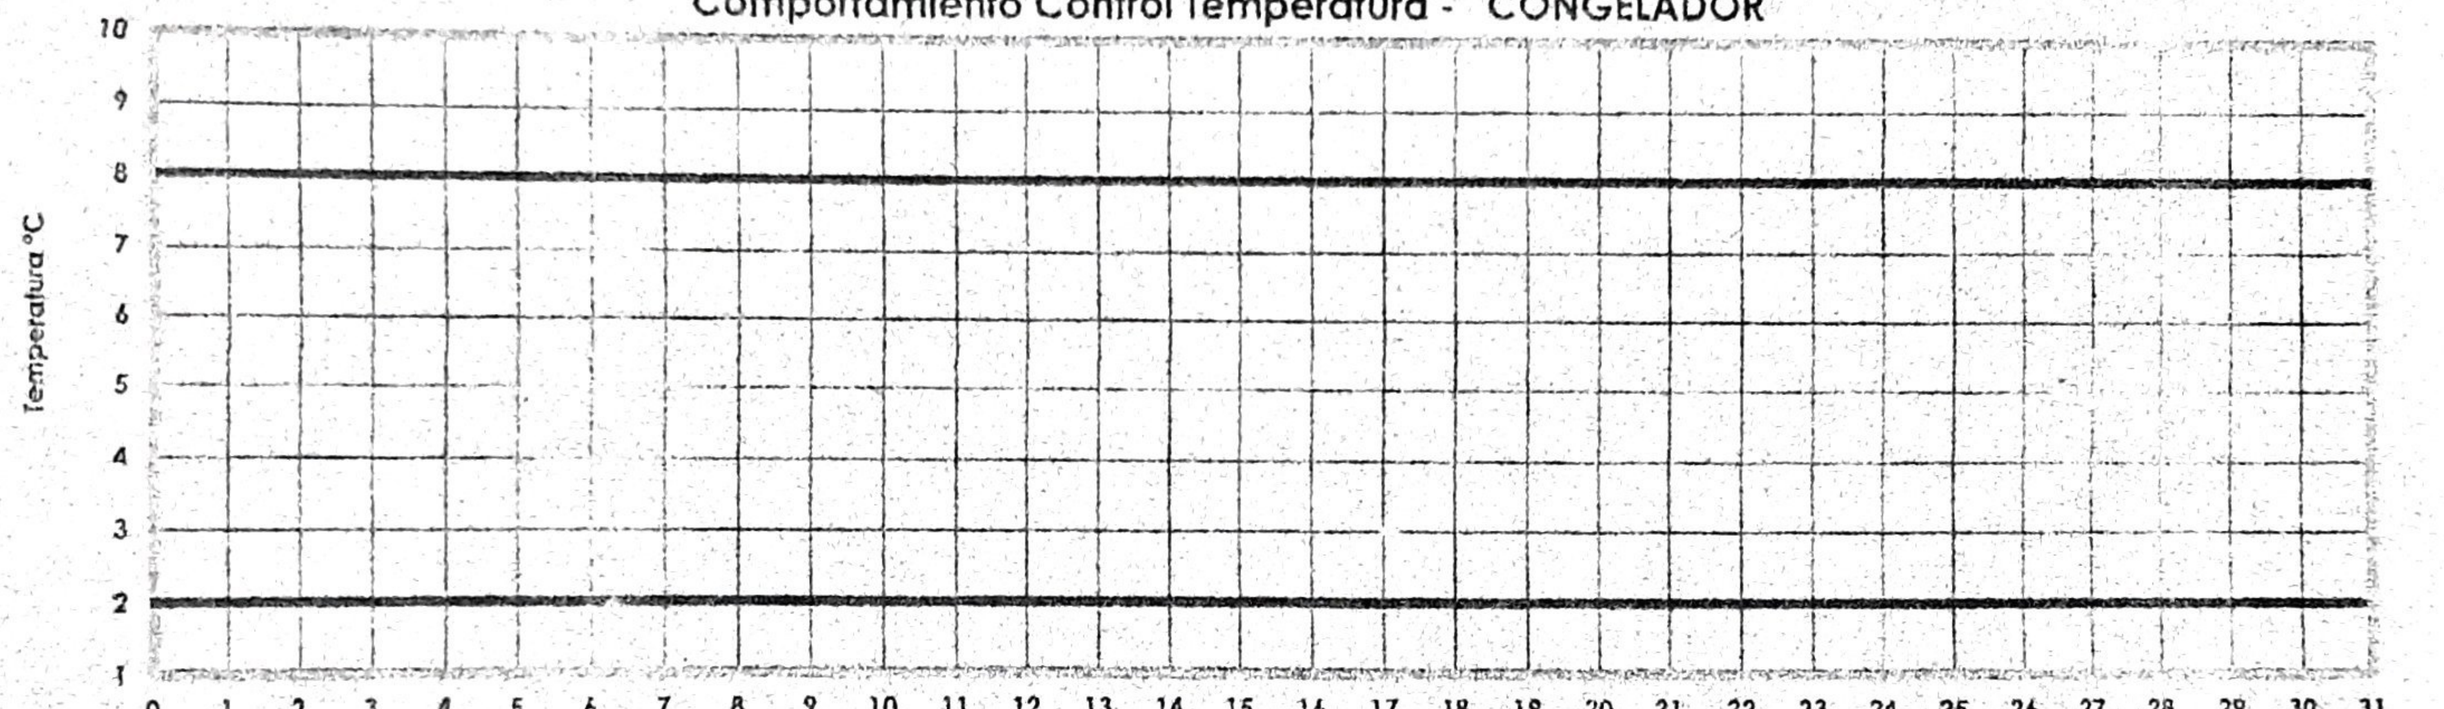

	CONTROL TEMPERATURA °C - REFRIGERADOR																														
DATOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LIMITE SUPERIOR	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
REAL (Mañana 8:00 a.m.)	7,3	7,6	8,0	7,4	7,2	7,0	6,6	6,7	6,3	5,1	6,9	5,2	5,6	6,0	6,0	6,8	5,6	6,1	6,8	7,0											
REAL (Tarde 2:00 p.m.)	8,0	7,8	8,2	7,6	7,3	7,1	6,6	7	6,8	6,2	7,1	5,4	7	6,2	6,3	6,9	6,2	6,4	6,9												
LIMITE INFERIOR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
RESPONSABLE MAÑANA	Lorena P	Lorena P	Jenny C	Kathe	Kathe	Kathe	Kathe	Kathe	Kathe	Lorena	Kathe	Kathe	Lorena	Kathe	Kathe	Kathe	Lorena	Kathe	Kathe	Lorena											
RESPONSABLE TARDE	Lorena P	Lorena P	Jenny C	Kathe	Kathe	Kathe	Kathe	Kathe	Kathe	Lorena	Kathe	Kathe	Lorena	Kathe	Kathe	Kathe	Lorena	Kathe	Kathe	Lorena											

Comportamiento Control Temperatura - REFRIGERADOR

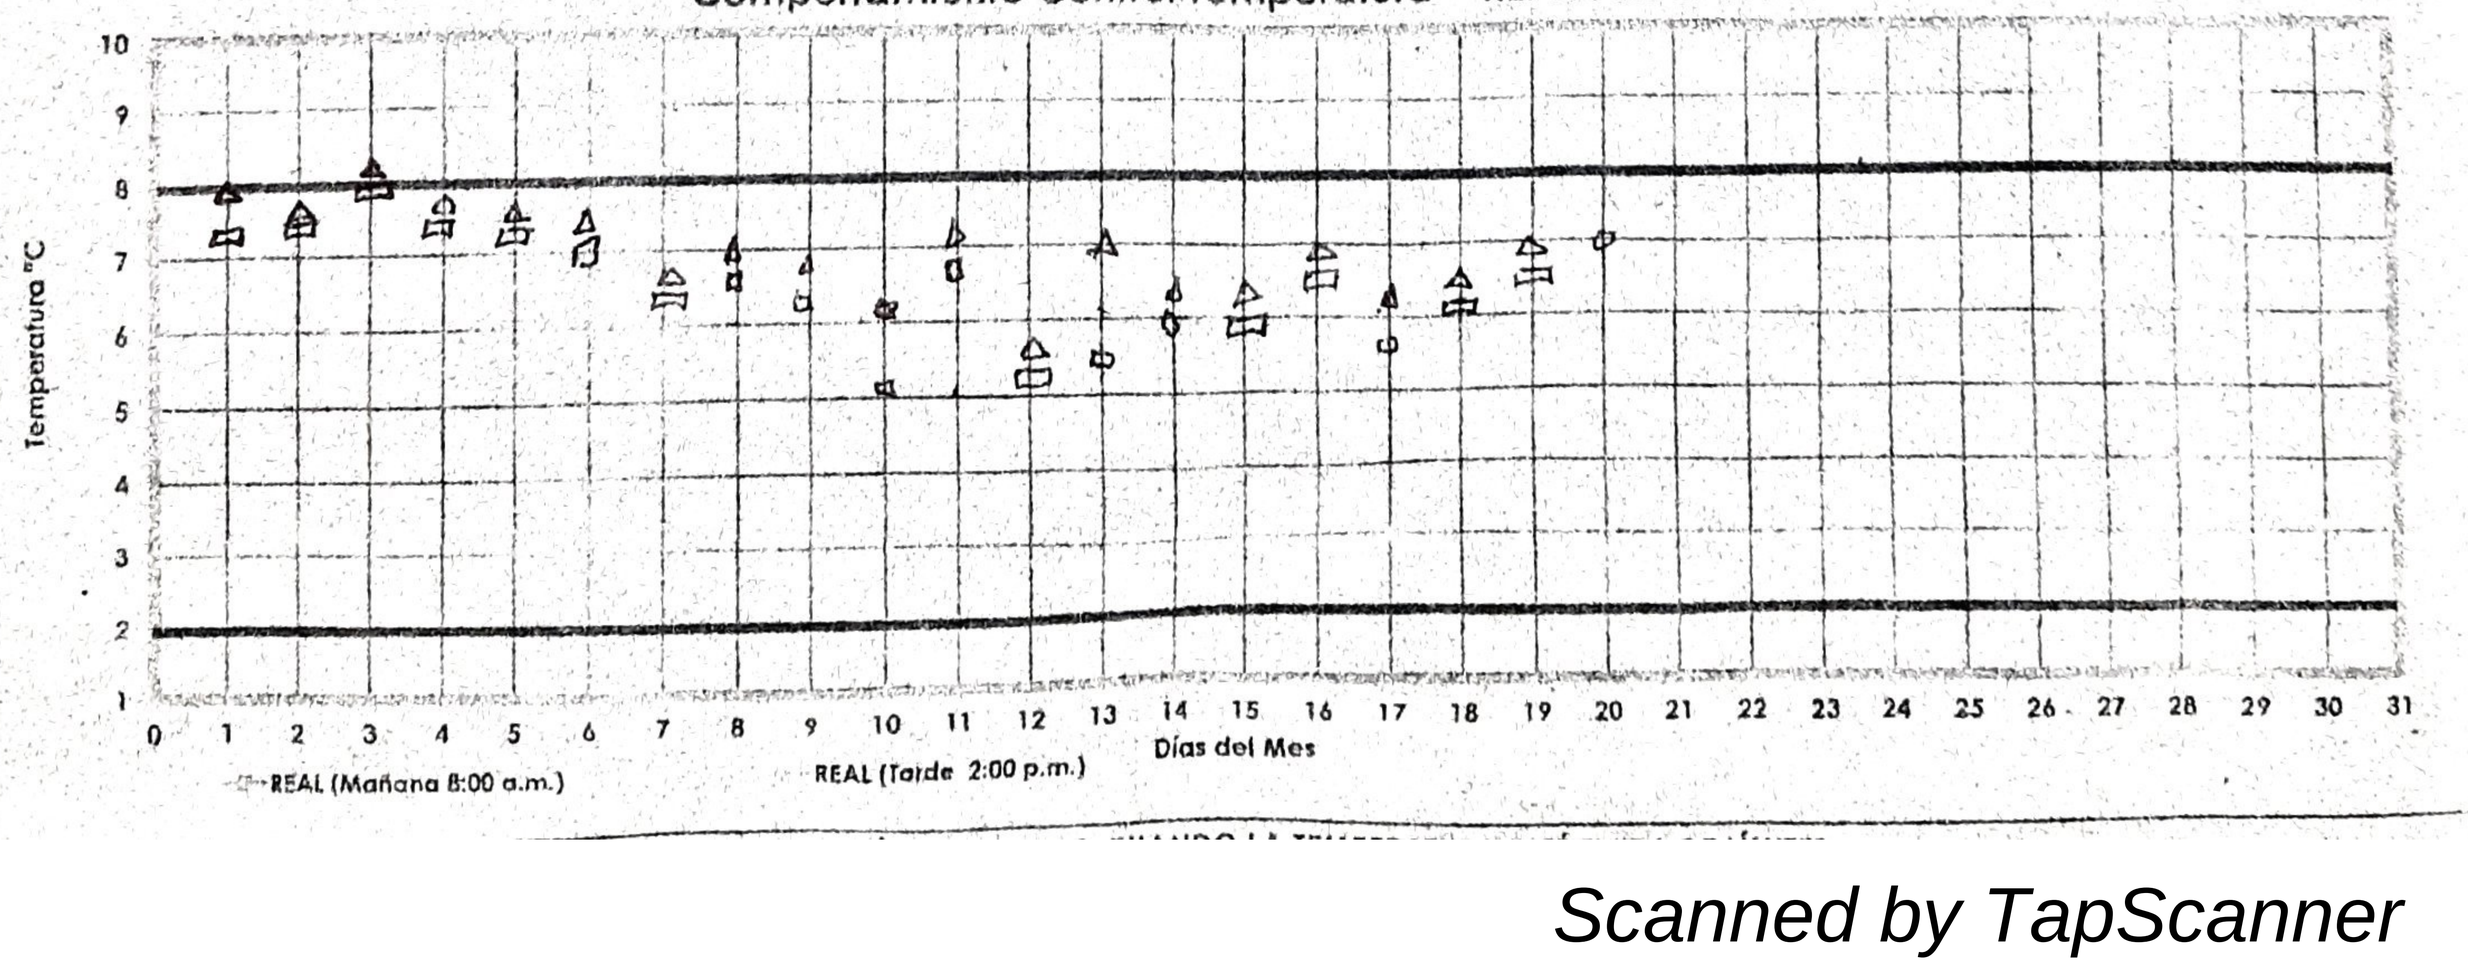

Scanned by TapScanner

ESE.HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
LISTA DE VERIFICACION DIARIA DE CARRO DE PARO DE URGENCIAS

MES Julio

DIAS		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31	
INSUMOS	CANTIDAD/ ESTADO	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N
CARRO DE PARO	ABIERTO O CERRADO	Cerrado		Cerrado		Cerrado		Cerrado		Abierto		Cerrado		Cerrado		Cerrado		Cerrado		Cerrado		Cerrado		Cerrado		Abierto		Cerrado		Abierto		Cerrado		Cerrado		Cerrado																																	
No. de CANDADO	REGISTRAR EL NUMERO	16826071		16826071		16826071		16826079		16826080		16826060		16826080		16826080		16826080		16826080		16826080		16826083		16826085		16826085		16826086		16826086		16826087		16826087		16826088																											
BALA DE OXIGENO	SI HAY O NO	SI		SI		SI		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI																											
DESFIBRILADOR	BUENO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓																											
MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMPLETO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓																											
SUCCIONADOR	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓																											
FERULA ESPINAL CORTA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓																											
PESA ADULTO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓																											
RESPONSABLE		Lorena P		Lorena P		Lorena P		Jimmy C		Kathe W		Kathe W		Kathe W		Kathe W		Lorena P		Kathe W		Kathe W		Kathe W		Lorena P		Kathe W		Lorena P		Kathe W		Kathe W		Kathe W																											

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
CARRO DE PARO: Colocar abierto o cerrado según corresponda
No. de Candado: Numero completo del candado del carro de paro
Bomba de Infusion: indicar el estado bueno o malo
Desfibrilador: Si la descarga fue exitosa colocar F Si es fallida colocar NF y reportar inmediatamente
Linea de comunicación: Funcionando (F) No Funcionando (NF)

Scanned by TapScanner

MES: Julio

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
LISTA DE VERIFICACION DIARIA DEL KIT OBSTETRICO

DIAS / INSUMOS	CANTIDAD/ ESTADO	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31	
		D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N
AMPICILINA + SULBACTAN	4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																						
SULFATO DE MAGNESIO	20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																						
BETAMETASONA	6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																						
LABETALOL	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																						
OXITOCINA	15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																						
NIFEDIPINO DE 10 MG	15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																						
NIFEDIPINO DE 30 MG	10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																						
ROXICAINA JALEA	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																						
METHERGIN	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																						
LACTATO DE RINGER	10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																						
SOLUCION SALINA 0.9 %	10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																						
MISOPROSTOL	1 CAJA	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																						
DOPAMINA	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																						
HUMIDIFFICADOR	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																						
CONDON	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																						
CATETER # 18	6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																						
CATETER # 16	6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																						
CATETER # 14	3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																						
KIT VENTURY ADULTO	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																						
SONDA NELATON 14 FR	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																						
SONDA FOLEY 16 FR	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																						
BOLSA RECOLECTORA DE ORINA	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																						
GUANTES ESTERILES # 7	3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																						
GUANTES ESTERILES # 7 1/2	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																						
EQUIPO MACROGOTEO	6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																						
EQUIPO MICROGOTEO	6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																						
CANULA NASAL	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																						
KIT ULTRACITOLOGICO	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																						
TUBOS LILA	3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																						
TUBOS SECOS	3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																						
JERINGA 50 ML	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																						
JERINGA 10 ML	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																						
JERINGA 5ML	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																						
RESPONSABLE		Lorena P	Lorena P	Lorena P	Lorena P	Jimmy C	Kathe W	Kathe W	Kathe W	Kathe W	Lorena P	[signature]	Kathe	Kathe W	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	Lorena P	Lorena P	Kathe	Lorena P	Kathe	[signature]	Lorena P	[signature]	[signature]	Lorena P	Kathe	Kate	Kate	Lorena P	Lorena P	Kathe	Kath	Kathe	Kathe	Lorena P	Lorena P																								

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMENTO
CARRO DE PARO: Colocar abierto o cerrado según corresponda
No. de Candado: Número completo del candado del carro de paro
Bomba de Infusión: indicar el estado, bueno o malo
Disponibilidad de la dotación: fue utilizado colocar / O si es faltante colocar NF y reportar inmediatamente
Equipo de comunicación: Funcionando (F) No Funcionando (NF)

Scanned by TapScanner

E.S.E. Hospital	GA - Gestión Asistencial * AD - Apoyo Diagnóstico * 714 -SERVICIO FARMACÉUTICO	CÓDIGO	GA-AD-SF-F-007
	CONTROL TEMPERATURA AMBIENTE	VERSIÓN	02
		CREACIÓN	2020-05-11
		REVISIÓN	2020-06-01


Registrar la temperatura en la mañana y en la tarde en el horario establecido. El registro de la mañana con un color diferente al del registro de la tarde. Verificar semanalmente estado de batería en equipos digitales.

Año: 2023

Dependencia: CARRO DE PARO Mes: Julio Mañana: ▭ Tarde: ▲ Rango: 5 °C - 28 °C

FECHA CAMBIO BATERÍA																														
	CONTROL TEMPERATURA AMBIENTE °C																													
DATOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LIMITE SUPERIOR °C	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
REAL (Mañana 8:00 a.m.)	17,5	18	19,2	20	20,2	20,0	19,9	20,2	19	20	20	19,9	19,9	19	19,9	19,9	20	20	20	19											
REAL (Tarde 2:00 p.m.)	18	19	20	21	21	21,9	20	21	21	22	21	20	20	21	20	20	21	21	21	21											
LIMITE INFERIOR	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
RESPONSABLE MAÑANA	Lorena P	Lorena P	Jimy C	Katlew	Katlew	[illegible]	Katlew	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Katlin	[illegible]	[illegible]	Katlin	Katlin	[illegible]	Katlin	Katlin	[illegible]											
RESPONSABLE TARDE	Lorena P	Lorena P	Jimy C	Katlew	Katlew	[illegible]	Katlew	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Katlin	[illegible]	[illegible]	Katlin	Katlin	[illegible]	Katlin	Katlin	[illegible]											

Comportamiento Temperatura Ambiente

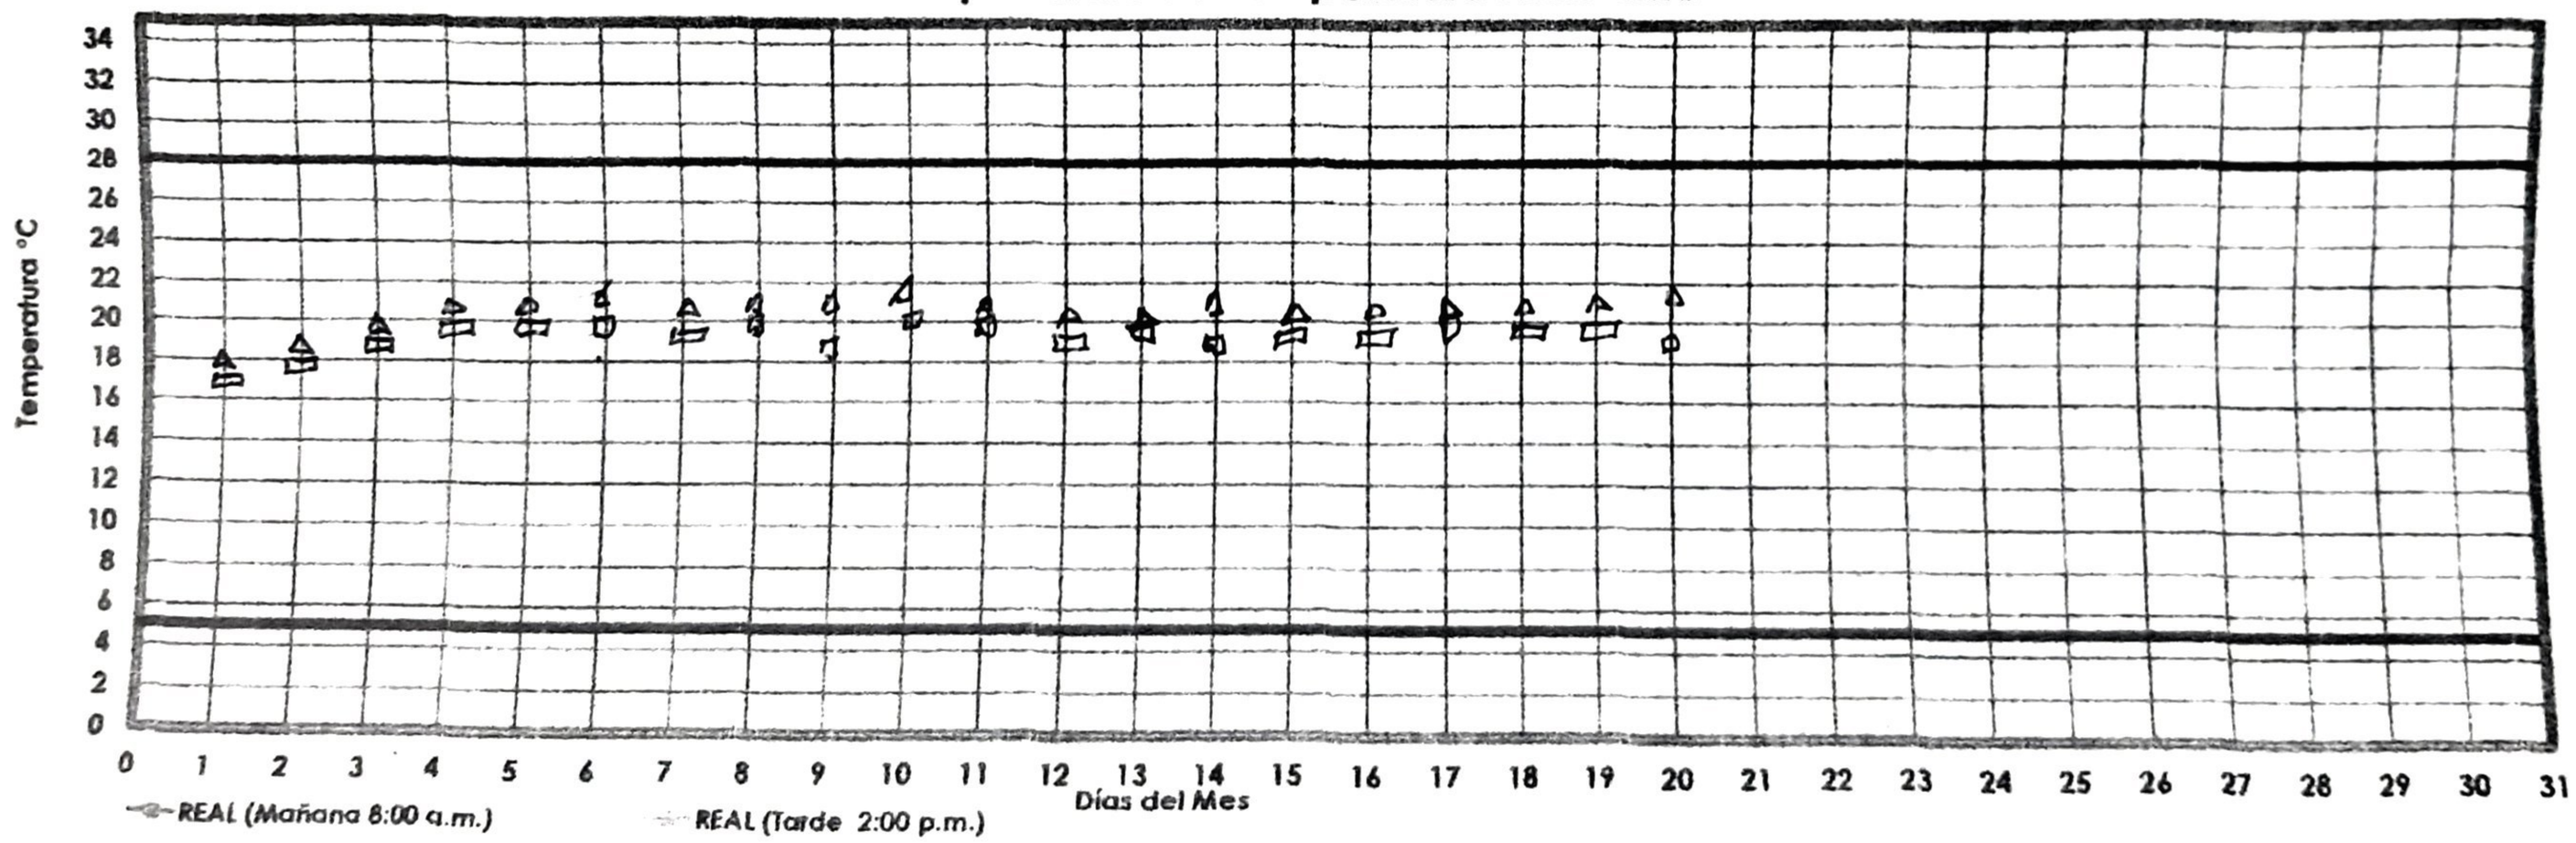

PLAN DE ACCIÓN GENERADO CUANDO LA TEMPERATURA ESTÉ FUERA DE LÍMITES

Scanned by TapScanner

E.S.E. Hospital

GA - Gestión Asistencial * AD - Apoyo Diagnóstico * TH SERVICIO FARMACÉUTICO

CONTROL HUMEDAD AMBIENTE


CÓDIGO	GA-AD-SF-F-008
VERSIÓN	02
CREACIÓN	2020-06-11
REVISIÓN	2020-06-01

Registrar la Humedad en la mañana y en la tarde en el horario establecido. El registro de la mañana con un color diferente al del registro de la tarde. Verificar semanalmente estado de batería en equipos digitales.

Dependencia: CARRO DE PARO Mes: Julio Mañana: ■ Tarde: ▲ Año: 2023 Rango: 45% 70%

FECHA CAMBIO BATERÍA																															
	CONTROL DE HUMEDAD AMBIENTE																														
DATOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LIMITE SUPERIOR °C	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
REAL (Mañana 8:00 a.m.)	51	54	59	69	63	62	60	61	66	64	58	57	60	67	61	63	66	62	59	60											
REAL (Tarde 2:00 p.m.)	53	56	60	70	65	65	62	63	62	67	59	60	55	65	65	65		65	62	64											
LIMITE INFERIOR	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%
RESPONSABLE MAÑANA	Lorena P	Lorena P	Lorena P	Kathe	Kathe	Kathe	Kathe	Kathe	Kathe	Kathe	Kathe	Kathe	Kathe	Kathe	Kathe	Kathe	Kathe	Kathe	Kathe	Lorena P											
RESPONSABLE TARDE	Lorena P	Lorena P	Lorena P	Kathe	Kathe	Kathe	Kathe	Kathe	Kathe	Kathe	Kathe	Kathe	Kathe	Kathe	Kathe	Kathe	Kathe	Kathe	Kathe	Lorena P											

Comportamiento Control Humedad Ambiente

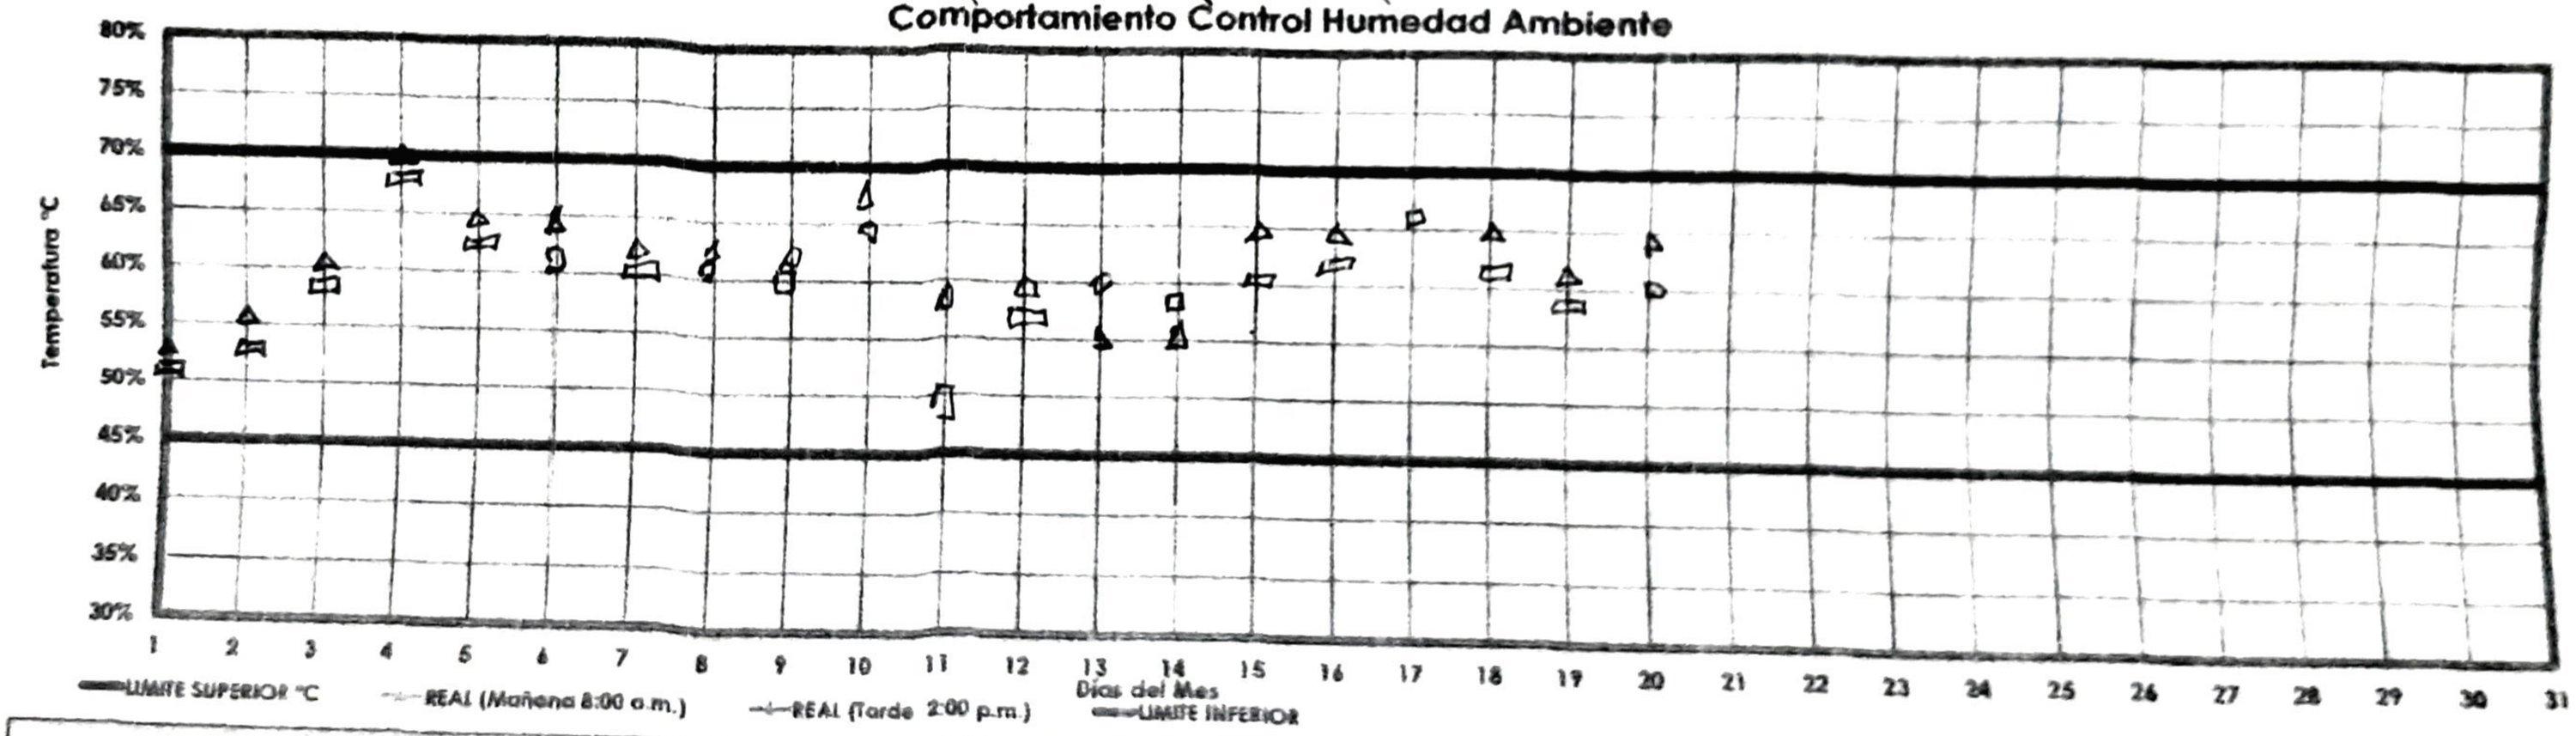

PLAN DE ACCIÓN GENERADO CUANDO LA HUMEDAD ESTÉ FUERA DE LÍMITES

Scanned by TapScanner