ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-35303-TM

Fecha: 2023-06-06

Generó: Luz Maryory Artunduaga Penagos

Responsable: Roberto Mario Sierra Castro

Duración estimada: 00:30:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS Equipo funciona correctamente

ACTIVO ELECTROBISTURI { ELTB-007 } WEM HF-120 9768

Ubicado en ó es Parte de:	// CLINICA OFTALMOLOGICA DE SUCRE/ CIRUGIA/ QUIROFANO/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	ELTB-007	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:	IIB	**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:	Alta		

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2022-09-05	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2023-06-06 11:00
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2023-06-06 11:20
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:30:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 4 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:20:14
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	02:00:00
CLASIFICACIÓN 2:			

RECURSOS A UTILIZAR

Descripción	Cantidad	Costo	Cantidad Usada	Tipo	Fuente
INGENIERO DE SOPORTE TÉCNICO	1	---	1	Recursos Humanos	Roberto Mario Sierra Castro

PROCEDIMIENTO

1		SE REALIZA INSPECCION FISICA	☑ Si ☐ No ☐ N/A


Todos los derechos reservados

2		LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
3		LIMPIEZA SISTEMA ELECTRONICO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
4		VERIFICACION DE CONEXIÓN DE PLACA, LAPIZ	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
5		VERIFICACION DE PEDALES	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
6		VERIFICACION DE DISPLAY	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
7		VERIFICACION DE TECLADO	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
8		VERIFICACION DE CORTE 30W	28
9		VERIFICACION DE CORTE 70W	67
10		VERIFICACION DE CORTE 100W	97
11		VERIFICACION DE COAGULACION 30W	27
12		VERIFICACION DE COAGULACION 70W	66
13		VERIFICACION DE COAGULACION 100W	96
14		PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
15		OBSERVACION	Equipo funciona correctamente




Adriana puerta

ACEPTADO POR



Jorge Mario Galvis Arbelaez

VALIDADO POR

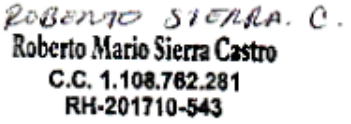

Roberto Mario Sierra Castro

REALIZADO POR

 Todos los derechos reservados