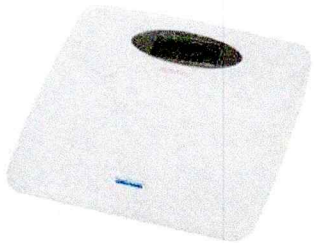
	ESE HOSPITAL SAN ISIDRO NIT: 800 025 221-1 ALPUJARRA-TOLIMA DIRECCION:Carrera 5 No.5-43 TEL.3212011134 HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS	CODIGO H17 VERSION 4 PAG 1-3

Nombre del equipo:	BASCULA DE PISO
#. de activo fijo:	
Marca:	HEALTH O METER
Modelo:	844KL
Serie:	8440134085
Invima:	**2013DM-0010061**



DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

Instrumento de pesaje de funcionamiento automático que utilizan la acción de la gravedad para determinación de la masa. Consiste en una plataforma de vidrio templado como soporte para el pesaje de pacientes, posee una pantalla LCD para la visualización del peso medio.

PARTES O ELEMENTOS DEL EQUIPO	REFERENCIA	ACCESORIOS
----	----	----
----	----	----
----	----	----

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS DEL EQUIPO

Voltaje Operación [V]	6	Peso [Kg]	----				
Voltaje máx. Operación [V]	6	Capacidad	0-180 kg				
Corriente máx. operación [A]	-----	Dimensiones	----				
Corriente min. operación [A]	-----	Años de vida del Equipo	5				
Potencia Consumida [W]	-----	Requiere Agua	SI	-	NO	X	
Frecuencia [Hz]	----	Requiere Gas Propano	SI	-	NO	X	
Presión [Bar]	-----	Requiere Combustible	SI	-	NO	X	
Velocidad [W]	----	Requiere Gases medicinales					

INFORMACIÓN DE ADQUISIÓN E INSTALACIÓN

Fabricante	HEALTH O METER	Forma de adquisición	COMPRA DIRECTA
Teléfono	1 708 377 0600	Costo de Adquisición	$443.522,66
Dirección	9500WEST 55 TH STREET MCCOOK, IL 60525	Fecha de compra	8/06/2023
Lugar de Origen	NO REGISTRA	Fecha de Instalación	NO REGISTRA
Proveedor	FLEMING BIOMEDICA	Inicio Garantía	NO REGISTRA
Teléfono	871 5629	Finalización Garantía	NO REGISTRA
Dirección	Calle 9 No. 15 - 36,	Fecha de puesta en servicio	NO REGISTRA
Email	flemingbiomedicasas@gmail.com		

	ESE HOSPITAL SAN ISIDRO NIT: 800 025 221-1 ALPUJARRA-TOLIMA DIRECCION:Carrera 5 No.5-43 TEL.3212011134 HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS	CODIGO H17 VERSION 4 PAG 2 - 3

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
BASCULA DE PISO	HEALTH O METER	844KL	8440134085

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

1. No utilice líquidos volátiles, como disolventes o bencina, debido a que provocarán que los materiales se fundan o se
2. No derramar liquidos sobre el equipo para evitar cortos del sistema eléctrico interno
3. verificar baterias antes de usar.
4. Revisar que la plataforma se encuentre estable para mayor seguridad del usuario.
5. ----------
6. ----------
7. ----------

CLASIFICACIÓN DE DISPOSITIVO MÉDICO(RIESGO)								UBICACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO:
I	X	IIA	-	IIB	-	III	-	ALMACEN

MANUALES TÉCNICOS		PLANOS	
Operación	----	Eléctricos	----
Mantenimiento	X	Electrónicos	----
Partes	----	Hidráulicos	----
Despieces	----	Neumáticos	----
		Mecánicos	----

CLASIFICACIÓN POR USO		
	Médico	X
	Básico	-
	Apoyo	-

TECNOLOGÍA PREDOMÍNATE		CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	
Eléctrico	-	Diagnóstico	X
Electrónico	X	Tratamiento Y Mantenimiento de la vida	-
Mecánico	-	Rehabilitación	-
Electromecánico	-	Prevención	-
Hidráulico	-	Análisis Laboratorio	-
Neumático	-	Mantenimiento	-
Vapor	-		
Solar	-		

CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA			
TIPO	-	CLASE	-

CALIBRACIÓN					MANTENIMIENTO	
Requiere Calibración			SI		TIPO:	
Variables susceptibles a calibración	Presión	-	Tiempo	-	PREVENTIVO	Semestralmente orientado al riesgo
	Temperatura	-	Co2	-		
	Volumen	-	Co	-		
	Impedancia	-	RPM	-		
	Marcapasos	-	Humedad	-	CORRECTIVO	Por llamado
	Respiración	-	flujo	-		
	G. Cardiáco	-	Fc	-		
	Ibp	-	Ecg	-		
	Energía	-	Spo2	-		
	Nibp	-	Peso	X		

PERIODICIDAD DE CALIBRACIÓN DEFINIDA		SEGÚN PLAN DE ASEGURAMIENTO METROLÓGICO

Condiciones de Recepción de Equipo	Nuevo	Usado	Repotenciado	RESPONSABLE DEL EQUIPO
	X	-	-	

	ESE HOSPITAL SAN ISIDRO NIT: 800 025 221-1 ALPUJARRA-TOLIMA DIRECCION:Carrera 5 No.5-43 TEL.3212011134 HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS	CODIGO H17 VERSION 4 PAG 3 - 3

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
BASCULA DE PISO	HEALTH O METER	844KL	8440134085

RUTINA DE MANTENIMIENTO
ACTIVIDADES
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.
Verificar que el equipo se encuentra funcionando correctamente
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo
Inspeccionar los componentes electrónicos
Verificacion de soporte que se encuentre estable y seguro.
Verificación de pantalla LCD

FECHA	No. INFORME	TIPO DE MANTENIMIENTO	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO

	ESE HOSPITAL SAN ISIDRO NIT: 800.025.221-1 ALPUJARRA - TOLIMA	CODIGO	HD-D-17
		VERSION	3
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS MEDICOS		

REGISTRO HISTORICO DE MANTENIMIENTO

FECHA	No. INFORME	TIPO DE MTTO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
20/9/23	AL-2092023	instalacion	ver inform	[illegible]

REPORTE DE SERVICIO No AL-26092096

NIT. 830.130.882-8

FLEMING BIOMEDICA S.A.S.
INGENIERIA BIOMEDICA
NIT: 830.130.882-8

1. Clasificación del servicio

1.1 tipo de servicio				1.2 carácter				
Preventivo [X]	Correctivo [ ]	Instalación [ ]	Capacitación [ ]	Garantía [ ]	Contrato [X]	Factura [ ]	Otro [ ]	

Ingeniero / Técnico	Ciudad/Municipio	Fecha (Día/Mes/Año)
ALEX CAMILO OVIEDO CLAROS	ALPUJARRA-TOLIMA	20/09/2023

2. Datos del cliente

Nombre del Cliente: ESE HOSPITAL SAN ISIDRO ALPUJARRA	Teléfono: 6088389027
Funcionario / Contacto	Cargo

3. Datos del equipo

Nombre del Equipo: BASCULA		No. De Contrato:	Inventario: N/R
Ubicación: ALMACEN	Marca: HEALTH O METER	Modelo: 844KL	Serie: 8440134085

4. Descripción del servicio

4.1. Falla Reportada y/o detectada: *INSTALACION DE EQUIPOS NUEVOS.*

4.2. Acción correctiva o procedimiento realizado: [✓]

[X] Revisión inicial del equipo	[ ] Pruebas neumáticas	[ ] Limpieza externa e interna de componentes y ajustes de conectores
[X] Mantenimiento de acuerdo con el protocolo	[ ] Pruebas hidráulicas	[ ] Pruebas finales de todas las funciones del equipo
[ ] Revisión y mantenimiento sistema eléctrico	[ ] Validación y configuración software	[ ] Validación y puesta en marcha del equipo
[ ] Revisión y mantenimiento sistema mecánico	[ ] Revisión y funcionamiento del sistema U.S.	[X] El equipo queda trabajando bien
[ ] Revisión y mantenimiento sistema electrónico	[ ] Revisión de accesorios	[ ] Acciones correctivas / ver observaciones

Descripción de la Intervención: *SE REALIZA INSTALACION DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS, DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS.*

5. Cambio o instalación de partes: SI: [ ] NO: [X]

Partes Requeridas

Cantidad	Descripción	No. de Parte	No. de Serie
----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------

6. Observaciones: *SE REALIZA ENTREGA E INSTALACION DE LOS EQUIPOS NUEVOS EN GARANTIA CON SUS RESPECTIVOS DOCUENTOS, MANUALES Y ACESORISOS, SEGÚN CONTRATO.*

7. Estatus del Servicio: Concluido [X] En proceso [ ] Equipo fuera de servicio [ ] Otro: _____

8. Calificación del Servicio: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Hora de Llegada: [ ] [ ]

Ingeniero/Técnico:
Firma
Nombre (En letra legible):
ALEX OVIEDO

Fecha y Hora de Salida: [ ] [ ] [ ]

Cliente:
Firma
Nombre (En letra legible):

Solución Global en Tecnología Hospitalaria

NEIVA CLL. 9N° 15-36 Telefax: 8715629-8711585
Cels.: 312 478 1505 - 310 298 6222
Frente al Hospital Universitario

BOGOTÁ CLL. 24C No. 70-25
Torre 2 Of. 202 Cels: 3202655657 - 3132845366

EJE CAFETERO: Cel: 3232304601
CALI: Cel: 3222173674

BUCARAMANGA: Cel: 3143105953
BARRANQUILLA: Cel: 3214863668

www.flemingbiomedica.com E-mail: soporte@flemingbiomedica.com

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CERTIFICADO N° RV202309-3720
CERTIFICATE N°

Respaldo Vital
Metrología Biomédica
NIT. 900.582.168 - 1 S.a.s

INFORMACIÓN GENERAL
GENERAL INFORMATION

SOLICITANTE: *CONSTUMER:*	E.S.E HOSPITAL SAN ISIDRO	**DIRECCIÓN:** *ADDRESS:*	CARRERA 5 # 5A-43
NIT: *NIT:*	800025221-1	**TELEFONO:** *PHONE:*	3212011134
DESCRIPCION DEL EQUIPO: *EQUIPMENT DESCRIPTION:*	BASCULA	**FABRICANTE:** *MANUFACTURER:*	HEALTH O METER
SERIE: *SERIAL Nº.*	8440134085	**MODELO:** *MODEL:*	844KL
ACTIVO FIJO: *FIXED ASSETS:*	NO REGISTRA	**DEPENDENCIA:** *DEPENDENCE:*	ALMACEN
LUGAR DE CALIBRACIÓN: *CALIBRATION PLACE:*	ALMACEN	**FECHA DE INGRESO:** *INGRESS DATE:*	2023-09-21
FECHA DE CALIBRACIÓN: *CALIBRATION DATE:*	2023-09-21	**FECHA DE EMISIÓN:** *ISSUANCE DATE:*	2023-09-21
NÚMERO DE PÁGINAS: *NUMBER OF PAGES:*	3	**INCLUYENDO ANEXOS:** *INCLUDING ANNEXES:*	0

MÉTODO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION METHOD

El procedimiento aplicado por RESPALDO VITAL S.A.S asegura la toma de datos y el cálculo de resultados mediante el procedimiento interno MET-P-008. El valor convencional de medición es determinado usando el método de comparación directa con un patrón de referencia. *The procedure applied by RESPALDO VITAL S.A.S ensures data collection and results calculation through the internal procedure MET-P-008 . Conventional measurement value is determined by the direct comparison method with a reference pattern.*

TRAZABILIDAD METROLÓGICA
METROLOGICAL TRACEABILITY

EQUIPO PATRON *PATTERN EQUIPMENT*	FABRICANTE *MANUFACTURER*	MODELO *MODEL*	N° INVENTARIO *SERIAL*	FECHA DE CALIBRACION *CALIBRATION DATE*	CERTIFICADO Nº *CERTIFICATE N*
MASA PATRON 5KG (2)	SB LTDA	PARALELEPIPEDO RECTANGULAR	CLB033, CLB034, CLB035	9/11/2021 - 21/04/2021	M-6764, M-5914
MASA PATRON 10 KG (3)	SB LTDA	PARALELEPIPEDO RECTANGULAR	CLB033, CLB034, CLB035	9/11/2021 - 21/04/2021	M-6764, M-5914
MASA PATRON 20 KG (9)	SB LTDA	PARALELEPÍPEDO	CLB036, CLB037, CLB038, CLB039, CLB040, CLB041, CLB042, CLB043, CLB044	9/11/2021, 25/03/2022, 25/03/2022, 21/04/2021, 21/04/2021, 21/04/2021, 21/04/2021	7187, M-6765, M-5909, M-5912,M-5911, M-5913, M-5910

CONDICIONES AMBIENTALES

TEMPERATURA INICIAL: *INITIAL TEMPERATURE:*	21,4	°C	**TEMPERATURA FINAL:** *FINAL TEMPERATURE:*	22,4	°C
HUMEDAD REL INICIAL: *INITIAL RELATIVE HUMIDITY:*	55	%HR	**HUMEDAD REL FINAL:** *FINAL RELATIVE HUMIDITY:*	56	%HR

INCERTIDUMBRE:
UNCERTAINTY:

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura de **k** y la probabilidad de cobertura de aproximadamente 95%. La regla de decisión aplicada en estos casos será |Error| +U ≤ EMP según la Guia ISO/IEC 98-4 Aplicando la declaracion Binaria con zona de seguridad ,si cumple la anterior condición la medición se toma como conforme y registrará un pasa, en caso contrario se registrá falla. La probabilidad de dar una aceptación falsa o un rechazo falso no lo determina el laboratorio RESPALDO VITAL S.A.S, sin embargo se puede calcular de acuerdo a la guia ISO/IEC 98-4. *The reported expanded measurement uncertainty is stated as the standard measurement uncertainty multiplied by the coverage factor of k and the coverage probability of approximately 95%. The decision rule applied in these cases will be |Error| +U ≤ EMP according to the ISO/IEC Guide 98-4 Applying the Binary declaration with security zone, if the previous condition is met, the measurement is taken as compliant and will register a pass, otherwise a failure will be registered. The probability of giving a false acceptance or a false rejection is not determined by the RESPALDO VITAL S.A.S laboratory, however it can be calculated accordingly according to the ISO/IEC 98-4 guide.*

Firma Autorizadas
Autorizad Signature

María Alejandra Rivera
Coordinador de Metrologia
RESPALDO VITAL S.A.S
Revisado y Aprobado

Cel. 3146559513
coordlaboratorio@respaldovital.com.co
respaldovitalsas@gmail.com
www.respaldovital.com.co
Cll. 9 N°15-36 Local 1 /Br Altico, Neiva - Colombia

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CERTIFICADO N° RV202309-3720
CERTIFICATE N°

Respaldo Vital Metrología Biomédica S.a.S
NIT. 900.582.168 - 1


RESULTADOS DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION RESULTS

Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al equipo, momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.RESPALDO VITAL S.A.S., no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los equipos calibrados.RESPALDO VITAL S.A.S declara que sus mediciones son trazables metrológicamente empleando patrones calibrados por medio de aboratorios competentes acreditados conforme a la Norma ISO/IEC 17025. *The results contained in this report relate to the equipment, time and conditions under which measurements were made .RESPALDO VITAL S.A.S. , not responsabiliza for damages that may result from improper use of the equipment calibrated. RESPALDO VITAL S.A.S declares that its measurements are metrologically traceable using standards calibrated by competent laboratories accredited in accordance with ISO/IEC 17025 Standard.*

DESVIACIÓN LINEAL

INTERVALO DE TRABAJO: 0-180 *WORK INTERVAL:* **RESOLUCIÓN:** 0,1 *RESOLUTION:* **INTERVALO DE MEDICIÓN:** 0 - 100 *MEASUREMENT INTERVAL:*


Valor Nominal (Kg)	Valor Promedio (Kg)	Error (Kg)	Incertidumbre Expandida (Kg)		Error máximo permitido (Kg)		Conforme/No conforme
0	0,00	0,00	±	0,06	±	1	Conforme
20	20,00	0,00	±	0,06	±	1,2	Conforme
40	40,00	0,00	±	0,06	±	1,4	Conforme
60	60,00	0,00	±	0,06	±	1,6	Conforme
80	79,90	-0,10	±	0,06	±	1,8	Conforme
100	99,90	-0,10	±	0,06	±	2	Conforme

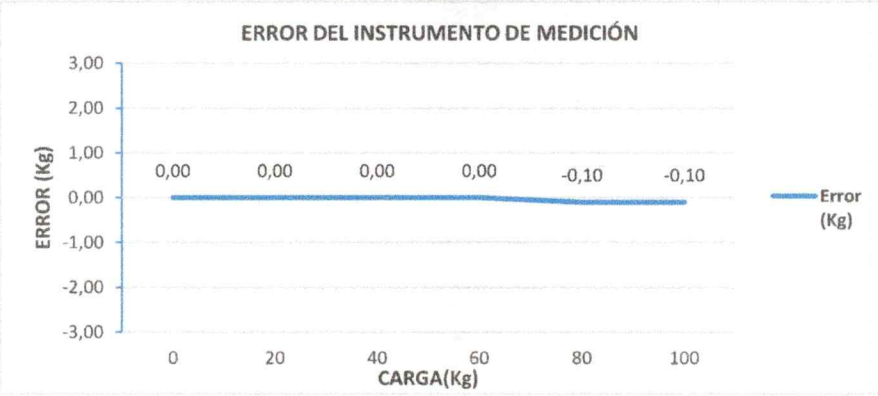


EXCENTRICIDAD

APROX 1/3 DE LA CARGA MAXIMA 35

Punto de referencia	Valor Promedio (Kg)	Error (Kg)
1	35	0
2	34,9	-0,1
3	34,9	-0,1
4	35	0
5	35	0
1	34,9	-0,1





Cel. 3146559513

coordlaboratorio@respaldovital.com.co
respaldovitalsas@gmail.com

www.respaldovital.com.co

Cll. 9 N°15-36 Local 1 /Br Altico, Neiva - Colombia

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CERTIFICADO N° RV202309-3720
CERTIFICATE N°

REPETIBILIDAD

APROX 1/2 DE LA CARGA MÁXIMA	50

Valor Nominal (Kg)	Valor Promedio (Kg)	Error (Kg)
50	50,00	0,00
50	50,00	0,00
50	50,00	0,00
50	50,00	0,00
50	50,00	0,00

OBSERVACIONES
OBSERVATIONS

SIN NOVEDAD

DECLARACIONES
STATEMENT

Este certificado expresa el resultado de las mediciones realizadas. No puede ser reproducido, excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito por RESPALDO VITAL S.A.S. De igual forma este certificado no es valido si se presenta de forma parcial. *This certificate faithfully expresses the result of the measurements carried out. It cannot be reproduced, except when written permission has been obtained by In the RESPALDO VITAL S.A.S. same way, this certificate is not valid if it is presented partially.*

El tratamiento de los datos personales consignados en este documento están protegidos por RESPALDO VITAL S.AS., de conformidad con la Ley 1581 de 2012, garantizado la confidencialidad en el manejo adecuado de la información. *The treatment of the personal data consigned in this document is protected by RESPALDO VITAL S.A.S., in accordance with Law 1581 of 2012, guaranteeing confidentiality in the proper handling of the information.*

«««« FIN DE CERTIFICADO »»»»

«««« END OF CERTIFICATE »»»»

<< Atras

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20063493	Nombre producto	**BALANZAS PESA-PERSONAS Y PESA BEBES, NEONATALES - ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS - BALANZAS PARA PESO CORPORAL EN ADULTOS, PEDIATRICOS Y NEONATO - PELSTAR HEALTH O METER**				
Registro Sanitario	INVIMA 2013DM-0010061	Vencimiento	2023/07/17	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: BALANZAS MÉDICAS DIGITALES (DIGITAL PHYSICIAN SCALES) 349KLX, 499KL, 500KL, 597KL, 597KG, 599KL, 599KG, 600KL, 600KG, 752KL, 752KG, 753KL BALANZAS PEDIÁTRICAS DIGITALES (DIGITAL PEDIATRIC SCALES) 522KL, 524KL, 553KL, 549KL BALANZAS PEDIÁTRICAS MECÁNICAS (MECHANICAL PEDIATRIC SCALES) 386KGS-01, 386S-01. BALANZAS DIGITALES PARA SILLAS DE RUEDAS (DIGITAL WHEELCHAIR SCALES) 2400KL, 2500KL, 2500KG, 2600KL, 2600KG, 2650KL, 2650KG, 2700KL BALANZA DIGITAL TIPO CAMILLA (DIGITAL STRETCHER SCALE) 2000KL. BALANZA DIGITAL DE SILLA DE RUEDA Y ASIENTO PLEGABLE (DIGITAL WHEELCHAIR SCALE AND FLIP SEAT) 2500CKL BALANZAS DIGITALES DE PLATAFORMA (DIGITAL PLATFORM SCALES) 1100KL, 2101KL, 2101KG. BALANZAS DIGITALES TIPO SILLA (DIGITAL CHAIR SCALES) 2595KL, 2595KG, 594KL. BALANZAS MECÁNICAS DE PISO (MECHANICAL FLOOR SCALES) 100KG, 100LB, 142KL, 160KL, 160KG, 160LB, 175LB. BALANZAS DIGITALES DE PISO (DIGITAL FLOOR SCALES) 800KL, 844KL, 822KL. BALANZA DE ESPECIMENES (DIGITAL SPECIMEN/LAPSPONGE SCALE) BALANZAS MECANICA TIPO BARRA (MECHANICAL PHYSICIAN BEAM SCALES) 400KL, 402KL, 402KLWH, 402LB, 402KLWH, 402KG, 450KL, 450KLWH. BALANZAS MECANICA PEDIATRICA TIPO BARRA (MECHANICAL PEDIATRIC BEAM SCALES) 1522KL, 1524KL . BALANZA NEONATAL (NEONATAL SCALE) 2210KL BALANZA PAÑAL (DIAPER SCALE) YG500R. BALANZA MECÁNICA TIPO SILLA (MECHANICAL CHAIR SCALE) 445KL. BALANZA DIGITAL PEDIÁTRICA PORTATIL (PEDIATRIC PORTABLE DIGITAL SCALE) 8320KL. TALLIMETROS (HEIGHT MEASUREMENT) PORTROD, STROD, PROPLUSROD, WMROD, 402KLROD, 499KLROD. CARRITO MEDICO PROFESIONAL (PROFESSIONAL MEDICAL CART) 2210CART. MALETIN DE TRANSPORTE PARA BALANZA 752KG, 64771. KIT DE CONECTIVIDAD. C-HOMWA-1, L-HOMWA-1. 498KL REMOTE DISPLAY DIGITAL PHYSICIAN SCALE - LB/KG 600KL-BT DIGITAL EYE LEVEL SCALE, DIGITAL HEIGHT ROD & AUTOMATIC BMI WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 501KL DIGITAL EYE LEVEL STAND-ON SCALE W/ HEIGHT ROD - LB/KG (POWER ADAPTER NOT INCLUDED) 501KG DIGITAL EYE LEVEL STAND-ON SCALE W/ HEIGHT ROD - KG (POWER ADAPTER NOT INCLUDED) 501KL-BT DIGITAL EYE LEVEL STAND-ON SCALE W/ HEIGHT ROD - LB/KG (POWER ADAPTER NOT INCLUDED) WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 501KG-BT DIGITAL EYE LEVEL STAND-ON SCALE W/ HEIGHT ROD - KG (POWER ADAPTER NOT INCLUDED) WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 550KL INFANT TO TODDLER, 2 IN 1 DIGITAL SCALE 522KG PEDIATRIC DIGITAL SCALE W/ TRAY - KG (POWER ADAPTER NOT INCLUDED) 524KG PEDIATRIC DIGITAL SCALE W/ SEAT - KG (POWER ADAPTER NOT INCLUDED) 549KG PEDIATRIC DIGITAL SCALE - KG 553KG PEDIATRIC DIGITAL SCALE - KG (POWER ADAPTER NOT INCLUDED) 2400KG PORTABLE DIGITAL WHEELCHAIR SCALE - KG 2400KL-BT PORTABLE DIGITAL WHEELCHAIR SCALE - IB/KG WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 2400KG-BT PORTABLE DIGITAL WHEELCHAIR SCALE - KG WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 2500KL-BT DIGITAL WHEELCHAIR SCALE WITH HANDRAILS - IB/KG WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 2500KG-BT DIGITAL WHEELCHAIR SCALE WITH HANDRAILS - KG WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 2600KL-BT PORTABLE/FOLDING DIGITAL WHEELCHAIR SCALE W/ HANDRAILS - IB/KG - 1 RAMP WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 2600KG-BT PORTABLE/FOLDING DIGITAL WHEELCHAIR SCALE W/ HANDRAILS - KG - 1 RAMP WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 2610KL PORTABLE/FOLDING DIGITAL WHEELCHAIR SCALE W/ HANDRAILS - IB/KG - 2 RAMPS 2610KG PORTABLE/FOLDING DIGITAL WHEELCHAIR SCALE W/ HANDRAILS - KG - 2 RAMPS 2610KL-BT PORTABLE/FOLDING DIGITAL WHEELCHAIR SCALE W/ HANDRAILS - IB/KG - 2 RAMPS WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 2610KG-BT PORTABLE/FOLDING DIGITAL WHEELCHAIR SCALE W/ HANDRAILS - KG - 2 RAMPS WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 2650KL-BT DIGITAL PORTABLE WHEELCHAIR SCALE - IB/KG (35" X 32" PLATFORM) WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 2650KG-BT DIGITAL PORTABLE WHEELCHAIR SCALE - KG (35" X 32" PLATFORM) WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 2700KG DIGITAL PORTABLE WHEELCHAIR SCALE - KG (44" X 42" PLATFORM) 2700KL-BT DIGITAL PORTABLE WHEELCHAIR SCALE - IB/KG (44" X 42" PLATFORM) WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 2700KG-BT DIGITAL PORTABLE WHEELCHAIR SCALE - KG (44" X 42" PLATFORM) WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 3001KL-AM ANTIMICROBIAL PLATFORM SCALE - ASSEMBLED - IB/KG (POWER ADAPTER NOT INCLUDED) 3001KG-AM ANTIMICROBIAL PLATFORM SCALE - ASSEMBLED - KG (POWER ADAPTER NOT INCLUDED) 3001KL-AMX ANTIMICROBIAL PLATFORM SCALE WITH LONG RAILS - ASSEMBLED - IB/KG (POWER ADAPTER NOT INCLUDED) 3001KG-AMX ANTIMICROBIAL PLATFORM SCALE WITH LONG RAILS - ASSEMBLED - KG (POWER ADAPTER NOT INCLUDED) 3001KL-AMUA ANTIMICROBIAL PLATFORM SCALE - UNASSEMBLED - IB/KG (POWER ADAPTER NOT INCLUDED) 3001KG-AMUA ANTIMICROBIAL PLATFORM SCALE - UNASSEMBLED - KG (POWER ADAPTER NOT INCLUDED) 1100KG DIGITAL PLATFORM SCALE WITH HANDRAILS - KG 1100KL-BT DIGITAL PLATFORM SCALE WITH HANDRAILS - IB/KG WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 1100KG-BT DIGITAL PLATFORM SCALE WITH HANDRAILS - KG WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 2101KL-BT DIGITAL PLATFORM SCALE WITH HANDRAILS - IB/KG WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 2101KG-BT DIGITAL PLATFORM SCALE WITH HANDRAILS - KG WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 596KL PORTABLE DIGITAL SCALE - IB/KG 880KL HEAVY DUTY DIGITAL FLOOR SCALE 894KLT TALKING DIGITAL FLOOR SCALE PACK OF 2 - IB/KG 895KLT TALKING DIGITAL FLOOR SCALE PACK OF 2 - IB/KG 402KG50 MECHANICAL BEAM SCALE W/FIXED POISE BAR W/HEIGHT ROD IN KG ONLY, 50 GRAM INCREMENTS 201HR WALL MOUNTED TELESCOPIC METAL HEIGHT ROD 205HR HIGH-STRENGTH WALL MOUNTED HEIGHT ROD ADULTHR ADULT HEIGHT ROD - CM AND FT BABYHR BABY HEIGHT ROD - CM AND FT 3001HR HEIGHT ROD FOR 3001KL-AM &3001KL-AMUA EBABYHR DIGITAL BABY HEIGHT ROD BABYSLINGSCALE BABY SLING HANGING SCALE IB/KG PELSTARONE PELSTAR WIRELESS KIT ENABLES THE TRANSMISSION OF SCALE DATA TO A WELCH ALLYN CVSM CON RADICADO 20201011671 SE APRUEBA LA ADICION DE REFERENCIAS: 3400KL, DIGITAL WET DIAPER/LAP SPONGE/ORGAN WITH PAN - G/OZ 3400KG, DIGITAL WET DIAPER/LAP SPONGE/ORGAN WITH PAN - G 3401KL, DIGITAL WET DIAPER/LAP SPONGE/ORGAN WITH TRAY - G/OZ BCS-G6-ADULT BODY COMPOSITION SCALE - ADULT BODY BCS-G6-LIMBS BODY COMPOSITION SCALE - ADULT INCLUDING LIMBS BCS-G6-DUO BODY COMPOSITION SCALE - ADULT AND PEDIATRIC BCS-G61-UPPER BODY COMPOSITION SCALE - UPPER BODY ONLY PTS-1000KL PATIENT TRANSFER SCALE CON SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS							
Marcas	PELSTAR HEALTH O METER						

Datos de Interes

Vida Util		Miembros Comprometidos	CUERPO HUMANO
Usos	DETERMINACION DEL PESO CORPORAL, GRACIAS A QUE CUENTAN CON UN SISTEMA DIGITAL, FACILITA CALCULAR EL INDICE DE MASA CORPORAL (IMC). LA AMPLIA GAMA DE MODELOS Y SU USO INTECIONAL PERMITE QUE ESTE DIRIGIDO TANTO A NEONATOS, NIÑOS Y PERSONAS ADULTAS. PARA USO EN AMBIENTES HOSPITALARIOS, CONSULTORIOS PARTICULARES Y HOMECARE	Riesgo	I

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
UNIDAD

Roles por Producto

Rol	Tipo.Ident	Identificacion	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	Consecutivo	2019125652	SINDER & CIA S.A.S	AVENIA EL DORADO No 96 A - 47	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
ACONDICIONADOR	Nit	8600700783	IMCOLMEDICA S.A.	CALLE 36 No. 15 - 42	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	diego.gutierrez@imcolmedica.com.co
FABRICANTE	Consecutivo	201704	PANAVIEW METAL PRODUCTS LTD	Li Zhou Jiao 2 Rd., Wei Wu Residents Group Nanya Village, Daojiao Town Dongguan City, Guangdong CHINA 523000	CHINA			
FABRICANTE	Consecutivo	205716	WUXI WEIGHER FACTORY CO. LTD.	MAJIAQIAO GUANGYI WUXI CITY, JIANGSU CHINA 214011	CHINA			
FABRICANTE	Consecutivo	206716	TRANSCELL ELECTRONICS SCALE CO., LTD.	8 XINGYUAN ROAD DONGSHAN INDUSTRIAL PARK, JIANGNING SCIENCE PARK NANJING, JIANGSU CHINA 211100	CHINA			
FABRICANTE	Consecutivo	6546654	PELSTAR LLC	9500 WEST 55TH	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			hernan.malagon@etb.net.co
FABRICANTE	Consecutivo	2017049045	DONGGUAN BEAVER PLASTIC & METAL PRODUCTS CO., LTD	Shui Ping Village, Da Lang Town Dongguan City, Guangdong CHINA 523800	CHINA			
IMPORTADOR	Consecutivo	201912565	DISTRIBUIDORA DE LAS AMERICAS S.A.S	Carrera 10 No 16 -39	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
IMPORTADOR	Nit	8600700783	IMCOLMEDICA S.A.	CALLE 36 No. 15 - 42	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	diego.gutierrez@imcolmedica.com.co
TITULAR REGISTRO SANITARIO	Consecutivo	6546654	PELSTAR LLC	9500 WEST 55TH	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			hernan.malagon@etb.net.co

Imprimir << Atras

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2022**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario: **482022000764357-6**

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
860070078	3	IMCOLMEDICA S.A

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CL 36 15 42	2889858	48	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
860028026	3	AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA GRANCOLOMBIANA S.A. NIVEL 1	26	0010

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
37293939	RUIZ BENITEZ DIANA MARIA

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	14004	No. 116575012876624	2022 - 11 - 04	No. 28776	2022 - 10 - 30

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8423100000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	215	XXX

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 2I221035 DECLARACION(1-4) PEDIDO: IMP 220139 P-9010 PELSTAR. MERCANCIA NUEVA. VISTO BUENO INVIMA N° VINVIMA-22-0110058. FECHA: 2022-09-13. NOS ACOGEMOS AL DECRETO 272 DE 2018 PARA DESGRAVACION ARANCELARIA 0%.. PRODUCTO: BALANZAS MECÁNICAS DE PISO (MECHANICAL FLOOR SCALES), MARCA: PELSTAR /HEALTH O METER, MODELO: 142KL, REFERENCIA: 142KL, USO O DESTINO: DETERMINACION DEL PESO CORPORAL, GRACIAS A QUE CUENTAN CON UN SISTEMA DIGITAL, FACILITA CALCULAR EL INDICE DE MASA CORPORAL (IMC). LA AMPLIA GAMA DE MODELOS Y SU USO INTECIONAL PERMITE QUE ESTE DIRIGIDO TANTO A NEONATOS, NIÑOS Y PERSONAS ADULTAS. PARA USO EN AMBIENTES HOSPITALARIOS, CONSULTORIOS PARTICULARES Y HOMECARE, CAPACIDAD: 150KG, SENSIBILIDAD AL PESO: 1LB, SERIAL: 1420093332, 1420093(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 482022000764357 133. Feha: 2022 11 18

134. Levante No. 482022000677829	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
	2022 - 11 - 18		

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	**980. Pago Total $** **0** 996. Espacio para Número autoadhesivo **9104819038429**

Health o meter®

Professional

Models 844KL / 844KL-USB
Digital Floor Scale



ISO 9001:2015
CERTIFIED

ISO13485:2016
CERTIFIED

User Instructions

PELSTAR, LLC 9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA
www.homscales.com

weigheasier®

P/N UM844KL_REV20211019

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS / ESPECIFICACIONES / CERTIFICACIONES / SERVICIO

Precauciones y Advertencias

Para prevenir lesiones y daño a su báscula, por favor siga estas instrucciones muy cuidadosamente.

- No transporte la báscula con objeto alguno sobre la plataforma.
- Para pesajes exactos, se debe colocar la báscula sobre una superficie plana y estable.
- Para pesajes exactos, verifique antes de cada uso el funcionamiento apropiado según el procedimiento descrito en este manual.
- No se utilice en presencia de materiales inflamables.

En ningún caso Pelstar, LLC será responsable por daños o lesiones causados por, o en relación a, el ensamblaje, uso o uso incorrecto de sus productos.

Especificaciones

Esta escala digital de piso exhibe el peso en libras, kilogramos o stones (piedras). También ofrece un bloqueo del peso que permite que la medición permanezca mostrada por 5 segundos luego de bajar de la báscula. Cada báscula de precisión se diseña para proporcionar mediciones de peso exactas, confiables y repetibles y características que hacen el proceso de pesaje simple, rápido y conveniente. Esta báscula está configurada para determinar el peso de un paciente estacionario.

Capacidad y Resolución	Capacidad: 440 lb / 200 kg / 31 st Resolución: 0.1 lb / 0.05 kg / 0.125 lb	
Entorno	Temperaturas de funcionamiento: 10°C a 35°C (50°F a 95°F) Temperaturas de Almacenamiento: 0°C a 50°C (32°F a 125°F) Presión Atmosférica: 500hPa a 1060hPa Humedad Máxima: 85% de HR en uso o almacenada	
Dimensiones Físicas	Tamaño de la Plataforma Ancho: 12 5/8" (321 mm) Largo: 12 5/8" (321 mm) Altura: 1 7/8" (48 mm)	Área Ocupada por el Producto: Ancho: 12 5/8" (321 mm) Largo: 12 5/8" (321 mm) Altura: 1 7/8" (48 mm) Peso: 4 lb (1.8 kg)

Certificaciones

ISO 9001:2015 CERTIFIED ISO13485:2016 CERTIFIED	Pelstar, LLC se ha certificado oficialmente como el fabricante de los dispositivos médicos Health o meter® Professional. El sistema de aseguramiento de calidad de Pelstar LLC cubre el desarrollo, producción, ventas y servicio de básculas médicas y sistemas de medición.

Información de Servicio al Cliente

Esta báscula se envía ensamblada en un embalaje. Examine cuidadosamente el embalaje en busca de daño en el envío antes de desempacar. Si se detecta algún daño, contacte a Servicio al Cliente.

Para ayuda adicional o suporte telefónico, por favor contacte a Servicio al Cliente:
Teléfono: 1 (800) 815-6615 Email: HomProCS@homscales.com

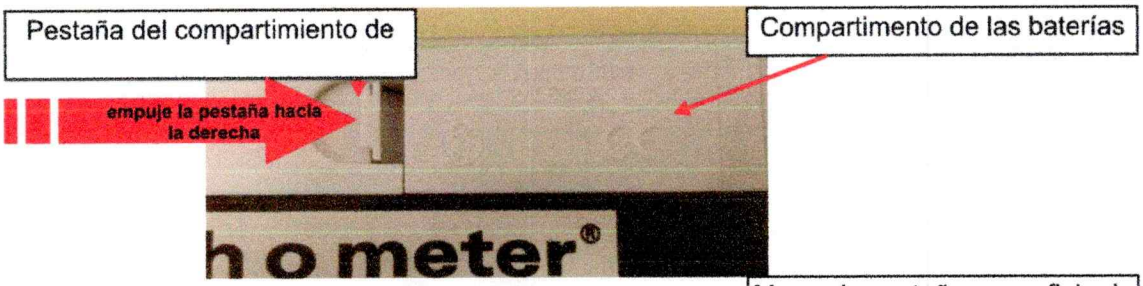
INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN

A fin de evitar daños en la báscula cuando la desempaque, **no use una navaja para cortar cartón, cuchillo o tijeras o cualquier objeto afilado para abrir el empaque protector interno.** Retire la báscula del embalaje y desempaque cuidadosamente, a fin de prevenir rayones en la unidad. Ponga aparte la caja para su almacenamiento.

Instrucciones para las Baterías

La báscula se envía con las baterías ya instaladas. Previo al primer uso, se debe retirar la pestaña de sujeción ubicada en la pestaña del compartimiento de la batería. El compartimiento de baterías está situado en la parte de abajo de la báscula. Para reemplazar las baterías, siga estos pasos.

1. Para abrir la cubierta de las baterías, empuje la pestaña del compartimiento hacia la derecha y tire hacia arriba. **Nota:** Usted NO necesita retirar ningún tornillo para abrir el compartimiento de las baterías.






2. Para retirar las baterías, presione hacia arriba sobre la pestaña blanca que sostiene la batería. Al mover la pestaña se aflojará la batería para que pueda ser removida. Retire ambas baterías y substitúyalas por dos baterías nuevas de Litio de 3V (CR2032). Siga la ilustración de las baterías para asegurarse de que están insertadas con el lado + hacia arriba.

3. Coloque nuevamente la cubierta del compartimento deslizando el extremo de la cubierta dentro del compartimento. Luego presione la pestaña en el compartimento para asegurar la posición de la cubierta.


Seleccionar el Modo de Peso (Kilogramos/KG o Libras/LB), o Stones/ST)

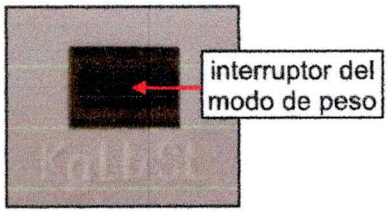1. Para seleccionar el modo de peso, dé la vuelta a la báscula para acceder al interruptor de modo de peso.
2. Deslice el interruptor hacia el modo de peso deseado.
3. La primera posición de la izquierda es para Kilogramos. La posición central es para Libras. La posición de la derecha es para Stones.









Opción de Conectividad del Modelo 844KL

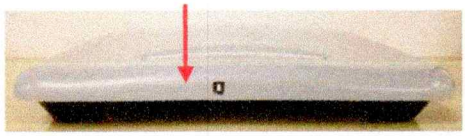El modelo 844KL incluye un puerto USB para conectividad con una PC u otro dispositivo. Para aprender más sobre las opciones de conectividad de esta báscula, por favor contacte a Health o meter® Professional Servicios al Cliente al 1-800-815-6615 o visite homprocs@homscales.com.





INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Medición del Peso

1. Para encender la báscula, golpee suave pero firmemente con su pie en el centro de la plataforma.	
2. Cuatro dígitos aparecerán en la pantalla.	
3. Espere a que 0.0 aparezca en la pantalla.	
4. Suba a la báscula. Permanezca quieto hasta que aparezca el peso.	
5. Después de que el peso se haya fijado, la medición destellará en la pantalla.	
6. El peso seguirá mostrado por 5 segundos luego de bajar de la báscula.	

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS / MANTENIMIENTO & LIMPIEZA

Consulte las instrucciones siguientes para comprobar y corregir cualquier falla antes de entrar en contacto con Servicio al Cliente.

Si la pantalla muestra el mensaje de "Lo bAtt", substituya las baterías según las instrucciones en la página 4.	
Si la pantalla muestra "Err E", la carga sobre la báscula excede la capacidad. 440 lb / 200 kg / 31 st	

Para ayuda adicional, por favor contacte a soporte técnico sin costo al 1 (800) 638-3722.

Mantenimiento

Precaución: Antes del primer uso, o después de períodos largos de falta de uso, revise la operación y funciones apropiadas de la báscula. Si la báscula no funciona correctamente, consulte al personal de servicio calificado.

1. Compruebe el aspecto general de toda la báscula para saber si hay daño o desgaste por uso obvios.
2. No la almacene cerca de productos químicos, calefacciones o radiadores.
3. No caiga, no golpee con el pie, ni salte sobre la báscula.
4. Esta báscula es un dispositivo de pesado extremadamente sensible. No almacene objeto alguno encima de la plataforma de la báscula.
5. Si su báscula deja de funcionar correctamente, no intente desarmarla. Esto anulará su garantía.

Limpieza y Desinfección

El cuidado apropiado y la limpieza son esenciales para asegurar una larga vida de pesaje exacto y efectivo.

1. Health o meter® Professional recomienda usar una solución suave de detergente sobre un paño suave o toallita desechable:
2. Después de la limpieza/desinfección, pase un paño humedecido con agua y luego un paño limpio y seco. Para evitar la acumulación de residuos o superficies mojadas, asegúrese de que todos los componentes de la báscula están completamente secos luego de la limpieza.
3. Nunca utilice materiales ásperos o abrasivos para limpiar la báscula, ya que éstos arruinan el acabado de la misma.
4. No sumerja la báscula en agua o en ningún otro líquido.
5. No vierta ni atomice líquidos directamente sobre la báscula.

GARANTÍA

Garantía Limitada de 1 Año

¿Qué Cubre la Garantía?

Este producto Health o meter® Professional está garantizado desde la fecha de compra contra defectos de materiales o de fabricación por un periodo de un (1) año. Si el producto no funciona correctamente, regrese el producto con flete pre-pagado y apropiadamente empacado a Pelstar, LLC (vea la sección "Obtener Servicio de Garantía", abajo, para obtener instrucciones.) Si el fabricante determina que existe un defecto en los materiales o en la fabricación, el único recurso del cliente será el reemplazo de la báscula sin costo alguno. El reemplazo será hecho con un producto o componente nuevo o remanufacturado. Si el producto no está disponible ya, el reemplazo puede realizarse con un producto similar de valor igual o mayor. Todas las partes reemplazadas se cubren sólo por el periodo de garantía original.

¿Quién Tiene Cobertura?

El comprador original del producto debe tener un comprobante de compra para recibir el servicio de garantía. Por favor guarde su factura o recibo. Los distribuidores de Pelstar o las tiendas al menudeo que venden los productos de Pelstar no tienen el derecho de alterar o modificar o en forma alguna cambiar los términos y condiciones de esta garantía.

¿Qué Se Excluye?

Su garantía no cubre el desgaste normal de partes como resultado de cualquiera de las siguientes condiciones: uso negligente o uso incorrecto del producto, uso de voltaje o corriente incorrectos, uso contrario a las instrucciones de operación, abuso incluyendo manipulación, daño en el transporte, o la reparación o alteraciones no autorizadas. Además, la garantía no cubre desastres naturales, tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados. Esta garantía le concede derechos legales específicos, y usted podría tener otros derechos que varían de país a país, de estado a estado, de provincia a provincia o de jurisdicción a jurisdicción.

Para obtener Servicio de Garantía, asegúrese de guardar su recibo de compra o documento que pruebe la compra. Llame al (+1) 800-638-3722 o al (+1) 708-377-0600 para recibir un número de autorización de devolución (RA), lo cual debe incluirse en la etiqueta de devolución. Incluya su comprobante de compra al producto defectuoso junto con su nombre, dirección, número telefónico durante el día y la descripción del problema. Empaquete cuidadosamente el producto y envíelo con el envío y el seguro prepagados a:

Pelstar, LLC

Attention (Atención) #R/A_____

Return Department (Departamento de Devoluciones)

9500 West 55th Street

McCook, IL 60525



PELSTAR, LLC

9500 West 55th Street • McCook, IL 60525 • USA

1-800-638-3722 o 1-708-377-0600

POR FAVOR REGISTRE SU BÁSCULA PARA COBERTURA DE GARANTÍA EN:

www.homscales.com

Health o meter® es una marca registrada de Sunbeam Products, Inc. usada bajo licencia.

Los productos Health o meter® Professional son fabricados, diseñados, y de propiedad de Pelstar, LLC.


Nos reservamos el derecho de mejorar, realzar, o modificar las características o especificaciones de los productos Health o meter® Professional sin previo aviso.

© Pelstar, LLC 2019

P/N UM844KL_REV20211019

	ESE HOSPITAL SAN ISIDRO NIT: 800 025 221-1 ALPUJARRA-TOLIMA DIRECCION:Carrera 5 No.5-43 TEL.3212011134 HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS	CODIGO H17 VERSION 4 PAG 1-3

Nombre del equipo:	BASCULA DE PISO
#. de activo fijo:	
Marca:	HEALTH O METER
Modelo:	844KL
Serie:	8440134112
Invima:	**2013DM-0010061**

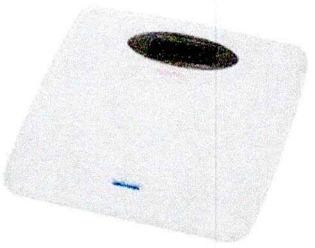

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

Instrumento de pesaje de funcionamiento automático que utilizan la acción de la gravedad para determinación de la masa. Consiste en una plataforma de vidrio templado como soporte para el pesaje de pacientes, posee una pantalla LCD para la visualización del peso medio.

PARTES O ELEMENTOS DEL EQUIPO	REFERENCIA	ACCESORIOS
----	----	----
----	----	----
----	----	----

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS DEL EQUIPO

Voltaje Operación [V]	6	Peso [Kg]	----				
Voltaje máx. Operación [V]	6	Capacidad	0-180 kg				
Corriente máx. operación [A]	----	Dimensiones	----				
Corriente min. operación [A]	----	Años de vida del Equipo	5				
Potencia Consumida [W]	----	Requiere Agua	SI	-	NO	X	
Frecuencia [Hz]	----	Requiere Gas Propano	SI	-	NO	X	
Presión [Bar]	----	Requiere Combustible	SI	-	NO	X	
Velocidad [W]	----	Requiere Gases medicinales					

INFORMACIÓN DE ADQUISIÓN E INSTALACIÓN

Fabricante	HEALTH O METER	Forma de adquisición	COMPRA DIRECTA
Teléfono	1 708 377 0600	Costo de Adquisición	$443.522,66
Dirección	9500WEST 55 TH STREET MCCOOK, IL 60525	Fecha de compra	8/06/2023
Lugar de Origen	NO REGISTRA	Fecha de Instalación	NO REGISTRA
Proveedor	FLEMING BIOMEDICA	Inicio Garantía	NO REGISTRA
Teléfono	871 5629	Finalización Garantía	NO REGISTRA
Dirección	Calle 9 No. 15 - 36,	Fecha de puesta en servicio	NO REGISTRA
Email	flemingbiomedicasas@gmail.com		

	ESE HOSPITAL SAN ISIDRO NIT: 800 025 221-1 ALPUJARRA-TOLIMA DIRECCION:Carrera 5 No.5-43 TEL.3212011134 HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS	CODIGO H17 VERSION 4 PAG 2 - 3

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
BASCULA DE PISO	HEALTH O METER	844KL	8440134112

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

1. No utilice líquidos volátiles, como disolventes o bencina, debido a que provocarán que los materiales se fundan o se
2. No derramar liquidos sobre el equipo para evitar cortos del sistema eléctrico interno
3. verificar baterias antes de usar.
4. Revisar que la plataforma se encuentre estable para mayor seguridad del usuario.
5. ----------
6. ----------
7. ----------

CLASIFICACIÓN DE DISPOSITIVO MÉDICO(RIESGO)								UBICACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO:
I	X	IIA	-	IIB	-	III	-	ALMACEN

MANUALES TÉCNICOS		PLANOS	
Operación	-----	Eléctricos	-----
Mantenimiento	X	Electrónicos	-----
Partes	-----	Hidráulicos	-----
Despieces	-----	Neumáticos	-----
		Mecánicos	-----
		Médico	X
CLASIFICACIÓN POR USO		Básico	-
		Apoyo	-

TECNOLOGÍA PREDOMÍNATE		CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	
Eléctrico	-	Diagnóstico	X
Electrónico	X	Tratamiento Y Mantenimiento de la vida	-
Mecánico	-	Rehabilitación	-
Electromecánico	-	Prevención	-
Hidráulico	-	Análisis Laboratorio	-
Neumático	-	Mantenimiento	-
Vapor	-	CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA	
Solar	-	TIPO -	CLASE -

CALIBRACIÓN					MANTENIMIENTO	
Requiere Calibración			SI		TIPO:	
Variables susceptibles a calibración	Presión	-	Tiempo	-	PREVENTIVO	Semestralmente orientado al riesgo
	Temperatura	-	Co2	-		
	Volumen	-	Co	-		
	Impedancia	-	RPM	-		
	Marcapasos	-	Humedad	-	CORRECTIVO	Por llamado
	Respiración	-	flujo	-		
	G. Cardiáco	-	Fc	-		
	Ibp	-	Ecg	-		
	Energía	-	Spo2	-		
	Nibp	-	Peso	X		
PERIODICIDAD DE CALIBRACIÓN DEFINIDA			SEGÚN PLAN DE ASEGURAMIENTO METROLÓGICO			

Condiciones de Recepción de Equipo	Nuevo	Usado	Repotenciado	RESPONSABLE DEL EQUIPO
	X	-	-	

	ESE HOSPITAL SAN ISIDRO NIT: 800 025 221-1 ALPUJARRA-TOLIMA DIRECCION:Carrera 5 No.5-43 TEL.3212011134 HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS	CODIGO H17 VERSION 4 PAG 3 - 3

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
BASCULA DE PISO	HEALTH O METER	844KL	8440134112

RUTINA DE MANTENIMIENTO
ACTIVIDADES
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.
Verificar que el equipo se encuentra funcionando correctamente
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo
Inspeccionar los componentes electrónicos
Verificacion de soporte que se encuentre estable y seguro.
Verificación de pantalla LCD

FECHA	No. INFORME	TIPO DE MANTENIMIENTO	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO

	ESE HOSPITAL SAN ISIDRO NIT: 800.025.221-1 ALPUJARRA - TOLIMA	CODIGO: HD-D-17 VERSION: 3
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS MEDICOS	

REGISTRO HISTORICO DE MANTENIMIENTO

FECHA	No. INFORME	TIPO DE MTTO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
20/9/23	M 26042074	[illegible]	ser inform	[illegible]

REPORTE DE SERVICIO No AL-26092092
NIT. 830.130.882-8

FLEMING BIOMEDICA S.A.S.
INGENIERIA BIOMEDICA
NIT: 830.130.882-8

1. Clasificación del servicio

1.1 tipo de servicio				1.2 carácter			
Preventivo [X]	Correctivo [ ]	Instalación [ ]	Capacitación [ ]	Garantía [ ]	Contrato [X]	Factura [ ]	Otro [ ]

Ingeniero / Técnico	Ciudad/Municipio	Fecha (Día/Mes/Año)
ALEX CAMILO OVIEDO CLAROS	ALPUJARRA-TOLIMA	20/09/2023

2. Datos del cliente

Nombre del Cliente: ESE HOSPITAL SAN ISIDRO ALPUJARRA	Teléfono: 6088389027
Funcionario / Contacto	Cargo

3. Datos del equipo

Nombre del Equipo: BASCULA		No. De Contrato:	Inventario: N/R
Ubicación: ALMACEN	Marca: HEALTH O METER	Modelo: 844KL	Serie: 8440134112

4. Descripción del servicio

4.1. Falla Reportada y/o detectada: INSTALACION DE EQUIPOS NUEVOS.

4.2. Acción correctiva o procedimiento realizado: [✓]

[X] Revisión inicial del equipo	[ ] Pruebas neumáticas	[ ] Limpieza externa e interna de componentes y ajustes de conectores
[X] Mantenimiento de acuerdo con el protocolo	[ ] Pruebas hidráulicas	[ ] Pruebas finales de todas las funciones del equipo
[ ] Revisión y mantenimiento sistema eléctrico	[ ] Validación y configuración software	[ ] Validación y puesta en marcha del equipo
[ ] Revisión y mantenimiento sistema mecánico	[ ] Revisión y funcionamiento del sistema U.S.	[X] El equipo queda trabajando bien
[ ] Revisión y mantenimiento sistema electrónico	[ ] Revisión de accesorios	[ ] Acciones correctivas / ver observaciones

Descripción de la Intervención: SE REALIZA INSTALACION DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS, DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS.

5. Cambio o instalación de partes: SI: [ ] NO: [X]

Partes Requeridas

Cantidad	Descripción	No. de Parte	No. de Serie
----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------

6. Observaciones: SE REALIZA ENTREGA E INSTALACION DE LOS EQUIPOS NUEVOS EN GARANTIA CON SUS RESPECTIVOS DOCUENTOS, MANUALES Y ACESORISOS, SEGÚN CONTRATO.

7. Estatus del Servicio: Concluido [X] En proceso [ ] Equipo fuera de servicio [ ] Otro: _____

8. Calificación del Servicio: [1] [2] [3] [4] [5]

Hora de Llegada: [ ]

Ingeniero/Técnico:
Firma
Nombre (En letra legible):
ALEX OVIEDO

Fecha y Hora de Salida: [ ] [ ] [ ]

Cliente:
Firma
Nombre (En letra legible):

Solución Global en Tecnología Hospitalaria

NEIVA CLL. 9N° 15-36 Telefax: 8715629-8711585
Cels.: 312 478 1505 - 310 298 6222
Frente al Hospital Universitario

BOGOTÁ CLL. 24C No. 70-25
Torre 2 Of. 202 Cels: 3202655657 - 3132845366

EJE CAFETERO: Cel: 3232304601
CALI: Cel: 3222173674

BUCARAMANGA: Cel: 3143105953
BARRANQUILLA: Cel: 3214863668

www.flemingbiomedica.com E-mail: soporte@flemingbiomedica.com

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CERTIFICADO N° RV202309-3721
CERTIFICATE N°

Respaldo Vital Metrología Biomédica S.A.S
NIT. 900.582.168 - 1

INFORMACION GENERAL
GENERAL INFORMATION

SOLICITANTE: *CONSTUMER:*	E.S.E HOSPITAL SAN ISIDRO	**DIRECCIÓN:** *ADDRESS:*	CARRERA 5 # 5A-43
NIT: *NIT:*	800025221-1	**TELEFONO:** *PHONE:*	3212011134
DESCRIPCION DEL EQUIPO: *EQUIPMENT DESCRIPTION:*	BASCULA	**FABRICANTE:** *MANUFACTURER:*	HEALTH O METER
SERIE: *SERIAL N°.*	8440134112	**MODELO:** *MODEL:*	844KL
ACTIVO FIJO: *FIXED ASSETS:*	NO REGISTRA	**DEPENDENCIA:** *DEPENDENCE:*	ALMACEN
LUGAR DE CALIBRACIÓN: *CALIBRATION PLACE:*	ALMACEN	**FECHA DE INGRESO:** *INGRESS DATE:*	2023-09-21
FECHA DE CALIBRACIÓN: *CALIBRATION DATE:*	2023-09-21	**FECHA DE EMISIÓN:** *ISSUANCE DATE:*	2023-09-21
NÚMERO DE PÁGINAS: *NUMBER OF PAGES:*	3	**INCLUYENDO ANEXOS:** *INCLUDING ANNEXES:*	0

MÉTODO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION METHOD

El procedimiento aplicado por RESPALDO VITAL S.A.S asegura la toma de datos y el cálculo de resultados mediante el procedimiento interno MET-P-008. El valor convencional de medición es determinado usando el método de comparación directa con un patrón de referencia. *The procedure applied by RESPALDO VITAL S.A.S ensures data collection and results calculation through the internal procedure MET-P-008 . Conventional measurement value is determined by the direct comparison method with a reference pattern.*

TRAZABILIDAD METROLÓGICA
METROLOGICAL TRACEABILITY

EQUIPO PATRON *PATTERN EQUIPMENT*	FABRICANTE *MANUFACTURER*	MODELO *MODEL*	N° INVENTARIO *SERIAL*	FECHA DE CALIBRACION *CALIBRATION DATE*	CERTIFICADO N° *CERTIFICATE N*
MASA PATRON 5KG (2)	SB LTDA	PARALELEPIPEDO RECTANGULAR	CLB033, CLB034, CLB035	9/11/2021 - 21/04/2021	M-6764, M-5914
MASA PATRON 10 KG (3)	SB LTDA	PARALELEPIPEDO RECTANGULAR	CLB033, CLB034, CLB035	9/11/2021 - 21/04/2021	M-6764, M-5914
MASA PATRON 20 KG (9)	SB LTDA	PARALELEPÍPEDO	CLB036, CLB037, CLB038, CLB039, CLB040, CLB041, CLB042, CLB043, CLB044	9/11/2021, 25/03/2022, 25/03/2022, 21/04/2021, 21/04/2021, 21/04/2021, 21/04/2021	7182, M-6765, M-5909, M-5912,M-5911, M-5913, M-5910

CONDICIONES AMBIENTALES

TEMPERATURA INICIAL: *INITIAL TEMPERATURE:*	21,4	°C	**TEMPERATURA FINAL:** *FINAL TEMPERATURE:*	22,4	°C
HUMEDAD REL INICIAL: *INITIAL RELATIVE HUMIDITY:*	55	%HR	**HUMEDAD REL FINAL:** *FINAL RELATIVE HUMIDITY:*	56	%HR

INCERTIDUMBRE:
UNCERTAINTY:

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura de **k** y la probabilidad de cobertura de aproximadamente 95%. La regla de decisión aplicada en estos casos será |Error| +U ≤ EMP según la Guia ISO/IEC 98-4 Aplicando la declaracion Binaria con zona de seguridad ,si cumple la anterior condición la medición se toma como conforme y registrará un pasa, en caso contrario se registrá falla. La probabilidad de dar una aceptación falsa o un rechazo falso no lo determina el laboratorio RESPALDO VITAL S.A.S, sin embargo se puede calcular de acuerdo a la guia ISO/IEC 98-4. *The reported expanded measurement uncertainty is stated as the standard measurement uncertainty multiplied by the coverage factor of k and the coverage probability of approximately 95%. The decision rule applied in these cases will be |Error| +U ≤ EMP according to the ISO/IEC Guide 98-4 Applying the Binary declaration with security zone, if the previous condition is met, the measurement is taken as compliant and will register a pass, otherwise a failure will be registered. The probability of giving a false acceptance or a false rejection is not determined by the RESPALDO VITAL S.A.S laboratory, however it can be calculated accordingly according to the ISO/IEC 98-4 guide.*

Firma Autorizadas
Autorizad Signature

María Alejandra Rivera
Coordinador de Metrología
RESPALDO VITAL S.A.S
Revisado y Aprobado

Cel. 3146559513
coordlaboratorio@respaldovital.com.co
respaldovitalsas@gmail.com
www.respaldovital.com.co
Cll. 9 N°15-36 Local 1 /Br Altico, Neiva - Colombia

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CERTIFICADO N° RV202309-3721
CERTIFICATE N°

Respaldo Vital Metrología Respaldo Vital S.A.S
NIT. 900.582.168 - 1


RESULTADOS DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION RESULTS

Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al equipo, momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.RESPALDO VITAL S.A.S., no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los equipos calibrados.RESPALDO VITAL S.A.S declara que sus mediciones son trazables metrológicamente empleando patrones calibrados por medio de aboratorios competentes acreditados conforme a la Norma ISO/IEC 17025. *The results contained in this report relate to the equipment, time and conditions under which measurements were made .RESPALDO VITAL S.A.S. , not responsabilza for damages that may result from improper use of the equipment calibrated. RESPALDO VITAL S.A.S declares that its measurements are metrologically traceable using standards calibrated by competent laboratories accredited in accordance with ISO/IEC 17025 Standard.*

DESVIACIÓN LINEAL

INTERVALO DE TRABAJO: 0-180 *WORK INTERVAL:*
RESOLUCIÓN: 0,1 *RESOLUTION:*
INTERVALO DE MEDICIÓN: 0 - 100 *MEASUREMENT INTERVAL:*


Valor Nominal (Kg)	Valor Promedio (Kg)	Error (Kg)	Incertidumbre Expandida (Kg)		Error máximo permitido (Kg)		Conforme/No conforme
0	0,00	0,00	±	0,06	±	1	Conforme
20	19,90	-0,10	±	0,06	±	1,2	Conforme
40	39,90	-0,10	±	0,06	±	1,4	Conforme
60	59,90	-0,10	±	0,06	±	1,6	Conforme
80	79,90	-0,10	±	0,06	±	1,8	Conforme
100	99,80	-0,20	±	0,06	±	2	Conforme

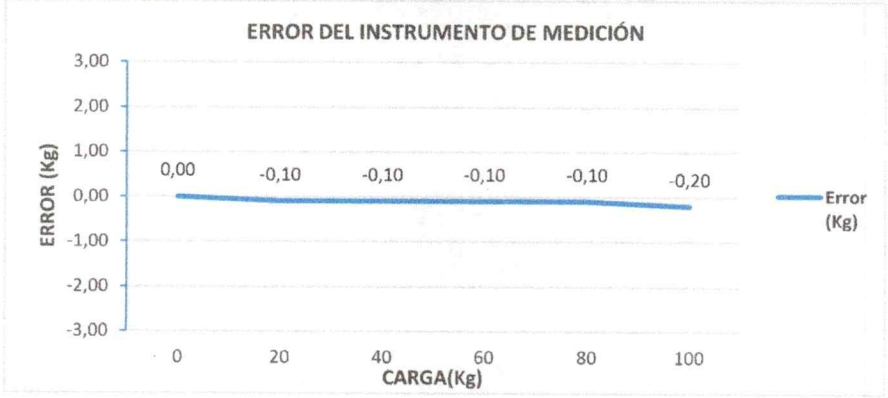


EXCENTRICIDAD

APROX 1/3 DE LA CARGA MÁXIMA 35

Punto de referencia	Valor Promedio (Kg)	Error (Kg)
1	34,9	-0,1
2	34,9	-0,1
3	34,9	-0,1
4	35	0
5	34,9	-0,1
1	34,9	-0,1





Cel. 3146559513
coordlaboratorio@respaldovital.com.co
respaldovitalsas@gmail.com
www.respaldovital.com.co
Cll. 9 N°15-36 Local 1 /Br Altico, Neiva - Colombia

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CERTIFICADO N° RV202309-3721
CERTIFICATE N°

REPETIBILIDAD

APROX 1/2 DE LA CARGA MÁXIMA	50

Valor Nominal (Kg)	Valor Promedio (Kg)	Error (Kg)
50	49,90	-0,10
50	49,90	-0,10
50	49,90	-0,10
50	49,90	-0,10
50	49,90	-0,10

OBSERVACIONES
OBSERVATIONS

SIN NOVEDAD

DECLARACIONES
STATEMENT

Este certificado expresa el resultado de las mediciones realizadas. No puede ser reproducido, excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito por RESPALDO VITAL S.A.S. De igual forma este certificado no es valido si se presenta de forma parcial. *This certificate faithfully expresses the result of the measurements carried out. It cannot be reproduced, except when written permission has been obtained by In the RESPALDO VITAL S.A.S. same way, this certificate is not valid if it is presented partially.*

El tratamiento de los datos personales consignados en este documento están protegidos por RESPALDO VITAL S.AS., de conformidad con la Ley 1581 de 2012, garantizado la confidencialidad en el manejo adecuado de la información. *The treatment of the personal data consigned in this document is protected by RESPALDO VITAL S.A.S., in accordance with Law 1581 of 2012, guaranteeing confidentiality in the proper handling of the information.*

«««« FIN DE CERTIFICADO »»»»

«««« END OF CERTIFICATE »»»»

<< Atras

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20063493	Nombre producto	**BALANZAS PESA-PERSONAS Y PESA BEBES, NEONATALES - ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS - BALANZAS PARA PESO CORPORAL EN ADULTOS, PEDIATRICOS Y NEONATO - PELSTAR HEALTH O METER**				
Registro Sanitario	INVIMA 2013DM-0010061	Vencimiento	2023/07/17	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: BALANZAS MÉDICAS DIGITALES (DIGITAL PHYSICIAN SCALES) 349KLX, 499KL, 500KL, 597KL, 597KG, 599KL, 599KG, 600KL, 600KG, 752KL, 752KG, 753KL BALANZAS PEDIÁTRICAS DIGITALES (DIGITAL PEDIATRIC SCALES) 522KL, 524KL, 553KL, 549KL BALANZAS PEDIÁTRICAS MECÁNICAS (MECHANICAL PEDIATRIC SCALES) 386KGS-01, 386S-01. BALANZAS DIGITALES PARA SILLAS DE RUEDAS (DIGITAL WHEELCHAIR SCALES) 2400KL, 2500KL, 2500KG, 2600KL, 2600KG, 2650KL, 2650KG, 2700KL BALANZA DIGITAL TIPO CAMILLA (DIGITAL STRETCHER SCALE) 2000KL. BALANZA DIGITAL DE SILLA DE RUEDA Y ASIENTO PLEGABLE (DIGITAL WHEELCHAIR SCALE AND FLIP SEAT) 2500CKL BALANZAS DIGITALES DE PLATAFORMA (DIGITAL PLATFORM SCALES) 1100KL, 2101KL, 2101KG. BALANZAS DIGITALES TIPO SILLA (DIGITAL CHAIR SCALES) 2595KL, 2595KG, 594KL. BALANZAS MECÁNICAS DE PISO (MECHANICAL FLOOR SCALES) 100KG, 100LB, 142KL, 160KL, 160KG, 160LB, 175LB. BALANZAS DIGITALES DE PISO (DIGITAL FLOOR SCALES) 800KL, 844KL, 822KL. BALANZA DE ESPECIMENES (DIGITAL SPECIMEN/LAPSPONGE SCALE) BALANZAS MECANICA TIPO BARRA (MECHANICAL PHYSICIAN BEAM SCALES) 400KL, 402KL, 402KLWH, 402LB, 402KLWH, 402KG, 450KL, 450KLWH. BALANZAS MECANICA PEDIATRICA TIPO BARRA (MECHANICAL PEDIATRIC BEAM SCALES) 1522KL, 1524KL . BALANZA NEONATAL (NEONATAL SCALE) 2210KL BALANZA PAÑAL (DIAPER SCALE) YG500R. BALANZA MECÁNICA TIPO SILLA (MECHANICAL CHAIR SCALE) 445KL. BALANZA DIGITAL PEDIÁTRICA PORTATIL (PEDIATRIC PORTABLE DIGITAL SCALE) 8320KL. TALLIMETROS (HEIGHT MEASUREMENT) PORTROD, STROD, PROPLUSROD, WMROD, 402KLROD, 499KLROD. CARRITO MEDICO PROFESIONAL (PROFESSIONAL MEDICAL CART) 2210CART. MALETIN DE TRANSPORTE PARA BALANZA 752KG, 64771. KIT DE CONECTIVIDAD. C-HOMWA-1, L-HOMWA-1. 498KL REMOTE DISPLAY DIGITAL PHYSICIAN SCALE - LB/KG 600KL-BT DIGITAL EYE LEVEL SCALE, DIGITAL HEIGHT ROD & AUTOMATIC BMI WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 501KL DIGITAL EYE LEVEL STAND-ON SCALE W/ HEIGHT ROD - LB/KG (POWER ADAPTER NOT INCLUDED) 501KG DIGITAL EYE LEVEL STAND-ON SCALE W/ HEIGHT ROD - KG (POWER ADAPTER NOT INCLUDED) 501KL-BT DIGITAL EYE LEVEL STAND-ON SCALE W/ HEIGHT ROD - LB/KG (POWER ADAPTER NOT INCLUDED) WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 501KG-BT DIGITAL EYE LEVEL STAND-ON SCALE W/ HEIGHT ROD - KG (POWER ADAPTER NOT INCLUDED) WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 550KL INFANT TO TODDLER, 2 IN 1 DIGITAL SCALE 522KG PEDIATRIC DIGITAL SCALE W/ TRAY - KG (POWER ADAPTER NOT INCLUDED) 524KG PEDIATRIC DIGITAL SCALE W/ SEAT - KG (POWER ADAPTER NOT INCLUDED) 549KG PEDIATRIC DIGITAL SCALE - KG 553KG PEDIATRIC DIGITAL SCALE - KG (POWER ADAPTER NOT INCLUDED) 2400KG PORTABLE DIGITAL WHEELCHAIR SCALE - KG 2400KL-BT PORTABLE DIGITAL WHEELCHAIR SCALE - IB/KG WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 2400KG-BT PORTABLE DIGITAL WHEELCHAIR SCALE - KG WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 2500KL-BT DIGITAL WHEELCHAIR SCALE WITH HANDRAILS - IB/KG WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 2500KG-BT DIGITAL WHEELCHAIR SCALE WITH HANDRAILS - KG WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 2600KL-BT PORTABLE/FOLDING DIGITAL WHEELCHAIR SCALE W/ HANDRAILS - IB/KG - 1 RAMP WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 2600KG-BT PORTABLE/FOLDING DIGITAL WHEELCHAIR SCALE W/ HANDRAILS - KG - 1 RAMP WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 2610KL PORTABLE/FOLDING DIGITAL WHEELCHAIR SCALE W/ HANDRAILS - IB/KG - 2 RAMPS 2610KG PORTABLE/FOLDING DIGITAL WHEELCHAIR SCALE W/ HANDRAILS - KG - 2 RAMPS 2610KL-BT PORTABLE/FOLDING DIGITAL WHEELCHAIR SCALE W/ HANDRAILS - IB/KG - 2 RAMPS WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 2610KG-BT PORTABLE/FOLDING DIGITAL WHEELCHAIR SCALE W/ HANDRAILS - KG - 2 RAMPS WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 2650KL-BT DIGITAL PORTABLE WHEELCHAIR SCALE - IB/KG (35" X 32" PLATFORM) WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 2650KG-BT DIGITAL PORTABLE WHEELCHAIR SCALE - KG (35" X 32" PLATFORM) WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 2700KG DIGITAL PORTABLE WHEELCHAIR SCALE - KG (44" X 42" PLATFORM) 2700KL-BT DIGITAL PORTABLE WHEELCHAIR SCALE - IB/KG (44" X 42" PLATFORM) WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 2700KG-BT DIGITAL PORTABLE WHEELCHAIR SCALE - KG (44" X 42" PLATFORM) WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 3001KL-AM ANTIMICROBIAL PLATFORM SCALE - ASSEMBLED - IB/KG (POWER ADAPTER NOT INCLUDED) 3001KG-AM ANTIMICROBIAL PLATFORM SCALE - ASSEMBLED - KG (POWER ADAPTER NOT INCLUDED) 3001KL-AMX ANTIMICROBIAL PLATFORM SCALE WITH LONG RAILS - ASSEMBLED - IB/KG (POWER ADAPTER NOT INCLUDED) 3001KG-AMX ANTIMICROBIAL PLATFORM SCALE WITH LONG RAILS - ASSEMBLED - KG (POWER ADAPTER NOT INCLUDED) 3001KL-AMUA ANTIMICROBIAL PLATFORM SCALE - UNASSEMBLED - IB/KG (POWER ADAPTER NOT INCLUDED) 3001KG-AMUA ANTIMICROBIAL PLATFORM SCALE - UNASSEMBLED - KG (POWER ADAPTER NOT INCLUDED) 1100KG DIGITAL PLATFORM SCALE WITH HANDRAILS - KG 1100KL-BT DIGITAL PLATFORM SCALE WITH HANDRAILS - IB/KG WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 1100KG-BT DIGITAL PLATFORM SCALE WITH HANDRAILS - KG WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 2101KL-BT DIGITAL PLATFORM SCALE WITH HANDRAILS - IB/KG WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 2101KG-BT DIGITAL PLATFORM SCALE WITH HANDRAILS - KG WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 596KL PORTABLE DIGITAL SCALE - IB/KG 880KL HEAVY DUTY DIGITAL FLOOR SCALE 894KLT TALKING DIGITAL FLOOR SCALE PACK OF 2 - IB/KG 895KLT TALKING DIGITAL FLOOR SCALE PACK OF 2 - IB/KG 402KG50 MECHANICAL BEAM SCALE W/FIXED POISE BAR W/HEIGHT ROD IN KG ONLY, 50 GRAM INCREMENTS 201HR WALL MOUNTED TELESCOPIC METAL HEIGHT ROD 205HR HIGH-STRENGTH WALL MOUNTED HEIGHT ROD ADULTHR ADULT HEIGHT ROD - CM AND FT BABYHR BABY HEIGHT ROD - CM AND FT 3001HR HEIGHT ROD FOR 3001KL-AM &3001KL-AMUA EBABYHR DIGITAL BABY HEIGHT ROD BABYSLINGSCALE BABY SLING HANGING SCALE IB/KG PELSTARONE PELSTAR WIRELESS KIT ENABLES THE TRANSMISSION OF SCALE DATA TO A WELCH ALLYN CVSM CON RADICADO 20201011671 SE APRUEBA LA ADICION DE REFERENCIAS: 3400KL, DIGITAL WET DIAPER/LAP SPONGE/ORGAN WITH PAN - G/OZ 3400KG, DIGITAL WET DIAPER/LAP SPONGE/ORGAN WITH PAN - G 3401KL, DIGITAL WET DIAPER/LAP SPONGE/ORGAN WITH TRAY - G/OZ BCS-G6-ADULT BODY COMPOSITION SCALE - ADULT BODY BCS-G6-LIMBS BODY COMPOSITION SCALE - ADULT INCLUDING LIMBS BCS-G6-DUO BODY COMPOSITION SCALE - ADULT AND PEDIATRIC BCS-G61-UPPER BODY COMPOSITION SCALE - UPPER BODY ONLY PTS-1000KL PATIENT TRANSFER SCALE CON SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS							
Marcas	PELSTAR HEALTH O METER						

Datos de Interes

Vida Util		Miembros Comprometidos	CUERPO HUMANO
Usos	DETERMINACION DEL PESO CORPORAL, GRACIAS A QUE CUENTAN CON UN SISTEMA DIGITAL, FACILITA CALCULAR EL INDICE DE MASA CORPORAL (IMC). LA AMPLIA GAMA DE MODELOS Y SU USO INTECIONAL PERMITE QUE ESTE DIRIGIDO TANTO A NEONATOS, NIÑOS Y PERSONAS ADULTAS. PARA USO EN AMBIENTES HOSPITALARIOS, CONSULTORIOS PARTICULARES Y HOMECARE	Riesgo	I

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
UNIDAD

Roles por Producto

Rol	Tipo.Ident	Identificacion	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	Consecutivo	2019125652	SINDER & CIA S.A.S	AVENIA EL DORADO No 96 A - 47	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
ACONDICIONADOR	Nit	8600700783	IMCOLMEDICA S.A.	CALLE 36 No. 15 - 42	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	diego.gutierrez@imcolmedica.com.co
FABRICANTE	Consecutivo	201704	PANAVIEW METAL PRODUCTS LTD	Li Zhou Jiao 2 Rd., Wei Wu Residents Group Nanya Village, Daojiao Town Dongguan City, Guangdong CHINA 523000	CHINA			
FABRICANTE	Consecutivo	205716	WUXI WEIGHER FACTORY CO. LTD.	MAJIAQIAO GUANGYI WUXI CITY, JIANGSU CHINA 214011	CHINA			
FABRICANTE	Consecutivo	206716	TRANSCELL ELECTRONICS SCALE CO., LTD.	8 XINGYUAN ROAD DONGSHAN INDUSTRIAL PARK, JIANGNING SCIENCE PARK NANJING, JIANGSU CHINA 211100	CHINA			
FABRICANTE	Consecutivo	6546654	PELSTAR LLC	9500 WEST 55TH	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			hernan.malagon@etb.net.co
FABRICANTE	Consecutivo	2017049045	DONGGUAN BEAVER PLASTIC & METAL PRODUCTS CO., LTD	Shui Ping Village, Da Lang Town Dongguan City, Guangdong CHINA 523800	CHINA			
IMPORTADOR	Consecutivo	201912565	DISTRIBUIDORA DE LAS AMERICAS S.A.S	Carrera 10 No 16 -39	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
IMPORTADOR	Nit	8600700783	IMCOLMEDICA S.A.	CALLE 36 No. 15 - 42	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	diego.gutierrez@imcolmedica.com.co
TITULAR REGISTRO SANITARIO	Consecutivo	6546654	PELSTAR LLC	9500 WEST 55TH	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			hernan.malagon@etb.net.co

Imprimir << Atras

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2022**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario **482022000764356-9**

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860070078 | 6. DV.: 3 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: IMCOLMEDICA S.A

13. Dirección: CL 36 15 42 | 15. Teléfono: 2889858 | 12. Cód. Admón.: 48 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860028026 | 25. DV.: 3 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA GRANCOLOMBIANA S.A. NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 0010

29. Número documento de identificación: 37293939 | 30. Apellidos y nombres: RUIZ BENITEZ DIANA MARIA

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	14004	No. 116575012876624	2022 - 11 - 04	No. 28776	2022 - 10 - 30

S

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
8423900000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	215	XXX

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 2I221035 DECLARACION(4-4) PEDIDO: IMP 220139 P-9010 PELSTAR. MERCANCIA NUEVA. VISTO BUENO INVIMA N° VINVIMA-22-0117742. FECHA: 2022-09-30. NOS ACOGEMOS AL DECRETO 272 DE 2018 PARA DESGRAVACION ARANCELARIA 0%.. PRODUCTO: TALLIMETRO METALICO (ADULT HEIGHT ROD), DESTINO: ACCESORIO EXCLUSIVO PARA TODAS LAS REFERENCIAS DE BALANZAS PARA PESO CORPORAL, MARCA: PELSTAR /HEALTH O METER, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: ITEM: ADULTHR, USO O DESTINO: PARA USO EN AMBIENTES HOSPITALARIOS, CONSULTORIOS PARTICULARES Y HOMECARE, CAPACIDAD: NO APLICA, SERIAL: NO TIENE, (ADULT HEIGHT ROD IN CMS/FEET) BALANZAS PESA-PERSONAS Y PESA BEBES, NEONATALES - ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS - BALANZAS PARA PESO CORPORAL EN ADULTOS, PEDIATRICOS Y NEONATO - PELSTAR HEALT(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: **0**

128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX

129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático

No hay declaración posterior

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración: 482022000764356

133. Feha: 2022 11 18

134. Levante No.	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
482022000677822	2022 - 11 - 18		

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **482022000764356-9**
Subpartida : **8423900000**

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

H O METER. ACCESORIO EXCLUSIVO PARA TODAS LAS REFERENCIAS DE BALANZAS PARA PESO CORPORAL. REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2013DM-0010061, VIGENCIA: 17/07/2023, EXPEDIENTE: 20063493, FABRICANTE: WUXI WEIGHER FACTORY CO. LTD. ORIGEN: CHINA, PRESENTACION COMERCIAL: UNIDAD. RIESGO: I, MERCANCIA NUEVA, AÑO FABRICACION: 2022. LOTE: P2WX2108AR01-500 CANT (10) UNIDADES (ITEM 8).

482022000764356-9

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

Health o meter®

Professional

Models 844KL / 844KL-USB
Digital Floor Scale



ISO 9001:2015
CERTIFIED

ISO13485:2016
CERTIFIED

User Instructions

PELSTAR, LLC 9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA
www.homscales.com

weigheasier®

P/N UM844KL_REV20211019

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS / ESPECIFICACIONES / CERTIFICACIONES / SERVICIO

Precauciones y Advertencias

Para prevenir lesiones y daño a su báscula, por favor siga estas instrucciones muy cuidadosamente.

- No transporte la báscula con objeto alguno sobre la plataforma.
- Para pesajes exactos, se debe colocar la báscula sobre una superficie plana y estable.
- Para pesajes exactos, verifique antes de cada uso el funcionamiento apropiado según el procedimiento descrito en este manual.
- No se utilice en presencia de materiales inflamables.

En ningún caso Pelstar, LLC será responsable por daños o lesiones causados por, o en relación a, el ensamblaje, uso o uso incorrecto de sus productos.

Especificaciones

Esta escala digital de piso exhibe el peso en libras, kilogramos o stones (piedras). También ofrece un bloqueo del peso que permite que la medición permanezca mostrada por 5 segundos luego de bajar de la báscula. Cada báscula de precisión se diseña para proporcionar mediciones de peso exactas, confiables y repetibles y características que hacen el proceso de pesaje simple, rápido y conveniente. Esta báscula está configurada para determinar el peso de un paciente estacionario.

Capacidad y Resolución	Capacidad: 440 lb / 200 kg / 31 st Resolución: 0.1 lb / 0.05 kg / 0.125 lb	
Entorno	Temperaturas de funcionamiento: 10°C a 35°C (50°F a 95°F) Temperaturas de Almacenamiento: 0°C a 50°C (32°F a 125°F) Presión Atmosférica: 500hPa a 1060hPa Humedad Máxima: 85% de HR en uso o almacenada	
Dimensiones Físicas	Tamaño de la Plataforma Ancho: 12 5/8" (321 mm) Largo: 12 5/8" (321 mm) Altura: 1 7/8" (48 mm)	Área Ocupada por el Producto: Ancho: 12 5/8" (321 mm) Largo: 12 5/8" (321 mm) Altura: 1 7/8" (48 mm) Peso: 4 lb (1.8 kg)

Certificaciones

ISO 9001:2015 CERTIFIED ISO13485:2016 CERTIFIED	Pelstar, LLC se ha certificado oficialmente como el fabricante de los dispositivos médicos Health o meter® Professional. El sistema de aseguramiento de calidad de Pelstar LLC cubre el desarrollo, producción, ventas y servicio de básculas médicas y sistemas de medición.

Información de Servicio al Cliente

Esta báscula se envía ensamblada en un embalaje. Examine cuidadosamente el embalaje en busca de daño en el envío antes de desempacar. Si se detecta algún daño, contacte a Servicio al Cliente.

Para ayuda adicional o suporte telefónico, por favor contacte a Servicio al Cliente:
Teléfono: 1 (800) 815-6615 Email: HomProCS@homscales.com

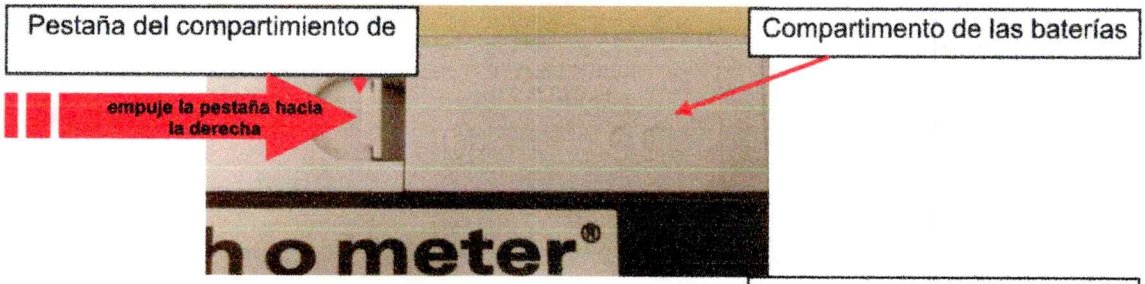
INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN

A fin de evitar daños en la báscula cuando la desempaque, **no use una navaja para cortar cartón, cuchillo o tijeras o cualquier objeto afilado para abrir el empaque protector interno.** Retire la báscula del embalaje y desempaque cuidadosamente, a fin de prevenir rayones en la unidad. Ponga aparte la caja para su almacenamiento.

Instrucciones para las Baterías

La báscula se envía con las baterías ya instaladas. Previo al primer uso, se debe retirar la pestaña de sujeción ubicada en la pestaña del compartimiento de la batería. El compartimiento de baterías está situado en la parte de abajo de la báscula. Para reemplazar las baterías, siga estos pasos.

1. Para abrir la cubierta de las baterías, empuje la pestaña del compartimiento hacia la derecha y tire hacia arriba. **Nota:** Usted NO necesita retirar ningún tornillo para abrir el compartimiento de las baterías.




2. Para retirar las baterías, presione hacia arriba sobre la pestaña blanca que sostiene la batería. Al mover la pestaña se aflojará la batería para que pueda ser removida. Retire ambas baterías y substitúyalas por dos baterías nuevas de Litio de 3V (CR2032). Siga la ilustración de las baterías para asegurarse de que están insertadas con el lado + hacia arriba.



3. Coloque nuevamente la cubierta del compartimento deslizando el extremo de la cubierta dentro del compartimento. Luego presione la pestaña en el compartimento para asegurar la posición de la cubierta.


Seleccionar el Modo de Peso (Kilogramos/KG o Libras/LB), o Stones/ST)

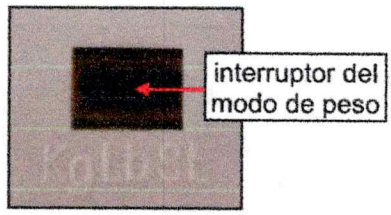1. Para seleccionar el modo de peso, dé la vuelta a la báscula para acceder al interruptor de modo de peso.
2. Deslice el interruptor hacia el modo de peso deseado.
3. La primera posición de la izquierda es para Kilogramos. La posición central es para Libras. La posición de la derecha es para Stones.









Opción de Conectividad del Modelo 844KL

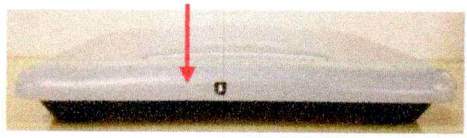El modelo 844KL incluye un puerto USB para conectividad con una PC u otro dispositivo. Para aprender más sobre las opciones de conectividad de esta báscula, por favor contacte a Health o meter® Professional Servicios al Cliente al 1-800-815-6615 o visite homprocs@homscales.com.





INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Medición del Peso

1. Para encender la báscula, golpee suave pero firmemente con su pie en el centro de la plataforma.	
2. Cuatro dígitos aparecerán en la pantalla.	
3. Espere a que 0.0 aparezca en la pantalla.	
4. Suba a la báscula. Permanezca quieto hasta que aparezca el peso.	
5. Después de que el peso se haya fijado, la medición destellará en la pantalla.	
6. El peso seguirá mostrado por 5 segundos luego de bajar de la báscula.	

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS / MANTENIMIENTO & LIMPIEZA

Consulte las instrucciones siguientes para comprobar y corregir cualquier falla antes de entrar en contacto con Servicio al Cliente.

Si la pantalla muestra el mensaje de "Lo bAtt", substituya las baterías según las instrucciones en la página 4.	
Si la pantalla muestra "Err E", la carga sobre la báscula excede la capacidad. 440 lb / 200 kg / 31 st	

Para ayuda adicional, por favor contacte a soporte técnico sin costo al 1 (800) 638-3722.

Mantenimiento

Precaución: Antes del primer uso, o después de períodos largos de falta de uso, revise la operación y funciones apropiadas de la báscula. Si la báscula no funciona correctamente, consulte al personal de servicio calificado.

1. Compruebe el aspecto general de toda la báscula para saber si hay daño o desgaste por uso obvios.
2. No la almacene cerca de productos químicos, calefacciones o radiadores.
3. No caiga, no golpee con el pie, ni salte sobre la báscula.
4. Esta báscula es un dispositivo de pesado extremadamente sensible. No almacene objeto alguno encima de la plataforma de la báscula.
5. Si su báscula deja de funcionar correctamente, no intente desarmarla. Esto anulará su garantía.

Limpieza y Desinfección

El cuidado apropiado y la limpieza son esenciales para asegurar una larga vida de pesaje exacto y efectivo.

1. Health o meter® Professional recomienda usar una solución suave de detergente sobre un paño suave o toallita desechable:
2. Después de la limpieza/desinfección, pase un paño humedecido con agua y luego un paño limpio y seco. Para evitar la acumulación de residuos o superficies mojadas, asegúrese de que todos los componentes de la báscula están completamente secos luego de la limpieza.
3. Nunca utilice materiales ásperos o abrasivos para limpiar la báscula, ya que éstos arruinan el acabado de la misma.
4. No sumerja la báscula en agua o en ningún otro líquido.
5. No vierta ni atomice líquidos directamente sobre la báscula.

GARANTÍA

Garantía Limitada de 1 Año

¿Qué Cubre la Garantía?

Este producto Health o meter® Professional está garantizado desde la fecha de compra contra defectos de materiales o de fabricación por un periodo de un (1) año. Si el producto no funciona correctamente, regrese el producto con flete pre-pagado y apropiadamente empacado a Pelstar, LLC (vea la sección "Obtener Servicio de Garantía", abajo, para obtener instrucciones.) Si el fabricante determina que existe un defecto en los materiales o en la fabricación, el único recurso del cliente será el reemplazo de la báscula sin costo alguno. El reemplazo será hecho con un producto o componente nuevo o remanufacturado. Si el producto no está disponible ya, el reemplazo puede realizarse con un producto similar de valor igual o mayor. Todas las partes reemplazadas se cubren sólo por el periodo de garantía original.

¿Quién Tiene Cobertura?

El comprador original del producto debe tener un comprobante de compra para recibir el servicio de garantía. Por favor guarde su factura o recibo. Los distribuidores de Pelstar o las tiendas al menudeo que venden los productos de Pelstar no tienen el derecho de alterar o modificar o en forma alguna cambiar los términos y condiciones de esta garantía.

¿Qué Se Excluye?

Su garantía no cubre el desgaste normal de partes como resultado de cualquiera de las siguientes condiciones: uso negligente o uso incorrecto del producto, uso de voltaje o corriente incorrectos, uso contrario a las instrucciones de operación, abuso incluyendo manipulación, daño en el transporte, o la reparación o alteraciones no autorizadas. Además, la garantía no cubre desastres naturales, tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados. Esta garantía le concede derechos legales específicos, y usted podría tener otros derechos que varían de país a país, de estado a estado, de provincia a provincia o de jurisdicción a jurisdicción.

Para obtener Servicio de Garantía, asegúrese de guardar su recibo de compra o documento que pruebe la compra. Llame al (+1) 800-638-3722 o al (+1) 708-377-0600 para recibir un número de autorización de devolución (RA), lo cual debe incluirse en la etiqueta de devolución. Incluya su comprobante de compra al producto defectuoso junto con su nombre, dirección, número telefónico durante el día y la descripción del problema. Empaquete cuidadosamente el producto y envíelo con el envío y el seguro prepagados a:

Pelstar, LLC

Attention (Atención) #R/A_____

Return Department (Departamento de Devoluciones)

9500 West 55th Street

McCook, IL 60525

PELSTAR, LLC

9500 West 55th Street • McCook, IL 60525 • USA

1-800-638-3722 o 1-708-377-0600

POR FAVOR REGISTRE SU BÁSCULA PARA COBERTURA DE GARANTÍA EN:

www.homscales.com

Health o meter® es una marca registrada de Sunbeam Products, Inc. usada bajo licencia.

Los productos Health o meter® Professional son fabricados, diseñados, y de propiedad de Pelstar, LLC.

Nos reservamos el derecho de mejorar, realzar, o modificar las características o especificaciones de los productos Health o meter® Professional sin previo aviso.

© Pelstar, LLC 2019

P/N UM844KL_REV20211019

	ESE HOSPITAL SAN ISIDRO NIT: 800 025 221-1 ALPUJARRA-TOLIMA DIRECCION:Carrera 5 No.5-43 TEL.3212011134 HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS	CODIGO H17 VERSION 4 PAG 1-3

Nombre del equipo:	BASCULA DE PISO
#. de activo fijo:	
Marca:	HEALTH O METER
Modelo:	844KL
Serie:	8440134111
Invima:	**2013DM-0010061**



DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

Instrumento de pesaje de funcionamiento automático que utilizan la acción de la gravedad para determinación de la masa. Consiste en una plataforma de vidrio templado como soporte para el pesaje de pacientes, posee una pantalla LCD para la visualización del peso medio.

PARTES O ELEMENTOS DEL EQUIPO	REFERENCIA	ACCESORIOS
----	----	----
----	----	----
----	----	----

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS DEL EQUIPO

Voltaje Operación [V]	6	Peso [Kg]	----				
Voltaje máx. Operación [V]	6	Capacidad	0-180 kg				
Corriente máx. operación [A]	----	Dimensiones	----				
Corriente min. operación [A]	----	Años de vida del Equipo	5				
Potencia Consumida [W]	----	Requiere Agua	SI	-	NO	X	
Frecuencia [Hz]	----	Requiere Gas Propano	SI	-	NO	X	
Presión [Bar]	----	Requiere Combustible	SI	-	NO	X	
Velocidad [W]	----	Requiere Gases medicinales					

INFORMACIÓN DE ADQUISIÓN E INSTALACIÓN

Fabricante	HEALTH O METER	Forma de adquisición	COMPRA DIRECTA
Teléfono	1 708 377 0600	Costo de Adquisición	$443.522,66
Dirección	9500WEST 55 TH STREET MCCOOK, IL 60525	Fecha de compra	8/06/2023
Lugar de Origen	NO REGISTRA	Fecha de Instalación	NO REGISTRA
Proveedor	FLEMING BIOMEDICA	Inicio Garantía	NO REGISTRA
Teléfono	871 5629	Finalización Garantía	NO REGISTRA
Dirección	Calle 9 No. 15 - 36,	Fecha de puesta en servicio	NO REGISTRA
Email	flemingbiomedicasas@gmail.com		

	ESE HOSPITAL SAN ISIDRO NIT: 800 025 221-1 ALPUJARRA-TOLIMA DIRECCION:Carrera 5 No.5-43 TEL.3212011134 HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS	CODIGO H17 VERSION 4 PAG 2 - 3

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
BASCULA DE PISO	HEALTH O METER	844KL	8440134111

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

1. No utilice líquidos volátiles, como disolventes o bencina, debido a que provocarán que los materiales se fundan o se
2. No derramar liquidos sobre el equipo para evitar cortos del sistema eléctrico interno
3. verificar baterias antes de usar.
4. Revisar que la plataforma se encuentre estable para mayor seguridad del usuario.
5. ----------
6. ----------
7. ----------

CLASIFICACIÓN DE DISPOSITIVO MÉDICO(RIESGO)							
I	X	IIA	-	IIB	-	III	-

UBICACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO: ALMACEN

MANUALES TÉCNICOS	
Operación	----
Mantenimiento	X
Partes	----
Despieces	----

PLANOS	
Eléctricos	----
Electrónicos	----
Hidráulicos	----
Neumáticos	----
Mecánicos	----

CLASIFICACIÓN POR USO	
Médico	X
Básico	-
Apoyo	-

TECNOLOGÍA PREDOMINATE	
Eléctrico	-
Electrónico	X
Mecánico	-
Electromecánico	-
Hidráulico	-
Neumático	-
Vapor	-
Solar	-

CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	
Diagnóstico	X
Tratamiento Y Mantenimiento de la vida	-
Rehabilitación	-
Prevención	-
Análisis Laboratorio	-
Mantenimiento	-

CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA

TIPO	-	CLASE	-

CALIBRACIÓN

Requiere Calibración: SI

Variables susceptibles a calibración					
	Presión	-	Tiempo	-
	Temperatura	-	Co2	-
	Volumen	-	Co	-
	Impedancia	-	RPM	-
	Marcapasos	-	Humedad	-
	Respiración	-	flujo	-
	G. Cardiáco	-	Fc	-
	Ibp	-	Ecg	-
	Energía	-	Spo2	-
	Nibp	-	Peso	X

MANTENIMIENTO

TIPO:

PREVENTIVO	Semestralmente orientado al riesgo
CORRECTIVO	Por llamado

PERIODICIDAD DE CALIBRACIÓN DEFINIDA | SEGÚN PLAN DE ASEGURAMIENTO METROLÓGICO

Condiciones de Recepción de Equipo	Nuevo	Usado	Repotenciado
	X	-	-

RESPONSABLE DEL EQUIPO

	ESE HOSPITAL SAN ISIDRO NIT: 800 025 221-1 ALPUJARRA-TOLIMA DIRECCION:Carrera 5 No.5-43 TEL.3212011134 HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS	CODIGO H17 VERSION 4 PAG 3 - 3

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
BASCULA DE PISO	HEALTH O METER	844KL	8440134111

RUTINA DE MANTENIMIENTO
ACTIVIDADES
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.
Verificar que el equipo se encuentra funcionando correctamente
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo
Inspeccionar los componentes electrónicos
Verificacion de soporte que se encuentre estable y seguro.
Verificación de pantalla LCD

FECHA	No. INFORME	TIPO DE MANTENIMIENTO	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO

ESE HOSPITAL SAN ISIDRO NIT: 800.025.221-1 ALPUJARRA - TOLIMA	CODIGO	HD-D-17
	VERSION	3
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS MEDICOS		

REGISTRO HISTORICO DE MANTENIMIENTO

FECHA	No. INFORME	TIPO DE MTTO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
20/9/23	AL-26092081	Instalacion	ver report	[firma]

REPORTE DE SERVICIO No AL-26092093
NIT. 830.130.882-8

FLEMING BIOMEDICA S.A.S.
INGENIERIA BIOMEDICA
NIT: 830.130.882-8

1. Clasificación del servicio

1.1 tipo de servicio				1.2 carácter				
Preventivo [X]	Correctivo [ ]	Instalación [ ]	Capacitación [ ]	Garantía [ ]	Contrato [X]	Factura [ ]	Otro [ ]	
Ingeniero / Técnico				**Ciudad/Municipio**			**Fecha (Día/Mes/Año)**	
ALEX CAMILO OVIEDO CLAROS				*ALPUJARRA-TOLIMA*			*20/09/2023*	

2. Datos del cliente

Nombre del Cliente *ESE HOSPITAL SAN ISIDRO ALPUJARRA*	Teléfono 6088389027
Funcionario / Contacto	Cargo

3. Datos del equipo

Nombre del Equipo: *BASCULA*		No. De Contrato:	Inventario: *N/R*
Ubicación: *ALMACEN*	Marca: *HEALTH O METER*	Modelo: *844KL*	Serie: *8440134111*

4. Descripción del servicio

4.1. Falla Reportada y/o detectada: *INSTALACION DE EQUIPOS NUEVOS.*

4.2. Acción correctiva o procedimiento realizado: [✓]

[X] Revisión inicial del equipo	[ ] Pruebas neumáticas	[ ] Limpieza externa e interna de componentes y ajustes de conectores
[X] Mantenimiento de acuerdo con el protocolo	[ ] Pruebas hidráulicas	[ ] Pruebas finales de todas las funciones del equipo
[ ] Revisión y mantenimiento sistema eléctrico	[ ] Validación y configuración software	[ ] Validación y puesta en marcha del equipo
[ ] Revisión y mantenimiento sistema mecánico	[ ] Revisión y funcionamiento del sistema U.S.	[X] El equipo queda trabajando bien
[ ] Revisión y mantenimiento sistema electrónico	[ ] Revisión de accesorios	[ ] Acciones correctivas / ver observaciones

Descripción de la Intervención: *SE REALIZA INSTALACION DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS, DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS.*

5. Cambio o instalación de partes: **SI:** [ ] **NO:** [X]

Partes Requeridas

Cantidad	Descripción	No. de Parte	No. de Serie
----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------
----------	----------	----------	----------

6. Observaciones: *SE REALIZA ENTREGA E INSTALACION DE LOS EQUIPOS NUEVOS EN GARANTIA CON SUS RESPECTIVOS DOCUENTOS, MANUALES Y ACESORISOS, SEGÚN CONTRATO.*

7. Estatus del Servicio: Concluido [X] En proceso [ ] Equipo fuera de servicio [ ] Otro: _____

8. Calificación del Servicio: [1] [2] [3] [4] [5]

Hora de Llegada: [ ]

Fecha y Hora de Salida: [ ] [ ]

Ingeniero/Técnico:
Firma
Nombre (En letra legible):
ALEX OVIEDO

Cliente:
Firma
Nombre (En letra legible):

Solución Global en Tecnología Hospitalaria

NEIVA CLL. 9N° 15-36 Telefax: 8715629-8711585
Cels.: 312 478 1505 - 310 298 6222
Frente al Hospital Universitario

BOGOTÁ CLL. 24C No. 70-25
Torre 2 Of. 202 Cels: 3202655657 - 3132845366

EJE CAFETERO: Cel: 3232304601
CALI: Cel: 3222173674

BUCARAMANGA: Cel: 3143105953
BARRANQUILLA: Cel: 3214863668

www.flemingbiomedica.com E-mail: soporte@flemingbiomedica.com

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CERTIFICADO N° RV202309-3722
CERTIFICATE N°

Respaldo Vital Metrología Biomédica S.A.S
NIT. 900.582.168 - 1

INFORMACION GENERAL
GENERAL INFORMATION

SOLICITANTE: *CONSTUMER:*	E.S.E HOSPITAL SAN ISIDRO	**DIRECCIÓN:** *ADDRESS:*	CARRERA 5 # 5A-43
NIT: *NIT:*	800025221-1	**TELEFONO:** *PHONE:*	3212011134
DESCRIPCION DEL EQUIPO: *EQUIPMENT DESCRIPTION:*	BASCULA	**FABRICANTE:** *MANUFACTURER:*	HEALTH O METER
SERIE: *SERIAL Nº.*	8440134111	**MODELO:** *MODEL:*	844KL
ACTIVO FIJO: *FIXED ASSETS:*	NO REGISTRA	**DEPENDENCIA:** *DEPENDENCE:*	ALMACEN
LUGAR DE CALIBRACIÓN: *CALIBRATION PLACE:*	ALMACEN	**FECHA DE INGRESO:** *INGRESS DATE:*	2023-09-21
FECHA DE CALIBRACIÓN: *CALIBRATION DATE:*	2023-09-21	**FECHA DE EMISIÓN:** *ISSUANCE DATE:*	2023-09-21
NÚMERO DE PÁGINAS: *NUMBER OF PAGES:*	3	**INCLUYENDO ANEXOS:** *INCLUDING ANNEXES:*	0

MÉTODO DE CALIBRACION
CALIBRATION METHOD

El procedimiento aplicado por RESPALDO VITAL S.A.S asegura la toma de datos y el cálculo de resultados mediante el procedimiento interno MET-P-008. El valor convencional de medición es determinado usando el método de comparación directa con un patrón de referencia. *The procedure applied by RESPALDO VITAL S.A.S ensures data collection and results calculation through the internal procedure MET-P-008 . Conventional measurement value is determined by the direct comparison method with a reference pattern.*

TRAZABILIDAD METROLÓGICA
METROLOGICAL TRACEABILITY

EQUIPO PATRON *PATTERN EQUIPMENT*	FABRICANTE *MANUFACTURER*	MODELO *MODEL*	Nº INVENTARIO *SERIAL*	FECHA DE CALIBRACION *CALIBRATION DATE*	CERTIFICADO Nº *CERTIFICATE N*
MASA PATRON 5KG (2)	SB LTDA	PARALELEPIPEDO RECTANGULAR	CLB033, CLB034, CLB035	9/11/2021 - 21/04/2021	M-6764, M-5914
MASA PATRON 10 KG (3)	SB LTDA	PARALELEPIPEDO RECTANGULAR	CLB033, CLB034, CLB035	9/11/2021 - 21/04/2021	M-6764, M-5914
MASA PATRON 20 KG (9)	SB LTDA	PARALELEPÍPEDO	CLB036, CLB037, CLB038, CLB039, CLB040, CLB041, CLB042, CLB043, CLB044	9/11/2021, 25/03/2022, 25/03/2022, 21/04/2021, 21/04/2021, 21/04/2021, 21/04/2021	7182, M-6765, M-5909, M-5912,M-5911, M-5913, M-5910

CONDICIONES AMBIENTALES

TEMPERATURA INICIAL: *INITIAL TEMPERATURE:*	21,4	°C	**TEMPERATURA FINAL:** *FINAL TEMPERATURE:*	22,4	°C
HUMEDAD REL INICIAL: *INITIAL RELATIVE HUMIDITY:*	55	%HR	**HUMEDAD REL FINAL:** *FINAL RELATIVE HUMIDITY:*	56	%HR

INCERTIDUMBRE:
UNCERTAINTY:

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura de **k** y la probabilidad de cobertura de aproximadamente 95%. La regla de decisión aplicada en estos casos será |Error| +U ≤ EMP según la Guia ISO/IEC 98-4 Aplicando la declaracion Binaria con zona de seguridad ,si cumple la anterior condición la medición se toma como conforme y registrará un pasa, en caso contrario se registrá falla. La probabilidad de dar una aceptación falsa o un rechazo falso no lo determina el laboratorio RESPALDO VITAL S.A.S, sin embargo se puede calcular de acuerdo a la guia ISO/IEC 98-4. *The reported expanded measurement uncertainty is stated as the standard measurement uncertainty multiplied by the coverage factor of k and the coverage probability of approximately 95%. The decision rule applied in these cases will be |Error| +U ≤ EMP according to the ISO/IEC Guide 98-4 Applying the Binary declaration with security zone, if the previous condition is met, the measurement is taken as compliant and will register a pass, otherwise a failure will be registered. The probability of giving a false acceptance or a false rejection is not determined by the RESPALDO VITAL S.A.S laboratory, however it can be calculated accordingly according to the ISO/IEC 98-4 guide.*

Firma Autorizadas
Autorizad Signature

María Alejandra Rivera
Coordinador de Metrologia
RESPALDO VITAL S.A.S
Revisado y Aprobado

Cel. 3146559513
coordlaboratorio@respaldovital.com.co
respaldovitalsas@gmail.com
www.respaldovital.com.co
Cll. 9 N°15-36 Local 1 /Br Altico, Neiva - Colombia

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CERTIFICADO N° RV202309-3722
CERTIFICATE N°

Respaldo Vital Metrología Biomédica S.A.S
NIT. 900.582.168 - 1


RESULTADOS DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION RESULTS

Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al equipo, momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.RESPALDO VITAL S.A.S., no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los equipos calibrados.RESPALDO VITAL S.A.S declara que sus mediciones son trazables metrológicamente empleando patrones calibrados por medio de aboratorios competentes acreditados conforme a la Norma ISO/IEC 17025. *The results contained in this report relate to the equipment, time and conditions under which measurements were made .RESPALDO VITAL S.A.S. , not responsabilza for damages that may result from improper use of the equipment calibrated. RESPALDO VITAL S.A.S declares that its measurements are metrologically traceable using standards calibrated by competent laboratories accredited in accordance with ISO/IEC 17025 Standard.*

DESVIACIÓN LINEAL

INTERVALO DE TRABAJO: 0-180 *WORK INTERVAL:*
RESOLUCIÓN: 0,1 *RESOLUTION:*
INTERVALO DE MEDICIÓN: 0 - 100 *MEASUREMENT INTERVAL:*


Valor Nominal (Kg)	Valor Promedio (Kg)	Error (Kg)	Incertidumbre Expandida (Kg)		Error máximo permitido (Kg)		Conforme/No conforme
0	0,00	0,00	±	0,06	±	1	Conforme
20	20,00	0,00	±	0,06	±	1,2	Conforme
40	39,90	-0,10	±	0,06	±	1,4	Conforme
60	59,80	-0,20	±	0,06	±	1,6	Conforme
80	79,80	-0,20	±	0,06	±	1,8	Conforme
100	99,70	-0,30	±	0,06	±	2	Conforme

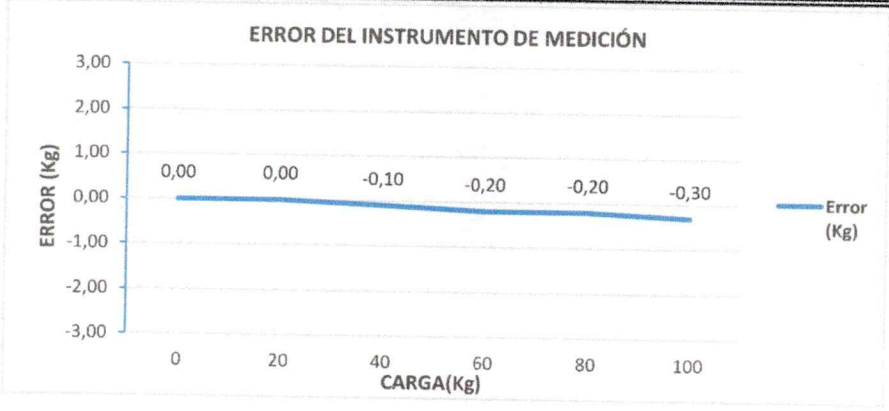


EXCENTRICIDAD

APROX 1/3 DE LA CARGA MAXIMA 35

Punto de referencia	Valor Promedio (Kg)	Error (Kg)
1	34,9	-0,1
2	34,9	-0,1
3	34,9	-0,1
4	35	0
5	34,9	-0,1
1	34,9	-0,1





Cel. 3146559513
coordlaboratorio@respaldovital.com.co
respaldovitalsas@gmail.com
www.respaldovital.com.co
Cll. 9 N°15-36 Local 1 /Br Altico, Neiva - Colombia

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO N° RV202309-3722

CERTIFICATE N°

REPETIBILIDAD

APROX 1/2 DE LA CARGA MÁXIMA	50

Valor Nominal (Kg)	Valor Promedio (Kg)	Error (Kg)
50	49,90	-0,10
50	49,90	-0,10
50	49,90	-0,10
50	49,90	-0,10
50	49,90	-0,10

OBSERVACIONES

OBSERVATIONS

SIN NOVEDAD

DECLARACIONES

STATEMENT

Este certificado expresa el resultado de las mediciones realizadas. No puede ser reproducido, excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito por RESPALDO VITAL S.A.S. De igual forma este certificado no es valido si se presenta de forma parcial. *This certificate faithfully expresses the result of the measurements carried out. It cannot be reproduced, except when written permission has been obtained by In the RESPALDO VITAL S.A.S. same way, this certificate is not valid if it is presented partially.*

El tratamiento de los datos personales consignados en este documento están protegidos por RESPALDO VITAL S.AS., de conformidad con la Ley 1581 de 2012, garantizado la confidencialidad en el manejo adecuado de la información. *The treatment of the personal data consigned in this document is protected by RESPALDO VITAL S.A.S., in accordance with Law 1581 of 2012, guaranteeing confidentiality in the proper handling of the information.*

«««« FIN DE CERTIFICADO »»»»

«««« END OF CERTIFICATE »»»»

<< Atras

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20063493	Nombre producto	**BALANZAS PESA-PERSONAS Y PESA BEBES, NEONATALES - ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS - BALANZAS PARA PESO CORPORAL EN ADULTOS, PEDIATRICOS Y NEONATO - PELSTAR HEALTH O METER**				
Registro Sanitario	INVIMA 2013DM-0010061	Vencimiento	2023/07/17	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: BALANZAS MÉDICAS DIGITALES (DIGITAL PHYSICIAN SCALES) 349KLX, 499KL, 500KL, 597KL, 597KG, 599KL, 599KG, 600KL, 600KG, 752KL, 752KG, 753KL BALANZAS PEDIÁTRICAS DIGITALES (DIGITAL PEDIATRIC SCALES) 522KL, 524KL, 553KL, 549KL BALANZAS PEDIÁTRICAS MECÁNICAS (MECHANICAL PEDIATRIC SCALES) 386KGS-01, 386S-01. BALANZAS DIGITALES PARA SILLAS DE RUEDAS (DIGITAL WHEELCHAIR SCALES) 2400KL, 2500KL, 2500KG, 2600KL, 2600KG, 2650KL, 2650KG, 2700KL BALANZA DIGITAL TIPO CAMILLA (DIGITAL STRETCHER SCALE) 2000KL. BALANZA DIGITAL DE SILLA DE RUEDA Y ASIENTO PLEGABLE (DIGITAL WHEELCHAIR SCALE AND FLIP SEAT) 2500CKL BALANZAS DIGITALES DE PLATAFORMA (DIGITAL PLATFORM SCALES) 1100KL, 2101KL, 2101KG. BALANZAS DIGITALES TIPO SILLA (DIGITAL CHAIR SCALES) 2595KL, 2595KG, 594KL. BALANZAS MECÁNICAS DE PISO (MECHANICAL FLOOR SCALES) 100KG, 100LB, 142KL, 160KL, 160KG, 160LB, 175LB. BALANZAS DIGITALES DE PISO (DIGITAL FLOOR SCALES) 800KL, 844KL, 822KL. BALANZA DE ESPECIMENES (DIGITAL SPECIMEN/LAPSPONGE SCALE) BALANZAS MECANICA TIPO BARRA (MECHANICAL PHYSICIAN BEAM SCALES) 400KL, 402KL, 402KLWH, 402LB, 402KLWH, 402KG, 450KL, 450KLWH. BALANZAS MECANICA PEDIATRICA TIPO BARRA (MECHANICAL PEDIATRIC BEAM SCALES) 1522KL, 1524KL . BALANZA NEONATAL (NEONATAL SCALE) 2210KL BALANZA PAÑAL (DIAPER SCALE) YG500R. BALANZA MECÁNICA TIPO SILLA (MECHANICAL CHAIR SCALE) 445KL. BALANZA DIGITAL PEDIÁTRICA PORTATIL (PEDIATRIC PORTABLE DIGITAL SCALE) 8320KL. TALLIMETROS (HEIGHT MEASUREMENT) PORTROD, STROD, PROPLUSROD, WMROD, 402KLROD, 499KLROD. CARRITO MEDICO PROFESIONAL (PROFESSIONAL MEDICAL CART) 2210CART. MALETIN DE TRANSPORTE PARA BALANZA 752KG, 64771. KIT DE CONECTIVIDAD. C-HOMWA-1, L-HOMWA-1. 498KL REMOTE DISPLAY DIGITAL PHYSICIAN SCALE - LB/KG 600KL-BT DIGITAL EYE LEVEL SCALE, DIGITAL HEIGHT ROD & AUTOMATIC BMI WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 501KL DIGITAL EYE LEVEL STAND-ON SCALE W/ HEIGHT ROD - LB/KG (POWER ADAPTER NOT INCLUDED) 501KG DIGITAL EYE LEVEL STAND-ON SCALE W/ HEIGHT ROD - KG (POWER ADAPTER NOT INCLUDED) 501KL-BT DIGITAL EYE LEVEL STAND-ON SCALE W/ HEIGHT ROD - LB/KG (POWER ADAPTER NOT INCLUDED) WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 501KG-BT DIGITAL EYE LEVEL STAND-ON SCALE W/ HEIGHT ROD - KG (POWER ADAPTER NOT INCLUDED) WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 550KL INFANT TO TODDLER, 2 IN 1 DIGITAL SCALE 522KG PEDIATRIC DIGITAL SCALE W/ TRAY - KG (POWER ADAPTER NOT INCLUDED) 524KG PEDIATRIC DIGITAL SCALE W/ SEAT - KG (POWER ADAPTER NOT INCLUDED) 549KG PEDIATRIC DIGITAL SCALE - KG 553KG PEDIATRIC DIGITAL SCALE - KG (POWER ADAPTER NOT INCLUDED) 2400KG PORTABLE DIGITAL WHEELCHAIR SCALE - KG 2400KL-BT PORTABLE DIGITAL WHEELCHAIR SCALE - IB/KG WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 2400KG-BT PORTABLE DIGITAL WHEELCHAIR SCALE - KG WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 2500KL-BT DIGITAL WHEELCHAIR SCALE WITH HANDRAILS - IB/KG WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 2500KG-BT DIGITAL WHEELCHAIR SCALE WITH HANDRAILS - KG WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 2600KL-BT PORTABLE/FOLDING DIGITAL WHEELCHAIR SCALE W/ HANDRAILS - IB/KG - 1 RAMP WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 2600KG-BT PORTABLE/FOLDING DIGITAL WHEELCHAIR SCALE W/ HANDRAILS - KG - 1 RAMP WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 2610KL PORTABLE/FOLDING DIGITAL WHEELCHAIR SCALE W/ HANDRAILS - IB/KG - 2 RAMPS 2610KG PORTABLE/FOLDING DIGITAL WHEELCHAIR SCALE W/ HANDRAILS - KG - 2 RAMPS 2610KL-BT PORTABLE/FOLDING DIGITAL WHEELCHAIR SCALE W/ HANDRAILS - IB/KG - 2 RAMPS WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 2610KG-BT PORTABLE/FOLDING DIGITAL WHEELCHAIR SCALE W/ HANDRAILS - KG - 2 RAMPS WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 2650KL-BT DIGITAL PORTABLE WHEELCHAIR SCALE - IB/KG (35" X 32" PLATFORM) WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 2650KG-BT DIGITAL PORTABLE WHEELCHAIR SCALE - KG (35" X 32" PLATFORM) WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 2700KG DIGITAL PORTABLE WHEELCHAIR SCALE - KG (44" X 42" PLATFORM) 2700KL-BT DIGITAL PORTABLE WHEELCHAIR SCALE - IB/KG (44" X 42" PLATFORM) WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 2700KG-BT DIGITAL PORTABLE WHEELCHAIR SCALE - KG (44" X 42" PLATFORM) WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 3001KL-AM ANTIMICROBIAL PLATFORM SCALE - ASSEMBLED - IB/KG (POWER ADAPTER NOT INCLUDED) 3001KG-AM ANTIMICROBIAL PLATFORM SCALE - ASSEMBLED - KG (POWER ADAPTER NOT INCLUDED) 3001KL-AMX ANTIMICROBIAL PLATFORM SCALE WITH LONG RAILS - ASSEMBLED - IB/KG (POWER ADAPTER NOT INCLUDED) 3001KG-AMX ANTIMICROBIAL PLATFORM SCALE WITH LONG RAILS - ASSEMBLED - KG (POWER ADAPTER NOT INCLUDED) 3001KL-AMUA ANTIMICROBIAL PLATFORM SCALE - UNASSEMBLED - IB/KG (POWER ADAPTER NOT INCLUDED) 3001KG-AMUA ANTIMICROBIAL PLATFORM SCALE - UNASSEMBLED - KG (POWER ADAPTER NOT INCLUDED) 1100KG DIGITAL PLATFORM SCALE WITH HANDRAILS - KG 1100KL-BT DIGITAL PLATFORM SCALE WITH HANDRAILS - IB/KG WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 1100KG-BT DIGITAL PLATFORM SCALE WITH HANDRAILS - KG WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 2101KL-BT DIGITAL PLATFORM SCALE WITH HANDRAILS - IB/KG WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 2101KG-BT DIGITAL PLATFORM SCALE WITH HANDRAILS - KG WITH PELSTAR WIRELESS TECHNOLOGY 596KL PORTABLE DIGITAL SCALE - IB/KG 880KL HEAVY DUTY DIGITAL FLOOR SCALE 894KLT TALKING DIGITAL FLOOR SCALE PACK OF 2 - IB/KG 895KLT TALKING DIGITAL FLOOR SCALE PACK OF 2 - IB/KG 402KG50 MECHANICAL BEAM SCALE W/FIXED POISE BAR W/HEIGHT ROD IN KG ONLY, 50 GRAM INCREMENTS 201HR WALL MOUNTED TELESCOPIC METAL HEIGHT ROD 205HR HIGH-STRENGTH WALL MOUNTED HEIGHT ROD ADULTHR ADULT HEIGHT ROD - CM AND FT BABYHR BABY HEIGHT ROD - CM AND FT 3001HR HEIGHT ROD FOR 3001KL-AM &3001KL-AMUA EBABYHR DIGITAL BABY HEIGHT ROD BABYSLINGSCALE BABY SLING HANGING SCALE IB/KG PELSTARONE PELSTAR WIRELESS KIT ENABLES THE TRANSMISSION OF SCALE DATA TO A WELCH ALLYN CVSM CON RADICADO 20201011671 SE APRUEBA LA ADICION DE REFERENCIAS: 3400KL, DIGITAL WET DIAPER/LAP SPONGE/ORGAN WITH PAN - G/OZ 3400KG, DIGITAL WET DIAPER/LAP SPONGE/ORGAN WITH PAN - G 3401KL, DIGITAL WET DIAPER/LAP SPONGE/ORGAN WITH TRAY - G/OZ BCS-G6-ADULT BODY COMPOSITION SCALE - ADULT BODY BCS-G6-LIMBS BODY COMPOSITION SCALE - ADULT INCLUDING LIMBS BCS-G6-DUO BODY COMPOSITION SCALE - ADULT AND PEDIATRIC BCS-G61-UPPER BODY COMPOSITION SCALE - UPPER BODY ONLY PTS-1000KL PATIENT TRANSFER SCALE CON SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS							
Marcas	PELSTAR HEALTH O METER						

Datos de Interes

Vida Util		Miembros Comprometidos	CUERPO HUMANO
Usos	DETERMINACION DEL PESO CORPORAL, GRACIAS A QUE CUENTAN CON UN SISTEMA DIGITAL, FACILITA CALCULAR EL INDICE DE MASA CORPORAL (IMC). LA AMPLIA GAMA DE MODELOS Y SU USO INTECIONAL PERMITE QUE ESTE DIRIGIDO TANTO A NEONATOS, NIÑOS Y PERSONAS ADULTAS. PARA USO EN AMBIENTES HOSPITALARIOS, CONSULTORIOS PARTICULARES Y HOMECARE	Riesgo	I

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
UNIDAD

Roles por Producto

Rol	Tipo.Ident	Identificacion	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	Consecutivo	2019125652	SINDER & CIA S.A.S	AVENIA EL DORADO No 96 A - 47	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
ACONDICIONADOR	Nit	8600700783	IMCOLMEDICA S.A.	CALLE 36 No. 15 - 42	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	diego.gutierrez@imcolmedica.com.co
FABRICANTE	Consecutivo	201704	PANAVIEW METAL PRODUCTS LTD	Li Zhou Jiao 2 Rd., Wei Wu Residents Group Nanya Village, Daojiao Town Dongguan City, Guangdong CHINA 523000	CHINA			
FABRICANTE	Consecutivo	205716	WUXI WEIGHER FACTORY CO. LTD.	MAJIAQIAO GUANGYI WUXI CITY, JIANGSU CHINA 214011	CHINA			
FABRICANTE	Consecutivo	206716	TRANSCELL ELECTRONICS SCALE CO., LTD.	8 XINGYUAN ROAD DONGSHAN INDUSTRIAL PARK, JIANGNING SCIENCE PARK NANJING, JIANGSU CHINA 211100	CHINA			
FABRICANTE	Consecutivo	6546654	PELSTAR LLC	9500 WEST 55TH	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			hernan.malagon@etb.net.co
FABRICANTE	Consecutivo	2017049045	DONGGUAN BEAVER PLASTIC & METAL PRODUCTS CO., LTD	Shui Ping Village, Da Lang Town Dongguan City, Guangdong CHINA 523800	CHINA			
IMPORTADOR	Consecutivo	201912565	DISTRIBUIDORA DE LAS AMERICAS S.A.S	Carrera 10 No 16 -39	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
IMPORTADOR	Nit	8600700783	IMCOLMEDICA S.A.	CALLE 36 No. 15 - 42	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	diego.gutierrez@imcolmedica.com.co
TITULAR REGISTRO SANITARIO	Consecutivo	6546654	PELSTAR LLC	9500 WEST 55TH	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			hernan.malagon@etb.net.co

Imprimir << Atras

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2022**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario **482022000764356-9**

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860070078 | 6. DV.: 3 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: IMCOLMEDICA S.A

13. Dirección: CL 36 15 42 | 15. Teléfono: 2889858 | 12. Cód. Admón.: 48 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860028026 | 25. DV.: 3 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA GRANCOLOMBIANA S.A. NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 0010

29. Número documento de identificación: 37293939 | 30. Apellidos y nombres: RUIZ BENITEZ DIANA MARIA

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	14004	No. 116575012876624	2022 - 11 - 04	No. 28776	2022 - 10 - 30

S

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
8423900000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	215	XXX

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, serialas y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 2I221035 DECLARACION(4-4) PEDIDO: IMP 220139 P-9010 PELSTAR. MERCANCIA NUEVA. VISTO BUENO INVIMA N° VINVIMA-22-0117742. FECHA: 2022-09-30. NOS ACOGEMOS AL DECRETO 272 DE 2018 PARA DESGRAVACION ARANCELARIA 0%.. PRODUCTO: TALLIMETRO METALICO (ADULT HEIGHT ROD), DESTINO: ACCESORIO EXCLUSIVO PARA TODAS LAS REFERENCIAS DE BALANZAS PARA PESO CORPORAL, MARCA: PELSTAR /HEALTH O METER, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: ITEM: ADULTHR, USO O DESTINO: PARA USO EN AMBIENTES HOSPITALARIOS, CONSULTORIOS PARTICULARES Y HOMECARE, CAPACIDAD: NO APLICA, SERIAL: NO TIENE, (ADULT HEIGHT ROD IN CMS/FEET) BALANZAS PESA-PERSONAS Y PESA BEBES, NEONATALES - ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS - BALANZAS PARA PESO CORPORAL EN ADULTOS, PEDIATRICOS Y NEONATO - PELSTAR HEALT(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 482022000764356 133. Feha: 2022 11 18
134. Levante No. 482022000677822	135. Fecha: 2022 - 11 - 18	Firma funcionario responsable 136. Nombre 137. C.C. No.

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **482022000764356-9**
Subpartida : **8423900000**

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, serialas y otros)

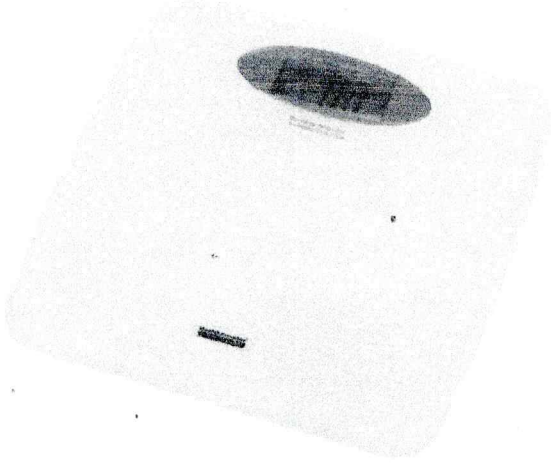
H O METER. ACCESORIO EXCLUSIVO PARA TODAS LAS REFERENCIAS DE BALANZAS PARA PESO CORPORAL. REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2013DM-0010061, VIGENCIA: 17/07/2023, EXPEDIENTE: 20063493, FABRICANTE: WUXI WEIGHER FACTORY CO. LTD. ORIGEN: CHINA, PRESENTACION COMERCIAL: UNIDAD. RIESGO: I, MERCANCIA NUEVA, AÑO FABRICACION: 2022. LOTE: P2WX2108AR01-500 CANT (10) UNIDADES (ITEM 8).

482022000764356-9

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

Health o meter®
Professional

Models 844KL / 844KL-USB
Digital Floor Scale



ISO 9001:2015
CERTIFIED
ISO13485:2016
CERTIFIED

User Instructions

PELSTAR, LLC 9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA
www.homscales.com

weigheasier®

P/N UM844KL_REV20211019

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS / ESPECIFICACIONES / CERTIFICACIONES / SERVICIO

Precauciones y Advertencias

Para prevenir lesiones y daño a su báscula, por favor siga estas instrucciones muy cuidadosamente.

- No transporte la báscula con objeto alguno sobre la plataforma.
- Para pesajes exactos, se debe colocar la báscula sobre una superficie plana y estable.
- Para pesajes exactos, verifique antes de cada uso el funcionamiento apropiado según el procedimiento descrito en este manual.
- No se utilice en presencia de materiales inflamables.

En ningún caso Pelstar, LLC será responsable por daños o lesiones causados por, o en relación a, el ensamblaje, uso o uso incorrecto de sus productos.

Especificaciones

Esta escala digital de piso exhibe el peso en libras, kilogramos o stones (piedras). También ofrece un bloqueo del peso que permite que la medición permanezca mostrada por 5 segundos luego de bajar de la báscula. Cada báscula de precisión se diseña para proporcionar mediciones de peso exactas, confiables y repetibles y características que hacen el proceso de pesaje simple, rápido y conveniente. Esta báscula está configurada para determinar el peso de un paciente estacionario.

Capacidad y Resolución	Capacidad: 440 lb / 200 kg / 31 st Resolución: 0.1 lb / 0.05 kg / 0.125 lb	
Entorno	Temperaturas de funcionamiento: 10°C a 35°C (50°F a 95°F) Temperaturas de Almacenamiento: 0°C a 50°C (32°F a 125°F) Presión Atmosférica: 500hPa a 1060hPa Humedad Máxima: 85% de HR en uso o almacenada	
Dimensiones Físicas	Tamaño de la Plataforma Ancho: 12 5/8" (321 mm) Largo: 12 5/8" (321 mm) Altura: 1 7/8" (48 mm)	Area Ocupada por el Producto: Ancho: 12 5/8" (321 mm) Largo: 12 5/8" (321 mm) Altura: 1 7/8" (48 mm) Peso: 4 lb (1.8 kg)

Certificaciones

ISO 9001:2015 CERTIFIED ISO13485:2016 CERTIFIED	Pelstar, LLC se ha certificado oficialmente como el fabricante de los dispositivos médicos Health o meter® Professional. El sistema de aseguramiento de calidad de Pelstar LLC cubre el desarrollo, producción, ventas y servicio de básculas médicas y sistemas de medición.

Información de Servicio al Cliente

Esta báscula se envía ensamblada en un embalaje. Examine cuidadosamente el embalaje en busca de daño en el envío antes de desempacar. Si se detecta algún daño, contacte a Servicio al Cliente.

Para ayuda adicional o suporte telefónico, por favor contacte a Servicio al Cliente:
Teléfono: 1 (800) 815-6615 Email: HomProCS@homscales.com

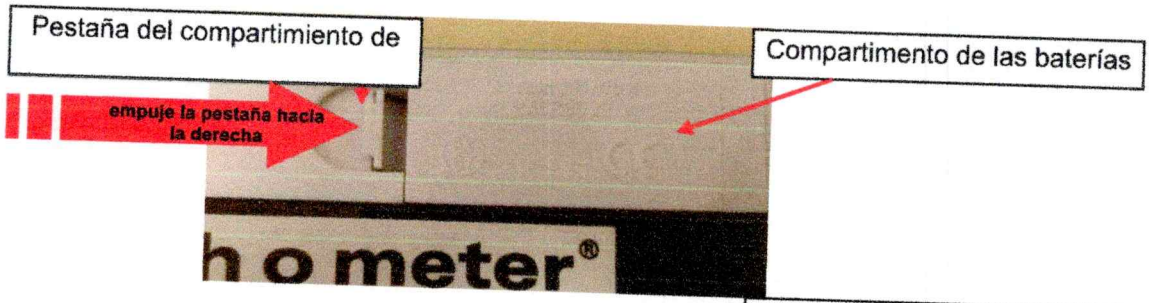
INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN

A fin de evitar daños en la báscula cuando la desempaque, **no use una navaja para cortar cartón, cuchillo o tijeras o cualquier objeto afilado para abrir el empaque protector interno.** Retire la báscula del embalaje y desempaque cuidadosamente, a fin de prevenir rayones en la unidad. Ponga aparte la caja para su almacenamiento.

Instrucciones para las Baterías

La báscula se envía con las baterías ya instaladas. Previo al primer uso, se debe retirar la pestaña de sujeción ubicada en la pestaña del compartimiento de la batería. El compartimiento de baterías está situado en la parte de abajo de la báscula. Para reemplazar las baterías, siga estos pasos.

1. Para abrir la cubierta de las baterías, empuje la pestaña del compartimiento hacia la derecha y tire hacia arriba. **Nota:** Usted NO necesita retirar ningún tornillo para abrir el compartimiento de las baterías.




2. Para retirar las baterías, presione hacia arriba sobre la pestaña blanca que sostiene la batería. Al mover la pestaña se aflojará la batería para que pueda ser removida. Retire ambas baterías y substitúyalas por dos baterías nuevas de Litio de 3V (CR2032). Siga la ilustración de las baterías para asegurarse de que están insertadas con el lado + hacia arriba.



3. Coloque nuevamente la cubierta del compartimento deslizando el extremo de la cubierta dentro del compartimento. Luego presione la pestaña en el compartimento para asegurar la posición de la cubierta.


Seleccionar el Modo de Peso (Kilogramos/KG o Libras/LB), o Stones/ST)

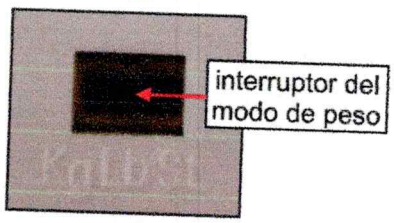1. Para seleccionar el modo de peso, dé la vuelta a la báscula para acceder al interruptor de modo de peso.
2. Deslice el interruptor hacia el modo de peso deseado.
3. La primera posición de la izquierda es para Kilogramos. La posición central es para Libras. La posición de la derecha es para Stones.









Opción de Conectividad del Modelo 844KL

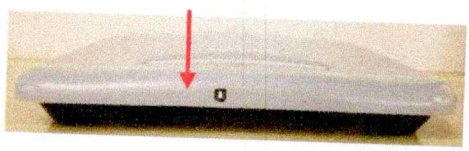El modelo 844KL incluye un puerto USB para conectividad con una PC u otro dispositivo. Para aprender más sobre las opciones de conectividad de esta báscula, por favor contacte a Health o meter® Professional Servicios al Cliente al 1-800-815-6615 o visite homprocs@homscales.com.





INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Medición del Peso

1. Para encender la báscula, golpee suave pero firmemente con su pie en el centro de la plataforma.	
2. Cuatro dígitos aparecerán en la pantalla.	
3. Espere a que 0.0 aparezca en la pantalla.	
4. Suba a la báscula. Permanezca quieto hasta que aparezca el peso.	
5. Después de que el peso se haya fijado, la medición destellará en la pantalla.	
6. El peso seguirá mostrado por 5 segundos luego de bajar de la báscula.	

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS / MANTENIMIENTO & LIMPIEZA

Consulte las instrucciones siguientes para comprobar y corregir cualquier falla antes de entrar en contacto con Servicio al Cliente.

Si la pantalla muestra el mensaje de "Lo bAtt", substituya las baterías según las instrucciones en la página 4.	
Si la pantalla muestra "Err E", la carga sobre la báscula excede la capacidad. 440 lb / 200 kg / 31 st	

Para ayuda adicional, por favor contacte a soporte técnico sin costo al 1 (800) 638-3722.

Mantenimiento

Precaución: Antes del primer uso, o después de períodos largos de falta de uso, revise la operación y funciones apropiadas de la báscula. Si la báscula no funciona correctamente, consulte al personal de servicio calificado.

1. Compruebe el aspecto general de toda la báscula para saber si hay daño o desgaste por uso obvios.
2. No la almacene cerca de productos químicos, calefacciones o radiadores.
3. No caiga, no golpee con el pie, ni salte sobre la báscula.
4. Esta báscula es un dispositivo de pesado extremadamente sensible. No almacene objeto alguno encima de la plataforma de la báscula.
5. Si su báscula deja de funcionar correctamente, no intente desarmarla. Esto anulará su garantía.

Limpieza y Desinfección

El cuidado apropiado y la limpieza son esenciales para asegurar una larga vida de pesaje exacto y efectivo.

1. Health o meter® Professional recomienda usar una solución suave de detergente sobre un paño suave o toallita desechable:
2. Después de la limpieza/desinfección, pase un paño humedecido con agua y luego un paño limpio y seco. Para evitar la acumulación de residuos o superficies mojadas, asegúrese de que todos los componentes de la báscula están completamente secos luego de la limpieza.
3. Nunca utilice materiales ásperos o abrasivos para limpiar la báscula, ya que éstos arruinan el acabado de la misma.
4. No sumerja la báscula en agua o en ningún otro líquido.
5. No vierta ni atomice líquidos directamente sobre la báscula.

GARANTÍA

Garantía Limitada de 1 Año

¿Qué Cubre la Garantía?

Este producto Health o meter® Professional está garantizado desde la fecha de compra contra defectos de materiales o de fabricación por un periodo de un (1) año. Si el producto no funciona correctamente, regrese el producto con flete pre-pagado y apropiadamente empacado a Pelstar, LLC (vea la sección "Obtener Servicio de Garantía", abajo, para obtener instrucciones.) Si el fabricante determina que existe un defecto en los materiales o en la fabricación, el único recurso del cliente será el reemplazo de la báscula sin costo alguno. El reemplazo será hecho con un producto o componente nuevo o remanufacturado. Si el producto no está disponible ya, el reemplazo puede realizarse con un producto similar de valor igual o mayor. Todas las partes reemplazadas se cubren sólo por el periodo de garantía original.

¿Quién Tiene Cobertura?

El comprador original del producto debe tener un comprobante de compra para recibir el servicio de garantía. Por favor guarde su factura o recibo. Los distribuidores de Pelstar o las tiendas al menudeo que venden los productos de Pelstar no tienen el derecho de alterar o modificar o en forma alguna cambiar los términos y condiciones de esta garantía.

¿Qué Se Excluye?

Su garantía no cubre el desgaste normal de partes como resultado de cualquiera de las siguientes condiciones: uso negligente o uso incorrecto del producto, uso de voltaje o corriente incorrectos, uso contrario a las instrucciones de operación, abuso incluyendo manipulación, daño en el transporte, o la reparación o alteraciones no autorizadas. Además, la garantía no cubre desastres naturales, tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados. Esta garantía le concede derechos legales específicos, y usted podría tener otros derechos que varían de país a país, de estado a estado, de provincia a provincia o de jurisdicción a jurisdicción.

Para obtener Servicio de Garantía, asegúrese de guardar su recibo de compra o documento que pruebe la compra. Llame al (+1) 800-638-3722 o al (+1) 708-377-0600 para recibir un número de autorización de devolución (RA), lo cual debe incluirse en la etiqueta de devolución. Incluya su comprobante de compra al producto defectuoso junto con su nombre, dirección, número telefónico durante el día y la descripción del problema. Empaquete cuidadosamente el producto y envíelo con el envío y el seguro prepagados a:

Pelstar, LLC

Attention (Atención) #R/A_____

Return Department (Departamento de Devoluciones)

9500 West 55th Street

McCook, IL 60525

PELSTAR, LLC

9500 West 55th Street • McCook, IL 60525 • USA

1-800-638-3722 o 1-708-377-0600

POR FAVOR REGISTRE SU BÁSCULA PARA COBERTURA DE GARANTÍA EN:

www.homscales.com

Health o meter® es una marca registrada de Sunbeam Products, Inc. usada bajo licencia.

Los productos Health o meter® Professional son fabricados, diseñados, y de propiedad de Pelstar, LLC.

Nos reservamos el derecho de mejorar, realzar, o modificar las características o especificaciones de los productos Health o meter® Professional sin previo aviso.

© Pelstar, LLC 2019

P/N UM844KL_REV20211019

Health o meter®
Professional

Modelo 160KG
BALANZA MECÁNICA DE SUELO



ISO13485:2003
CERTIFIED

CE 14 0459

INSTRUCCIONES DEL USO

PELSTAR, LLC 9500 West 55th Street • McCook, IL 60525

P/N UM160KG Rev20150506

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Para evitar dañar la balanza al desembalarla, no utilice una cuchilla, un cuchillo, tijeras ni ningún otro objeto afilado al abrir el embalaje protector interior. Retire la balanza mecánica de suelo de la caja, así como el material de embalaje con cuidado, para evitar rayar la unidad. Retire las tarjetas introducidas alrededor de la balanza. Aparte el embalaje para su almacenamiento.

PREPARACIÓN DE LA BALANZA PARA SU USO

Esta balanza se calibró en fábrica y no necesita ser calibrada nuevamente antes de utilizarse.

Nota: No hay calibración de campo para el modelo 160KG.

Nota: El peso se indica en kilogramos (kg).

1. Coloque la balanza sobre una superficie rígida y plana para garantizar su exactitud. La precisión puede resultar afectada por moquetas o alfombras suaves y tupidas.
2. Asegúrese de que todos los objetos se retiran de la plataforma de la balanza.
3. Suba y baje de la balanza varias veces antes de intentar pesarse. De este modo se alineará el mecanismo interno.
4. Ajuste el puntero a cero utilizando, en caso necesario, la manilla de ajuste a cero situada en la parte inferior de la balanza.

Nota: A medida que utilice la balanza durante un período de tiempo, es posible que el puntero se desvíe ligeramente de cero. El mejor momento de comprobar el ajuste a cero es antes de realizar una medición. Si el puntero no se encuentra en cero, gire la manilla de ajuste a cero para corregirlo.

5. Suba a la balanza con el peso distribuido por igual sobre ambos pies y no se mueva.
6. En cuanto se indique un peso y la medición del mismo se haya medido y registrado, indique al paciente que se baje de la balanza.

SUGERENCIAS PARA PESARSE

1. Asegúrese de que no hay objetos en la plataforma de peso.
2. Pésese aproximadamente a la misma hora todos los días. Los alimentos que ingiere, los líquidos que bebe y su nivel de actividad harán variar su peso.
3. Para obtener resultados más realistas, pésese sin ropa puesta. El peso medio de la ropa, incluidos los zapatos, es de aproximadamente 0,9-2,26 kg para mujeres y 2,26-3,62 kg para hombres.
4. Asegúrese siempre de que el indicador de la balanza se encuentra en cero antes de subirse a la plataforma.