







MEDCAPTAIN

eye-sens INFUSION PUMP

KIPUL DAPVITA, PTNRS BJJ



Company
Division of Distribution Health Supplies
for Hospital/clinic use
KIPUL DAPVITA PTNRS BJJ

MOVIE 10 10









LEVISOR

ite: \$0

OK.
panasonic.

TELEFONO INHALAMBRICO OK

VALAMBRICO OK







V...len

Vent... central
de piso de 12"

TURBO DRUM
Lavado perfecto

19'
Lavado rápido

MOL
















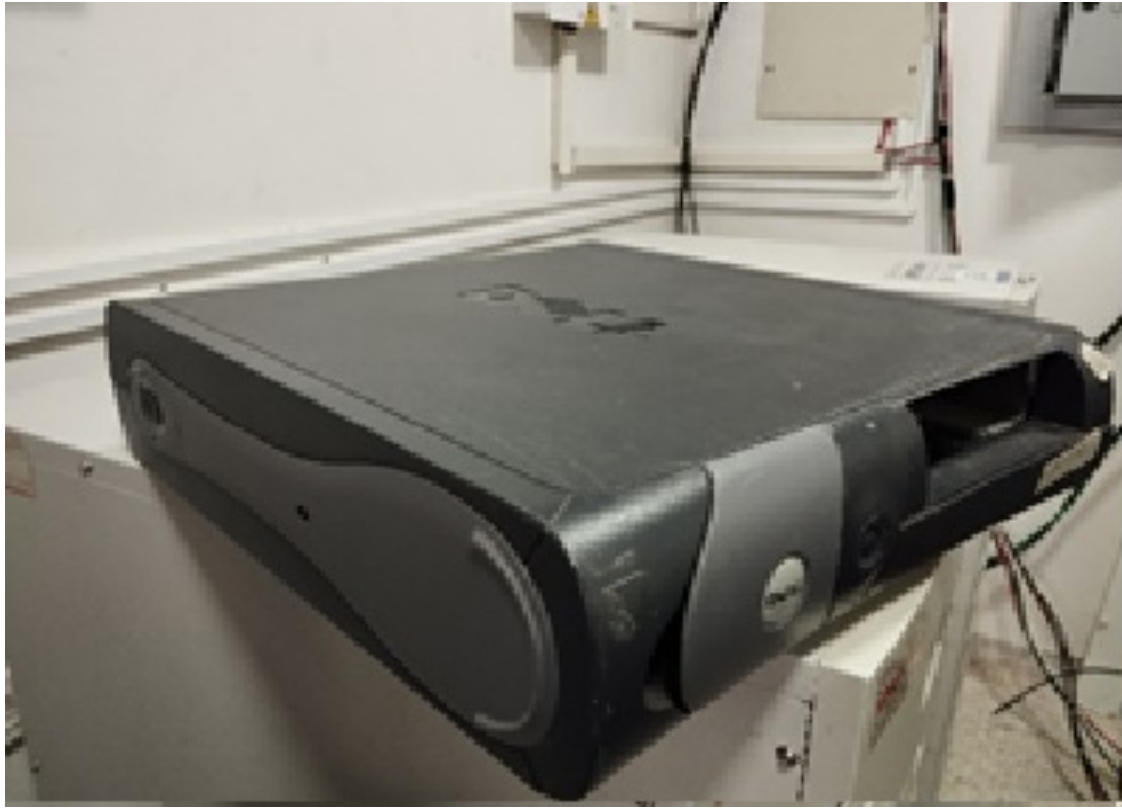



Panasonic KX-FT931

AUTO ANSWER

CALLER ID

STOP

FAX/START COPY

A+* TONE

FLASH

REDIAL

PAUSE

MONITOR

BROADCAST

VOLUME

MENU









Panasonic KX-FT931

AUTO ANSWER

CALLER ID

STOP

FAX/START COPY

A+* TONE

FLASH

REDIAL

PAUSE

MONITOR

BROADCAST

VOLUME

MENU












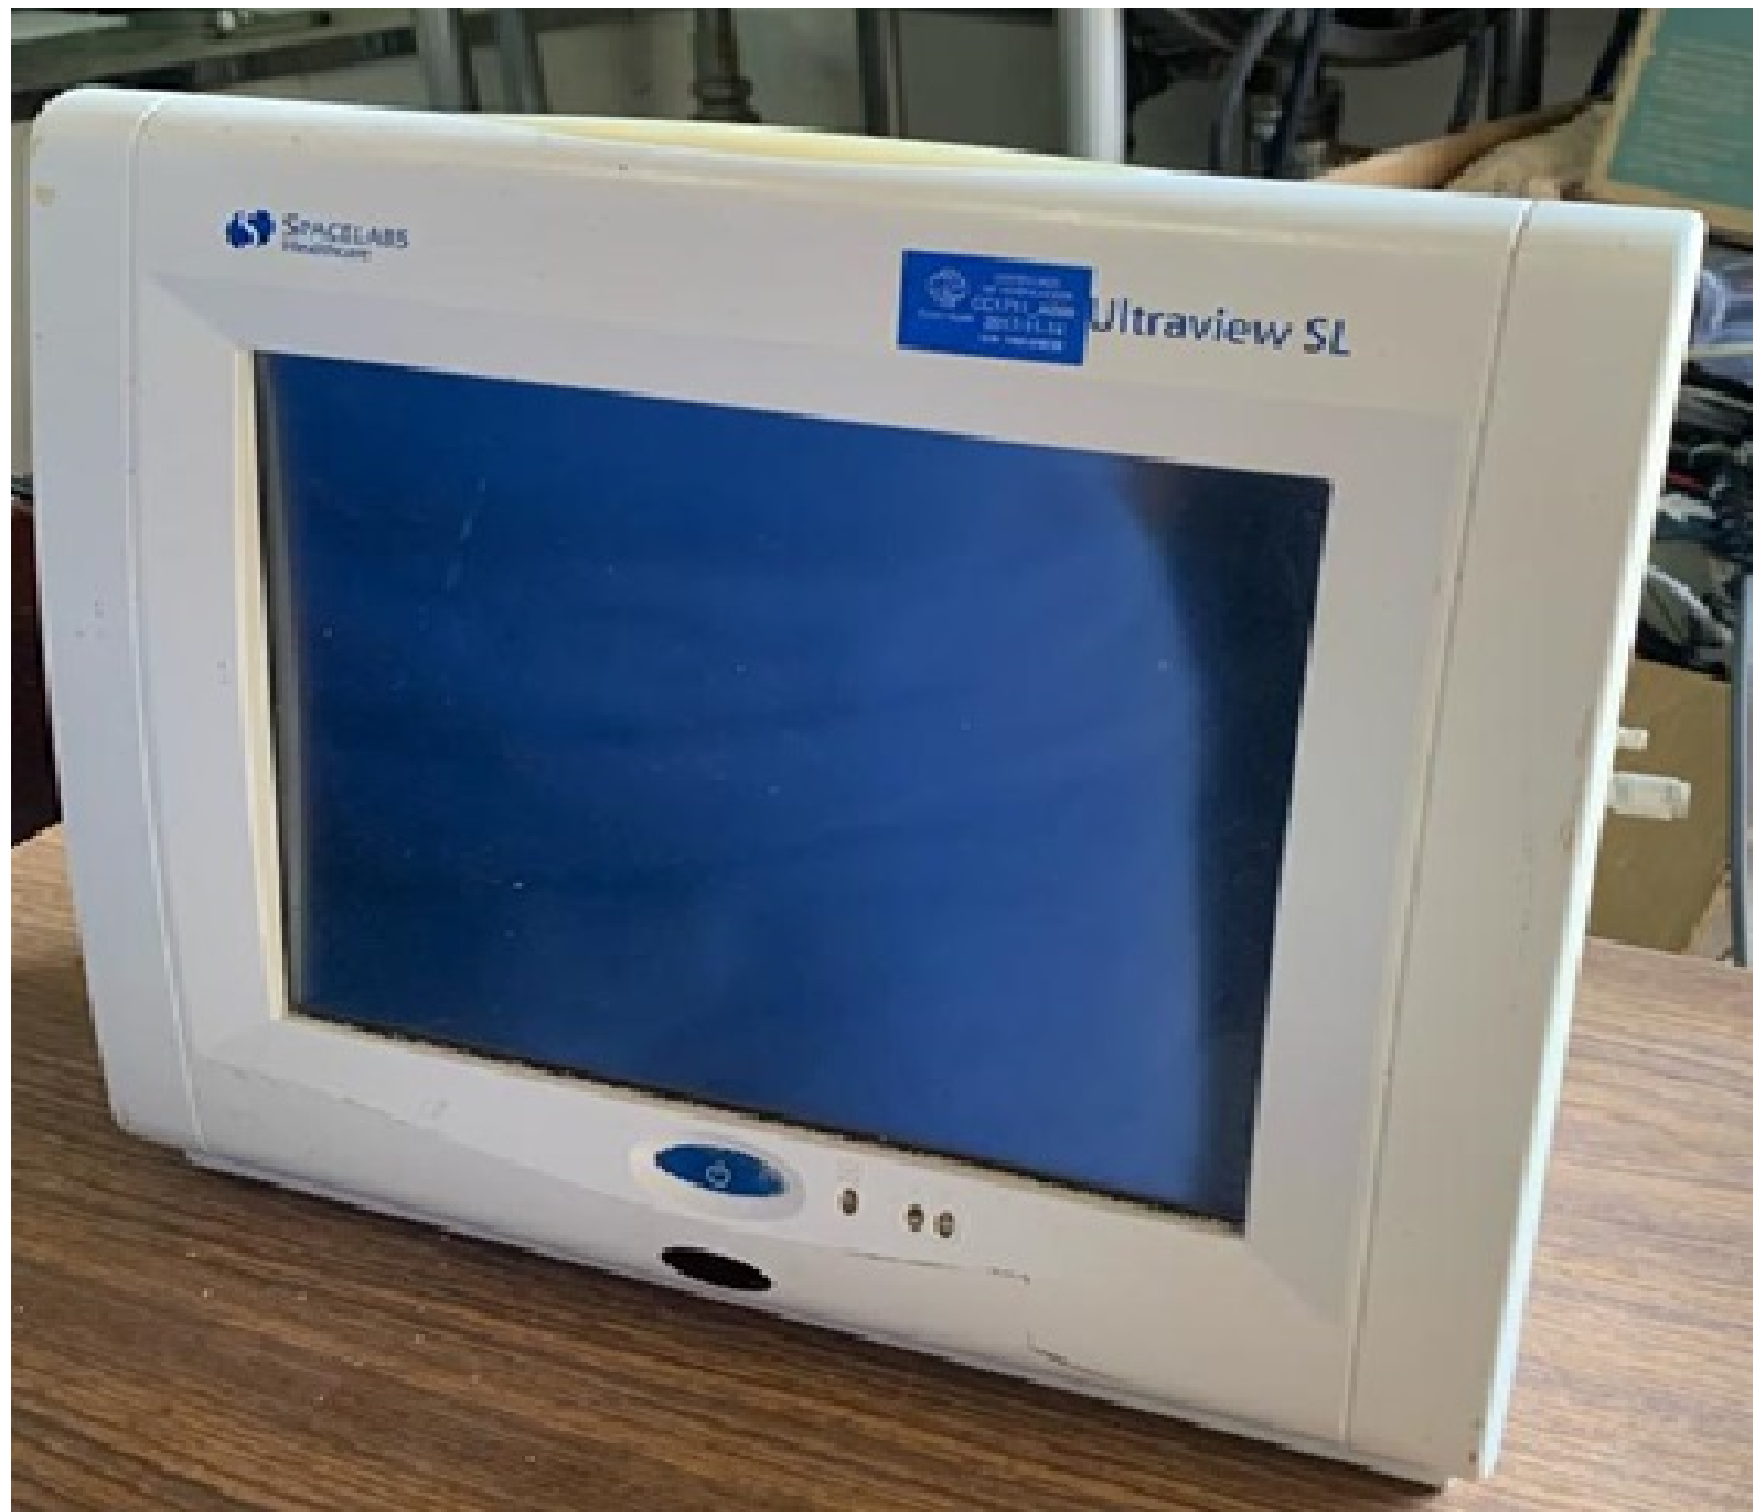





Biofuge *PRIMO*

HERAEUS
LABORTECHNIK







START/STOP TIME/SPEED LID OPEN

BRAKE PROG

BECTON
DICKINSON

SET GCF

CLAY ADAMS
Dynac III
Centrifuge

1 2 3
4 5 6
7 8 9
CLEAR 0 ENTER

763534
999
PALMIRA AERPUERTO

Aeropuerto
DEPIESA











MEDIFUSION®



Medic 5

2

SELECCION ENERGIA JOLIOS

1000

COND. ESTERIL

2 CARGA

ESTERNON

APEX

ADVERTENCIA - MANTENERSE A DISTANCIA

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

DEFIBRILACION DE URGENCIA

Se debe utilizar el modo de choque manual. Mantener el botón de carga (CARGA) en posición de carga hasta que se indique por el indicador de carga (CARGA) que se ha alcanzado el nivel de energía deseado. El nivel de energía deseado se indica en el indicador de energía (ENERGIA) en Joules.





MEDIFUSION®

MEDIAN BIOMEDICA INTEGRAL S.A.S.
CALLE 100 # 100-110
Sello de Garantia

FECHA	SECCION
<i>20/03/2015</i>	<i>...</i>

Av. 24th No. 240 - 71 80, San Vicente Cali - 800 1000
Cali - 312 280 8004 - 312 747 7180



Volumetric Infusion Pump

Flow Rate
0.00 mL/hr

Infusion Pump Rate
0.00 mL/hr

0.00 mL/hr

PRIME STOP CYC
1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64
OFF

MEDIFUSION®

1000

Welch Allyn



Spot Vital Signs





HDCS00624

Cinemaster



POWER MENU FOCUS A

eraz, clara y
completa su estado
de salud al medico.

que
respetar la intimidad
de los demas
pacientes.

dir las normas e
ccion de la

Contribuir al cuidado
del medio ambiente

Exertar las conviccio



eraz, clara y
completa su estado
de salud al medico.

que
respetar la intimidad
de los demas
pacientes.

dir las
formas e
ccion de la

Contribuir al cuidado
del medio ambiente

Exertar las conviccio



eraz, clara y
completa su estado
de salud al medico.

que
respetar la intimidad
de los demas
pacientes.

dir las normas e
ccion de la

Contribuir al cuidado
del medio ambiente

Exertar las convicciones



eraz, clara y
completa su estado
de salud al medico.

que
respetar la intimidad
de los demas
pacientes.

dir las normas e
ccion de la

Contribuir al cuidado
del medio ambiente

Exertar las convicciones









eraz, clara y
completa su estado
de salud al medico.

que
respetar la intimidad
de los demas
pacientes.

dir las
formas e
ccion de la

Contribuir al cuidado
del medio ambiente

Exertar las convicciones



eraz, clara y
completa su estado
de salud al medico.

que
respetar la intimidad
de los demas
pacientes.

dir las normas e
ccion de la

Contribuir al cuidado
del medio ambiente

Exertar las convicciones




















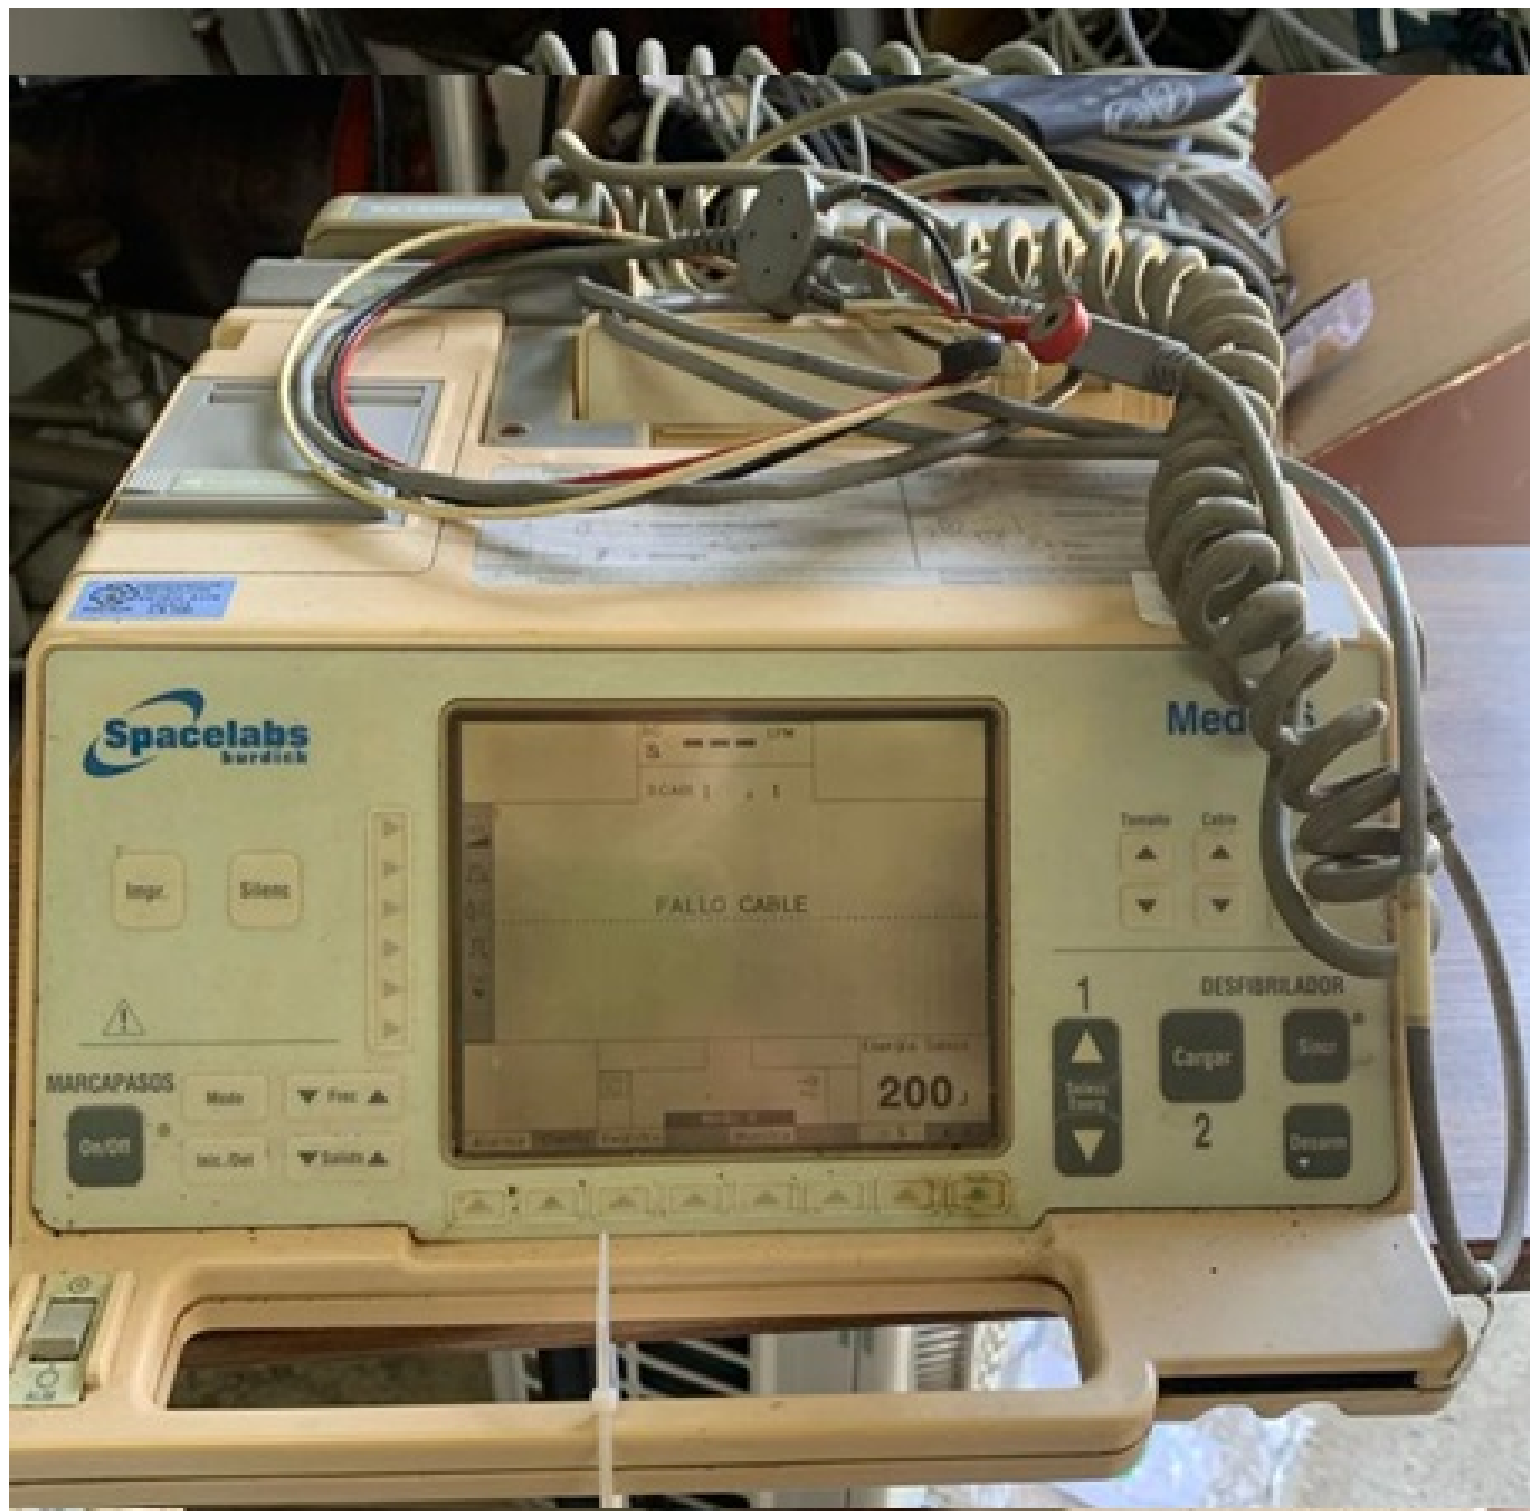



mindray

MEC-1200

Wijaya - Drg / st.
Ya lapor tuda
15-05-19

ON
MUTE
PREFE ECHO
RECORD ALARM

















ORTHO FAST

CURIX screens

AGFA



UNIDADES CBF 201 BOSTON



ORTHO FAST
CURIX screens AGFA







ORTHO FAST
CURIX screens AGFA

UNIDADES CBF 201 BOSTON

AGFA
KODAK



SCHILLER

AT-1

T

HOSPITAL DEPARTAMENTO DE SALUD
H000018108
ELECTROCARDIOGRAMA
MARCA SCHILLER S/N 190.00963



ECG control panel with various buttons and indicators:

- Lead Selection:** I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6
- Buttons:** INICIO AUTO, INICIO MANUAL, PARAR, COPIAR, AMPL AUTO, FILT, ALT, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 25 mm/s, 30 mm/mV, 50 mm/s
- Indicators:** BEEP QRS, 1mV, ELECTRODO SUELTO, PAPEL, FILTRO



NO UTILIZAR ESTE
CANAL, ESTA DAÑADO

MEDIFUSION
DI-2200









EDAN



Handwritten text on a piece of paper taped to the device:
Mrs B
21.01
Mrs B's boy



eraz, clara y
completa su estado
de salud al medico.

que
respetar la intimidad
de los demas
pacientes.


dir las normas e
ccion de la

Contribuir al cuidado
del medio ambiente

Exertir las convicciones



FETALGARD Lite™

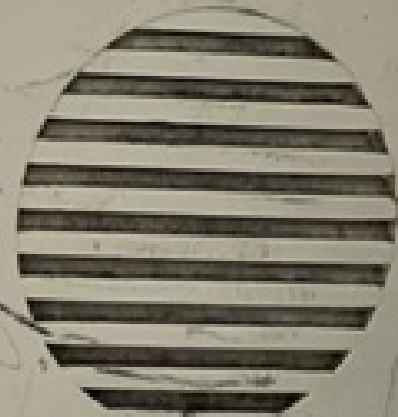

ANALOGIC S



24	11003-00012	DETECCION DE ANEMIA	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	0 TRANS	1000	100%
25	11003-00012	DETECCION DE ANEMIA	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO BOBINA	AL ESTADO	1000	100%
26	11003-00012	DETECCION DE ANEMIA	BOBINA	BOBINA		1000	100%
27	11003-00012	DETECCION DE ANEMIA	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACION	BOBINA 1	1000	100%
			MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO BOBINA	BOBINA 1	1000	100%
				MANTENIMIENTO			











TEMP 20 TEMP

21.29e
23 Oct 2023

BD4000xS

Becton Dickinson
BD Biosciences

2



Volumetric Infusion Pump

Flow Rate



Total Vol. Infused Vol.



Indicator Pump Rate



Control keypad with buttons labeled: ERASE, VOL, UNIT, and various directional arrows (up, down, left, right, and a star symbol).

- AIR
- DOSE
- DOSE
- DOSE
- DOSE
- DOSE

MEDIFUSION®

BOMBA DE INFUSION MEDIFUSION MP1000
ESTA BOMBA ESTA AJUSTADA PARA SER UTILIZADA
CON SET MARCA COSMED 200705 200L

COPIE 4410
2017-01-14
V.M. MEDIFUSION














Desfibrilador





PERLEN PERMEAMETER
Perlen

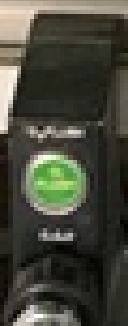

Dopplex®



Audio

DOPPLEX®



Huntleigh
DIAGNOSTICS

61	✓	HDCS-05435	REGRU...
62	✓	HDCS-02713	TENSIONMETRO PEDAL...
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			

MANTENIMIENTO	MODE...
MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO















REGISTRO NACIONAL DE BIENES MUEBLES
CCTM71 A129
Inscripción 2007-01-14
148 84

MEGAM BIOMEDICA INTEGRAL S.A.S.
C.R. 9002 080 001-4
Sello de Garantía
Fecha: _____ Hora: _____
January Prietto
Av. 25A No. 2467 - St. San Vicente, Tel: 800 1000
Calle: 807 900 8004 - 310 147 1132

2

 Burdick

EK10



Apogee de p...
de 40



✓

W **Allyn**

M EQUIPE DE REPARATION
DE BUREAU
CENTRE DE REPARATION
REPARATION
MARQUE ET MODELE
REPARATION

EQUIPE DE REPARATION
DE BUREAU
CENTRE DE REPARATION
REPARATION
MARQUE ET MODELE
REPARATION



66	HDCS-02788	DOPPLER	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO
67	HDCS-01355	DOPPLER	BOBINA ACTIVOS	MANTENIMIENTO
68	HDCS-00621	PULSÓMETRO PEDIÁTRICO	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO
69	HDCS-02766	PULSÓMETRO	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO















Dopplex

Audio

DOPPLEX

Leigh
PLASTICA

CENTRAL
DEPARTAMENTO
CCIT/11/A331
Data: 2017-11-14
S.M.B.A.













White rectangular sticker with illegible text and a small image.

HACEB



DPA 10/10









CARDISUNY
FUKUDA M-E

W

α 1000

ADULT

6

12

6

12

BOY

6

12

6

12

AGE

4

8

12

1

2

WTD

SINSE

AC

BATT


OFF/RECHARGE-ON

OFF/RECHARGE-ON

START/STOP

Burdick

EK 10




Control panel with the following buttons:

- Row 1: I, II, III, AUTO
- Row 2: AVR, VFL, VFT, MAN
- Row 3: V1, V2, V3, MW
- Row 4: ON/STBY, V4, V5, V6, STOP

www.burdick.com/tegraph



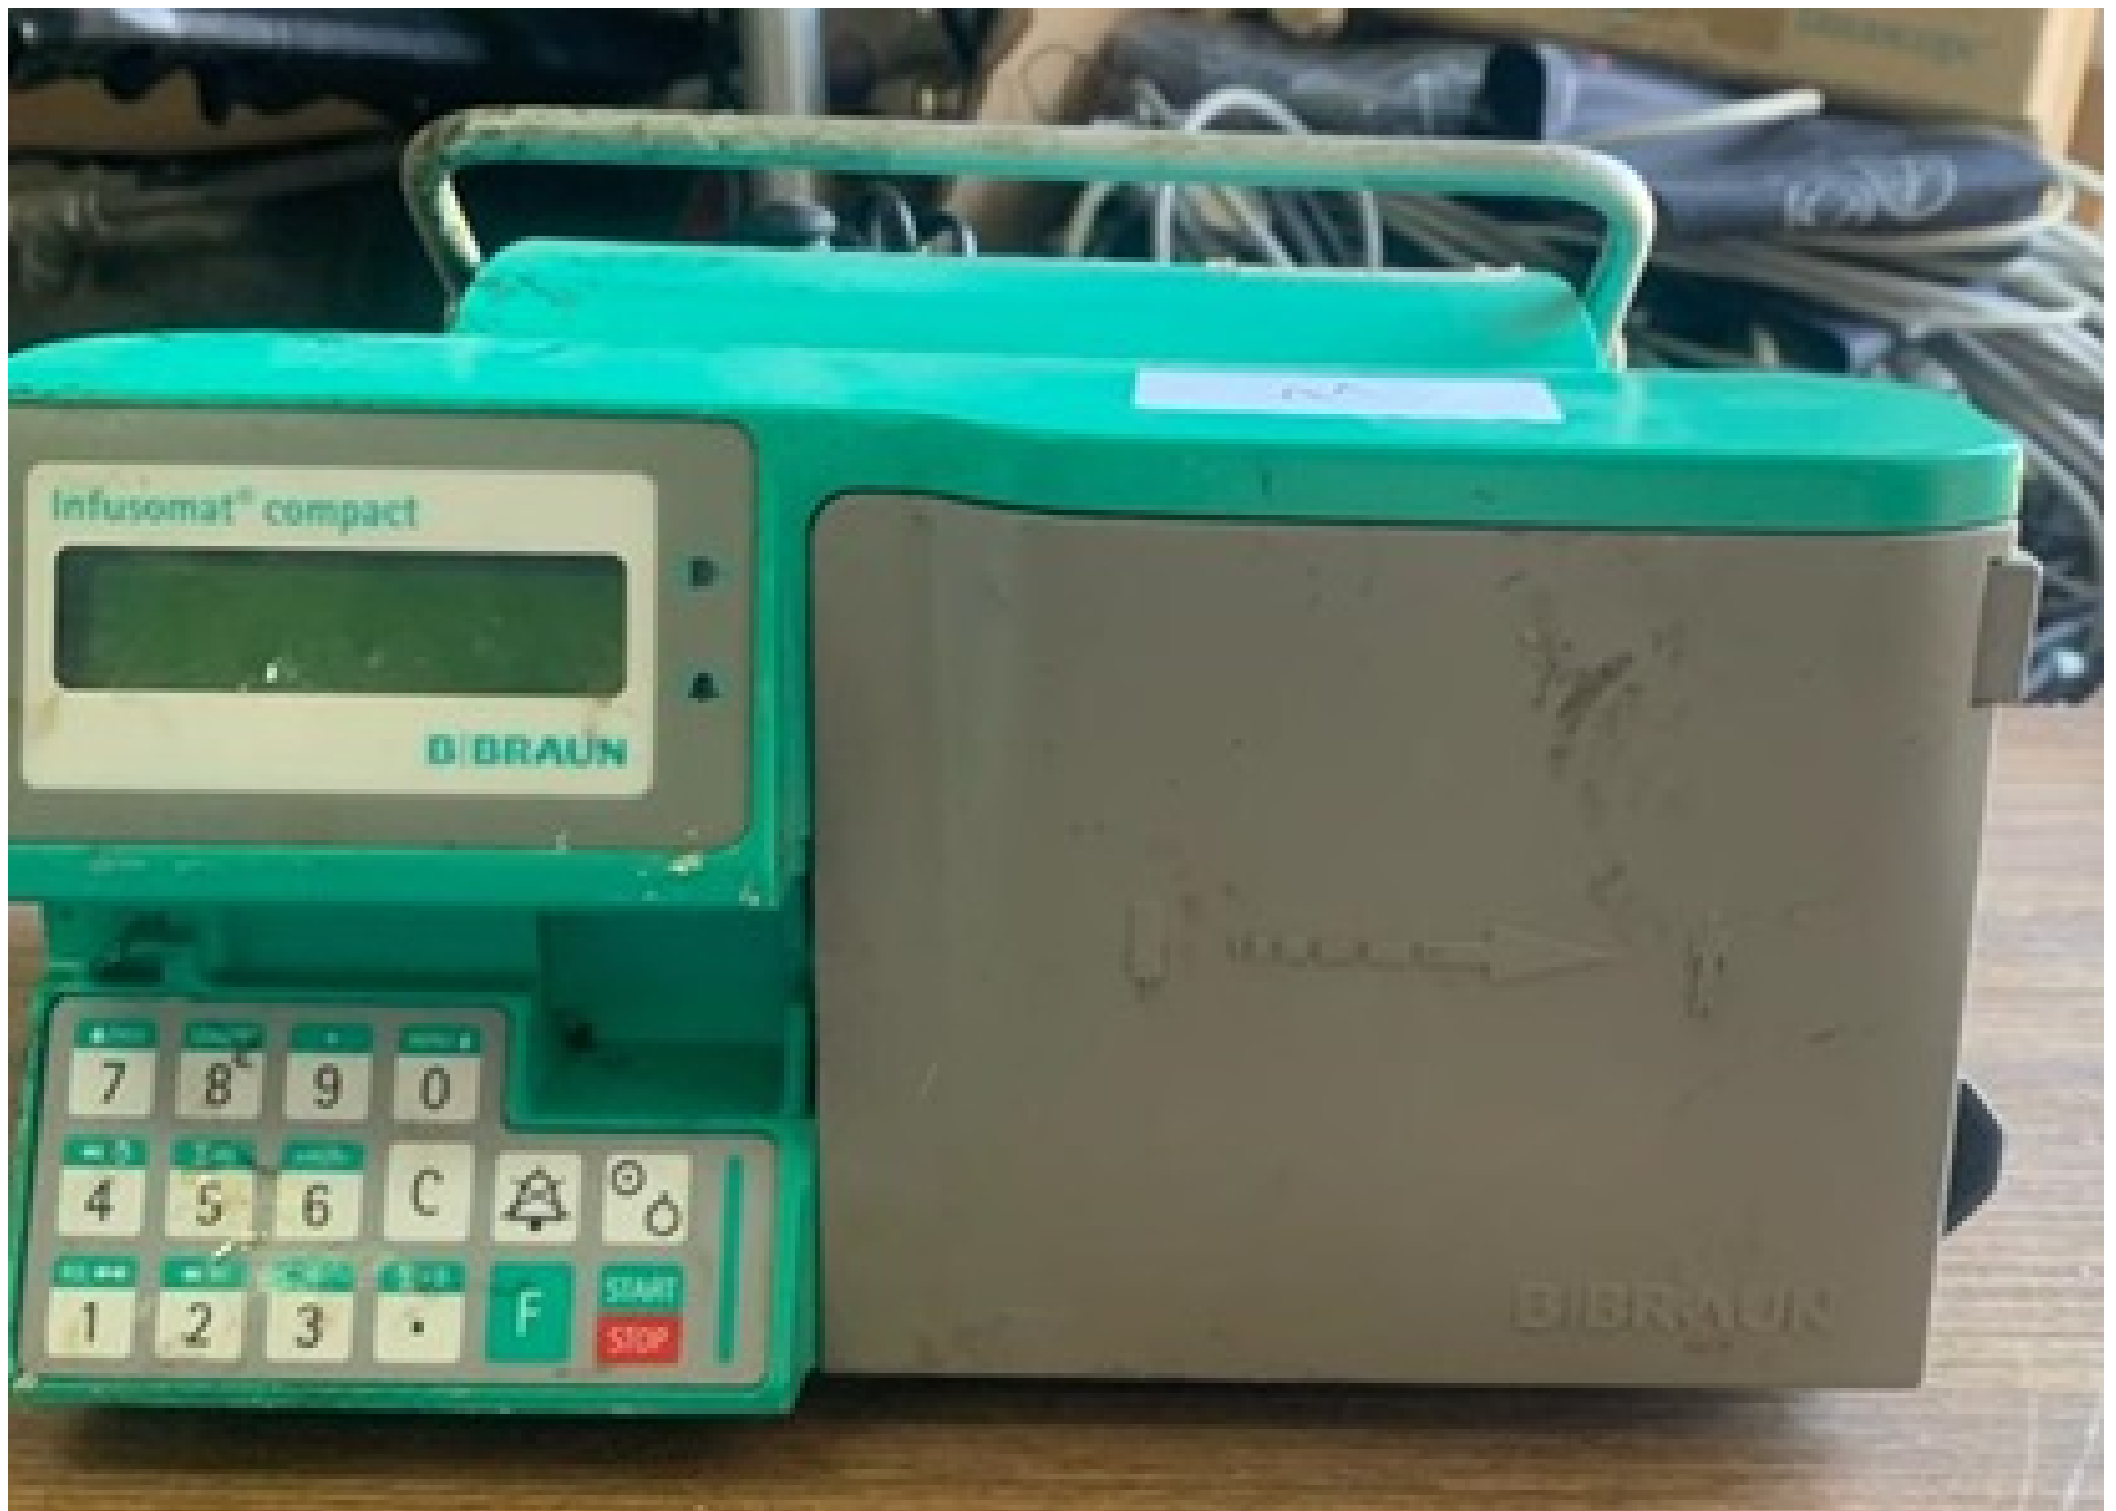










REQUIRE SEASON
BURBULA

ARGUS 717 V


0000 0000 0000 0000 MENU START STOP

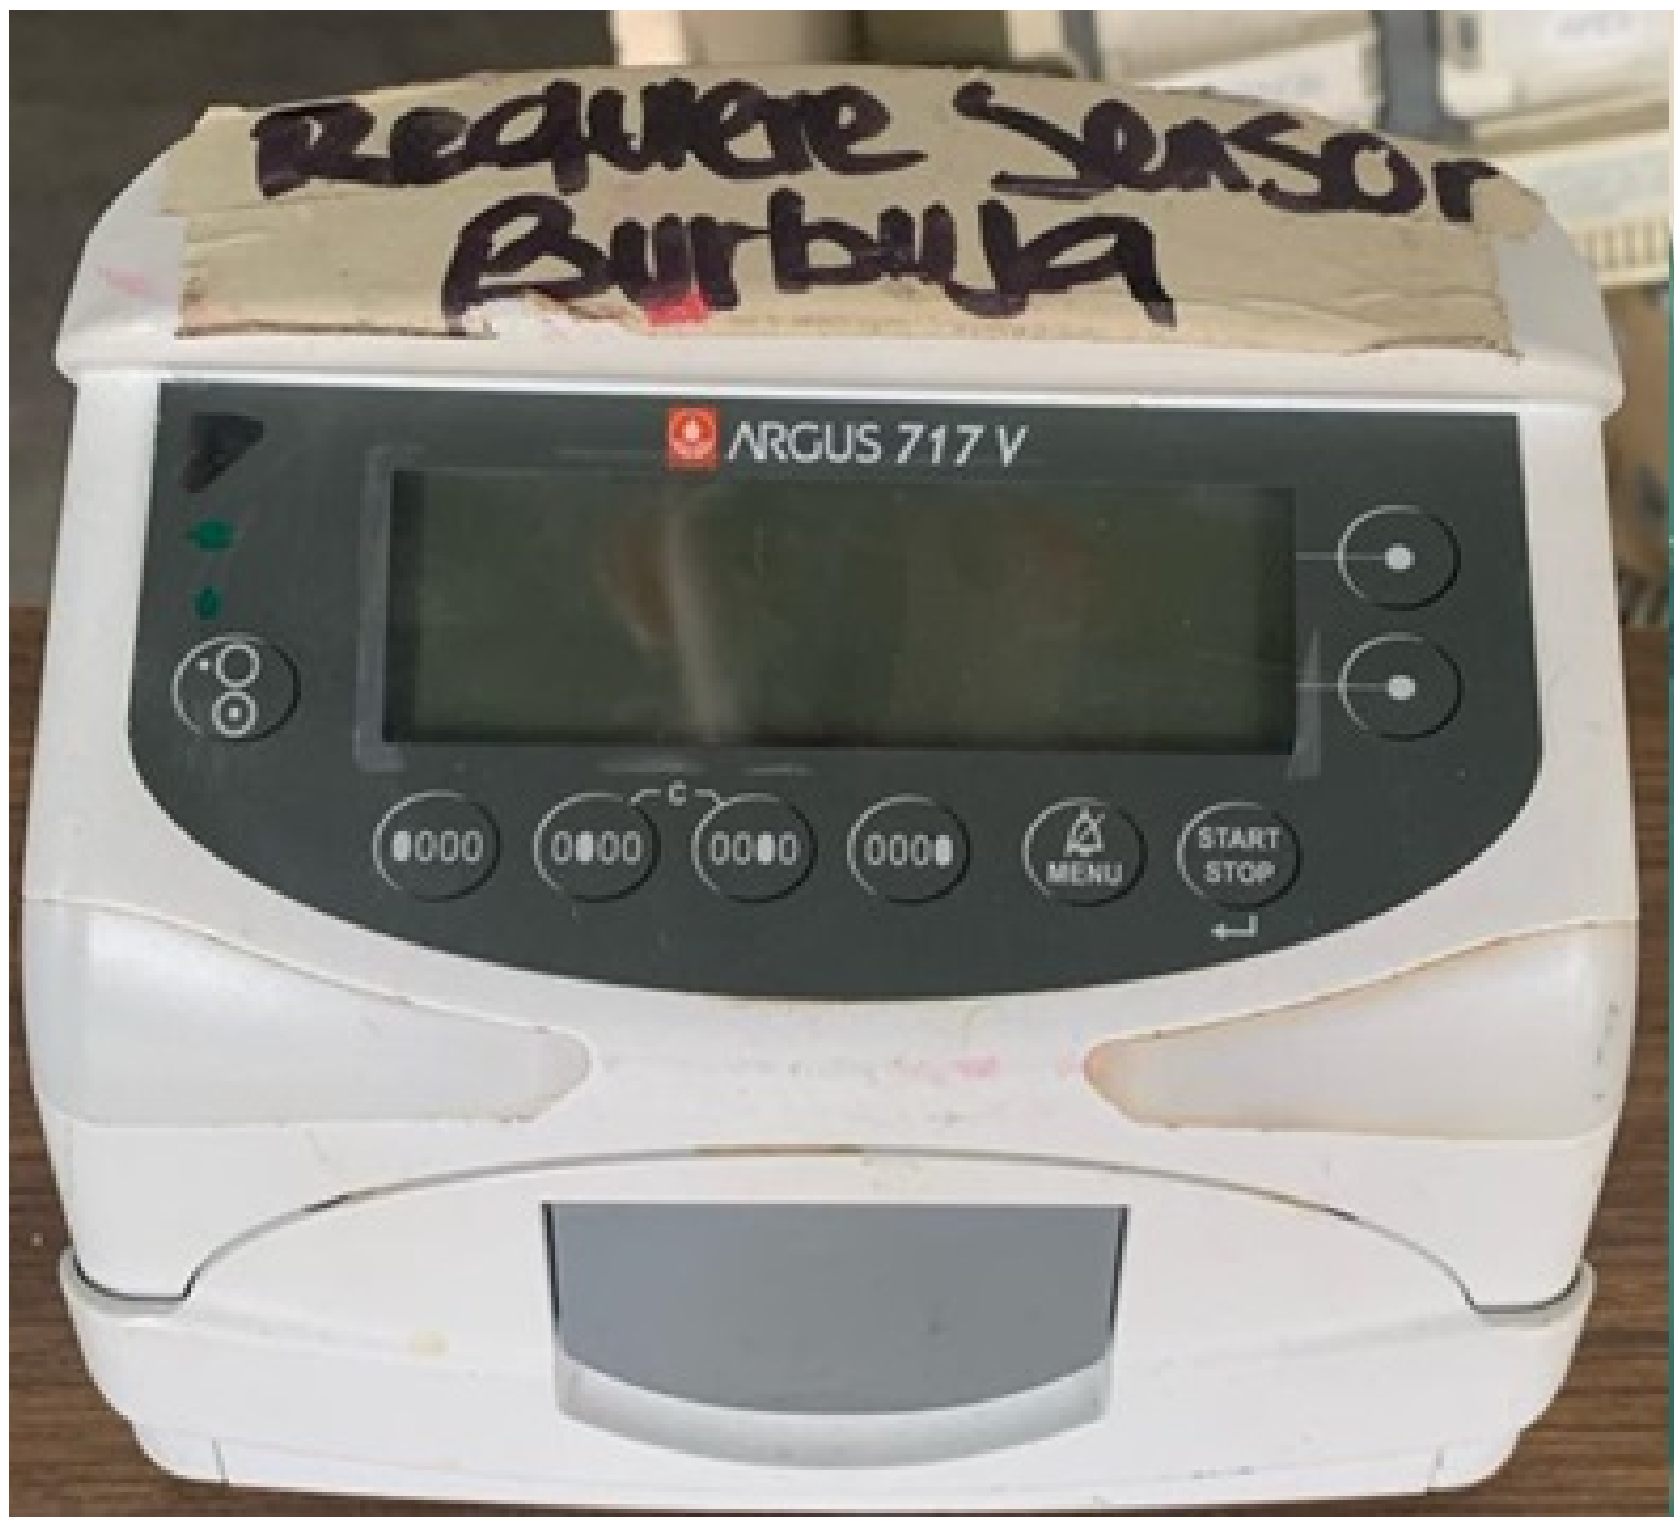







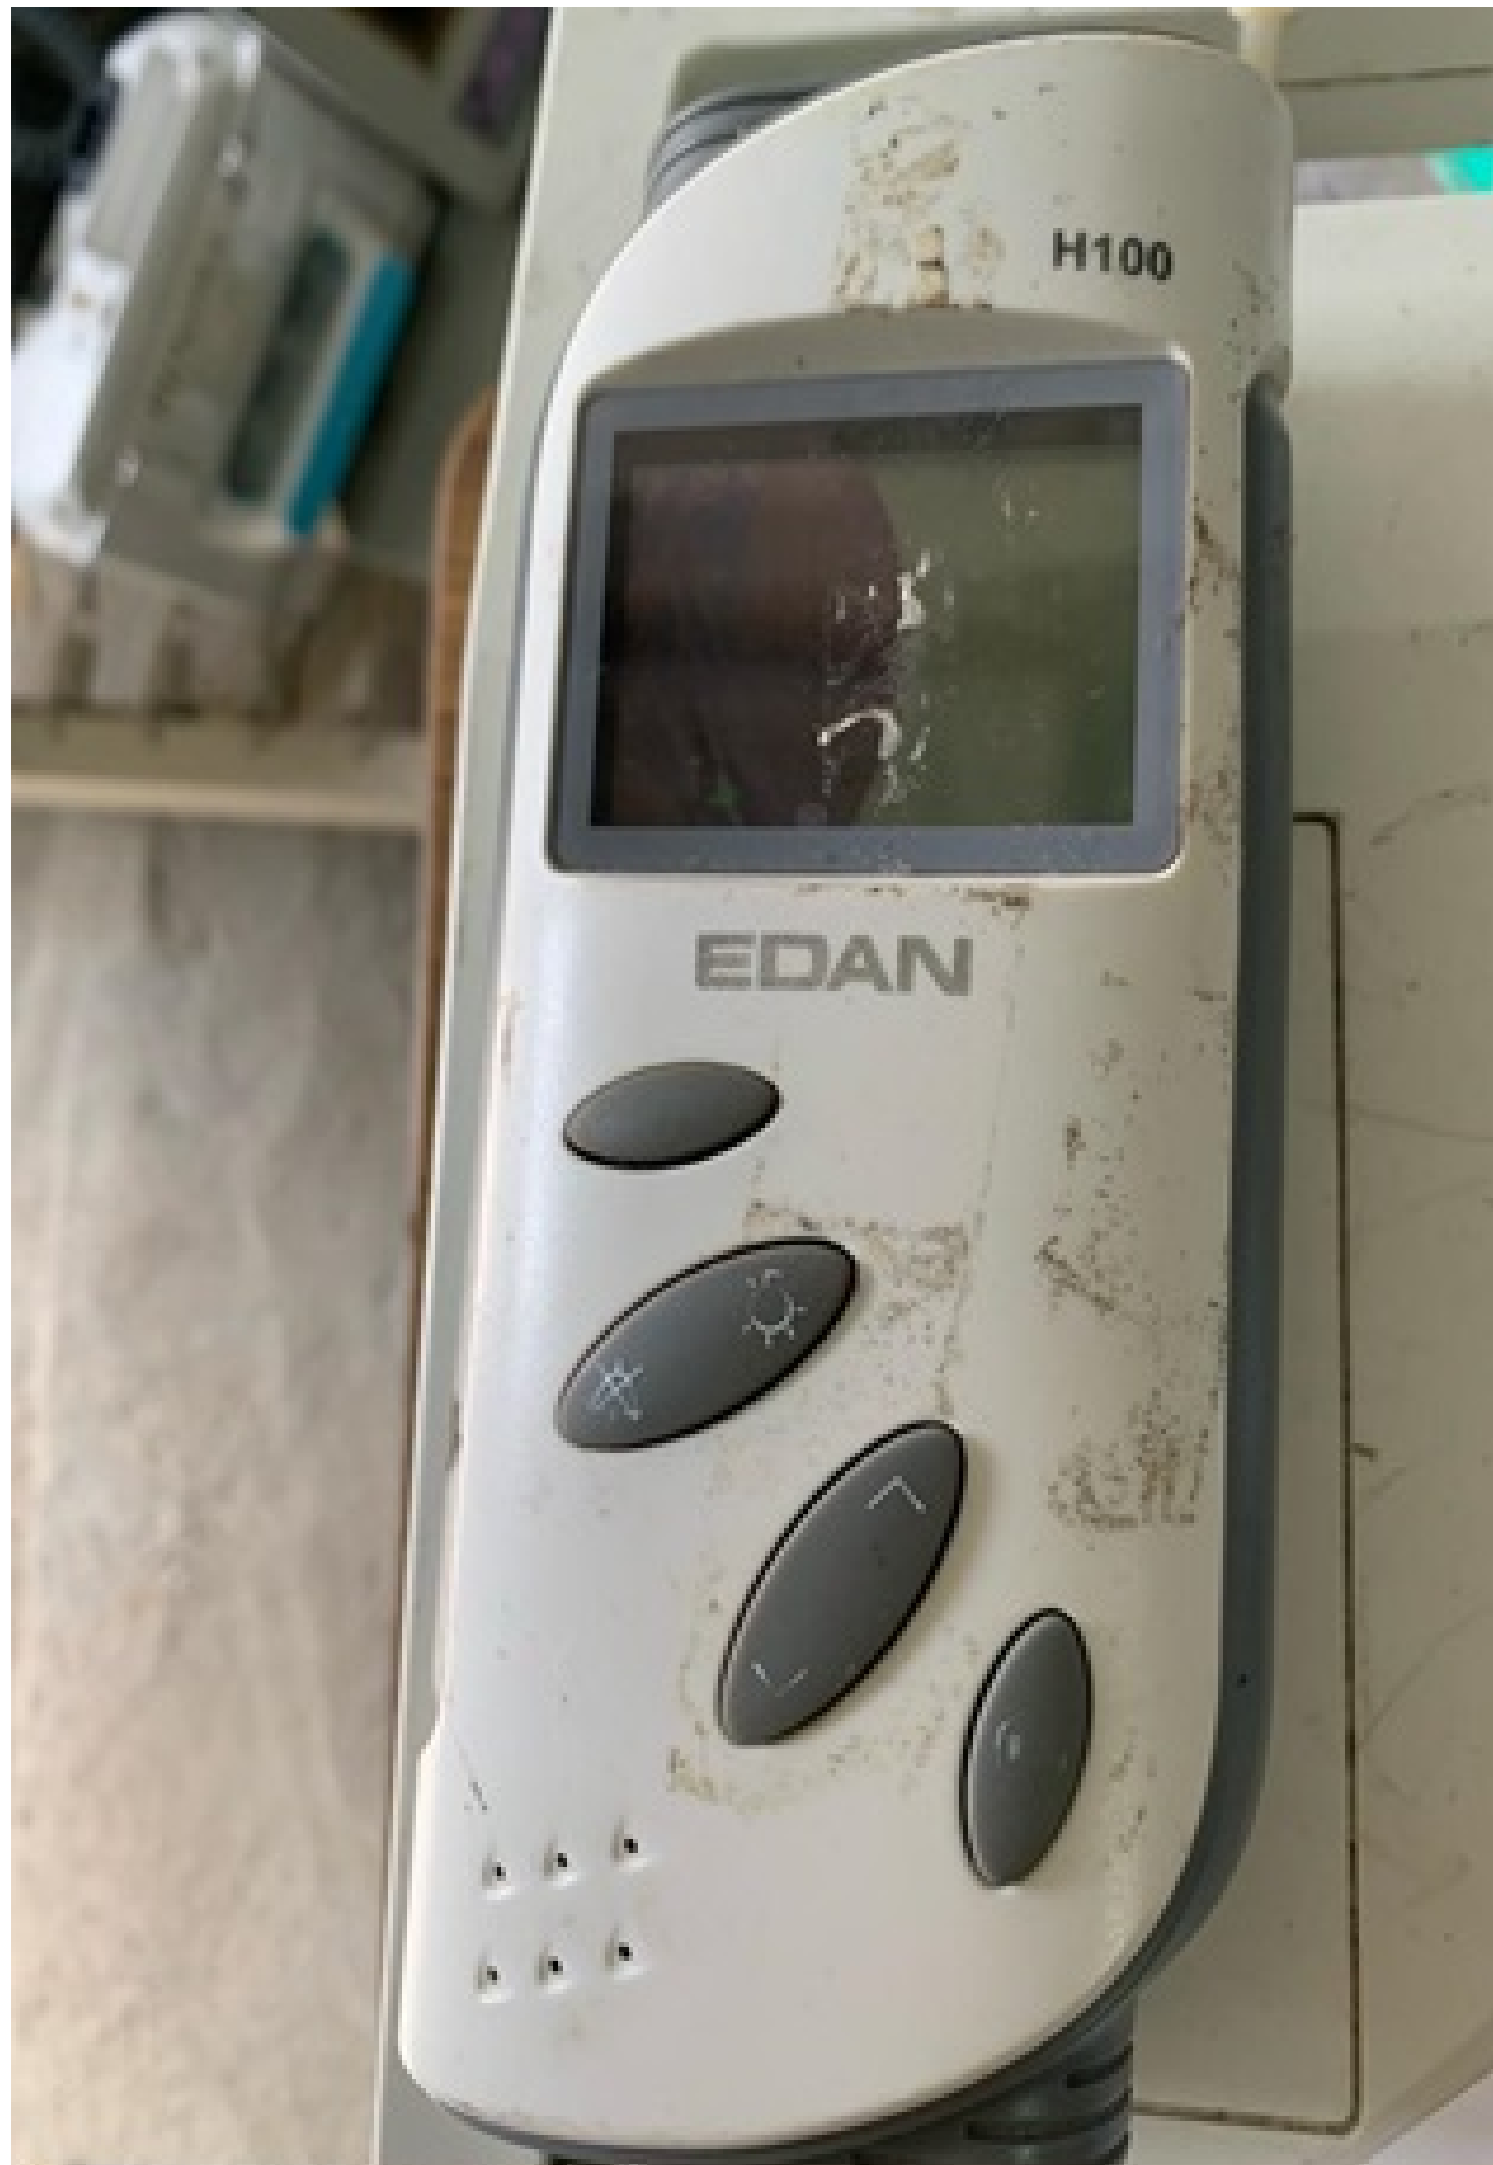

H100

EDAN



MED CAPTAIN
SYS-6010 INFUSION PUMP





BLUELINE
PORTABLE TOILETS

Adjustable
Height
Toilet
Seat


EDAN



Fetal Heart
Rate Doppler

SonoTrax

48	COM-02426	CENTRIFUGA DE MUELA 8 24 TUBOS	MANTENIMIENTO
79	COM-02425	BOMBA DE MUELA	MANTENIMIENTO
80	COM-02424	BOMBA DE INFUSION NIFRO	MANTENIMIENTO
81	COM-02423	BOMBA DE MUELA	MANTENIMIENTO
			BODEGA
			HOSPITALIZACION
			MANTENIMIENTO
			MANTENIMIENTO
			MANTENIMIENTO
			MANTENIMIENTO
			BODEGA
			MANTENIMIENTO
			MANTENIMIENTO
			BODEGA ACTIVOS FUO
			MANTENIMIENTO
			MANTENIMIENTO
			DE AMBULAN
			MANTENIMIENTO

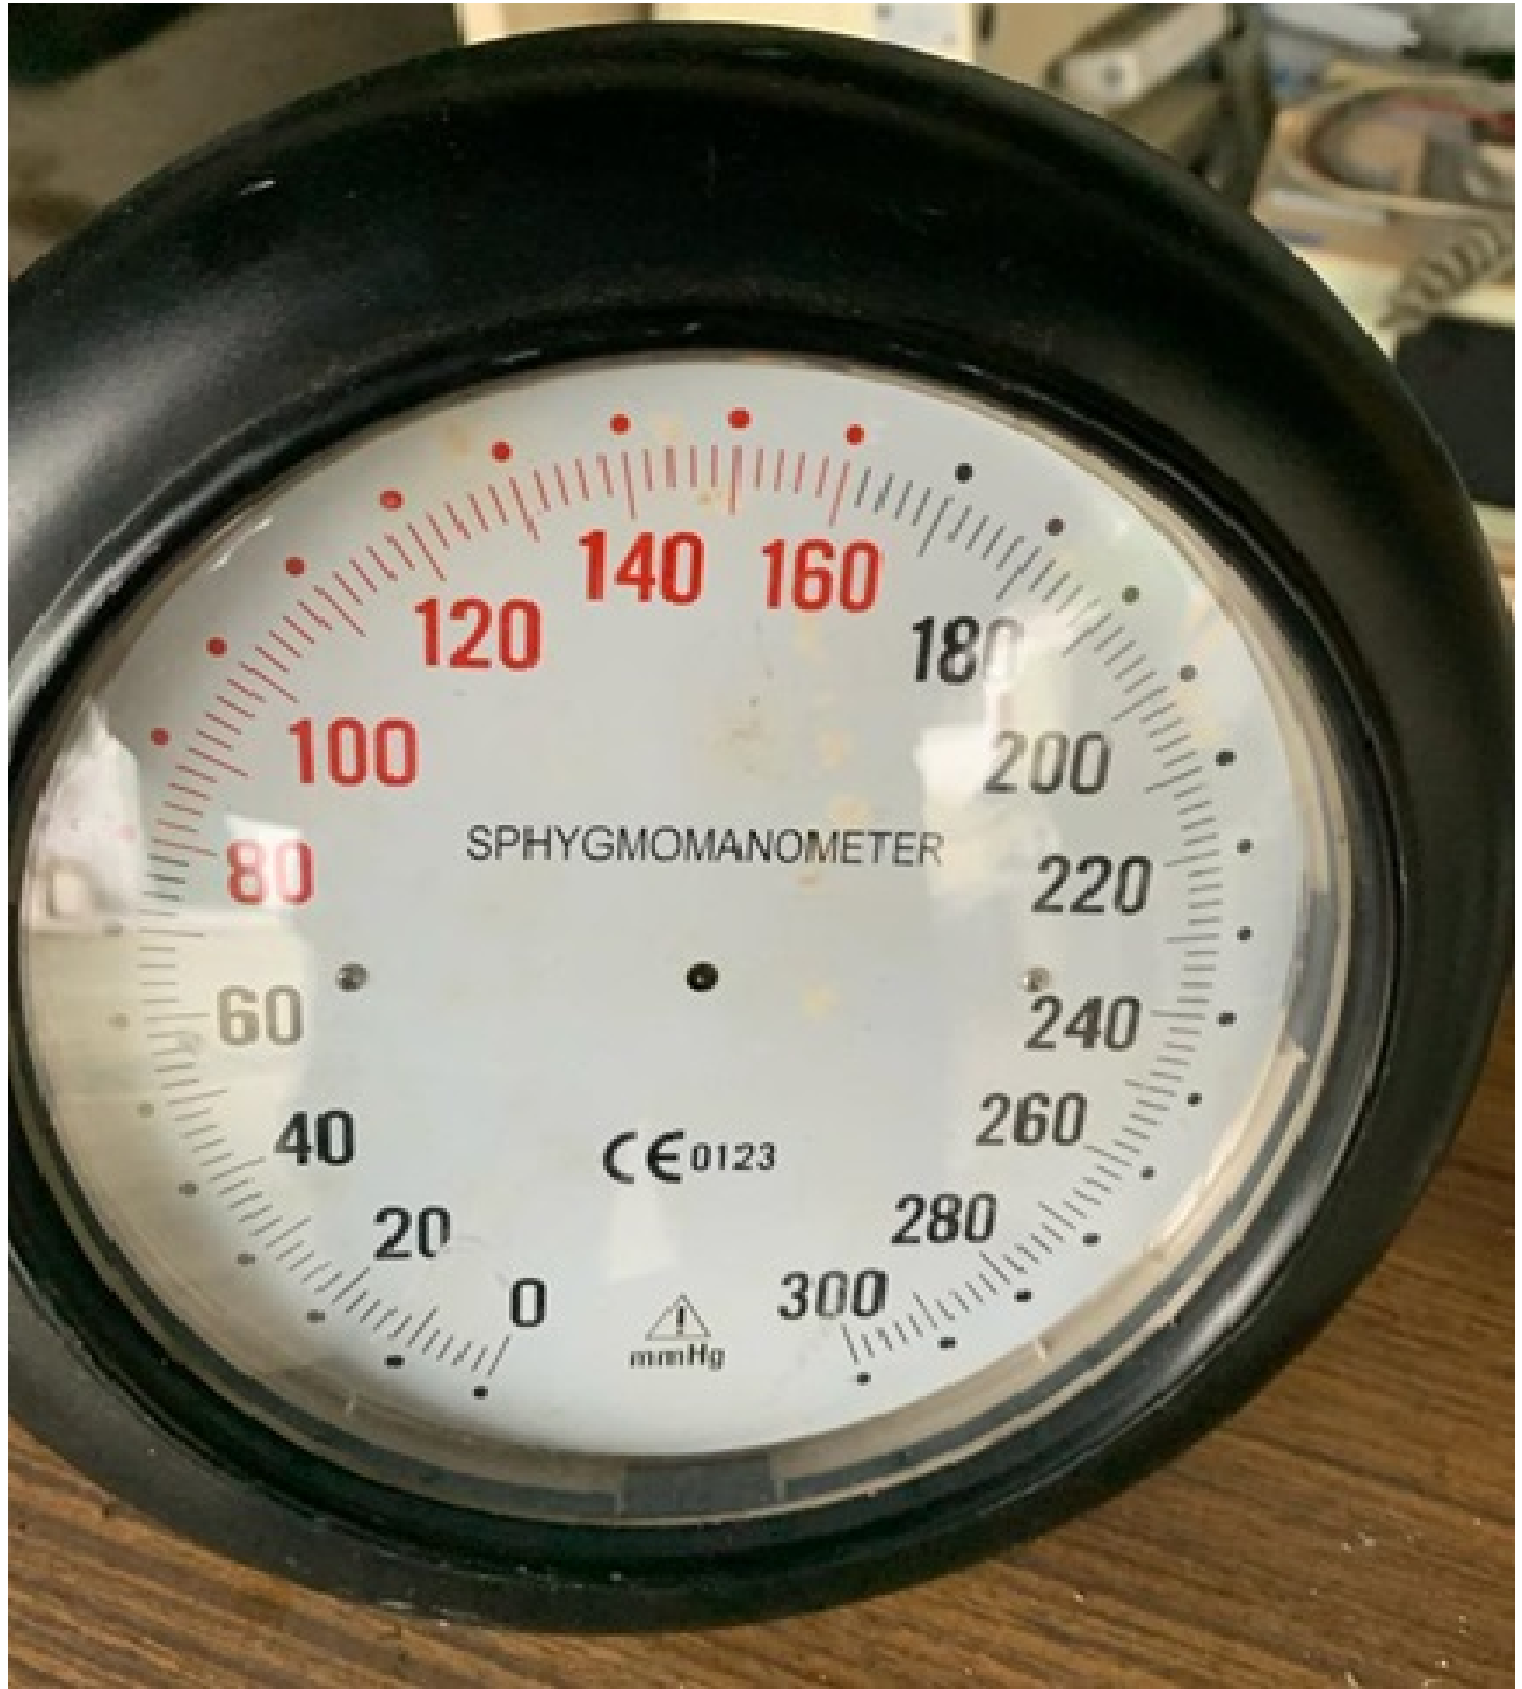





SPHYGMOMANOMETER

CERTIFIED

mmHg







Panasonic

Energia

Consumo de energía 5,21 kWh

Eficiencia energética 126 kWh

El consumo de energía depende de los factores de uso y de las condiciones de instalación.

Modelo: CU-PA09CJ-EU

Modelo: CS-PA09CJ-EU

Consumo de energía en modo de espera: 0,5 kWh

Consumo de energía en modo de espera: 0,5 kWh

Consumo de energía en modo de espera: 0,5 kWh

Consumo de energía en modo de espera: 0,5 kWh

Consumo de energía en modo de espera: 0,5 kWh



3

Mayor consumo

Menor consumo

Consumo de energía en modo de espera: 0,5 kWh

Consumo de energía en modo de espera: 0,5 kWh

Consumo de energía en modo de espera: 0,5 kWh

Consumo de energía en modo de espera: 0,5 kWh

Consumo de energía en modo de espera: 0,5 kWh

Consumo de energía en modo de espera: 0,5 kWh

Consumo de energía en modo de espera: 0,5 kWh

Consumo de energía en modo de espera: 0,5 kWh

Consumo de energía en modo de espera: 0,5 kWh

Consumo de energía en modo de espera: 0,5 kWh

Consumo de energía en modo de espera: 0,5 kWh

Consumo de energía en modo de espera: 0,5 kWh

Consumo de energía en modo de espera: 0,5 kWh

Consumo de energía en modo de espera: 0,5 kWh

Consumo de energía en modo de espera: 0,5 kWh

Consumo de energía en modo de espera: 0,5 kWh


Consumo de energía en modo de espera: 0,5 kWh

Consumo de energía en modo de espera: 0,5 kWh





NO FORZAR LA PALANCA

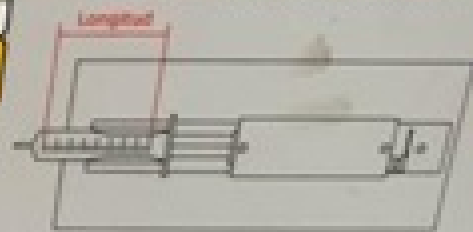


APEMA
Bomba de Infusión PC11UBT





DELIVERY RATE

0.000 ml/h



VOLUME DELIVERED

0.000 CLEAR

START

RESET

SILENCE

LIMIT ON
OFF CLEAR

PIGGYBACK

DOSE LIMIT

0.000 ml



DOSE DELIVERED

0.000 ml



Abbott/Shaw

LifeCare[®] Pump

MODEL 4P

LOCK
ON

LOAD
OFF
RECHARGE

Venodyne
MODEL EPS 410 systems

 Specialty Health Care Corp.
PO Box 368, 1253 Haddon Ave., West Berlin, New Jersey 08091
(609) 627-1100 • 1-800-624-8494



SLEEVE PRESSURE



POWER ON

Division of Advanced Instruments, Inc.
1000 Highland Avenue / 617-449-4900
Needham Heights, Massachusetts 02194





YORK

Energetski

Učinkovitost pri hlađenju: 3,19 kWh / kWh
Učinkovitost pri grijavanju: 3,68 kWh / kWh
Učinkovitost pri hlađenju (srednja): 3,19 kWh / kWh
Učinkovitost pri grijavanju (srednja): 3,68 kWh / kWh
Učinkovitost pri hlađenju (maksimalna): 4,08 kWh / kWh
Učinkovitost pri grijavanju (maksimalna): 4,58 kWh / kWh

Učinkovitost pri hlađenju (srednja) = 3,19 kWh / kWh
Učinkovitost pri grijavanju (srednja) = 3,68 kWh / kWh

Učinkovitost pri hlađenju (maksimalna) = 4,08 kWh / kWh
Učinkovitost pri grijavanju (maksimalna) = 4,58 kWh / kWh

Učinkovitost pri hlađenju (minimalna) = 2,52 kWh / kWh
Učinkovitost pri grijavanju (minimalna) = 2,98 kWh / kWh

Učinkovitost pri hlađenju (srednja) = 3,19 kWh / kWh
Učinkovitost pri grijavanju (srednja) = 3,68 kWh / kWh

Učinkovitost pri hlađenju (maksimalna) = 4,08 kWh / kWh
Učinkovitost pri grijavanju (maksimalna) = 4,58 kWh / kWh

Učinkovitost pri hlađenju (minimalna) = 2,52 kWh / kWh
Učinkovitost pri grijavanju (minimalna) = 2,98 kWh / kWh

INVERTER





2150 PULSE OXIMETER

