ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

LISTA DE VERIFICACION DIARIA DE CARRO DE PARO DE URGENCIAS

MES: Noviembre

| DIAS | INSUMOS: CANTIDAD/ESTADO | CARRO DE PARO: ABIERTO O CERRADO | No. de CANDADO: REGISTRAR EL NUMERO | SELLA DE CERRADO: SI HAY O NO | DESFIBRILADOR: BUENO | MONITOR DE SIGNOS VITALES: COMPLETO | SUCCIONADOR: 1 | FERULA ESPINAL CORTA: 1 | PESA ADULTO: 1 | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D N D N D N D | Cerrado | 16826362 | SI | | | | | | Lorena P |
| | | Cerrado | 16826362 | SI | | | | | | Katle W |
| | | Cerrado | 16826362 | SI | | | | | | Katle W |
| 2 | | Cerrado | 16826362 | SI | | | | | | Katle W |
| | | Cerrado | 16826362 | SI | | | | | | Katle W |
| 3 | | Abierto | | SI | | | | | | |
| 4 | | Cerrado | 16826363 | SI | | | | | | Katle W |
| | | Abertura | 16826363 | SI | | | | | | Lorena P |
| 5 | | Abierto | — o — | SI | | | | | | Brenda P |
| | | Cerrado | 16826365 | SI | | | | | | Lorena P |
| 6 | | Cerrado | 16826365 | SI | | | | | | |
| | | Cerrado | 16826365 | SI | | | | | | |
| 7 | | Cerrado | 16826369 | SI | | | | | | Lorena P |
| | | Cerrado | 16826369 | SI | | | | | | Katle W |
| 8 | | Cerrado | 16826365 | SI | | | | | | Karla C |
| | | Cerrado | 16826365 | SI | | | | | | Lorena P |
| 9 | | Cerrado | 16826365 | SI | | | | | | Jimmy |
| | | Cerrado | 16826365 | SI | | | | | | Katle W |
| 10 | | Cerrado | 16826365 | SI | | | | | | Katle W |
| | | Cerrado | 16826365 | SI | | | | | | |
| 11 | | Cerrado | 16826365 | SI | | | | | | Karla C |
| | | Cerrado | 16826365 | SI | | | | | | Lorena P |
| 12 | | Cerrado | 16826365 | SI | | | | | | Katle W |
| | | Cerrado | 16826366 | SI | | | | | | Lorena P |
| 13 | | Abierto | 16826370 | SI | | | | | | |
| | | Cerrado | 16826370 | SI | | | | | | Katle W |
| 14 | | Cerrado | 16826370 | SI | | | | | | Karla C |
| | | Cerrado | 16826370 | SI | | | | | | |
| 15 | | Cerrado | 16826373 | SI | | | | | | Lorena P |
| 16 | | Cerrado | 16826373 | SI | | | | | | Katle W |
| | | Cerrado | 16826373 | SI | | | | | | Lorena P |
| 17 | | Cerrado | 16826373 | SI | | | | | | Jimmy C |
| | | Cerrado | 16826373 | SI | | | | | | Katle W |
| 18 | | Cerrado | 16826373 | SI | | | | | | Katle W |
| | | Cerrado | 16826373 | SI | | | | | | Katle W |
| 19 | | Cerrado | 16826373 | SI | | | | | | Katle W |
| | | Cerrado | 16826373 | SI | | | | | | |
| 20 | | Cerrado | 16826373 | SI | | | | | | Lorena P |
| | | Cerrado | 16826373 | SI | | | | | | Lorena P |
| 21 | | Cerrado | 16826373 | SI | | | | | | Lorena P |
| | | Cerrado | 16826373 | SI | | | | | | Katle W |
| 22 | | Cerrado | 16826373 | SI | | | | | | |
| | | Cerrado | 16826373 | SI | | | | | | Katle W |
| 23 | | Cerrado | 16826373 | SI | | | | | | Katle W |
| | | Abierto | 16826373 | SI | | | | | | Katle W |
| 24 | | Abierto | 16826373 | SI | | | | | | Katle W |
| | | Cerrado | 16826373 | SI | | | | | | Katle W |
| 25 | | Cerrado | 16826373 | SI | | | | | | Katle W |
| | | Cerrado | 16826374 | SI | | | | | | Katle W |
| 26 | | Cerrado | 16826374 | SI | | | | | | Katle W |
| | | Cerrado | 16826374 | SI | | | | | | Katle W |
| 27 | | Cerrado | 16826373 | SI | | | | | | Katle W |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO

CARRO DE PARO: Colocar sisirio o candado según corresponda

No. de Candado: Numero completo del candado del carro de paro

Diario de Inspección: realizar el estado bueno o malo

Desfibrilador: Si la descarga fue exitosa colocar F Ok si fallida colocar NF y reportar inmediatamente

Linea de comunicación: Fotografiado (F) No Fotografiado (NF)

Powered by CamScanner

**ESE.HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**
**LISTA DE VERIFICACION DIARIA DEL KIT OBSTETRICO**

MES: NOVIEMBRE

| INSUMOS | CANTIDAD/ ESTADO |
|---|---|
| AMPICILINA + SULBACTAN | 4 |
| SULFATO DE MAGNESIO | 20 |
| BETAMETASONA | 6 |
| LABETALOL | 2 |
| OXITOCINA | 15 |
| NIFEDIPINO DE 10 MG | 15 |
| NIFEDIPINO DE 30 MG | 15 |
| ROXICAINA JALEA | 1 |
| METHERGIN | 5 |
| LACTATO DE RINGER | 10 |
| SOLUCION SALINA 0,9 % | 10 |
| MISOPROSTOL | 1 CAJA |
| DOPAMINA | 1 |
| HUMIDIFICADOR | 1 |
| CONDON | 1 |
| CATETER # 10 | 6 |
| CATETER # 10 | 6 |
| CATETER # 14 | 3 |
| KIT VENTURY ADULTO | 1 |
| SONDA NELATON 14 FR | 1 |
| SONDA FOLEY 18 FR | 1 |
| BOLSA RECOLECTORA DE ORINA | 1 |
| GUANTES ESTERILES # 7 | 3 |
| GUANTES ESTERILES # 7 1/2 | 1 |
| EQUIPO MACROGOTEO | 6 |
| EQUIPO MICROGOTEO | 6 |
| CANULA NASAL | 1 |
| KIT ULTRACITOLOGICO | 1 |
| TUBOS LILA | 3 |
| TUBOS SECOS | 3 |
| JERINGA 50 ML | 1 |
| JERINGA 10 ML | 2 |
| JERINGA 5ML | 2 |
| RESPONSABLE | |

DIAS: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

D N

**INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO**

CARRO DE PARO: Colocar abierto o cerrado según corresponda

No. de Candado: Número completo del contenido del carro de paro

Sellos de Seguridad: Indicar el estado bueno o malo

Inviolables: Si la descarga fue exitosa colocar Y Osi es fallida colocar NF y reportar inmediatamente

ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz (F) No. Funcionando (NF)

Powered by CamScanner


| E.S.E. Hospital | GA - Gestión Asistencial * AD - Apoyo Diagnóstico * 714 -SERVICIO FARMACÉUTICO | CÓDIGO | GA.AD.SF-F-007 |
|---|---|---|---|
| | **CONTROL TEMPERATURA AMBIENTE** | VERSIÓN | 02 |
| | | CREACIÓN | 2020-05-11 |
| | | REVISIÓN | 2020-06-01 |

Registrar la temperatura en la mañana y en la tarde en el horario establecido. El registro de la mañana con un color diferente al del registro de la tarde. Verificar semanalmente estado de batería en equipos digitales.

Dependencia: CARRO DE PARO Mes: NOVIEMBRE Mañana: ☐ Tarde: ▲ Año: 2023 Rango: 5 °C - 28 °C

| FECHA CAMBIO BATERÍA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONTROL TEMPERATURA AMBIENTE °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| LIMITE SUPERIOR °C | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| REAL (Mañana 8:00 a.m.) | 20 | 20.9 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20.5 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20.4 | 20.5 | 19 | 20.9 | 20 | 19.9 | 19.9 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 19.9 | | 18.9 | | | | |
| REAL (Tarde 2:00 p.m.) | 21 | 21 | 21 | 21.5 | 20 | 21.6 | 21 | 21 | 21.4 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21.6 | 21.5 | 21.9 | 21 | | 20 | | 19 | | | | |
| LIMITE INFERIOR | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| RESPONSABLE MAÑANA | Lorena P | Lorena P | Kathe | Kathe | Lorena P | Lorena P | Lorena P | Kathe | Lorena P | Kathe | Kathe | Lorena P | Lorena P | Kathe | Kathe | Lorena P | Lorena P | Kathe | Kathe | Kathe | Lorena P | Kathe | Kathe | Kathe | Kathe | Kathe | Kathe | Kathe | | | |
| RESPONSABLE TARDE | Lorena P | Kathe | Kathe | Kathe | Lorena P | Lorena P | Kathe | Kathe | Lorena P | Kathe | Kathe | Lorena P | Lorena P | Kathe | Kathe | Lorena P | Lorena P | Kathe | Kathe | Kathe | Lorena P | Kathe | Kathe | Kathe | Kathe | Kathe | Kathe | Kathe | | | |

**Comportamiento Temperatura Ambiente**

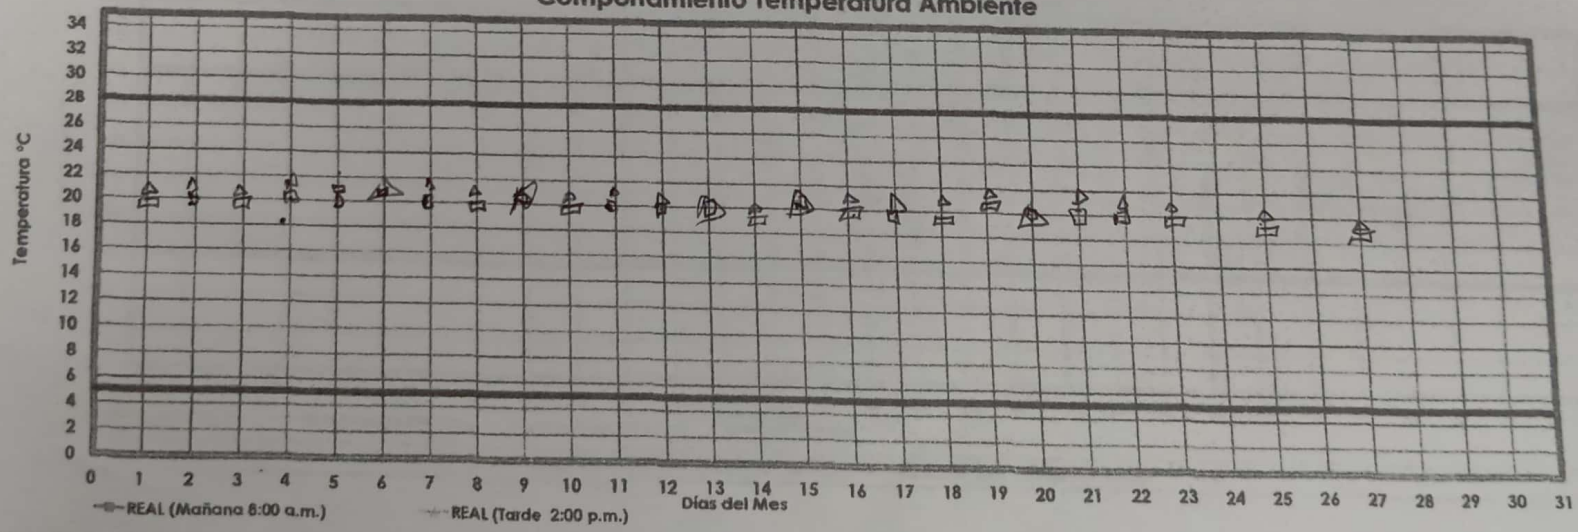


**PLAN DE ACCIÓN GENERADO CUANDO LA TEMPERATURA ESTÉ FUERA DE LÍMITES**

Powered by CamScanner

E.S.E. Hospital

GA - Gestión Asistencial * AD - Apoyo Diagnóstico * 714 -SERVICIO FARMACEUTICO

# CONTROL HUMEDAD AMBIENTE

| CÓDIGO | GA.AD.S1-F-008 |
|---|---|
| VERSIÓN | 02 |
| CREACIÓN | 2020-05-11 |
| R/VISIÓN | 2020-06-01 |


Registrar la Humedad en la mañana y en la tarde en el horario establecido. El registro de la mañana con un color diferente al del registro de la tarde. Verificar semanalmente estado de batería en equipos digitales.

Dependencia: CABLO DE PARO  Mes: NOVIEMBRE  Mañana: ■  Tarde: ▲  Año: 2023  Rango: 45% - 70%

## CONTROL DE HUMEDAD AMBIENTE

| DATOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA CAMBIO BATERÍA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIMITE SUPERIOR °C | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| REAL (Mañana 8:00 a.m.) | 69 | 64 | 67 | 71 | 69 | 72 | 71 | 67 | 60 | 67 | 61 | 62 | 62 | 61 | 66 | 55 | 62 | 69 | 64 | 65 | 61 | 63 | 55 | | 56 | | 54 | | | | |
| REAL (Tarde 2:00 p.m.) | 70 | 69 | 68 | 68 | 66 | 71 | 72 | 68 | 60 | 68 | 65 | 63 | 64 | 62 | 60 | 57 | 62 | 65 | 65 | 67 | 65 | 61 | 57 | | 58 | | 60 | | | | |
| LIMITE INFERIOR | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
| RESPONSABLE MAÑANA | Laura P | " | Katherine | " | Laura Blanco | Laura Blanco | " | Katherine | Laura P | Katherine | " | Laura P | Laura P | Katherine | " | Katherine | Laura P | Katherine | Katherine | Laura P | Laura P | Laura P | " | | Katherine | | Katherine | | | | |
| RESPONSABLE TARDE | " | " | Katherine | " | Laura P | Laura Blanco | " | Katherine | Laura P | Katherine | " | Laura P | Laura P | Katherine | " | Katherine | Laura P | Katherine | Katherine | Laura P | Laura P | Laura P | " | | Katherine | | Katherine | | | | |

## Comportamiento Control Humedad Ambiente

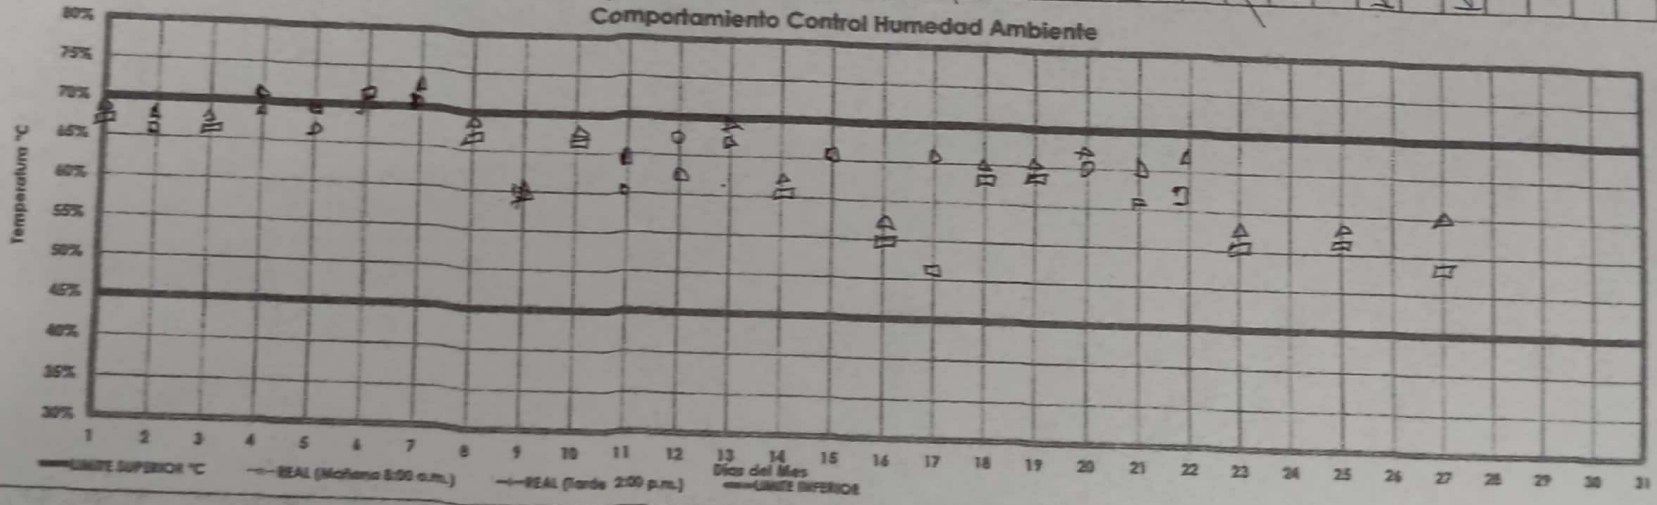


## PLAN DE ACCIÓN GENERADO CUANDO LA HUMEDAD ESTÉ FUERA DE LÍMITES

Powered by CamScanner


| | GA - Gestión Asistencial * AD - Apoyo Diagnóstico * 714 -SERVICIO FARMACEUTICO | CÓDIGO | GA.AD.SF-F-005 |
|---|---|---|---|
| E.S.E. Hospital | **CONTROL TEMPERATURA NEVERA** | VERSIÓN | 02 |
| | | CREACIÓN | 2020-05-11 |
| | | REVISIÓN | 2020-06-01 |

Registrar la temperatura en la mañana y en la tarde en el horario establecido. El registro de la mañana con un color diferente al del registro de la tarde. Verificar semanalmente estado de batería en equipos digitales.

Dependencia: NEVERA Mes: NOVIEMBRE Mañana: ☐ Tarde: △ Año: 2023 Rango: 8 °C - 2 °C


| FECHA CAMBIO BATERÍA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONTROL TEMPERATURA °C - CONGELADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| LIMITE SUPERIOR | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| REAL (Mañana 8:00 a.m.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REAL (Tarde 2:00 p.m.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIMITE INFERIOR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RESPONSABLE MAÑANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE TARDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Comportamiento Control Temperatura - CONGELADOR

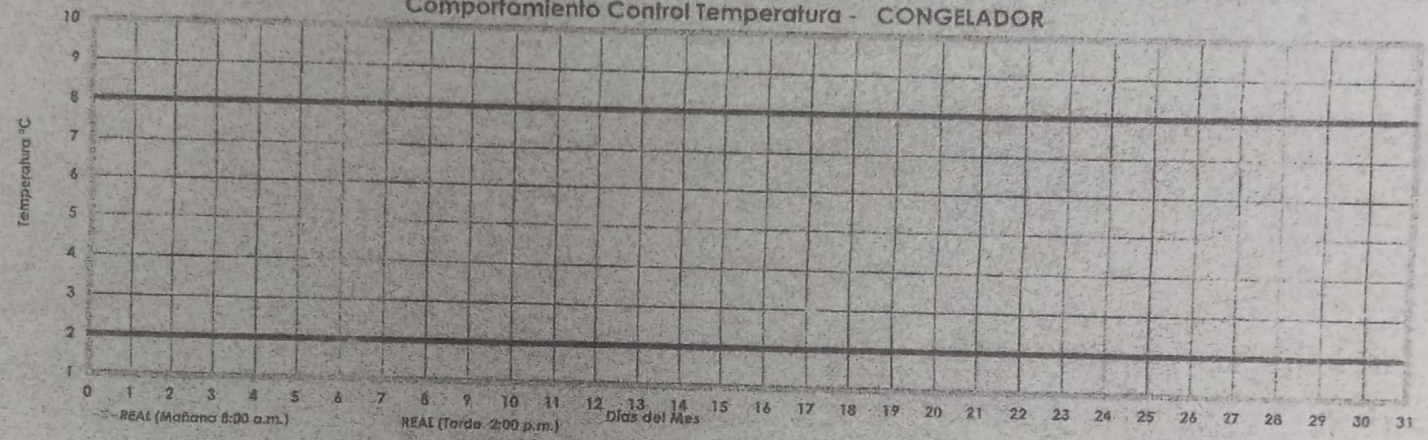


| DATOS | CONTROL TEMPERATURA °C - REFRIGERADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| LIMITE SUPERIOR | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| REAL (Mañana 8:00 a.m.) | 5.8 | 6.0 | 5.5 | 5.1 | 4.0 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 4.2 | 4.3 | 5.6 | 6.4 | 5.9 | 6.0 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 4.6 | 4.7 | 6.0 | 6.2 | 4.5 | 3.4 | | | | |
| REAL (Tarde 2:00 p.m.) | 5.0 | 6.3 | 5.0 | 5.1 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 6.1 | 6.3 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 5.0 | 5.0 | | | | |
| LIMITE INFERIOR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RESPONSABLE MAÑANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE TARDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Comportamiento Control Temperatura - REFRIGERADOR

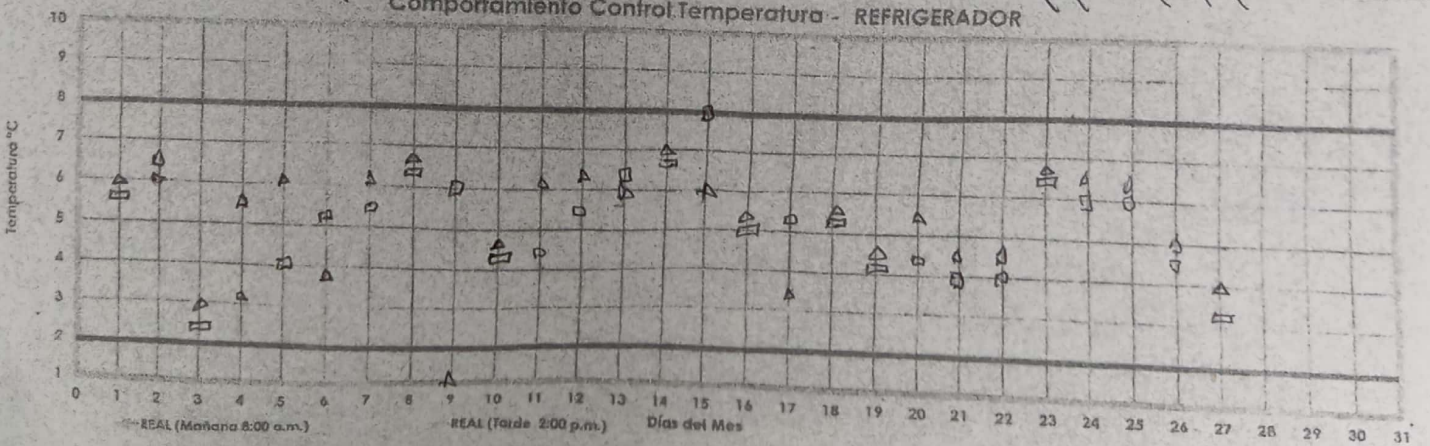


Powered by CamScanner