ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
LISTA DE VERIFICACION DIARIA DE CARRO DE PARO DE HOSPITALIZACION

MES: MARZO

DIAS		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31	
INSUMOS	CANTIDAD/ ESTADO	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N
CARRO DE PARO	ABIERTO O CERRADO	Cerrado		Cerrado		Cerrado		Cerrado		Cerrado		Cerrado		Cerrado		Cerrado		Cerrado		Cerrado		Cerrado		Cerrado		Cerrado		Cerrado		Cerrado		Cerrado		Cerrado		Cerrado		Cerrado		Cerrado		Cerrado		Cerrado		Cerrado		Cerrado		Cerrado									
No. de CANDADO	REGISTRAR EL NUMERO	2198449487		2198449487		2198449487		2198449487		2198449487		2198449487		2198449487		2198449487		2198449487		2198449487		2198449487		2198449487		2198449487		2198449487		2198449487		2198449487		2198449487		2198449487		2198449487		2198449487		2198449487		2198449487		2198449487		2198449487		2198449487									
BALA DE OXIGENO	SI HAY O NO	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO									
DESFIBRILADOR	BUENO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓									
MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMPLETO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓									
SUCCIONADOR	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓									
FERULA ESPINAL CORTA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓									
PESA ADULTO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓									
RESPONSABLE		Tecnico		Tecnico		Tecnico		Tecnico		Tecnico		Tecnico		Tecnico		Tecnico		Tecnico		Tecnico		Tecnico		Tecnico		Tecnico		Tecnico		Tecnico		Tecnico		Tecnico		Tecnico		Tecnico		Tecnico		Tecnico		Tecnico		Tecnico		Tecnico		Tecnico									

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
CARRO DE PARO: Colocar abierto o cerrado según corresponda
No. de Candado: Numero completo del candado del carro de paro
Bomba de Infusion: indicar el estado bueno o malo
Desfibrilador:Si la descarga fue exitosa colocar F Cuando es fallida colocar NF y reportar inmediatamente
Linea de comunicación: Funcionando (F) No Funcionando (NF)

Powered by CamScanner

E.S.E. Hospital	GA - Gestión Asistencial * AD - Apoyo Diagnóstico * 214 -SERVICIO FARMACÉUTICO	CÓDIGO	GA.AD.SF.F-007
	CONTROL TEMPERATURA AMBIENTE	VERSIÓN	02
		CREACIÓN	2020-05-11
		REVISIÓN	2020-04-01


Registrar la temperatura en la mañana y en la tarde en el horario establecido. El registro de la mañana con un color diferente al del registro de la tarde. Verificar semanalmente estado de batería en equipos digitales.

Año: 2024

Dependencia: Hospitalización Mes: Marzo Mañana: Tarde: Rango: 5 °C - 28 °C

FECHA CAMBIO BATERÍA																														
	CONTROL TEMPERATURA AMBIENTE °C																													
DATOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LIMITE SUPERIOR °C	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
REAL (Mañana 8:00 a.m.)	20	19	19	18	19	20	20	20	18	20	19	19	19	18	17	16	18	19	20	20	19	19	20	18	20	19	19				
REAL (Tarde 2:00 p.m.)	21	21	21	22	22	21	24	21	22	21	24	19	20	20	21	19	20	20	21	21	20	20	22	22	21	19	20				
LIMITE INFERIOR	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
RESPONSABLE MAÑANA	Kathe	Lorena	Lorena		Lorena	Kathe	Lorena	Kathe		Kathe		Kathe	Lorena	Lorena		Kathe	Kathe	Lorena	Lorena	Lorena	Kathe	Lorena			Kathe	Kathe	Kathe				
RESPONSABLE TARDE	Kathe	Lorena	Lorena		Lorena	Kathe	Lorena	Kathe		Kathe		Kathe	Lorena	Lorena		Kathe	Kathe	Lorena	Kathe	Lorena	Kathe	Lorena			Kathe	Lorena	Kathe				

Comportamiento Temperatura Ambiente

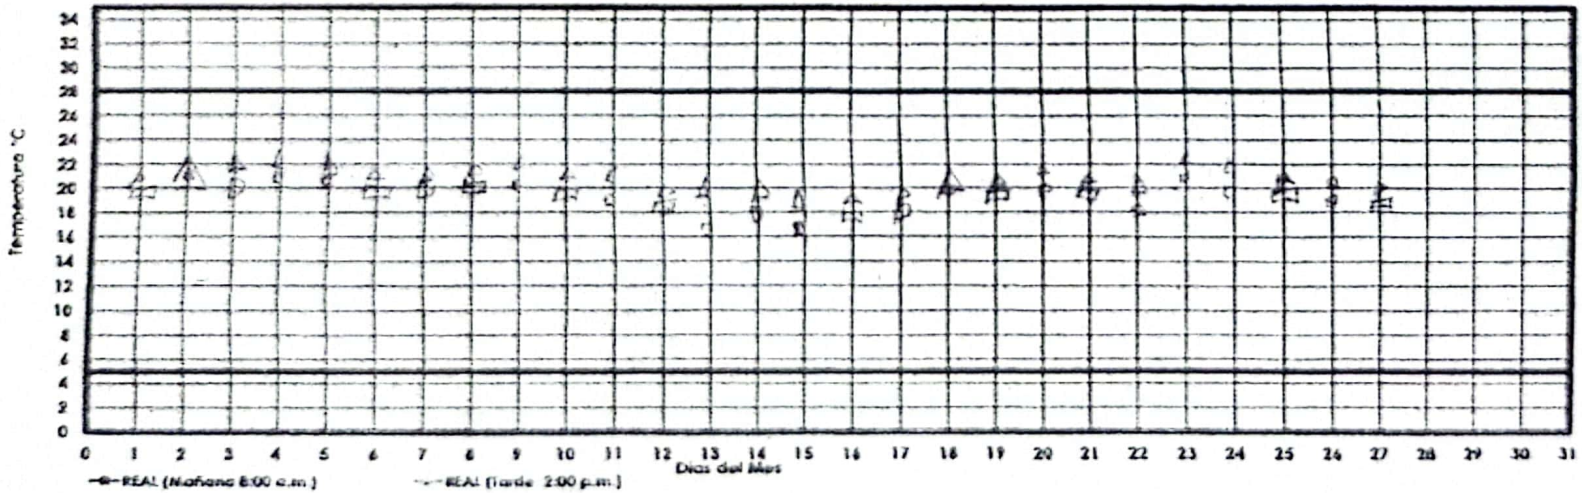

PLAN DE ACCIÓN GENERADO CUANDO LA TEMPERATURA ESTÉ FUERA DE LÍMITES

Powered by CamScanner

E.S.E. Hospital	GA - Gestión Asistencial * AD - Apoyo Diagnóstico * 714 -SERVICIO FARMACÉUTICO	CÓDIGO	GA.AD.SF-F-008
	CONTROL HUMEDAD AMBIENTE	VERSIÓN	02
		CREACIÓN	2020-05-11
		REVISIÓN	2020-06-01


Registrar la Humedad en la mañana y en la tarde en el horario establecido. El registro de la mañana con un color diferente al del registro de la tarde. Verificar semanalmente estado de batería en equipos digitales.

Año: 2024

Dependencia: HOSPITALIZACION **Mes:** MARZO **Mañana:** ■ **Tarde:** ▲ **Rango:** 45% - 70%

FECHA CAMBIO BATERÍA																																
	CONTROL DE HUMEDAD AMBIENTE																															
DATOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LIMITE SUPERIOR °C	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
REAL (Mañana 8:00 a.m.)	60	57	60	53	60	56	55	56	55	51	50	62	60	57	50	56	58	56	53	51	53	47	20	50	50	48	62				
REAL (Tarde 2:00 p.m.)	62	66	56	55	65	57	60	57	57	53	52	63	64	63	55	57	60	60	52	60	54	60	72	56	56	60	63				
LIMITE INFERIOR	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%
RESPONSABLE MAÑANA	Kath	Lomp			Lomp	Kath	Lomp	Kath		Kath		Kath		Lomp		Kath	Lomp	Lomp	Kath		Lomp	Kath		Lomp	Kath		Kath				
RESPONSABLE TARDE	Kath	Lomp			Lomp	Kath	Lomp	Kath		Kath		Kath		Lomp		Kath	Lomp	Lomp	Kath	Lomp	Kath	Lomp		Lomp	Kath	Lomp	Kath				

Comportamiento Control Humedad Ambiente

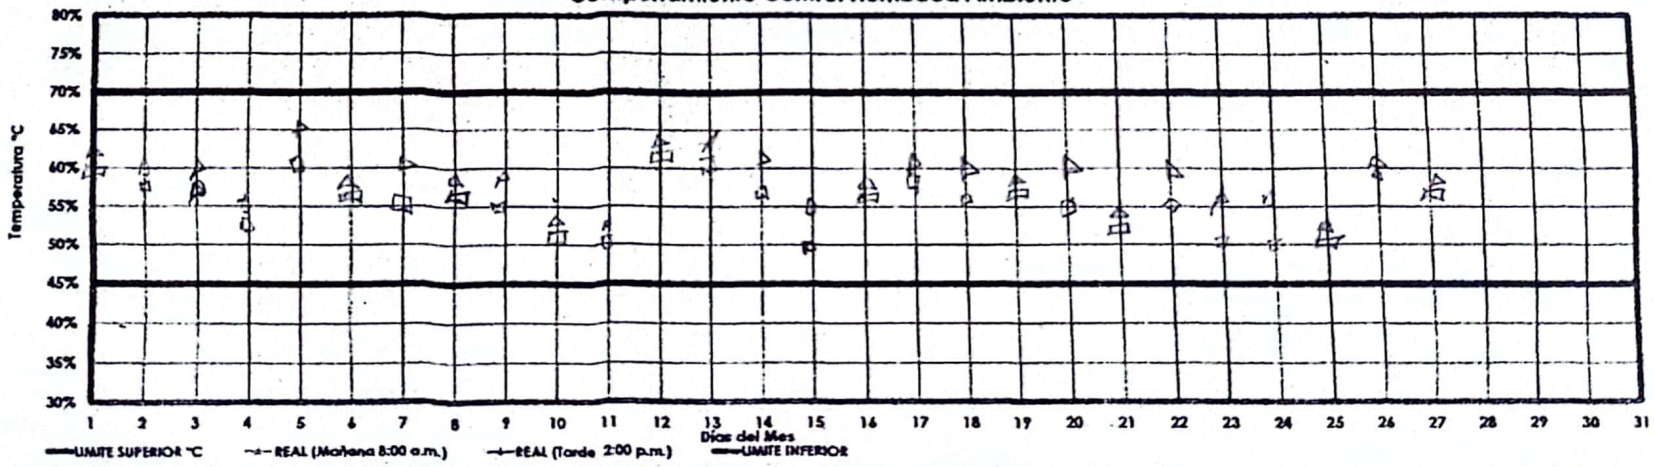

PLAN DE ACCIÓN GENERADO CUANDO LA HUMEDAD ESTÉ FUERA DE LÍMITES

Powered by CamScanner