CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N° **IPFNA1015**

Datos del Solicitante.

CLIENTE: ***Client***	**CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DE SUCRE SAS**	**NIT:** ***Nit.***	900.217.343-9
DIRECCIÓN: ***Address***	CLL 14 N° 20-53	**TELÉFONO:** ***Telephone***	307315544
CIUDAD: ***City***	SINCELEJO - SUCRE	**CONTACTO:** ***Contact***	DIANA ANAYA

Datos del Equipo Bajo Prueba.

EQUIPO: ***Device***	BÁSCULA ANÁLOGA	**MARCA:** ***Brand***	KENWELL
MODELO: ***Model***	160KG	**SERIE:** ***Serial***	SB-1109
INVENTARIO: ***Code***	NO REPORTA	**UBICACIÓN:** ***Place***	CIRUGÍA

Condiciones de Calibración

LUGAR DE CALIBRACIÓN: ***Place Calibration*** PREPARACIÓN DE PACIENTES

FECHA DE RECEPCIÓN: ***Date of Receipt***	2024-04-08	**FECHA DE CALIBRACIÓN:** ***Date of Calibration***	2024-04-08
TEMPERATURA INICIAL: ***Temperature***	30,5 °C	**TEMPERATURA FINAL:** ***End Temperature***	30,9 °C
HUMEDAD R. INICIAL: ***Humidity***	56 %	**HUMEDAD R. FINAL:** ***End Humidity***	58 %

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de BIOLAB SAS.
This certificate must not be partially or totally reproduced, except whit BIOLAB SAS. permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

The results of this certificate refer to the moment and condition in wich the measurement were made.
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados
The user is responsable for having his instruments calibrated at apropiate intervals.

FIRMAS AUTORIZADAS
Authorized Signatures

Realizó

Tnlg. Edwin Santos
Metrólogo
Eng. Calibration

Revisó

Firmado digitalmente por Ing. María Mónica Tavera Quiroz

María Mónica Tavera Quiroz
Directora de Laboratorio
Dir. Lab. Calibration

Certificado de Calibración N° **IPFNA1015**

Método Utilizado:

La calibración se realiza por el método de comparación entre el equipo bajo prueba y las pesas patrón de referencia, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el numeral 5. de la GUÍA PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA PESAR DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO (SIM MWG7/cg-01/V.00). La cual determina normalmente: la repetibilidad de las indicaciones, los errores de las indicaciones y el efecto en la indicación de la aplicación excéntrica de una carga.

Used Method:

Calibration is performed by the method of comparison between the equipment under test and the reference standard weights, taking into account the criteria set out in paragraph 5. of the GUIDE FOR INSTRUMENT CALIBRATION FOR NON-AUTOMATIC WEIGHING (SIM MWG7 /cg-01/V.00). Which normally determined: the repeatability of indications, the errors of the indications and the effect on the display of eccentric application of a load.

Incertidumbre de medición

La incertidumbre expandida informada de la medición se establece como la incertidumbre normalizada de la medición multiplicada por el factor de cobertura k obtenido de acuerdo a los grados efectivos de libertad (υeff) relacionados a continuación y tal que la probabilidad de cobertura corresponde a aproximadamente 95%:

Measurement uncertainty

The reported expanded uncertainty of measurement is set as the standard measurement uncertainty multiplied by the coverage factor k obtained according to the effective degrees of freedom (υeff) listed below and such that the coverage probability corresponds to approximately 95%

INDICACIÓN	0	10	20	30	45	60	75	90	110	120	135
υ eff	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194
K	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

La Incertidumbre fue evaluada tomando como referencia el numeral 7. de la guía SIM MWG7/cg-01/V.00.

La incertidumbre de medición expandida fue calculada de los componentes estándares de la incertidumbre de medida de la indicación (el error de la imperfecta repetibilidad, el error de redondeo de la indicación sin carga y con carga y el error debido a la imperfecta excentricidad) y los componentes estándares de la incertidumbre de la pesa de referencia (la corrección de la masa nominal para la obtención del valor de masa convencional, la corrección para el empuje de aire, la corrección para la deriva desde la ultima calibración y la corrección para efectos de convección).

Uncertainty was assessed by reference numeral 7. Guide SIM MWG7 / cg-01 / V.00.

Measurement uncertainty expanded was calculated from the standard components of the measurement uncertainty of the display (the error of imperfect repeatability, the rounding error of indication at no load and load and the error due to imperfect eccentricity) and standard components of the uncertainty of the reference weight (correcting the nominal mass to obtain the value of conventional mass correction for air buoyancy, the correction for drift since the last calibration and correction for convection effects).

Información de los equipos patrones utilizados.

Los equipos patrones e instrumentos utilizados en estas mediciones, son trazables a patrones nacionales e internacionales de referencia, de acuerdo al sistema internacional de unidades (SI)

Information patterns used equipment.

Patterns and instruments used in these measurements, teams are traceable to national and international benchmarks, according to the International System of Units (SI)

Patrón Utilizado	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración	Intervalo de Calibración (meses)	Certificado N°
Pesa patrón 5kg_J1	DETECTO	PARALELEPÍPEDO	1	2023-11-15	12	15871M
Pesa patrón 10kg_J1	DETECTO	PARALELEPÍPEDO	1	2023-11-15	12	15870M
Pesa patrón 20 kg (1) - J1	DETECTO	PARALELEPÍPEDO	01	2023-11-15	12	15869M
Pesa patrón 20 kg (2) - J1	DETECTO	PARALELEPÍPEDO	02	2023-11-15	12	15869M
Pesa patrón 20 kg (3) - J1	DETECTO	PARALELEPÍPEDO	03	2023-11-15	12	15869M
Pesa patrón 20 kg (4) - J1	DETECTO	PARALELEPÍPEDO	04	2023-11-15	12	15869M
Pesa patrón 20 kg (5) - J1	DETECTO	PARALELEPÍPEDO	05	2023-11-15	12	15869M
Pesa patrón 20 kg (6) - J1	DETECTO	PARALELEPÍPEDO	06	2023-11-15	12	15869M

Certificado de Calibración N° **IPFNA1015**

CONDICIONES PARA LA CALIBRACIÓN

CAPACIDAD DE MEDIDA DEL EQUIPO BAJO PRUEBA: 160 kg
DIVISIÓN DE ESCALA: 0,25 kg
TEMPERATURA DEL EQUIPO BAJO PRUEBA: 30,7 °C ***TEMPERATURA DE LAS PESAS PATRÓN:*** 30,2 °C

CARGAS DE PRUEBA: PESAS PATRÓN CLASE F1 Y M1 CON CERTIFICACIÓN OIML R-111

PRUEBAS Y RESULTADOS

Repetibilidad:

Asumida como constante durante el alcance de pesada
Carga de 80 kg compuesta de cuatro pesas patrón de 20 kg clases M1 ; aplicada 5 veces. La indicación se ajustó a cero cuando fue necesario.


Valor de Repetibilidad: **80 kg**


Carga	Lecturas
80	78,75
80	78,85
80	78,75
80	78,75
80	78,75

Excentricidad:

Valor Excentricidad:
60 kg

Carga de 60 kg compuesta de tres pesas patrón de 20 kg clases M1; aplicadas una vez en cada posición de la prueba, la indicación sin carga se ajustó a cero cuando fue necesario.





Posición	Lecturas
1	59,50
2	59,50
3	60,00
4	60,00
5	59,50

Error de indicación **Unidad de medida:** kg

Carga	Lectura	Error de Medición	Incertidumbre Expandida ±
0	0,00	0,00	0,36
10	10,00	0,00	0,36
20	20,00	0,00	0,36
30	30,00	0,00	0,36
45	45,00	0,00	0,36
60	59,50	-0,50	0,36
75	74,75	-0,25	0,36
90	88,00	-2,00	0,36
110	106,00	-4,00	0,36
120	115,00	-5,00	0,36
135	129,00	-6,00	0,36


Cada carga de prueba se aplicó una vez; se cargó de manera discontinua sólo hacia arriba, la indicación sin carga se regresó a cero cuando fue necesario; todas las cargas fueron ubicadas en el centro del receptor de carga.

Rango de Calibración: de 0 a 135
División de escala 0,25

Error Máximo: -6,00

Incertidumbre Máxima ± : 0,36

Certificado de Calibración N° **IPFNA1015**

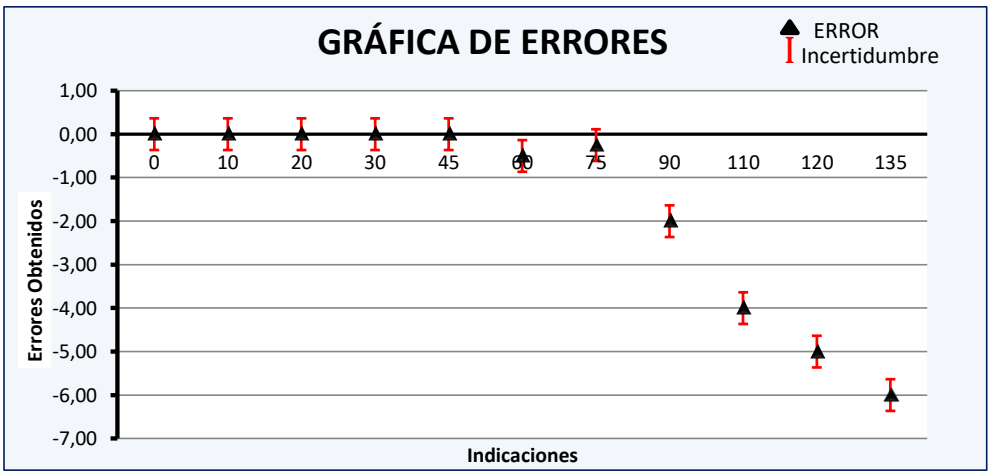

OBSERVACIONES
Se recomienda revisar los resultados obtenidos, los puntos de calibración son los acordados con el cliente.

Fin del Certificado