

Bogotá, D.C. 01/04/2024

Señores:

ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA -EGAT

Calle 13 No. 31-96

Ciudad


Referencia: Observaciones a las Propuestas de otros Oferentes

Industrias Metálicas Los Pinos S.A se permite realizar de manera respetuosa las siguientes observaciones a las propuestas y evaluación de los demás oferentes del Lote 3. Camillas de Transporte

PROPONENTE INDUSTRIAS MEDICOL

- **3.5.1 mínimo 2 atriles abatibles telescópicos con 4 ganchos porta líquidos integrados a la camilla**

El proponente dentro de su propuesta no cumple con el requerimiento, toda vez que tal y como se menciona en la ficha técnica aportada por el mismo, se ofrecen dos ganchos de atril telescópicos con 4 ganchos porta líquidos, no cumple que sean integrados a la camilla y la función de ser abatibles, por lo cual debe ser calificado como No Cumple en este requerimiento, Cualquier cambio en la especificación por parte del oferente se entendería como una mejora o adición a la propuesta ya presentada, lo que vulneraría los principios de igualdad y transparencia de los demás oferentes.

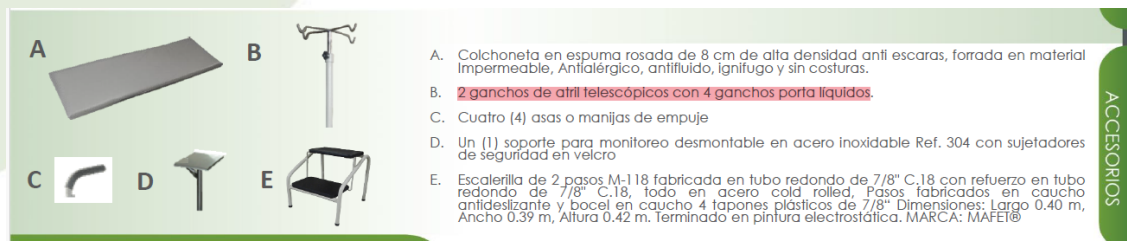

PROPONENTE DOTASALUD

- **3.5.1 mínimo 2 atriles abatibles telescópicos con 4 ganchos porta líquidos integrados a la camilla**

El proponente dentro de su propuesta no cumple con el requerimiento, toda vez que tal y como se menciona en la ficha técnica aportada por el mismo se ofrece un atril graduable y desmontable que no cumple que sea integrado a la camilla y la función de ser abatible, por lo cual debe ser calificado como No Cumple en este requerimiento, Cualquier cambio en la especificación por parte del oferente y/o el fabricante se entendería como una mejora o adición a la propuesta ya presentada, lo que vulneraría los principios de igualdad y transparencia de los demás oferentes.



PORTA SUERO 3.5.1

Graduable y desmontable. Con dos ganchos de doble servicio.
Capacidad de carga 17.6 lb (8 Kg).

• **3.5 Accesorios - 3.5.3 Un soporte para monitoreo desmontable en acero inoxidable con sujetadores de seguridad en velcro**

Dentro de los documentos aportados por el oferente, Ficha técnica y Manual no se evidencia que el soporte para monitor sea fabricado en acero inoxidable ni que cuente con sujetadores de seguridad en velcro, por el contrario se evidencia en el manual que el soporte para el monitor cuenta con termoformado o tapa polimérica, lo que indica que no esta fabricado completamente en acero inoxidable, por lo cual debe ser calificado como No Cumple en este requerimiento, Cualquier cambio en la especificación por parte del oferente y/o el fabricante se entendería como una mejora o adición a la propuesta ya presentada.

ESTADO Y FUNCIONAMIENTO MESA PORTA MONITOR (Si aplica)		
Estado del termoformado (tapa polímero)		
Ajuste de tornillos en las partes móviles de la mesa		
Estructura de la mesa (golpes, rayones y oxidación)		

PROPONENTE ELECTROMEDICA EQUIPOS MEDICOS

• **3.5.1 mínimo 2 atriles abatibles telescópicos con 4 ganchos porta líquidos integrados a la camilla**

El proponente dentro de su propuesta no cumple con el requerimiento, toda vez que tal y como se menciona en la ficha técnica aportada por el mismo se ofrece un atril graduable y desmontable que no cumple que sea integrado a la camilla y la función de ser abatible, por lo cual debe ser calificado como No Cumple en este requerimiento, Cualquier cambio en la especificación por parte del oferente y/o el fabricante se entendería como una mejora o adición a la propuesta ya presentada, lo que vulneraría los principios de igualdad y transparencia de los demás oferentes



PORTA SUERO 3.5.1

Graduable y desmontable. Con dos ganchos de doble servicio.
Capacidad de carga 17.6 lb (8 Kg).

- **3.2 Colchón forrado - 3.2.3 Condiciones generales - Antialérgico, antiescaras, antiﬂuido, ignífugo y sin costuras**

El proponente no oferta Colchón Sin costuras, tal y como se evidencia en la ficha técnica aportada por este, por lo cual debe ser calificado como No Cumple

HYDRUX
EXAMEN Y RECUPERACIÓN

COLCHONETA

Con núcleo en espuma de poliuretano (PU) de alta densidad, $26 \pm 2 \text{ Kg/m}^3$.
Cubierta fabricada en policloruro de vinilo con protección a la luz, líquidos, anti
estática ASTM D-257, resistente a las bacterias AATCC TM 147, resistente al
moho NO GROWTH (NG), retardante al fuego y libre de látex. 2.1/2.2/2.3

Colchoneta desmontable fabricada en espuma de poliuretano de alta densidad, 3.1 in
(80 mm) de espesor, cubierta anti bacterial, impermeable, ignífuga y libre de látex. 2.1-2.2-2.3-2.4

- **3.5 Accesorios - 3.5.3 Un soporte para monitoreo desmontable en acero inoxidable con sujetadores de seguridad en velcro**

Dentro de los documentos aportados por el oferente, Ficha técnica no se evidencia que el soporte para monitor sea fabricado en acero inoxidable ni que cuente con sujetadores de seguridad en velcro, Según el manual aportado por la firma Dotasalud que corresponde a este mismo modelo de camilla este soporte no está fabricado en acero inoxidable en su totalidad, por lo cual debe ser calificado como No Cumple en este requerimiento, Cualquier cambio en la especificación por parte del oferente y/o el fabricante se entendería como una mejora o adición a la propuesta ya presentada.

ACCESORIOS OPCIONALES* Con costo adicional

- Porta suero inoxidable extra. 5.1 - incluido
- Soporte tanque de oxígeno vertical.
- Mesa porta monitor con soporte para historia clínica. 5.3 incluido

PROPONENTE EQUIPOS CASA BLANCA

- **3.5.1 mínimo 2 atriles abatibles telescópicos con 4 ganchos porta líquidos integrados a la camilla**

El proponente dentro de su propuesta no cumple con el requerimiento, toda vez que tal y como se menciona en la ficha técnica aportada por el mismo se ofrece un atril graduable y desmontable que no cumple que sea integrado a la camilla y la función de ser abatible, por lo cual debe ser calificado como No Cumple en este requerimiento, Cualquier cambio en la especificación por parte del oferente y/o el fabricante se entendería como una mejora o adición a la propuesta ya presentada, lo que vulneraría los principios de transparencia de los demás oferentes



PORTA SUERO 3.5.1

Graduable y desmontable. Con dos ganchos de doble servicio.
Capacidad de carga 17.6 lb (8 Kg).

- **3.2 Colchón forrado - 3.2.3 Condiciones generales - Antialérgico, antiescaras, antifluído, ignífugo y sin costuras**

El proponente no oferta Colchón Sin costuras, tal y como se evidencia en la ficha técnica aportada por este, por lo cual debe ser calificado como No Cumple

HYDRUX
EXAMEN Y RECUPERACIÓN

COLCHONETA

Con núcleo en espuma de poliuretano (PU) de alta densidad, $26 \pm 2 \text{ Kg/m}^3$. Cubierta fabricada en policloruro de vinilo con protección a la luz, líquidos, anti estática ASTM D-257, resistente a las bacterias AATCC TM 147, resistente al moho NO GROWTH (NG), retardante al fuego y libre de látex. 2.1/2.2/2.3

Colchoneta desmontable fabricada en espuma de poliuretano de alta densidad, 3.1 in (80 mm) de espesor, cubierta anti bacterial, impermeable, ignífuga y libre de látex. 2.1-2.2-2.3-2.4

- **3.5 Accesorios - 3.5.3 Un soporte para monitoreo desmontable en acero inoxidable con sujetadores de seguridad en velcro**

Dentro de los documentos aportados por el oferente, Ficha técnica no se evidencia que el soporte para monitor sea fabricado en acero inoxidable ni que cuente con sujetadores de seguridad en velcro, Según el manual aportado por la firma Dotasalud que corresponde a este mismo modelo de camilla este soporte no está fabricado en acero inoxidable en su totalidad, por lo cual debe ser calificado como No Cumple en este requerimiento, Cualquier cambio en la especificación por parte del oferente y/o el fabricante se entendería como una mejora o adición a la propuesta ya presentada.

PROPONENTE ET SERVICES

- **3.5.1 mínimo 2 atriles abatibles telescópicos con 4 ganchos porta líquidos integrados a la camilla**

Dentro de los documentos aportados por el Proponente Ficha técnica del producto ofertado no se evidencia el cumplimiento de este requisito ya que la oferta se hace por un atril de acero inoxidable con gancho de plástico, que no cumple la literalidad de ser integrado a la camilla y abatible, por lo cual debe ser calificado como No Cumple en este requerimiento, Cualquier cambio en la especificación por parte del oferente y/o el fabricante se entendería como una mejora o adición a la propuesta ya presentada, lo que vulneraría los principios de igualdad y transparencia de los demás oferentes

Atril IV

Columna de acero inoxidable con gancho de plástico.



- **3.2 Colchón forrado - 3.2.3 Condiciones generales - Antialérgico, antiescaras, antifluído, ignífugo y sin costuras**

El proponente no oferta Colchón Sin costuras, tal y como se evidencia en la ficha técnica aportada por este, por lo cual debe ser calificado como No Cumple

SKP011

CARACTERÍSTICAS Y ASPECTOS DESTACADOS

Parámetros técnicos

— Dimensiones (LxAxAl) 1925x900x140mm

Cubierta con cremallera

— Material PU
— Color gris o azul oscuro
— Dimensiones (LxAxAl) 1925x900x140mm

Capa superior

— Material espuma de memoria viscoelástica
— Color azul, verde, negro
— Espesor 40mm
— Densidad 42-45kg/m3

Capa de base firme

— Material espuma de poliuretano
— Color blanco-crema
— Espesor 100mm
— Densidad 40kg/m3

Capa superior

a) Alta densidad: 42-45kg/m3
b) Propiedades termoactivas únicas para brindar un buen soporte y un excelente alivio de la presión

Capa base firme

a) Alta densidad: 40kg/m3
b) Muy elástico y termoestable. El diseño seccional funciona para que el colchón y la superficie de la cama se ajusten bien en diferentes posiciones, como el respaldo y el ajuste del reposa rodillas.

Funda con cremallera

Aire a través, a prueba de agua, suave, resistente al viento, fuerte resistencia a la tracción y anti-infección. Diseño de cremallera larga, fácil de quitar y lavar.

Tamaño

Se aceptan tamaños personalizados




- **3.5 Accesorios - 3.5.3 Un soporte para monitoreo desmontable en acero inoxidable con sujetadores de seguridad en velcro**

Dentro de los documentos aportados por el oferente, Ficha técnica no se evidencia que se incluya un soporte porta monitor, por lo cual debe ser calificado como No Cumple para este requisito técnico.

PROPONENTE HEALTH CORP

- **3.5.1 mínimo 2 atriles abatibles telescópicos con 4 ganchos porta líquidos integrados a la camilla**

El proponente dentro de su propuesta no cumple con el requerimiento, toda vez que tal y como se menciona en la ficha técnica aportada por el mismo se ofrece un atril graduable y desmontable que no cumple que sea integrado a la camilla y la función de ser abatible, por lo cual debe ser calificado como No Cumple en este requerimiento, Cualquier cambio en la especificación por parte del oferente y/o el fabricante se entendería como una mejora o adición a la propuesta ya presentada, lo que vulneraría los principios de transparencia de los demás oferentes



PORTA SUERO 3.5.1

Graduable y desmontable. Con dos ganchos de doble servicio.
Capacidad de carga 17.6 lb (8 Kg).

- **3.2 Colchón forrado - 3.2.3 Condiciones generales - Antialérgico, antiescaras, antifluido, ignífugo y sin costuras**

El proponente no oferta Colchón Sin costuras, tal y como se evidencia en la ficha técnica aportada por este, por lo cual debe ser calificado como No Cumple

HYDRUX
EXAMEN Y RECUPERACIÓN

COLCHONETA

Con núcleo en espuma de poliuretano (PU) de alta densidad, $26 \pm 2 \text{ Kg/m}^3$,
Cubierta fabricada en policloruro de vinilo con protección a la luz, líquidos, anti
estática ASTM D-257, resistente a las bacterias AATCC TM 147, resistente al
moho NO GROWTH (NG), retardante al fuego y libre de látex. 2.1/2.2/2.3

Colchoneta desmontable fabricada en espuma de poliuretano de alta densidad, 3.1 in
(80 mm) de espesor, cubierta anti bacterial, impermeable, ignífuga y libre de látex. 2.1-2.2-2.3-2.4


- **3.5 Accesorios - 3.5.3 Un soporte para monitoreo desmontable en acero inoxidable con sujetadores de seguridad en velcro**

Dentro de los documentos aportados por el oferente, Ficha técnica no se evidencia que el soporte para monitor sea fabricado en acero inoxidable ni que cuente con sujetadores de seguridad en velcro, Según el manual aportado por la firma Dotasalud que corresponde a este mismo modelo de camilla este soporte no está fabricado en acero inoxidable en su totalidad, por lo cual debe ser calificado como No Cumple en este requerimiento, Cualquier cambio en la especificación por parte del oferente y/o el fabricante se entendería como una mejora o adición a la propuesta ya presentada.

PROPONENTE LAS ELECTROMEDICINA

- **3.5.1 mínimo 2 atriles abatibles telescópicos con 4 ganchos porta líquidos integrados a la camilla**

El proponente dentro de su propuesta no cumple con el requerimiento, toda vez que tal y como se menciona en la ficha técnica aportada por el mismo se ofrece un atril graduable y desmontable que no cumple que sea integrado a la camilla y la función de ser abatible, por lo cual debe ser calificado como No Cumple en este requerimiento, Cualquier cambio en la especificación por parte del oferente y/o el fabricante se entendería como una mejora o adición a la propuesta ya presentada, lo que vulneraría los principios de transparencia de los demás oferentes



PORTA SUERO 3.5.1

Graduable y desmontable. Con dos ganchos de doble servicio. Capacidad de carga 17.6 lb (8 Kg).

- **3.2 Colchón forrado - 3.2.3 Condiciones generales - Antialérgico, antiescaras, antifluído, ignífugo y sin costuras**

El proponente no oferta Colchón Sin costuras, tal y como se evidencia en la ficha técnica aportada por este, por lo cual debe ser calificado como No Cumple

HYDRUX

EXAMEN Y RECUPERACIÓN

COLCHONETA

Con núcleo en espuma de poliuretano (PU) de alta densidad, $26 \pm 2 \text{ Kg/m}^3$.
Cubierta fabricada en policloruro de vinilo con protección a la luz, líquidos, anti
estática ASTM D-257, resistente a las bacterias AATCC TM 147, resistente al
moho NO GROWTH (NG), retardante al fuego y libre de látex. 2.1/2.2/2.3

Colchoneta desmontable fabricada en espuma de poliuretano de alta densidad, 3.1 in
(80 mm) de espesor, cubierta anti bacterial, impermeable, ignífuga y libre de látex. 2.1-2.2-2.3-2.4

- **3.5 Accesorios - 3.5.3 Un soporte para monitoreo desmontable en acero inoxidable con sujetadores de seguridad en velcro**

Dentro de los documentos aportados por el oferente, Ficha técnica no se evidencia que el soporte para monitor sea fabricado en acero inoxidable ni que cuente con sujetadores de seguridad en velcro, Según el manual aportado por la firma Dotasalud que corresponde a este mismo modelo de camilla este soporte no está fabricado en acero inoxidable en su totalidad, por lo cual debe ser calificado como No Cumple en este requerimiento, Cualquier cambio en la especificación por parte del oferente y/o el fabricante se entendería como una mejora o adición a la propuesta ya presentada.

Atentamente,



EDWIN ANDRES MONTOYA ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL