IT26-1YS

Trazanto

Unique point Chemical Integrator

For Steam sterilization processes.



Usage
Control of Steam sterilization processes between 121 ºC and 135 ºC.

Applicable Regulation
Designed under Quality Management Systems standards ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016.
ISO 11140-1:2014.

Classification
Class 1, according to risk.

Authorization
ANMAT (Argentinean National Administration of Drugs, Food and Medical Devices) PM 1614-4.

FDA 510(k)
K191021

Characteristics
Type 5 Integrator Indicator (according to ISO 11140-1).
One-side-laminated strips printed with indicator ink.
Size: 70 mm x 23 mm.
Initial color: yellow.
Final color: black.
100 % Toxic Heavy Metal free.



Integration condition calibrated with the kill time of a 10^6 *Geobacillus stearothermophilus*spores population, calculated in BIER (Biological Indicator Evaluator Resistometer). Conditions: saturated steam at 121 ºC, 128 ºC, 135 ºC.
The product ensures an adequate control of the efficacy of sterilization processes (temperature, time, quality of steam).

To interpret results visually, use the reference found in the indicator. Optionally, the readout of the chemical indicator can be done using Trazanto Automatic Quality Control and Traceability System (see instructions for use in device´s manual).

Environmental conditions during manufacture
T = 15-30 ºC, RH = 30-80 %.

Storage conditions
T = 10-30 ºC, RH = 30-80 %, keep out of direct light.

Transport conditions
Storage conditions should be strictly followed.
Transport in closed and reinforced boxes in order to avoid damages.
The transport of this product does not represent a risk for health.

Shelf life
5 years.

Packing
200 or 500 units per aluminum foil bag.
Packing information: product description, instructions for use, regulation, storage conditions, manufacturer information and data on label.

Labelling
On product's packing: product code and description, process for intended use, classification according to regulation, color change, presentation, batch number, manufacture and expiration date, bar code and datamatrix code.

Possible target markets
Healthcare, Food, Pharmaceutical and Medical Industries.

Other important information
Read product's instructions for use thoroughly before use.

Precautions
Do not store the product near sterilizing agents.
Do not expose this product to EO, Dry Heat or any sterilization processes other than Steam.
Do not reuse the sterilizer until the indicator has changed into the color indicated in the product.

IT26-1YS

Trazanto

Integrador Químico de Un Punto

Para procesos de esterilización por Vapor.



Uso previsto
Control de procesos de esterilización por Vapor entre 121 ºC y 135 ºC.


Normativa aplicable
Diseñado bajo normas de Sistemas de Gestión de Calidad ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016.
ISO 11140-1:2014

Clasificación
Clase 1, de acuerdo al riesgo.

Habilitación
ANMAT PM 1614-4.

510(k) FDA
K191021

Características
Indicador Integrador Tipo 5 (conforme ISO 11140-1).
Tira unilaminada impresa con tinta indicadora.
Tamaño: 70 mm x 23 mm (aproximado).
Color inicial: **amarillo.**
Color final: **negro.**
100 % Libre de Metales Pesados Tóxicos.

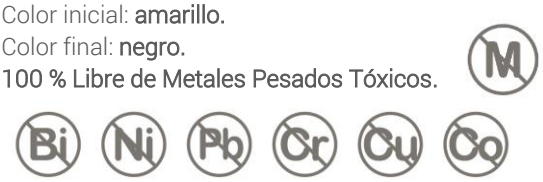

La condición de integración está calibrada con el tiempo de muerte de una población de 10^6 esporas de *Geobacillus stearothermophilus,* calculada en un BIER (Biological Indicator Evaluator Resistometer).
Condiciones: Vapor saturado a 121 ºC, 128 ºC, 135 ºC.
El producto asegura un control adecuado de la eficacia del proceso de esterilización (temperatura, tiempo, calidad del vapor).

Para interpretación de los resultados en forma visual, utilice la referencia que se encuentra en el indicador.
Opcionalmente, la lectura del indicador químico puede realizarse empleando el Sistema Automático de Control de Calidad y Trazabilidad Trazanto (ver instrucciones en el manual del dispositivo).

Condiciones ambientales de producción
T = 15-30 ºC, HR = 30-80 %.

Condiciones de almacenamiento
T = 10-30 ºC, HR = 30-80 %, mantener al abrigo de la luz.

Condiciones de transporte
Respetar las condiciones de almacenamiento.
Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar golpes.
El transporte de este producto no implica riesgo alguno para la salud de las personas.

Período de vida útil
5 años.

Envase
200 o 500 unidades por bolsa de alumínio.
Datos en el envase: descripción del producto, instrucciones de uso, normativa, condiciones de almacenamiento, datos del fabricante e información en la etiqueta.

Etiquetado
En envase: código y descripción del producto, proceso para el cual se utiliza, clasificación según la normativa, viraje de color, presentación, lote, fechas de fabricación y de vencimiento, código de barras y código datamatrix..

Posibles mercados de destino
Área de la Salud, Industria Alimenticia, Farmacéutica y de Productos Médicos.

Otra información relevante
Antes de su utilización se recomienda leer las instrucciones de uso del producto.

Precauciones
No almacenar el producto cerca de agentes esterilizantes.
No esterilizar por Óxido de Etileno, Calor Seco u otro proceso de esterilización diferente al Vapor.
No volver a utilizar el esterilizador hasta que el cambio de color del indicador sea el indicado en el producto.

<< Atras

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20193604	Nombre producto	INDICADORES QUIMICOS Y BIOLOGICOS PARA PROCESOS DE ESTERILIZACION				
Registro Sanitario	INVIMA 2020DM-0022614	Vencimiento	2030/12/14	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS BT10 INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. BT20 INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. BT30 INDICADOR BIOLÓGICO SEMI-AUTOCONTENIDO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR CALOR SECO. INDICADOR BIOLÓGICO SEMI-AUTOCONTENIDO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR CALOR SECO. INDICADOR BIOLÓGICO SEMI-AUTOCONTENIDO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR CALOR SECO. INDICADOR BIOLÓGICO SEMI-AUTOCONTENIDO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR CALOR SECO. INDICADOR BIOLÓGICO SEMI-AUTOCONTENIDO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR CALOR SECO. BT80 INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO PARA PROCESOS DE DESCONTAMINACIÓN POR CALOR HÚMEDO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO PARA PROCESOS DE DESCONTAMINACIÓN POR CALOR HÚMEDO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO PARA PROCESOS DE DESCONTAMINACIÓN POR CALOR HÚMEDO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO PARA PROCESOS DE DESCONTAMINACIÓN POR CALOR HÚMEDO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO PARA PROCESOS DE DESCONTAMINACIÓN POR CALOR HÚMEDO. BT90 INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA COLORIMÉTRICA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA COLORIMÉTRICA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA COLORIMÉTRICA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA COLORIMÉTRICA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA COLORIMÉTRICA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BT91 INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BT95 INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR PLASMA O VAPOR DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR PLASMA O VAPOR DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR PLASMA O VAPOR DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR PLASMA O VAPOR DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR PLASMA O VAPOR DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BT96 INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA SUPER RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR PLASMA O VAPOR DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA SUPER RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR PLASMA O VAPOR DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA SUPER RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR PLASMA O VAPOR DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA SUPER RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR PLASMA O VAPOR DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BT97 INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA SUPER RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE DESINFECCIÓN DE AMBIENTES Y SUPERFICIES POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA SUPER RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE DESINFECCIÓN DE AMBIENTES Y SUPERFICIES POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA SUPER RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE DESINFECCIÓN DE AMBIENTES Y SUPERFICIES POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA SUPER RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE DESINFECCIÓN DE AMBIENTES Y SUPERFICIES POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA SUPER RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE DESINFECCIÓN DE AMBIENTES Y SUPERFICIES POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BT100 INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR FORMALDEHÍDO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR FORMALDEHÍDO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR FORMALDEHÍDO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR FORMALDEHÍDO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR FORMALDEHÍDO. BT101 INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA COLORIMÉTRICA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR FORMALDEHÍDO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA COLORIMÉTRICA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR FORMALDEHÍDO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA COLORIMÉTRICA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR FORMALDEHÍDO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA COLORIMÉTRICA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR FORMALDEHÍDO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA COLORIMÉTRICA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR FORMALDEHÍDO. BT102 INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR FORMALDEHIDO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR FORMALDEHIDO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR FORMALDEHIDO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR FORMALDEHIDO. BT110 INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE CICLOS DE							

ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. BT200 INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA COLORIMÉTRICA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA COLORIMÉTRICA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA COLORIMÉTRICA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA COLORIMÉTRICA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA COLORIMÉTRICA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. BT202 INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA COLORIMÉTRICA PARA CONTROL DE PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA COLORIMÉTRICA PARA CONTROL DE PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA COLORIMÉTRICA PARA CONTROL DE PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA COLORIMÉTRICA PARA CONTROL DE PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA COLORIMÉTRICA PARA CONTROL DE PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. BT220 INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR ASISTIDOS POR VACÍO Y POR DESPLAZAMIENTO DE AIRE POR GRAVEDAD A 121 – 135 ºC. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR ASISTIDOS POR VACÍO Y POR DESPLAZAMIENTO DE AIRE POR GRAVEDAD A 121 – 135 ºC. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR ASISTIDOS POR VACÍO Y POR DESPLAZAMIENTO DE AIRE POR GRAVEDAD A 121 – 135 ºC. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR ASISTIDOS POR VACÍO Y POR DESPLAZAMIENTO DE AIRE POR GRAVEDAD A 121 – 135 ºC. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR ASISTIDOS POR VACÍO Y POR DESPLAZAMIENTO DE AIRE POR GRAVEDAD A 121 – 135 ºC. BT221 INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR CON DESPLAZAMIENTO DE AIRE POR GRAVEDAD A 132 -135ºC. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR CON DESPLAZAMIENTO DE AIRE POR GRAVEDAD A 132 -135ºC. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR CON DESPLAZAMIENTO DE AIRE POR GRAVEDAD A 132 -135ºC. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR CON DESPLAZAMIENTO DE AIRE POR GRAVEDAD A 132 -135ºC. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR CON DESPLAZAMIENTO DE AIRE POR GRAVEDAD A 132 -135ºC. BT222 INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA SÚPER RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR ASISTIDOS POR VACÍO Y POR DESPLAZAMIENTO DE AIRE POR GRAVEDAD A 121 – 135 ºC. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA SÚPER RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR ASISTIDOS POR VACÍO Y POR DESPLAZAMIENTO DE AIRE POR GRAVEDAD A 121 – 135 ºC. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA SÚPER RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR ASISTIDOS POR VACÍO Y POR DESPLAZAMIENTO DE AIRE POR GRAVEDAD A 121 – 135 ºC. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA SÚPER RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR ASISTIDOS POR VACÍO Y POR DESPLAZAMIENTO DE AIRE POR GRAVEDAD A 121 – 135 ºC. BT223 INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA SÚPER RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR CON DESPLAZAMIENTO DE AIRE POR GRAVEDAD A 132 -135ºC. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA SÚPER RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR CON DESPLAZAMIENTO DE AIRE POR GRAVEDAD A 132 -135ºC. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA SÚPER RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR CON DESPLAZAMIENTO DE AIRE POR GRAVEDAD A 132 -135ºC. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA SÚPER RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR CON DESPLAZAMIENTO DE AIRE POR GRAVEDAD A 132 -135ºC. BT224 INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA ULTRA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR CON DESPLAZAMIENTO DE AIRE POR GRAVEDAD A 132 -135ºC. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA ULTRA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR CON DESPLAZAMIENTO DE AIRE POR GRAVEDAD A 132 -135ºC. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA ULTRA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR CON DESPLAZAMIENTO DE AIRE POR GRAVEDAD A 132 -135ºC. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA ULTRA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR CON DESPLAZAMIENTO DE AIRE POR GRAVEDAD A 132 -135ºC. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO DE LECTURA ULTRA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR CON DESPLAZAMIENTO DE AIRE POR GRAVEDAD A 132 -135ºC. BT21 INDICADOR BIOLÓGICO EN AMPOLLAS AUTOCONTENIDAS CON ESPORAS PARA MONITOREAR PROCESOS INDUSTRIALES DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR DE LÍQUIDOS. INDICADOR BIOLÓGICO EN AMPOLLAS AUTOCONTENIDAS CON ESPORAS PARA MONITOREAR PROCESOS INDUSTRIALES DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR DE LÍQUIDOS. INDICADOR BIOLÓGICO EN AMPOLLAS AUTOCONTENIDAS CON ESPORAS PARA MONITOREAR PROCESOS INDUSTRIALES DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR DE LÍQUIDOS. INDICADOR BIOLÓGICO EN AMPOLLAS AUTOCONTENIDAS CON ESPORAS PARA MONITOREAR PROCESOS INDUSTRIALES DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR DE LÍQUIDOS. INDICADOR BIOLÓGICO EN AMPOLLAS AUTOCONTENIDAS CON ESPORAS PARA MONITOREAR PROCESOS INDUSTRIALES DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR DE LÍQUIDOS. BT22 INDICADOR BIOLÓGICO EN AMPOLLAS AUTOCONTENIDAS CON ESPORAS PARA MONITOREAR PROCESOS INDUSTRIALES DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR DE LÍQUIDOS. INDICADOR BIOLÓGICO EN AMPOLLAS AUTOCONTENIDAS CON ESPORAS PARA MONITOREAR PROCESOS INDUSTRIALES DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR DE LÍQUIDOS. INDICADOR BIOLÓGICO EN AMPOLLAS AUTOCONTENIDAS CON ESPORAS PARA MONITOREAR PROCESOS INDUSTRIALES DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR DE LÍQUIDOS. INDICADOR BIOLÓGICO EN AMPOLLAS AUTOCONTENIDAS CON ESPORAS PARA MONITOREAR PROCESOS INDUSTRIALES DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR DE LÍQUIDOS. BT23 INDICADOR BIOLÓGICO EN AMPOLLAS AUTOCONTENIDAS CON ESPORAS PARA MONITOREAR PROCESOS INDUSTRIALES DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR DE LÍQUIDOS. INDICADOR BIOLÓGICO EN AMPOLLAS AUTOCONTENIDAS CON ESPORAS PARA MONITOREAR PROCESOS INDUSTRIALES DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR DE LÍQUIDOS. INDICADOR BIOLÓGICO EN AMPOLLAS AUTOCONTENIDAS CON ESPORAS PARA MONITOREAR PROCESOS INDUSTRIALES DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR DE LÍQUIDOS. INDICADOR BIOLÓGICO EN AMPOLLAS AUTOCONTENIDAS CON ESPORAS PARA MONITOREAR PROCESOS INDUSTRIALES DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR DE LÍQUIDOS. BT24 INDICADOR BIOLÓGICO EN AMPOLLAS AUTOCONTENIDAS CON ESPORAS PARA MONITOREAR PROCESOS INDUSTRIALES DE ESTERILIZACIÓN

POR VAPOR DE LÍQUIDOS A BAJA TEMPERATURA 110-121 ºC. INDICADOR BIOLÓGICO EN AMPOLLAS AUTOCONTENIDAS CON ESPORAS PARA MONITOREAR PROCESOS INDUSTRIALES DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR DE LÍQUIDOS A BAJA TEMPERATURA 110-121 ºC. INDICADOR BIOLÓGICO EN AMPOLLAS AUTOCONTENIDAS CON ESPORAS PARA MONITOREAR PROCESOS INDUSTRIALES DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR DE LÍQUIDOS A BAJA TEMPERATURA 110-121 ºC. INDICADOR BIOLÓGICO EN AMPOLLAS AUTOCONTENIDAS CON ESPORAS PARA MONITOREAR PROCESOS INDUSTRIALES DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR DE LÍQUIDOS A BAJA TEMPERATURA 110-121 ºC. INDICADOR BIOLÓGICO EN AMPOLLAS AUTOCONTENIDAS CON ESPORAS PARA MONITOREAR PROCESOS INDUSTRIALES DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR DE LÍQUIDOS A BAJA TEMPERATURA 110-121 ºC. BT93 INDICADOR BIOLÓGICO EN CUPONES EN ENVOLTORIOS INDIVIDUALES PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR PLASMA O VAPOR DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. INDICADOR BIOLÓGICO EN CUPONES EN ENVOLTORIOS INDIVIDUALES PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR PLASMA O VAPOR DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. INDICADOR BIOLÓGICO EN CUPONES EN ENVOLTORIOS INDIVIDUALES PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR PLASMA O VAPOR DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. INDICADOR BIOLÓGICO EN CUPONES EN ENVOLTORIOS INDIVIDUALES PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR PLASMA O VAPOR DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. INDICADOR BIOLÓGICO EN CUPONES EN ENVOLTORIOS INDIVIDUALES PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR PLASMA O VAPOR DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BT40 INDICADOR BIOLÓGICO EN TIRAS CON ESPORAS PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO Y CALOR SECO. INDICADOR BIOLÓGICO EN TIRAS CON ESPORAS PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO Y CALOR SECO. INDICADOR BIOLÓGICO EN TIRAS CON ESPORAS PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO Y CALOR SECO. INDICADOR BIOLÓGICO EN TIRAS CON ESPORAS PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO Y CALOR SECO. INDICADOR BIOLÓGICO EN TIRAS CON ESPORAS PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO Y CALOR SECO. BT50 INDICADOR BIOLÓGICO EN TIRAS CON ESPORAS PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO. INDICADOR BIOLÓGICO EN TIRAS CON ESPORAS PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO. INDICADOR BIOLÓGICO EN TIRAS CON ESPORAS PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO. INDICADOR BIOLÓGICO EN TIRAS CON ESPORAS PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO. INDICADOR BIOLÓGICO EN TIRAS CON ESPORAS PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO. BT60 INDICADOR BIOLÓGICO EN TIRAS CON ESPORAS PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR Y CALOR SECO. INDICADOR BIOLÓGICO EN TIRAS CON ESPORAS PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR Y CALOR SECO. INDICADOR BIOLÓGICO EN TIRAS CON ESPORAS PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR Y CALOR SECO. INDICADOR BIOLÓGICO EN TIRAS CON ESPORAS PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR Y CALOR SECO. INDICADOR BIOLÓGICO EN TIRAS CON ESPORAS PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR Y CALOR SECO. CD10 INDICADOR MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. INDICADOR MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. INDICADOR MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. INDICADOR MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. INDICADOR MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. CD11 ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. CD12 TIRA CONTROL INTERNO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. TIRA CONTROL INTERNO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. TIRA CONTROL INTERNO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. TIRA CONTROL INTERNO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. TIRA CONTROL INTERNO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. CD13 ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. CD14 TIRA DOBLE DE CONTROL INTERNO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. TIRA DOBLE DE CONTROL INTERNO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. TIRA DOBLE DE CONTROL INTERNO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. TIRA DOBLE DE CONTROL INTERNO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. TIRA DOBLE DE CONTROL INTERNO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. CD15 TIRA DOBLE DE INDICADOR MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. TIRA DOBLE DE INDICADOR MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. TIRA DOBLE DE INDICADOR MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. TIRA DOBLE DE INDICADOR MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. TIRA DOBLE DE INDICADOR MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. CD16 DOBLE TIRA TROQUELADA MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. DOBLE TIRA TROQUELADA MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. DOBLE TIRA TROQUELADA MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. DOBLE TIRA TROQUELADA MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. DOBLE TIRA TROQUELADA MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. CD17 CÍRCULO AUTOADHESIVO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. CÍRCULO AUTOADHESIVO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. CÍRCULO AUTOADHESIVO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. CÍRCULO AUTOADHESIVO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. CÍRCULO AUTOADHESIVO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. CD18 SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO. CD20 INDICADOR MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. INDICADOR MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. INDICADOR MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. INDICADOR MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. INDICADOR MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. CD21 ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. CD22 TIRA CONTROL INTERNO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. TIRA CONTROL INTERNO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. TIRA CONTROL INTERNO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. TIRA CONTROL INTERNO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. TIRA CONTROL INTERNO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. CD23 ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA

	DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. CD24 TIRA DOBLE DE CONTROL INTERNO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. TIRA DOBLE DE CONTROL INTERNO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. TIRA DOBLE DE CONTROL INTERNO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. TIRA DOBLE DE CONTROL INTERNO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. TIRA DOBLE DE CONTROL INTERNO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. CD25 TIRA DOBLE DE INDICADOR MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. TIRA DOBLE DE INDICADOR MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. TIRA DOBLE DE INDICADOR MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. TIRA DOBLE DE INDICADOR MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. TIRA DOBLE DE INDICADOR MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. CD26 TARJETA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. TARJETA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. TARJETA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. TARJETA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. TARJETA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. CD27 CÍRCULO AUTOADHESIVO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. CÍRCULO AUTOADHESIVO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. CÍRCULO AUTOADHESIVO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. CÍRCULO AUTOADHESIVO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. CÍRCULO AUTOADHESIVO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. CD28 SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. ETIQUETA DOBLE AUTOADHESIVA. SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. ETIQUETA DOBLE AUTOADHESIVA. SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. ETIQUETA DOBLE AUTOADHESIVA. SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. ETIQUETA DOBLE AUTOADHESIVA. SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. ETIQUETA DOBLE AUTOADHESIVA. CD29 TIRA DOBLE DE INDICADOR MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. TIRA DOBLE DE INDICADOR MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. TIRA DOBLE DE INDICADOR MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. TIRA DOBLE DE INDICADOR MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. TIRA DOBLE DE INDICADOR MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. CD40 INDICADOR MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. INDICADOR MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. INDICADOR MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. INDICADOR MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. INDICADOR MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CD41 ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CD42 TIRA CONTROL INTERNO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. TIRA CONTROL INTERNO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. TIRA CONTROL INTERNO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. TIRA CONTROL INTERNO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. TIRA CONTROL INTERNO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CD43 ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CD47 CÍRCULO AUTOADHESIVO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CÍRCULO AUTOADHESIVO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CÍRCULO AUTOADHESIVO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CÍRCULO AUTOADHESIVO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CÍRCULO AUTOADHESIVO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CD48 SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PEROXIDO DE HIDROGENO. ETIQUETA DOBLE AUTOADHESIVA. SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PEROXIDO DE HIDROGENO. ETIQUETA DOBLE AUTOADHESIVA. SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PEROXIDO DE HIDROGENO. ETIQUETA DOBLE AUTOADHESIVA. SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PEROXIDO DE HIDROGENO. ETIQUETA DOBLE AUTOADHESIVA. SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR PEROXIDO DE HIDROGENO. ETIQUETA DOBLE AUTOADHESIVA. CD50 INDICADOR MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR FORMALDEHÍDO. INDICADOR MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR FORMALDEHÍDO. INDICADOR MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR FORMALDEHÍDO. INDICADOR MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR FORMALDEHÍDO. INDICADOR MULTIVARIABLE PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR FORMALDEHÍDO. CD51 ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR FORMALDEHÍDO. ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR FORMALDEHÍDO. ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR FORMALDEHÍDO. ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR FORMALDEHÍDO. ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR FORMALDEHÍDO. CD52 TIRA CONTROL INTERNO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR FORMALDEHÍDO. TIRA CONTROL INTERNO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR FORMALDEHÍDO. TIRA CONTROL INTERNO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR FORMALDEHÍDO. TIRA CONTROL INTERNO PARA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR FORMALDEHÍDO. T
Marcas	BIONOVA ®, CHEMDYE ®, CINTAPE ®, INTEGRON ®, CHEMINK ®.

Datos de Interes

Vida Util	1	**Miembros Comprometidos**	CUERPO HUMANO
Usos	INDICADOS PARA EL CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACION POR OXIDO DE ETILENO (OE), CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACION POR VAPOR, CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACION POR CALOR SECO, PARA PROCESOS DE DESCONTAMINACION POR CALOR HUMEDO, CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACION POR PEROXIDO DE HIDROGENO, CONTROL DE PROCESOS DE ESTERILIZACION POR PLASMA O VAPOR DE PEROXIDO DE HIDROGENO, CONTROL DE DESINFECCION DE	**Riesgo**	I

	AMBIENTES Y SUPERFICIES POR PEROXIDO DE HIDROGENO, CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACION POR FORMALDEHIDO, PARA MONITOREAR PROCESOS INDUSTRIALES DE ESTERILIZACION POR VAPOR DE LIQUIDOS.		

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
INDICADORES QUIMICOS: 1, 12, 25, 100, 200, 250, 500, 750, 1000 UNIDADES POR ENVASE (ROLLO, PAQUETE)., INDICADORES BIOLOGICOS: 1, 30, 50, 100, 200 UNIDADES POR ENVASE (CAJA).

Roles por Producto

Rol	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	ESTERIPAC S.A.S.	CR 9C N 17 - 86	COLOMBIA	ANTIOQUIA	LA CEJA	esteripac@esteripac.co
FABRICANTE	TERRAGENE S.A.	RUTA NACIONAL NO.9, KM 280, ALV	ARGENTINA			
IMPORTADOR	ESTERIPAC S.A.S.	CR 9C N 17 - 86	COLOMBIA	ANTIOQUIA	LA CEJA	esteripac@esteripac.co
TITULAR REGISTRO SANITARIO	ESTERIPAC S.A.S.	CR 9C N 17 - 86	COLOMBIA	ANTIOQUIA	LA CEJA	esteripac@esteripac.co

Imprimir << Atras