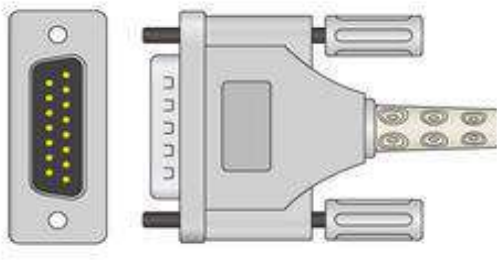
FICHA TÉCNICA

IMAGEN:		
	***PRODUCTO***	**CABLE DE EKG PARA ELECTROCARDIOGRAFO**
	MARCA	UNIMED
	REFERENCIA	E10-SH1-B
	REGISTRO SANITARIO	2019DM-0004316-R1
	RIESGO	IIA

USO - DESCRIPCIÓN	Dispositivo médico destinado a transmitir señales eléctricas del corazón a un monitor, para obtener datos de electrocardiografía del paciente.
CARACTERÍSTICAS	Elemento para usar en paciente Adulto - pediátrico, se debe hacer desinfección, uso bajo vigilancia médica. Cable de cobre estañado con conector, terminales tipo Banana Medición de alta precisión Fácil de usar y conectar Duradero Cables reutilizables de alta calidad La temperatura de funcionamiento varía de 10 ° a 35 ° C (50 ° a 95 ° F) Cumple con la American Heart Association (AHA) Marcado CE Materiales libres de contaminantes ambientales (caucho de látex natural) utilizados incluye juego de leads tipo banana de 4 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conector	Redondo 10 Pin
Compatible con:	Cable a paciente de 10 derivadas para toma de EKG, uso en Electrocardiógrafo Schiller AT1, AT2, AT2 Light, AT2 Plus, AT4; Esaote: P80 Series 40893, Biosound MyLab 30 CD, 30 CV, 50; Cardiette: AR1200 adv; MyLab 30 Vet., CS100, CS-200, CS6/12, Cardiovit AT-10 plus, AT-104PC, AT-110, Del Mar, Esaote P80/120, Bionet Cardiocare 200/300 , Innomed, Ergoline, Cardiette, Cardioline, Cardiorapid, Edan, Gima, Philips Pagewriter, Kontron, Macquaire, Nihon Khoden, Progetti, Biosound, Well Allyn CP10, CP50.
Longitud del cable:	2.2 M
Longitud de derivadas	Bipolares: 1.2m; Precordiales 0.8m
Peso:	0.73kg
Autoclavable:	No
Temp. Operación:	5°C a 45°C
Humedad operación:	0 a 80% No condensada

MATERIAL / COMPOSICIÓN	Filamentos de metal, TPU
ALMACENAMIENTO	Temperatura de almacenamiento: -25-55°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada
PRESENTACIÓN	Unidad.
RECOMENDACIONES	**Mantenimiento:** - El cable debe ser limpiado usando un paño suave humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70% antes de usarse en cada paciente. - Permita que el cable se seque antes de su uso. - No utilice agentes abrasivos o productos químicos excepto el alcohol isopropílico al 70% - No irradie, exponga a autoclave, empape o sumerja el cable en ningùn tipo de solución. **Precauciones:** - Asegúrese que el cable se encuentre intacto físicamente, sin fracturas o alambres deteriorados o partes dañadas. Haga una inspección visual del cable y descártelo si se encuentran fracturas o decoloración. - No intente reprocesar, reacondicionar o reciclar los cables, este proceso puede dañar los componentes eléctricos, conduciendo a un daño potencial al paciente. - Una falla en la conexión apropiada al sensor o al módulo de oximetría podría resultar en lecturas intermitentes, resultados imprecisos o no lectura. - Para evitar el daño en el cable, siempre agárrelo del conector, nunca del cable cuando haga la conexión o desconexión de la terminal. - Siempre refiérase al manual de operador del módulo de oximetría para instrucciones completas o información adicional. - Ubique adecuadamente el cable para reducir la posibilidad que el paciente se enrede o estrangule.