

Sociedad Clínica Boyacá S.A.S.

Nit. 891.856.507-9

Transversal 29 No. 9C - 41
PBX. (608) 7 63 23 01
Email.: clinicaboyaca@gmail.com Web: clinicaboyaca.com.co
Duitama - Boyaca - Colombia



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.:
FEVC544529

Resolución No. 18764068113306
FECHA: 2024/04/01 HASTA: 2025/04/01
RANGO DEL FEVC516000 AL FEVC1000000 AUTORIZACIÓN
TIPO FACTURA ELECTRONICA
SOMOS RESPONSABLES DE I.V.A.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CUFE :

c3213eef8eef7f8818803f104fa03a5b52135931f429b8853b4bc1c593150ca7231fbe85483cfe778d28e48c548a4df8

Datos Tercero

Nombre: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**
Identificacion: **899999034-1**
Dirección : **CARRERA 12 # 55A - 51**
Ciudad : **SOGAMOSO**
Teléfono: **704035-707235**

Datos Factura

Fecha Validacion Dian : **2024-10-02 17:16:21**
Fecha Vencimiento : **01/11/2024**
Forma de pago : **Credito**

Datos Paciente

Nombre: **ESPITIA DERAMIREZ OTILIA**
Identificacion: **CC 23852149**
Dirección : **CARRERA 19 N° 16- 42**
Ciudad : **SOGAMOSO** Teléfono: **3202732071-3114749696 7851682**

Datos Atención

Via Ingreso: **CONSULTA ESPECIALISTA**
F ingreso: **17/09/2024**
F. Salida : **17/09/2024**
Historia : **00014133**

Codigo	Descripción	Fecha	Autorización	Cant	$ Unitario	V. Bruto	Copago	Cuota Mod.	$ Total
954107	Audiometria Tonal	17/09/2024	648	1,00	44.910	44.910			44.910
954301	Audiometria Verbal (logoaudiometria)	17/09/2024		1,00	44.910	44.910			44.910
954302	Impedanciometria	17/09/2024		1,00	46.980	46.980			46.980

Observaciones

T238

Valores Finales

Sub Total	136.800
Descuento	0
Copago / Abono	
Cuota Moderadora	
Total Factura	**136.800**

SON: Ciento Treinta y Seis Mil, Ochocientos Pesos con 00/100 * * *

Impreso: 2024-07-29

Servicio Médico Asistencial - SENA **Regional: BOYACA**

ORDEN DE ATENCIÓN Nro.: 648

Adscrito:	820011 - SOCIEDAD CLINICA BOYACA LIMITADA
Dirección:	TRANSVERSAL 29 No. 9 C -41 (DUITAMA)
Teléfono(s):	7602579 - 7604756
Especialidad:	Clinicas - Clinicas

HC: 23852149

Favor atender por nuestra cuenta a ESPITIA RAMIREZ OTILIA identificado con el carne 4109781 -A Madre-Padre de RAMIREZ ESPITIA CRISANTO DE JESUS Funcionario del SENA.

DESCRIPCIÓN

Concepto	Cantidad	Valor	Total
Examenes Especiales Sin Hospitalizacion	3	0	0

OBSERVACIONES

SE AUTORIZA:

1-LOGOAUDIOMTERIA
2-IMPEDANCIOMETRIA
3-AUDIOMETRIA TONAL

VIGENCIA: ORDENES DE LABORATORIO 30 DIAS, MEDICAMENTOS 15 DIAS Y OTRAS AUTORIZACIONES 60 DIAS

Nota: VERIFICAR LA UTILIZACIÓN DE LA ORDEN SEGUN EL SERVICIO SOLICITADO

Luis Fernando Tenza Pumpin
MÉDICO GENERAL
R.M. 151709
M. NACIONAL

Médico/Odontólogo Asesor

Otilia Espitia

Recibido a Satisfacción C.C.

23852149

creada por: pmoreno

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 23.852.149
ESPITIA De RAMIREZ

APELLIDOS
OTILIA

NOMBRES

FIRMA



QUINDÍO

4109781 - A

Otilia
Espitia de Ramirez
C C 23852149
Rh O +



31/12/1924
Fecha de nacimiento:

SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL



FECHA DE NACIMIENTO 31-DIC-1924
SOTAQUIRA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.50 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
06-DIC-1960 PAIPA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0718100-00161326-F-0023852149-20090705 0013084887A 1 4980003300

SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL

RENOVACION
Fecha:31-03-2011
Vence:31-03-2012

Crisanto de Jesús Ramírez Espitia
Nombre del Funcionario o Pensionado

Este carné es de uso estrictamente personal y debe ser presentado con el documento de identidad del beneficiario para la prestación del servicio. Su utilización indebida acarreara al beneficiario las sanciones establecidas.

Firma Autorizada

Sociedad Clínica Boyacá Ltda.
Nit. 891.856.507-9
Transversal 29 No. 9c - 41 Tels. 7604757 Fax 7631386
Duitama - (Boyacá)

INFORME AUDIOLÓGICO

FECHA: 17/09/2024
NOMBRE: OTILIA ESPITIA DE RAMIREZ **DOCUMENTO:** CC 23852149
FECHA DE NACIMIENTO: 31/12/1924 **EDAD:** 99 AÑOS
REMITE: CLÍNICA BOYACÁ **EQUIPO:** INTERACOUSTICS AD629
ENTIDAD: SENA **TRANSDUCTOR:** DD 450

MOTIVO DE CONSULTA: HIPOACUSIA EN ESTUDIO
ANTECEDENTES: ALTERACIÓN CARDIACA, DIABETES, HTA

RESULTADOS Y OBSERVACIONES

OTOSCOPIA
OÍDO DERECHO: Normal **OÍDO IZQUIERDO:** Normal

IMPEDANCIOMETRÍA
OÍDO DERECHO: Timpanograma Tipo A sugestivo de función adecuada de oído medio
OÍDO IZQUIERDO: Timpanograma Tipo A sugestivo de función adecuada de oído medio

REFLEJOS ACUSTICOS
OÍDO DERECHO: Reflejos ipsilaterales y contralaterales ausentes de 500Hz a 4000Hz.
OÍDO IZQUIERDO: Reflejos ipsilaterales y contralaterales ausentes de 500Hz a 4000Hz.

AUDIOMETRÍA
PTA (500Hz-2000Hz) **OÍDO DERECHO:** 83dB **OÍDO IZQUIERDO:** 73dB
OÍDO DERECHO: Hipoacusia neurosensorial severa-profunda; sin respuesta a partir de 6000Hz.
OÍDO IZQUIERDO: Hipoacusia neurosensorial severa-profunda; sin respuesta a partir de 6000Hz.

LOGOAUDIOMETRÍA
OÍDO DERECHO: Logra el 40% de discriminación del habla a 90dB, acorde a promedio tonal.
OÍDO IZQUIERDO: Logra el 60% de discriminación del habla a 85dB, acorde a promedio tonal.

RECOMENDACIONES
- ✓ Valoración por otorrinolaringología
- ✓ Uso de ayuda auditiva



MARTHA LILIANA FAJARDO MONROY
Fonoaudióloga- Especialista en Audiología

Sociedad Clínica Boyacá Ltda.
Nit. 891.856.507-9
Transversal 29 No. 9c - 41 Tels. 7604757 Fax 7631386
Duitama - (Boyacá)


AUD 17/09/2024 10:27:05 a. m.
IMP 17/09/2024 10:27:05 a. m.


DOC: CC 23852149 **EDAD: 99 AÑO**

NOMBRE: OTILIA


APELLIDO: ESPITIA DE RAMIREZ

AUDIOMETRÍA TONAL

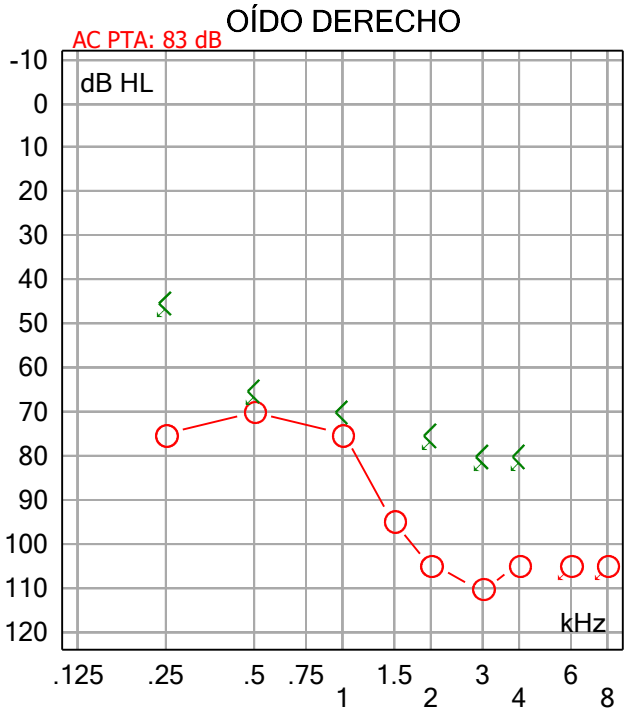

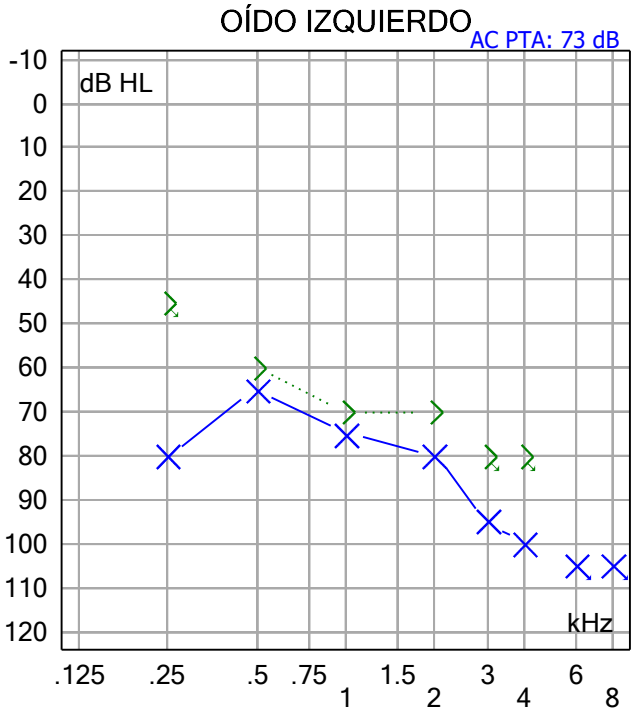

LOGOAUDIOMETRÍA

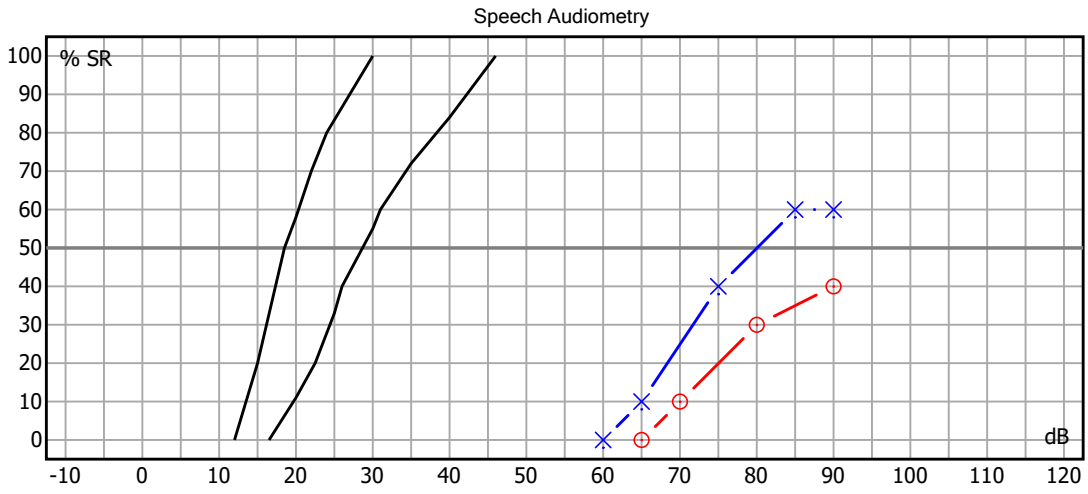

umbral de voz
umbral de palabra
máxima de discriminacion

OD


UV _____dB HL
UP _____dB HL
UDS ___ a___dB

OI

UV _____dB HL
UP _____dB HL
UDS ___ a___dB


226 Hz Timpanograma

Derecho

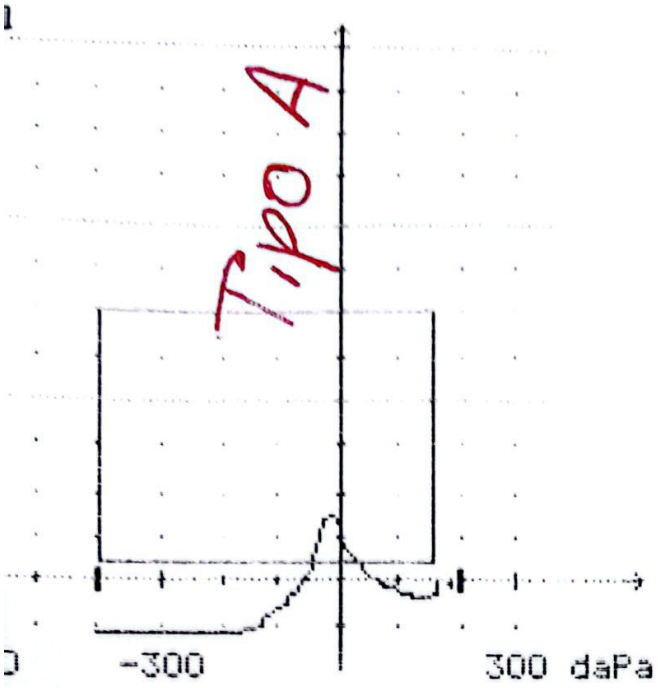

lumen	1.66 ml
mplimiento	0.37 ml
esion	-13 daPa
adient	40 daPa

Izquierdo

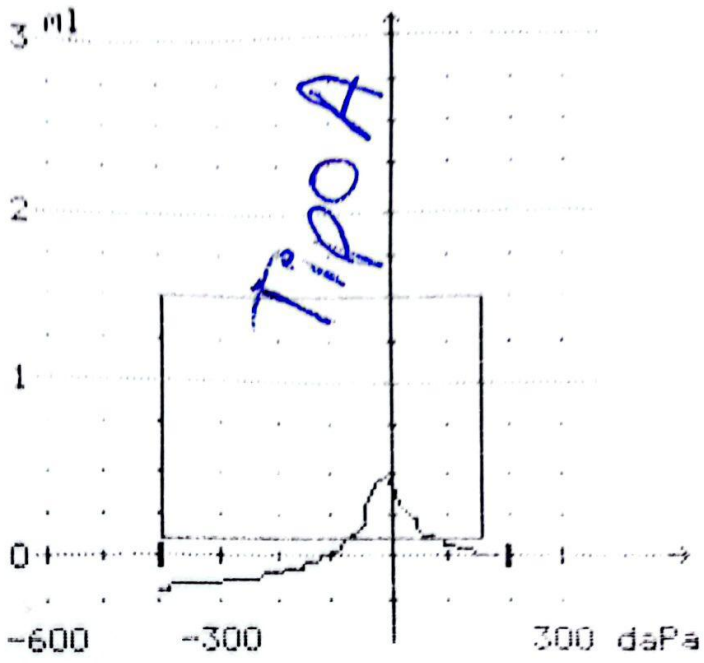

Volumen	0.92 ml
Cumplimiento	0.46 ml
Presion	-12 daPa
Gradient	73 daPa

Derecho

si	500Hz	100dB	PASO
si	1000Hz	105dB	FALL
si	2000Hz	105dB	FALL
si	4000Hz	100dB	FALL
ontra	500Hz	105dB	FALL
ontra	1000Hz	105dB	FALL
ontra	2000Hz	105dB	FALL
ontra	4000Hz	105dB	FALL

Izquierdo

Ipsi	500Hz	105dB	FALL
Ipsi	1000Hz	105dB	FALL
Ipsi	2000Hz	105dB	FALL
Ipsi	4000Hz	100dB	FALL
Contra	500Hz	105dB	FALL
Contra	1000Hz	105dB	FALL
Contra	2000Hz	105dB	FALL
Contra	4000Hz	105dB	FALL