

Subject: Re: BPMETRO - inconvenientes programación
From: "Ing. Carlos A. Lobo M." <calobo@inm.gov.co>
Date: 29/05/2020, 10:06 a. m.
To: Subdirector Física <subdirfísica@inm.gov.co>, Mauricio Sachica Avellaneda <msachica@inm.gov.co>
CC: Secretaria General <secgeneral@inm.gov.co>, Mesa de Servicio INM <mesadeayuda@inm.gov.co>, Jose Laureano Urrego <lurrego@inm.gov.co>, Ana María Reyes Sanclemente <amreyes@inm.gov.co>, Jose Eduin Culma Caviades <jeculma@inm.gov.co>, Calibraciones INM <calibraciones@inm.gov.co>, Leidy Lilliana Rios Martinez <llrios@inm.gov.co>, Ciro Alberto Sánchez Morales <csanchez@inm.gov.co>, Alexander Martínez López <amartinez@inm.gov.co>, Diana Marcela Forero Guerrero <dforero@inm.gov.co>, Nelson Duvan Vargas Sáenz <ndvargas@inm.gov.co>
References: <CADrNi2RHrMRf56Msh8+uUgOYjTthGJ31d0BjaWcLgTuZsJLw@mail.gmail.com>
<CADrNi2S4hWTeaU51cscbvFACbn=3fDpnJJLN7qclCnwcfXNciw@mail.gmail.com> <a5676c23-ead5-1f82-fb67-aaef75ca1bc2@inm.gov.co>
<CADrNi2RvycLPAiMq6g6PbP+viRybGe8knuyvMySuaoB6bSqGQ@mail.gmail.com> <be3f2abd-a61f-4334-7e9a-09eb614b3b23@inm.gov.co> <CADrNi2TnUSqvhz82v1-th=diUyCfuC3qLHupO07fOcoEXcnPZQ@mail.gmail.com> <2326fb72-d386-7bb6-ec9-d6b36e7f11a3@inm.gov.co>
<CADrNi2QiEYGeHi2bs7N=YMaacquPrsHM6dGW5N_AOj1Oaw86vtQ@mail.gmail.com> <91eec5f5-5049-3c4e-807b-3018f1cefc1d@inm.gov.co> <CADrNi2RrmCXjTu1a-NxfhP6UdSuJmGn3m0ERP5WXQfdtyWKvA@mail.gmail.com> <5adc0d31-bf42-dc2f-089b-f6a60f2e1451@inm.gov.co>
<CADrNi2SR64fYwRdO6=51jXyoiKGJih7RUUG_X5d86izVAG7EGw@mail.gmail.com> <CADrNi2SpXi_n4tEqkLMfKAVwpGOY=9IU+GP33xP4FGRxKj9AQ@mail.gmail.com>
<CADrNi2Rf-hqyCmE7L6zYgY3hqWbBF8U==otZHXOLC5=41ji1g@mail.gmail.com>
<CAGiUse+HvFRa=9xe+gQth4+qpQt+Ap5JW9pj0mmcig13gX0qig@mail.gmail.com>
X-Tagtoolbar-Keys: D20200529100654546
Message-ID: <56a4ec39-f005-7e67-f327-0f5e25c4d286@inm.gov.co>
Disposition-Notification-To: "Ing. Carlos A. Lobo M." <calobo@inm.gov.co>
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:68.0) Gecko/20100101 Thunderbird/68.8.1
MIME-Version: 1.0
In-Reply-To: <CAGiUse+HvFRa=9xe+gQth4+qpQt+Ap5JW9pj0mmcig13gX0qig@mail.gmail.com>
Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----7DD7C0789017FCD9B9E77ADE"
Content-Language: es-AR

Buenos días Ing. Álvaro Bermudez.

Por parte del soporte a la plataforma BPMetro, se han realizado los correspondientes seguimientos, y se evidencia que los registros en BD están correctos, pero en la salida del reporte, aparecen las fechas de manera incorrecta. Lo cual, se escaló con el proveedor, para que él mismo actualice los campos en el reporte, y pueda generar las programaciones de manera correcta, según mensaje con fecha 2020-05-28, 21:34:54 que se anexa al final.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordial saludo,

Ing. Carlos A. Lobo M.
Profesional Especializado
Sistemas de Información y Redes
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1414
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia



Antes de imprimir, piense si debe hacerlo, use papel reciclable.

¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilizemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.



On 29/05/2020 9:51 a. m., Subdirector Física wrote:

Saludos, agradezco su apoyo con el asunto, revisar si os inconvenientes ya fueron solventados o se debe reiniciar el proceso.

Atentamente,

Álvaro Bermúdez Coronel
Subdirector General
Subdirección de Metrología Física
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext.1611
www.inm.gov.co
Av. Cra. 50 No. 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá D.C., Colombia



Día Mundial de la Metrología 23 - 24 mayo 2019

¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilizemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

----- Forwarded Message -----

Subject:Re: Servicios programados radicados 20002151 y 20002152
To:Luis Felipe Ramirez Gonzalez <luisrg@digitalware.com.co>
References:<CAJrBzi3VQOdK1RLABnQ+jeWnnxSH4q41U9fK tqb3OSQJZJrYg@mail.gmail.com> <bb43c027-f512-5860-16e0-5f25ceb65d68@inm.gov.co> <CAAOXohD5Jj4hsk=-0-P_rz9gqZtvXqgQgVzcRW6jRpDmWf_QQ@mail.gmail.com>
Cc:Jose Laureano Urrego <lurrego@inm.gov.co>, Jose Eduin Culma Caviedes <jeculma@inm.gov.co>, Luis Enrique Amaya Rincon <leamaya@inm.gov.co>
From:Ing.Carlos A.Lobo M. <calobo@inm.gov.co>
X-Tagtoolbar-Keys:D20200528213453925
Message-ID:<e1f38fec-8477-26b3-201e-4a02155df2ef@inm.gov.co>
Disposition-Notification-To:"Ing.Carlos A.Lobo M." <calobo@inm.gov.co>
Date:Thu, 28 May 2020 21:34:54 -0500
User-Agent:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:68.0) Gecko/20100101 Thunderbird/68.8.1
MIME-Version:1.0
In-Reply-To:<CAAOXohD5Jj4hsk=-0-P_rz9gqZtvXqgQgVzcRW6jRpDmWf_QQ@mail.gmail.com>
Content-Type:multipart/alternative; boundary="-----66DC4AC27B2315F25EF8C531"
Content-Language:es-AR

Buenas noches Ing.Luis Felipe.

La información de las fechas para los respectivos radicados, se detallan a continuación.

1. Radicado 20002151

Servicios cotización radicado 20002151					
Equipo	Marca	Modelo	Número de serie	Código servicio	Cantid
Multimetro	Fluke	8508A	950155045	11455. Calibración medidores digitales-mayor a 5 dígitos-punto inicial - Servicio Interno	1
				11945. Calibración de medidores digitales mayor a 5 dígitos, punto adicional. Servicio Interno	313
Calibrador	Transmille	3041A	L1323114	11460. Calibración calibrador Patrón- punto inicial - Servicio Interno	1
				11461. Calibración calibrador Patrón- punto adicional - Servicio Interno	158

2. Radicado 20002152

Servicios cotización radicado 20002152					
Equipo	Marca	Modelo	Número de serie	Código servicio	Cantid
GRUPO DE REFERENCIAS DE TENSION	FLUKE	734A	6625011 Y OTROS 1	11099. Intercomparación de Referencias Corriente Continua servicio interno	1
				11098. Intercomparación de referencias corriente continua punto adicional servicio interno	1
GRUPO DE REFERENCIAS DE TENSION	FLUKE	734A	6625011 Y OTROS 2	11099. Intercomparación de Referencias Corriente Continua servicio interno	1
				11098. Intercomparación de referencias corriente continua punto adicional servicio interno	1
GRUPO DE REFERENCIAS DE TENSION	FLUKE	734A	6625011 Y OTROS 3	11099. Intercomparación de Referencias Corriente Continua servicio interno	1
				11098. Intercomparación de referencias corriente continua punto adicional servicio interno	1
GRUPO DE REFERENCIAS DE TENSION	FLUKE	734A	6625011 Y OTROS 4	11099. Intercomparación de Referencias Corriente Continua servicio interno	1
				11098. Intercomparación de referencias corriente continua punto adicional servicio interno	1
GRUPO DE REFERENCIAS DE TENSION	FLUKE	734A	6625011 Y OTROS 5	11099. Intercomparación de Referencias Corriente Continua servicio interno	1
				11098. Intercomparación de referencias corriente continua punto adicional servicio interno	1

GRUPO DE REFERENCIAS DE TENSION	FLUKE	734A	6625011 Y OTROS 6	11099. Intercomparación de Referencias Corriente Continua servicio interno	1
				11098. Intercomparación de referencias corriente continua punto adicional servicio interno	1
GRUPO DE REFERENCIAS DE TENSION	FLUKE	7004N	954455284 Y OTROS 1	11099. Intercomparación de Referencias Corriente Continua servicio interno	1
				11098. Intercomparación de referencias corriente continua punto adicional servicio interno	1
GRUPO DE REFERENCIAS DE TENSION	FLUKE	7004N	954455284 Y OTROS 2	11099. Intercomparación de Referencias Corriente Continua servicio interno	1
				11098. Intercomparación de referencias corriente continua punto adicional servicio interno	1
GRUPO DE REFERENCIAS DE TENSION	FLUKE	7004N	954455284 Y OTROS 3	11099. Intercomparación de Referencias Corriente Continua servicio interno	1
				11098. Intercomparación de referencias corriente continua punto adicional servicio interno	1
GRUPO DE REFERENCIAS DE TENSION	FLUKE	7004N	954455284 Y OTROS 4	11099. Intercomparación de Referencias Corriente Continua servicio interno	1
				11098. Intercomparación de referencias corriente continua punto adicional servicio interno	1
GRUPO DE REFERENCIAS DE TENSION	FLUKE	7004N	954455284 Y OTROS 5	11099. Intercomparación de Referencias Corriente Continua servicio interno	1
				11098. Intercomparación de referencias corriente continua punto adicional servicio interno	1
GRUPO DE REFERENCIAS DE TENSION	FLUKE	7004N	954455284 Y OTROS 6	11099. Intercomparación de Referencias Corriente Continua servicio interno	1
				11098. Intercomparación de referencias corriente continua punto adicional servicio interno	1
NANOVOLTIMETRO	AGILENT	34420A	MY42006002	11960. Calibración de Medidores de baja tensión < 100 mV, punto inicial. Servicio Interno	1
				11961. Calibración de Medidores de baja tensión < 100 mV, punto adicional. Servicio Interno	31
NANOVOLTIMETRO	AGILENT	34420A	MY42005971	11960. Calibración de Medidores de baja tensión < 100 mV, punto inicial. Servicio Interno	1
				11961. Calibración de Medidores de baja tensión < 100 mV, punto adicional. Servicio Interno	31

Agradezco se generen los archivos correspondientes de salida, con las fechas correctas.

Cordial saludo,

Ing. Carlos A. Lobo M.
Profesional Especializado
Sistemas de Información y Redes
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1414
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia




Antes de imprimir, piense si debe hacerlo, use papel reciclable.

¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilizemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

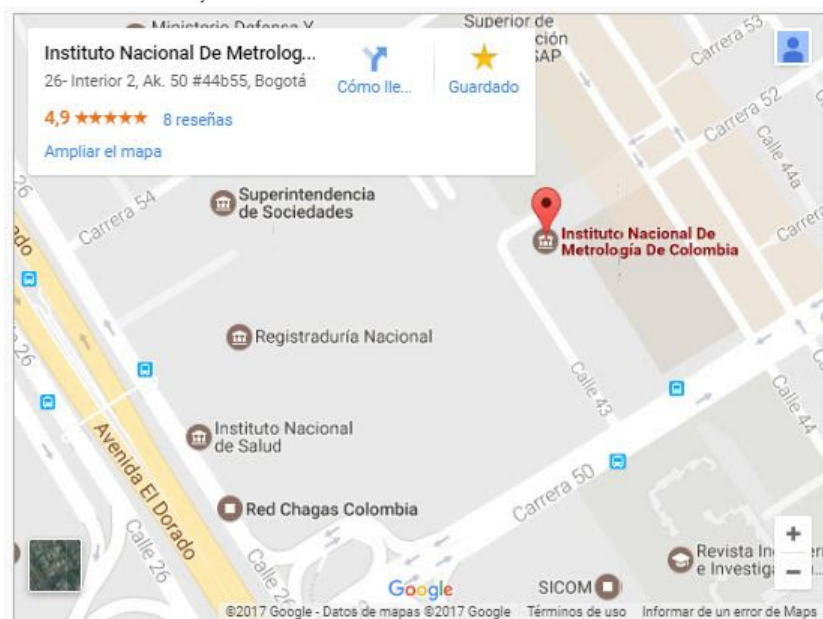

On 28/05/2020 10:44 a. m., Luis Felipe Ramirez Gonzalez wrote:

Buenos días Ing. Carlos,

Nos pueden regalar la definición de cómo debe quedar, ya que en este caso la interpretación del reporte de programación es que el equipo es el mismo y por eso la fecha en el formato es el mismo.

Pero si vemos el serial si presenta una diferencia, por ejemplo:

Equipo:

GRUPO DE REFERENCIAS DE TENSION

Seriales para el mismo equipo:

6625011 Y OTROS 1

6625011 Y OTROS 2

6625011 Y OTROS 3

6625011 Y OTROS 4

6625011 Y OTROS 5

6625011 Y OTROS 6

En conclusión sería que nos confirmen si el formato debe discriminar las fechas también por el campo de serial, quedamos atentos. Ya que revisando la traza este siempre ha funcionado de la misma forma

Saludos,



LUIS FELIPE RAMIREZ GONZALEZ
MANAGER CONSULTANT
DIGITAL WARE
Calle 72 # 12 - 65, piso 2.
Bogotá D. C. - Colombia
PBX: [\(571\) 3122601](tel:(571)3122601)
FAX: [\(571\) 3122620](tel:(571)3122620)
Luisrg@digitalware.com.co
www.digitalware.com.co

*Las tildes han sido omitidas para mejor lectura del mensaje.

Antes de imprimir este mensaje, por favor verifique si es necesario. Proteger el medio ambiente es asunto de todos.

Este correo y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la persona o entidad de destino.

El mié., 27 may. 2020 a las 10:55, Ing.Carlos A.Lobo M. (<calobo@inm.gov.co>) escribió:

Buenos días Ing. Luis Felipe.

FYI.

Ing. Carlos A. Lobo M.
Profesional Especializado
Sistemas de Información y Redes
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1414
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia




Instituto Nacional
de Metrología
de Colombia

Antes de imprimir, piense si debe hacerlo, use papel reciclable.

¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilizemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

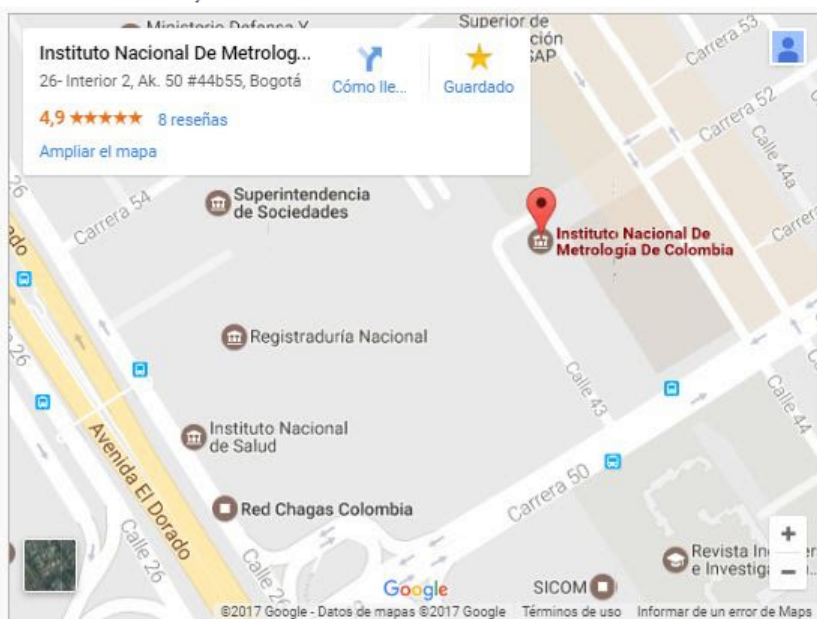

El mié., 27 may. 2020 a las 11:11, Mauricio Sachica Avellaneda (<msachica@inm.gov.co>) escribió:
Buenos días ingeniero Carlos Lobo,

De manera atenta solicito información sobre el estado de los radicados 20002151 y 20002152, dichos radicados llevan más de un mes en el proceso de solicitud, cotización y programación debido a los problemas con la plataforma BPMETRO y aún no han podido culminar este proceso exitosamente y por lo tanto no se han podido prestar los respectivos servicios de calibración y verificación que hacen parte del plan de trazabilidad y aseguramiento metrológico del laboratorio, el cual se ha visto afectado por estos inconvenientes.

Adjunto archivo PDF con el correo enviado por Luis Enrique Amaya el 20 de Mayo de 2020 indicando los problemas en la programación de los servicios del radicado 20002152. El laboratorio realizó la programación de los servicios del radicado 20002151 en la misma fecha, pero no ha llegado la confirmación de dicha programación y debido a que el sistema BPMETRO no nos permite conocer el estado de una tarea, ni las fechas finalmente programadas, después de que la tarea ya fue atendida por el laboratorio (lo cual me parece bastante desafortunado no poder realizar este seguimiento), entonces no sabemos en qué estado del proceso se encuentran.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a una respuesta oportuna ya que todos estos inconvenientes retrasan las actividades del laboratorio y por lo tanto del INM.

Atentamente,


Mauricio Sáchica Avellaneda
Profesional Especializado
Subdirección de Metrología Física
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1617
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia



¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilizemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

El lun., 18 may. 2020 a las 10:42, Mauricio Sachica Avellaneda (<msachica@inm.gov.co>) escribió:
Buenos día ingeniero Carlos Lobo,

Se tienen los radicados número 20002151 y 20002152 para realizar la respectiva programación de los servicios internos cotizados en el aplicativo BPMETRO, sin embargo cada una de estos radicados solo presenta los servicios para un único equipo. Esto es una falla, ya que el radicado 20002151 debería mostrar dos equipos cotizados para poder realizar su respectiva programación y el radicado 20002152 debería mostrar catorce equipos cotizados para la programación de sus servicios. Por otro parte aún no se pueden delegar las tareas del laboratorio de corriente continua y alterna (adjunto imagen). Quedo atento a una pronta solución ya que esto retrasa las actividades del laboratorio. Gracias.

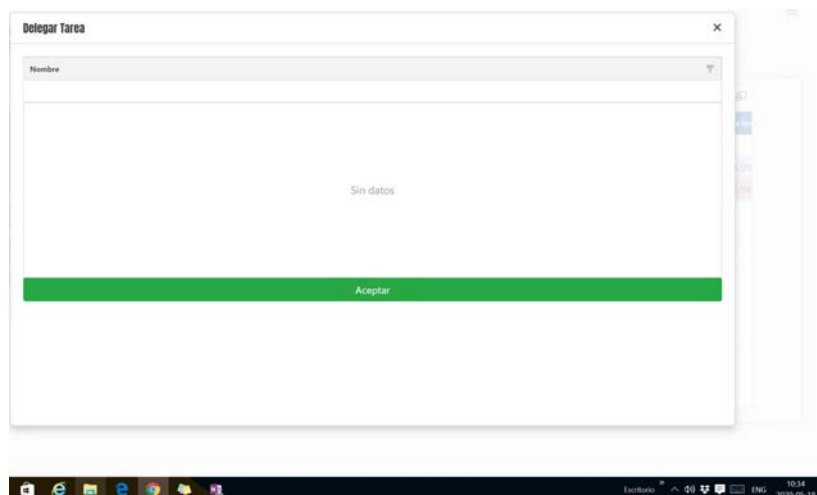

Atentamente,

Mauricio Sáchica Avellaneda
Profesional Especializado
Subdirección de Metrología Física
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1617
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia



¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilizemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

----- Forwarded Message -----

Delivered-To: calobo@inm.gov.co

Received: by 2002:a05:6e02:150:0:0:0 with SMTP id j16csp670183ilr; Wed, 20 May 2020 07:25:16 -0700 (PDT)

X-Received: by 2002:ae9:e854:: with SMTP id a81mr5090910qkg.396.1589984715988; Wed, 20 May 2020 07:25:15 -0700 (PDT)

ARC-Seal:i=1; a=rsa-sha256; t=1589984715; cv=none; d=google.com; s=arc-20160816; b=0x3HFiu7CtN8sX/sBLENCom2g6420yW
/f1rBVAf1fhwMhpzZt8aBxz6ZiGvHKIT0n hzbmrrQNrdrYrJkVOR42VD9MNYNCISpY5owyka41vRS25s0GPhYelr3oUY8U2ZWWa8u1
G+WGCAsI/mi7zungRgu1oK29KdMHEjQxZ42U6iL1q1cXbqvM8IHyHKWrd8AaM92Pb
D/DJAEo6GZGikRQecNlhdBNfne9UEufu3tfsKn9IEbdUqAaanW+11UYmAPrBzTyg
SomPUpOodloa8sdCjMks2k3d8CDyJ2YUEjL1TZkAZW/sjwE9euWHOGRLR1HA75A5Jx2WZ X+EA==

ARC-Message-Signature:i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20160816; h=cc:to:subject:message-id:date:from:in-reply-to:references :mime-version:dkim-
signature; bh=nO/s2pl58DXnF45+79fCudJkDlglDn/b7x+oG16m0Ug=; b=OgEBm6sMmSDEgiFeUI24L07Q9+Qmc9OQdF5AqTsVekvCmA0sVTo2scLt5Xf16D421
pGKDg1NQ8vfcL8c8sIRjMIC6Gowj8xVyp465mJhU+19DKnNlCt6HFBws64jW6hnM3
jTwBla2FUV4fdT7GidRkkuSB6Qzj0xvP8K3QniAlKJxchvHxvNhxu+FyQH/aW16VS 0J8NKBVUDOWMA/t6oHs6poR4OkwH54euserPjr+n95dKIQq
/F/Mrk9G2+MKuirlrkwo XJDDhVq/2XakMwqICyG764LU2YatH+hCMQd+7sjHQ+I5DDGgWr9hOXEOJ4sUIXO/oGf pTYA==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.google.com; dkim=pass header.i=@inm.gov.co.20150623.gappssmtp.com header.s=20150623 header.b=exBvyHlq; spf=pass (google.com: domain of
leamaya@inm.gov.co designates 209.85.220.41 as permitted sender) smtp.mailfrom=leamaya@inm.gov.co

Return-Path: <leamaya@inm.gov.co>

Received: from mail-sor-f41.google.com (mail-sor-f41.google.com. [209.85.220.41]) by mx.google.com with SMTPS id v189sor3403071qkc.0.2020.05.20.07.25.15 for
<calobo@inm.gov.co> (Google Transport Security); Wed, 20 May 2020 07:25:15 -0700 (PDT)

Received-SPF: pass (google.com: domain of leamaya@inm.gov.co designates 209.85.220.41 as permitted sender) client-ip=209.85.220.41;

Authentication-Results: mx.google.com; dkim=pass header.i=@inm.gov.co.20150623.gappssmtp.com header.s=20150623 header.b=exBvyHlq; spf=pass (google.com: domain of
leamaya@inm.gov.co designates 209.85.220.41 as permitted sender) smtp.mailfrom=leamaya@inm.gov.co

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=inm.gov.co.20150623.gappssmtp.com; s=20150623; h=mime-version:references:in-reply-to:from:date:message-
id:subject:to:cc; bh=nO/s2pl58DXnF45+79fCudJkDlglDn/b7x+oG16m0Ug=; b=exBvyHlq8EhcqW9mAoenvlvzCQp0Agk/2HbJ6kZxfu94+83AnYBN9SYOVIJVoFs
scT+IM/7dnnUoMy6lFOpXb9fXTBKpmEPmhzeYfBo4BKNLuiPzQtTbXPL0W2Yecd9D
fYsFCRFSqkwl43LajSjPzPmo0+uHaXkrxT9MHMDmTzV5wddHfm1qLG9inL19jLFLS5S
aMgpltb3yyEebCWA2v3BVNmGIKONEzp5n7aEvKT3pS4sRfN18XQvVAoc4L75VEUxU7OX
qCEBIBAWMuUwT0Czcr46eTVGV73R/smlm0zYmexgqwk6SwRx6ld54Suq4YH10BeXyJlsn uthw==

X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=1e100.net; s=20161025; h=x-gm-message-state:mime-version:references:in-reply-to:from:date :message-
id:subject:to:cc; bh=nO/s2pl58DXnF45+79fCudJkDlglDn/b7x+oG16m0Ug=; b=D1nZNDicRo9jUYqY58Wwc+yEndyxkTUNDSRBu4c+WDevBZbcAMhYjkh8Coj8Xt/d
f0Z2L+PX8UkIRxkf5a3o3rjuvGtrckFnSFx4d+1YMueUDi0K2xksJGRFRbcl7ZTriuh
PrBxX2/k+oUch4hUXpglh+dLSfXtdxgQqDK+j6f47MLi5ZdybJQVvR7W7d1G7zNRts Ujo/au1Jmo
/StRJSFrgJyO+HlvKd1iN44lesq1pmT8ZuIL9p4iuaobv4Wcc3p2rnFx OzJYVqYVUWgputFibq1cSlwOluEefB8p2/CF7IR4c2ix7ISKvN0bQx1bRJ9LbWWjguZ nxwA==

X-Gm-Message-State: AOAM531pM9t0UKzuMv556D67JeWmkDUHDQTX22fxQ+LWUMtTj8OwKQ
egDDaf50db0nNuGHHU1/Za6ij2bXwg6CUHosCqixxOZPkt5+BIUhPu91nfmLADOMtUs2RZSadR XICljoC3sISPP17G5Om7OA26fll0=

X-Google-Smtp-Source: ABdhPly64NEZSaeK9RNetTinZUSagDD/Eh8UAZOR9I1ZD0FwSHi6X72Km9UEcH4CeDxLA3JyQtWmoLuwBtMs+/s2o=

X-Received: by 2002:ac8:2aa6:: with SMTP id b35mr5226773qta.153.1589984713415; Wed, 20 May 2020 07:25:13 -0700 (PDT)

MIME-Version: 1.0

References: <CADrNi2QbfbknoarCtOiB28LOQP7aEnUEs6YWnHJZp3GG3XtycQ@mail.gmail.com>

In-Reply-To: <CADrNi2QbfbknoarCtOiB28LOQP7aEnUEs6YWnHJZp3GG3XtycQ@mail.gmail.com>

From: Luis Enrique Amaya Rincon <leamaya@inm.gov.co>

Date: Wed, 20 May 2020 09:25:01 -0500

Message-ID: <CAJrBz3VQOdK1RLABnQ+jeWnnxSH4q41U9fk_tqb3OSQJZrYg@mail.gmail.com>

Subject: Fwd: Servicios programados radicados 20002151 y 20002152

To: Ing. Carlos A Lobo M. <calobo@inm.gov.co>, Luis Felipe Ramirez Gonzalez <luisrg@digitalware.com.co>, Jose Laureano Urrego <lurrego@inm.gov.co>, Ana
María Reyes Sanclemente <coordinaciongs@inm.gov.co>

Cc: Mauricio Sachica Avellaneda <msachica@inm.gov.co>, Leidy Liliana Rios Martinez <llrios@inm.gov.co>

Content-Type: multipart/mixed; boundary="0000000000000b3fad05a6152a29"

Buen dia Carlos,

Le envio fechas del radicado 20002152 que se programaron para el laboratorio de corriente continua,
El laboratorio revisó fechas y programa, yo revise lo que hizo el lab contra este cuadro, la pase a Vo Bo de la jefe AnaMaria y al dar
Vo Bo las fechas se distorsionan o cambian.
Anexo la programación y cuadros de fechas emitidas por el laboratorio.

Cordialmente,

Luis Enrique Amaya Rincón
Técnico Operativo
Subdirección Innovación y Servicios Tecnológicos
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext.1418
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia



¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilizamos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

----- Forwarded message -----

De: **Mauricio Sachica Avellaneda** <msachica@inm.gov.co>
Date: mar., 19 may. 2020 a las 19:51
Subject: Servicios programados radicados 20002151 y 20002152

To: Luis Enrique Amaya Rincon <leamaya@inm.gov.co>

Cordial saludo Enrique,

Ya realicé la programación de los servicios internos en BPMETRO, correspondiente a los radicados 20002151 y 20002152. En los archivos adjuntos se encuentran las fechas programadas para cada servicio. Quedo atento a comentarios. Gracias.

Atentamente,

Mauricio Sáchica Avellaneda
Profesional Especializado
Subdirección de Metrología Física
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1617
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia



¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilizemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".



Libre de virus. www.avast.com

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.


CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

El vie., 8 may. 2020 a las 17:46, Mauricio Sachica Avellaneda (<msachica@inm.gov.co>) escribió:

Cordial saludo ingeniero Carlos Lobo,

Muchas gracias por la gestión, efectivamente ya los tiempos de ejecución se actualizaron y no aparecen en cero, respecto al problema para delegar, aún no se ven usuarios disponibles para delegar las tareas del laboratorio de corriente continua y alterna (adjunto imagen) y ahora hay otro inconveniente, las cotizaciones que realicé y aprobé cuando le llegan nuevamente a la oficina de recepción de equipos, no aparecen las modificaciones realizadas, es decir no actualizan, esto fue evidenciado con el funcionario Luis Enrique.

Por favor tener presente que todos estos inconvenientes están retrasando el proceso de cotización y respectiva programación de servicios del laboratorio de corriente continua y alterna, lo cual supone incumplimientos en nuestro plan de trazabilidad y aseguramiento metrológico. Pienso que el sistema debería haber sido validado antes de su puesta en servicio, además de ser un requisito de calidad. Se debería haber hecho una transición adecuada con el sistema anterior y de esta manera no realizar pruebas y resolver muchos inconvenientes sobre la marcha ya que esto genera traumatismos. Además veo que no hay un conocimiento adecuado del sistema. Agradezco la atención prestada y quedo atento a una pronta respuesta.

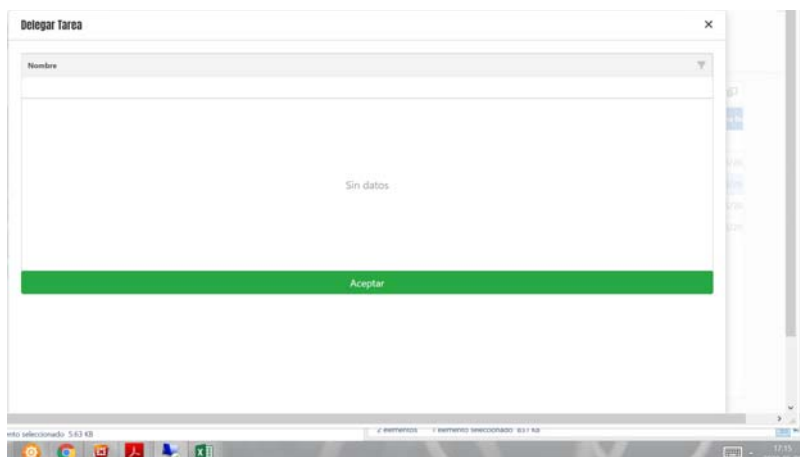

Atentamente,

Mauricio Sáchica Avellaneda
Profesional Especializado
Subdirección de Metrología Física
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1617
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia



¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilizamos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

El vie., 8 may. 2020 a las 9:28, Ing.Carlos A.Lobo M. (<calobo@inm.gov.co>) escribió:

Buenos días Ing. Mauricio Sáchica.

Te comunico que el día de hoy, Viernes 2020-05-08, 08:42 se cargaron los delegados del laboratorio de CC, según anexo.

Por otro lado, los puntos adicionales ya quedan correctos cuando finalice la cotización, ya que DW informó que a nivel de proceso, se ejecutan los calculos de manera correcta.

Quedo pendiente de confirmar si en su lista de usuarios le aparecen.

Gracias y éxitos.

Cordial saludo,


Ing. Carlos A. Lobo M.
 Profesional Especializado
 Sistemas de Información y Redes
 Instituto Nacional de Metrología de Colombia
 Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1414
 Página Web: www.inm.gov.co
 Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
 Bogotá, D.C., Colombia



¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilizemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

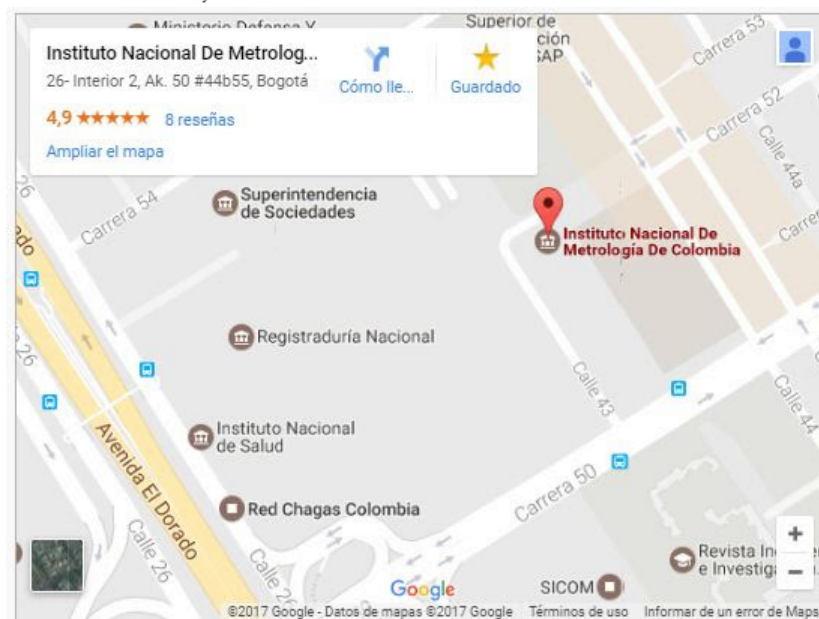

On 06/05/2020 8:21 a. m., Mauricio Sachica Avellaneda wrote:

Buenos días ingeniero Carlos Lobo,

De manera atenta solicito información sobre el estado de la revisión del aplicativo Ophelian BPM, ya que actualmente no se ven usuarios disponibles para delegar las tareas del laboratorio de corriente continua y alterna y sigue apareciendo el tiempo de ejecución en cero para los puntos adicionales de algunos servicios (los servicios cuyo tiempo es menor a una hora). Corresponde al radicado 20002151 (servicios para equipos internos) y radicado 20002212 (servicios solicitados por IDEAM).

Por otra parte quisiera saber si el tiempo de ejecución que debería aparecer en el sistema es el de un servicio o el tiempo total de acuerdo con la cantidad seleccionada. Actualmente, como se muestra en la siguiente imagen, el tiempo que muestra el sistema es el de un servicio (1 hora) y no el total para los 31 seleccionados. Esto corresponde a radicado 20002152. Deseamos saber si esto está bien, para proceder a aprobar la cotización y tener certeza que el sistema posteriormente realizará el cálculo del tiempo de ejecución total del servicio para el proceso de programación en el laboratorio.

*Servicios	*Tiempo de Ejecución	*Usuario Responsable	O...	*Cantidad	*Cotiza
Medidores de baja tensión < 100 mV punto inicial - servicio int...	16	msachica		1	0
Medidores de baja tensión < 100 mV punto adicional - servi...	1	msachica		31	0

Quedo atento a la ayuda e información que nos pueda brindar, ya que en este momento se encuentran varias cotizaciones represadas en el sistema, tanto de servicios intralaboratorio como de servicios solicitados por una empresa externa (IDEAM). Muchas gracias.

Atentamente,

Mauricio Sáchica Avellaneda

Profesional Especializado

Subdirección de Metrología Física

Instituto Nacional de Metrología de Colombia

Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1617

Página Web: www.inm.gov.co

Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN

Bogotá, D.C., Colombia



¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilizemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

El mié., 29 abr. 2020 a las 11:59, Ing.Carlos A.Lobo M. (<calobo@inm.gov.co>) escribió:

Buenas tardes estimado Ing.Sáchica.

Dos cosas.

Primero, por favor no vaya a enviar la solicitud que está trabajando hacia Luis Enrique, ya que, se están realizando los respectivos correctivos por parte del Proveedor que ya quedaron en el entorno de prueba, pero no han sido aplicados al entorno de producción.

Segundo, se preguntó como se registran los delegados. En reunión de la tarde, se tendrán los mismos en la plataforma.

Quedo pendiente a su respuesta.

Cordial saludo,

Ing. Carlos A. Lobo M.
Profesional Especializado
Sistemas de Información y Redes
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1414
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia




Antes de imprimir, piense si debe hacerlo, use papel reciclable.

¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilizemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

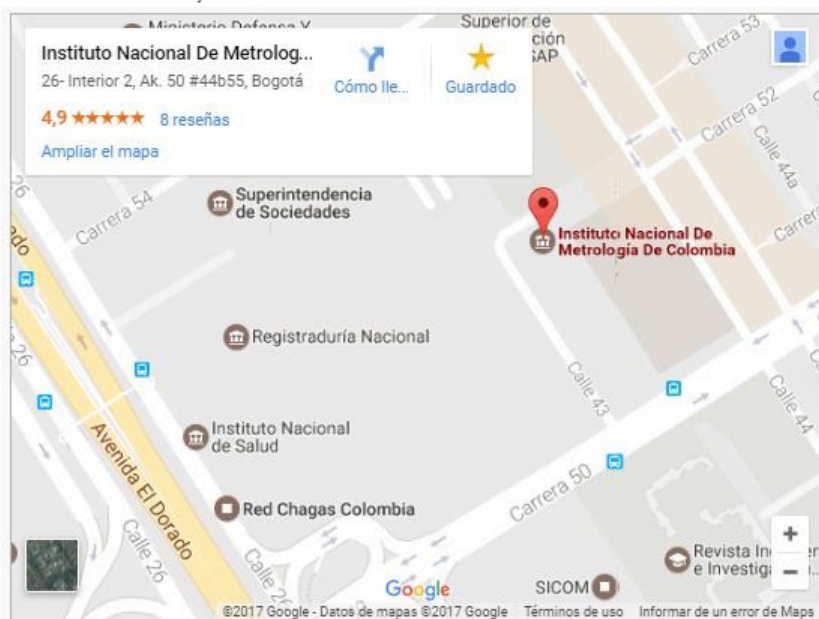

On 29/04/2020 10:38 a. m., Mauricio Sachica Avellaneda wrote:

Ingeniero Carlos Lobo,

A continuación la lista de las personas para delegar:

Alexander Martínez López - amartinez@inm.gov.co

Diana Marcela Forero Guerrero - dmforero@inm.gov.co

Nelson Duvar Vargás Sáenz - ndvargas@inm.gov.co

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

Mauricio Sáchica Avellaneda

Profesional Especializado

Subdirección de Metrología Física

Instituto Nacional de Metrología de Colombia

Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1617

Página Web: www.inm.gov.co

Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia



¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilizemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

El mié., 29 abr. 2020 a las 10:28, Ing.Carlos A.Lobo M. (<calobo@inm.gov.co>) escribió:

Buenos días apreciado Ing.Sáchica.

Por favor, me remite la lista de las personas para delegar?.

Gracias y quedo pendiente.

Cordial saludo,

Ing. Carlos A. Lobo M.
Profesional Especializado
Sistemas de Información y Redes
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1414
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia




Antes de imprimir, piense si debe hacerlo, use papel reciclable.

¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilizemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

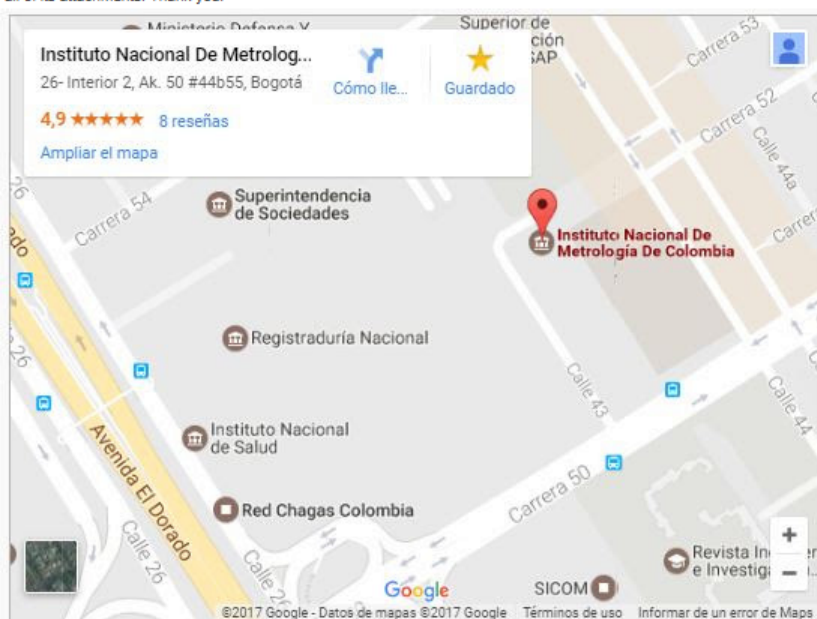

On 29/04/2020 10:24 a. m., Mauricio Sachica Avellaneda wrote:

El número de radicado corresponde al 20002151. Gracias.

Atentamente,

Mauricio Sáchica Avellaneda
Profesional Especializado
Subdirección de Metrología Física
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1617
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia



¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilizemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

El mié., 29 abr. 2020 a las 10:17, Ing.Carlos A.Lobo M. (<calobo@inm.gov.co>) escribió:

Buenos días estimado Ing.Sáchica.

Por favor, me remite el radicado en donde ocurrió la incidencia, especificada en punto 2?. Por favor, con copia a la mesa de ayuda (mesadeayuda@inm.gov.co), mientras se revisa la lista de delegados.

Cordial saludo,

Ing. Carlos A. Lobo M.
Profesional Especializado
Sistemas de Información y Redes
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1414
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia




Antes de imprimir, piense si debe hacerlo, use papel reciclable.

¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilizemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

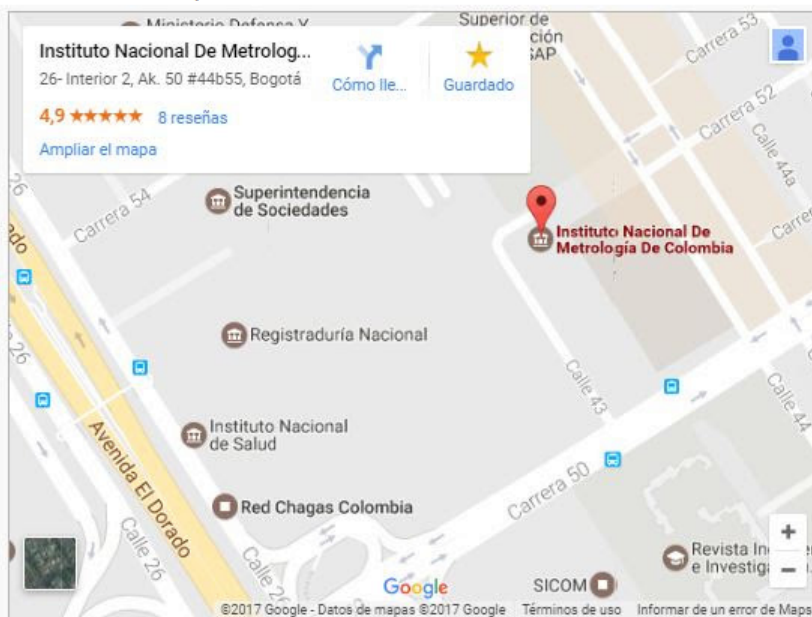


On 29/04/2020 9:34 a. m., Mauricio Sachica Avellaneda wrote:

Buenos días ingeniero Carlos Lobo,

Muchas gracias por la gestión del usuario. Estamos realizando la cotización de dos servicios de calibración internos, sin embargo se tienen las siguientes observaciones:

- Al realizar los pasos para delegar una cotización, la lista de usuarios está en blanco

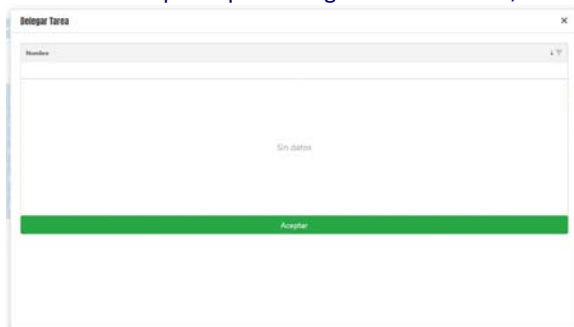

- Se está realizando la cotización de un calibrador y un multímetro y los respectivos servicios de puntos adicionales (código de servicio 11461 y 11456 respectivamente), aparecen con tiempo cero

	*Servicios	*Tiempo de Ejecución	*Usuario Responsable	Observaci
ID	Calibración calibrador Patrón- punto adicional - Servicio Interno	0	msachica	
ID	Calibración calibrador Patrón- punto inicial - Servicio Interno	22	msachica	

	*Tiempo de Ejecución	*Usuario Responsable	Observación	*Cantidad
	14	msachica		1
	0	msachica		313

Quedo atento a la ayuda e información que nos pueda brindar. Gracias

Atentamente,

Mauricio Sáchica Avellaneda
 Profesional Especializado
Subdirección de Metrología Física
 Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1617
Página Web: www.inm.gov.co
 Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia



¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilizemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

El mar., 28 abr. 2020 a las 17:44, Carlos A Lobo M. (<calobo@inm.gov.co>) escribió:

Buenas tardes apreciado Ing. Sáchica.

El día de ayer, se le dio la actualización del responsable al laboratorio de CC & CA, según se visualiza en figura 1.

Figura 1. Actualización del responsable Laboratorio CC & CA

Quedo pendiente de su respuesta.

Cordial saludo,

--

El 2020-04-24 a las 18:17, Mauricio Sachica Avellaneda escribió:

Buenas tardes ingeniero Carlos Lobo,

Muchas gracias por la respuesta e información brindada. Teniendo en cuenta lo anterior por favor cambiar la persona asignada de las cotizaciones del laboratorio de corriente continua y alterna y por lo tanto también encargada de delegar dichas solicitudes. Actualmente se encuentra asignado el físico Alexander Martínez López para dicha actividad, por favor cambiar para que yo, Mauricio Sáchica Avellaneda, este encargado de realizar dicha actividad. Gracias.

Atentamente,

Mauricio Sáchica Avellaneda
 Profesional Especializado
Subdirección de Metrología Física
 Instituto Nacional de Metrología de Colombia

Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1617

Página Web: www.inm.gov.co

Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN

Bogotá, D.C., Colombia



¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilizemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

El vie., 24 abr. 2020 a las 15:28, Ing.Carlos A.Lobo M. (<calobo@inm.gov.co>) escribió:

Buenas tardes apreciado Ing. Mauricio Sachica.

La solución propuesta es la de Delegación, según Ud lo resalta "...podría la persona asignada y responsable (a la cual le llegarán las cotizaciones) asignar otro funcionario desde el sistema para realizar la respectiva acción...". Para realizar esta delegación, debe realizar los siguientes pasos:

Paso 1. Selección de la tarea

Buscar la tarea a delegar, según figura 1.

Figura 1. Acceso a la bandeja de tareas

Se busca la tarea según figura 2.


Figura 2. Lista de tareas pendientes (Esto es un ejemplo, puede diferir en su caso)




Paso 2. Delegación

Teniendo la tarea activa, buscar el icono de delegación en la lista de iconos de las tareas, según se visualiza en figura 3.

Figura 3. Delegación de tareas





Seleccione el usuario, y luego seleccione la opción Aceptar resaltado en recuadro.

Paso 3. Confirmación

La tarea desaparece de su bandeja y aparece en la bandeja del delegado.

Por favor, realizar la operación y quedo pendiente a su confirmación.

Cordial saludo,

On 23/04/2020 3:04 p. m., Mauricio Sachica Avellaneda wrote:

Buenas tardes ingeniero Carlos Lobo,

Se realizó la solicitud para la calibración de algunos equipos internos del laboratorio de corriente continua y alterna, es decir para subir los equipos al sistema y de esta manera poderlos cotizar y programar, sin embargo de la oficina de recepción y entrega de equipos nos indican que el sistema únicamente permite una persona por laboratorio para cotizar los servicios (en este momento el responsable del laboratorio) y si se desea cambiar dicha persona toca enviarle un correo solicitando el cambio. El laboratorio de corriente continua y alterna tiene varias áreas las cuales son multifunción, resistencia DC, tensión DC y transferencia AC-DC y dependiendo el servicio a cotizar, programar e incluso prestar pueden intervenir diferentes funcionarios del laboratorio y no siempre el mismo. De acuerdo con lo anterior quisiera saber si es posible dejar varios funcionarios por laboratorio habilitados para cotizar y programar, o si esto no es posible, podría la persona asignada y responsable (a la cual le llegarán las cotizaciones) asignar otro funcionario desde el sistema para realizar la respectiva acción, similar a como funciona el sistema único de radicación de documentos SURDO o si definitivamente solo una persona por laboratorio es la que debe realizar todas las cotizaciones de los servicios asignados al laboratorio.

Quedo atento a una respuesta. Agradezco la ayuda e información que nos pueda brindar.

Atentamente,

Mauricio SÁCHICA Avellaneda
Profesional Especializado
Subdirección de Metrología Física
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1617 o s
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia



¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilizamos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".



Libre de virus. www.avast.com

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. **Gracias.**

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. **Gracias.**

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.