



Regional Distrito Capital
Centro de Diseño y Metrología

Grupo Administrativo Intercentros

CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA, CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL, CENTRO DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL, CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA

FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES

NOMBRE DE LA MÁQUINA, EQUIPO Y/O SERVICIO:

ITEM: 1 KIT PARA PRÓTESIS

Descripción General: KIT PARA PRÓTESIS MI MODULAR TRANSTIBIAL SUSPENSIÓN LINER CON PIN Y LANZADERA, TUBO Y ADAPTADOR EN ALUMINIO, PIÉ SACH.

Kit para prótesis modular para amputación transtibial suspensión por liner, pin de traba y lanzadera, componentes de tubo y adaptador en aluminio, Sach

Esquema: (plasmee una imagen genérica de la máquina, equipo y/o servicio, que no corresponda a una marca específica)



Especificaciones técnicas de la máquina, equipo y/o servicio:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERIZACIÓN
1	Tubo kit transtibial	Tubo en aluminio con adaptador hembra de 30mm para transtibial.
2	Adaptador de Tubo	Adaptador piramidal hembra para tubo de 30mm, transtibial
3	Lanzadera y pin de traba	Lanzadera, serie 0, ALUMINIO rosca exterior proximal de M36x1.5, rosca interior distal de M36x1.5. Soporte de peso hasta 100 Kg. Peso del elemento 191 Gr.


 <p>Regional Distrito Capital Centro de Diseño y Metrología</p>	<p align="center">Grupo Administrativo Intercentros</p> <p align="center">CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA, CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL, CENTRO DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL, CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA</p>
	<p>FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES</p>

4	Liner	Liner con conector distal. Espesor 3,6 (mm) / Longitud 410 mm aproximadamente. Uniforme y Cónico. Según talla.
3	Adaptador de Pie	Adaptador para pie, piramidal macho con rosca interna M10 en acero inoxidable.
4	Pie Sach	Material: Madera, plástico Peso Max. Soportado 100 Kg Tobillo sólido y talón suave.

Condiciones y soporte:

Garantías:	12 meses en pies k1-k2, 18 meses en pies k2-k3, 24 meses en pies k3-k4 , 12 meses en componentes metálicos, 6 meses en liners y cosmesis para pie.
Plazo de Entrega:	15 días hábiles luego de la confirmación de la compra.
Experiencia:	El proveedor debe relacionar y certificar la experiencia en representación y comercialización de equipos y dispositivos médicos cumpliendo requisitos de los entes regulatorios.

Otros:	
---------------	--

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre: Lina Marcela Florez	Nombre: Jairo Romero	Nombre: Cargo:
Firma: 	Firma: 	Firma:



Regional Distrito Capital
Centro de Diseño y Metrología

Grupo Administrativo Intercentros

CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA, CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL, CENTRO DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL, CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA

FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES

NOMBRE DE LA MÁQUINA, EQUIPO Y/O SERVICIO:

ITEM 2: KIT PARA PRÓTESIS

Descripción General: KIT PARA PRÓTESIS MI MODULAR DESARTICULADO DE RODILLA, RODILLA 4 EJES TUBO Y ADAPTADOR EN ALUMINIO, PIÉ SACH

Kit para prótesis para miembro inferior, modular, para nivel desarticulación de rodilla, suspensión anatómica, rodilla de 4 ejes, tubo y adaptador en aluminio, pie sach,

Esquema: (plasmee una imagen genérica de la máquina, equipo y/o servicio, que no corresponda a una marca específica)



Especificaciones técnicas de la máquina, equipo y/o servicio:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERIZACIÓN
1	Tubo para amputación Desarticulado de rodilla	Tubo en aluminio con adaptador hembra de 30mm para amputación desarticulado de rodilla.
2	Adaptador de Tubo	Adaptador piramidal hembra para tubo de 30mm, transfemoral.
3	Rodilla de 4 ejes	Rodilla protésica endoesquelética de 4 ejes para adulto.


 <p>Regional Distrito Capital Centro de Diseño y Metrología</p>	<p>Grupo Administrativo Intercentros</p> <p>CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA, CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL, CENTRO DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL, CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA</p>
	<p>FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES</p>

3	Adaptador de Pie	Adaptador para pie, piramidal macho con rosca interna M10 en acero inoxidable.
4	Pie Sach	Material: Madera, plástico Peso Max. Soportado 100 Kg Tobillo sólido y talón suave

Condiciones y soporte:

Garantías:	12 meses en pies k1-k2, 18 meses en pies k2-k3, 24 meses en pies k3-k4 , 12 meses en componentes metálicos, 6 meses en liners y cosmesis para pie.
Plazo de Entrega:	15 días hábiles luego de la confirmación de la compra.
Experiencia:	El proveedor debe relacionar y certificar la experiencia en representación y comercialización de equipos y dispositivos médicos cumpliendo requisitos de los entes regulatorios.

Otros:	
---------------	--

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre: Lina Marcela Florez	Nombre: Jairo Romero	Nombre: Cargo:
Firma: 	Firma: 	Firma:



Regional Distrito Capital
Centro de Diseño y Metrología

Grupo Administrativo Intercentros

CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA, CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL, CENTRO DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL, CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA

FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES

NOMBRE DE LA MÁQUINA, EQUIPO Y/O SERVICIO:

ITEM 3. KIT PARA PRÓTESIS

Descripción General: KIT PARA PRÓTESIS MI MODULAR TRANSFEMORAL (ADULTO O NIÑO) SUSPENSION POR VALVULA DE ROSCA, RODILLA 4 EJES EN ALUMINIO, TUBO Y ADAPTADOR EN ALUMINIO, PIÉ SACH

Kit para prótesis de miembro inferior, nivel amputación transmfemoral (adulto o niño) suspensión por válvula de rosca, rodilla protésica 4 ejes en aluminio, tubo y adaptador en aluminio, pié sach

Esquema: (plasme una imagen genérica de la máquina, equipo y/o servicio, que no corresponda a una marca específica)



Especificaciones técnicas de la máquina, equipo y/o servicio:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERIZACIÓN
1	Tubo para amputación transfemoral.	Tubo en aluminio con adaptador hembra de 30mm para transfemoral.
2	Adaptador de Tubo	Adaptador piramidal hembra para tubo de 30mm, transfemoral.
3	Rodilla 4 ejes en aluminio	Rodilla protésica endoesquelética de 4 ejes en aluminio.


 <p>Regional Distrito Capital Centro de Diseño y Metrología</p>	<p>Grupo Administrativo Intercentros</p> <p>CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA, CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL, CENTRO DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL, CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA</p>
	<p>FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES</p>

3	Adaptador de Pie	Adaptador para pie, piramidal macho con rosca interna M10 en acero inoxidable.
4	Pie Sach	Material: Madera, plástico Peso Max. Soportado 100 Kg Tobillo sólido y talón suave.

Condiciones y soporte:

Garantías:	12 meses en pies k1-k2, 18 meses en pies k2-k3, 24 meses en pies k3-k4 , 12 meses en componentes metálicos, 6 meses en liners y cosmesis para pie.
Plazo de Entrega:	15 días hábiles luego de la confirmación de la compra.
Experiencia:	El proveedor debe relacionar y certificar la experiencia en representación y comercialización de equipos y dispositivos médicos cumpliendo requisitos de los entes regulatorios.

Otros:	
---------------	--

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre: Lina Marcela Florez	Nombre: Jairo Romero	Nombre: Cargo:
Firma: 	Firma: 	Firma:

	Grupo Administrativo Intercentros CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA, CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL, CENTRO DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL, CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA
	FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES

NOMBRE DE LA MAQUINA, EQUIPO Y/O SERVICIO:

ITEM 4. KIT PARA PRÓTESIS

Descripción General: KIT PARA PRÓTESIS MI MODULAR TRANSFEMORAL SUSPENSION POR VÁLVULA DE ROSCA, RODILLA 4 EJES EN ALUMINIO, TUBO Y ADAPTADORES EN ALUMINIO, PIÉ BAJO RETORNO DE ENERGÍA

Kit para prótesis miembro inferior, nivel de amputación transfemoral, modular suspensión por válvula de rosca, rodilla 4 ejes en aluminio, tubo y adaptadores en aluminio, pie en fibra de carbono de bajo retorno de energía

Esquema: (plasmee una imagen genérica de la máquina, equipo y/o servicio, que no corresponda a una marca específica)



Especificaciones técnicas de la máquina, equipo y/o servicio:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERIZACIÓN
1	Tubo para amputación transfemoral.	Tubo en aluminio con adaptador hembra de 30mm para transfemoral.
2	Adaptador de Tubo	Adaptador piramidal hembra para tubo de 30mm, transfemoral.
3	Rodilla 4 ejes en aluminio	Rodilla protésica endoesquelética de 4 ejes en aluminio.


 <p>Regional Distrito Capital Centro de Diseño y Metrología</p>	<p>Grupo Administrativo Intercentros</p> <p>CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA, CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL, CENTRO DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL, CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA</p>
	<p>FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES</p>

3	Adaptador de Pie	Adaptador para pie, piramidal macho con rosca interna M10 en acero inoxidable.
4	Pie bajo retorno de energía	Pie protésico, en fibra de carbono, de bajo retorno de energía, lateralidad derecha o izquierda y disponibilidad de talla según caracterización.

Condiciones y soporte:

Garantías:	12 meses en pies k1-k2, 18 meses en pies k2-k3, 24 meses en pies k3-k4 , 12 meses en componentes metálicos, 6 meses en liners y cosmesis para pie.
Plazo de Entrega:	15 días hábiles luego de la confirmación de la compra.
Experiencia:	El proveedor debe relacionar y certificar la experiencia en representación y comercialización de equipos y dispositivos médicos cumpliendo requisitos de los entes regulatorios.

Otros:	
---------------	--

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre: Lina Marcela Florez	Nombre: Jairo Romero	Nombre: Cargo:
Firma: 	Firma: 	Firma:

	Grupo Administrativo Intercentros CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA, CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL, CENTRO DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL, CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA
	FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES

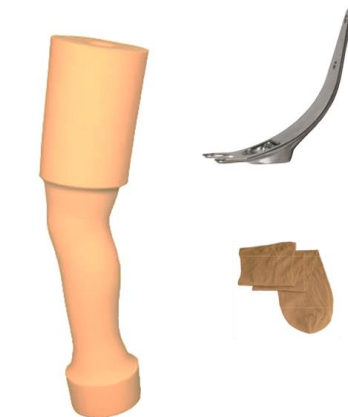
NOMBRE DE LA MAQUINA, EQUIPO Y/O SERVICIO:

ITEM 5. KIT PARA PRÓTESIS

Descripción General: KIT PARA CAMBIO DE SOCKET DESARTICULADO DE RODILLA, Y ADAPTADOR.

Kit para cambio de socket de amputación desarticulado de rodilla, con adaptador, espuma y media cosmética.
--

Esquema: (plasmee una imagen genérica de la máquina, equipo y/o servicio, que no corresponda a una marca específica)




Especificaciones técnicas de la máquina, equipo y/o servicio:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERIZACIÓN
1	Adaptador	Adaptador para cambio de socket para prótesis de desarticulado de rodilla.
2	Espuma y media cosmética	Espuma cosmética para prótesis desarticulado de rodilla con orificio interno para el tubo, media cosmética para prótesis desarticulado de rodilla.

Condiciones y soporte:

 Regional Distrito Capital Centro de Diseño y Metrología	Grupo Administrativo Intercentros CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA, CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL, CENTRO DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL, CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA
	FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES
Garantías:	12 meses en pies k1-k2, 18 meses en pies k2-k3, 24 meses en pies k3-k4 , 12 meses en componentes metálicos, 6 meses en liners y cosmesis para pie.
Plazo de Entrega:	15 días hábiles luego de la confirmación de la compra.
Experiencia:	El proveedor debe relacionar y certificar la experiencia en representación y comercialización de equipos y dispositivos médicos cumpliendo requisitos de los entes regulatorios.

Otros:	
---------------	--

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre: Lina Marcela Florez	Nombre: Jairo Romero	Nombre: Cargo:
Firma: 	Firma: 	Firma:

 <p>Regional Distrito Capital Centro de Diseño y Metrología</p>	<p>Grupo Administrativo Intercentros</p> <p>CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA, CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL, CENTRO DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL, CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA</p>
	<p>FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES</p>

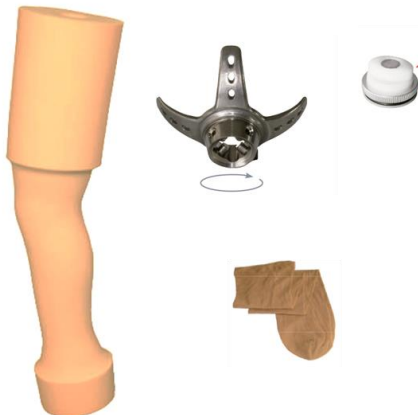
NOMBRE DE LA MAQUINA, EQUIPO Y/O SERVICIO:

<p>ITEM 6. KIT PARA PRÓTESIS</p>

Descripción General: KIT PARA CAMBIO DE SOCKET TRANSFEMORAL CON VÁLVULA DE ROSCA Y ADAPTADOR DE SOCKET TIPO ARAÑA

<p>Kit para cambio de socket de nivel transfemoral con válvula de rosca y adaptador de socket tipo araña.</p>

Esquema: (plasmee una imagen genérica de la máquina, equipo y/o servicio, que no corresponda a una marca específica)




Especificaciones técnicas de la máquina, equipo y/o servicio:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERIZACIÓN
1	Adaptador	Adaptador para cambio de socket para prótesis de desarticulado de rodilla.
2	Válvula de Rosca	Válvula con rosca y autoexpulsión para transfemoral.
3	Espuma y media cosmética	Espuma cosmética para prótesis transfemoral con orificio interno para el tubo, media cosmética para prótesis transfemoral.

Condiciones y soporte:

 Regional Distrito Capital Centro de Diseño y Metrología	Grupo Administrativo Intercentros CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA, CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL, CENTRO DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL, CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA
	FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES
Garantías:	12 meses en pies k1-k2, 18 meses en pies k2-k3, 24 meses en pies k3-k4 , 12 meses en componentes metálicos, 6 meses en liners y cosmesis para pie.
Plazo de Entrega:	15 días hábiles luego de la confirmación de la compra.
Experiencia:	El proveedor debe relacionar y certificar la experiencia en representación y comercialización de equipos y dispositivos médicos cumpliendo requisitos de los entes regulatorios.

Otros:	
---------------	--

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre: Lina Marcela Florez	Nombre: Jairo Romero	Nombre: Cargo:
Firma: 	Firma: 	Firma:

	Grupo Administrativo Intercentros CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA, CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL, CENTRO DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL, CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA
	FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES

NOMBRE DE LA MAQUINA, EQUIPO Y/O SERVICIO:

ITEM 7. BOLSA DE COLOCACIÓN PRÓTESIS

Descripción General: BOLSA DE COLOCACIÓN PROTESIS

Bolsa de Colocación prótesis

Esquema: (plasmee una imagen genérica de la máquina, equipo y/o servicio, que no corresponda a una marca específica)



Especificaciones técnicas de la máquina, equipo y/o servicio:


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERIZACIÓN
1	Bolsa de Colocación de prótesis	<p>Bolsa de postura rápida que facilita la colocación de la prótesis, gracias a la superficie deslizante del material del medio auxiliar la colocación de una prótesis transfemoral y de miembro superior con encaje de succión es más fácil para el paciente. Material: Tejido 100% poliamida (PA) Recubrimiento 100% poliuretano (PUR).</p> <p>Disponible en tallas.</p>

Condiciones y soporte:

Garantías:	30 días.
Plazo de Entrega:	15 días hábiles luego de la confirmación de la compra.
Experiencia:	El proveedor debe relacionar y certificar la experiencia en representación y comercialización de equipos y dispositivos médicos cumpliendo requisitos de los entes regulatorios.

 <p>Regional Distrito Capital Centro de Diseño y Metrología</p>	<p>Grupo Administrativo Intercentros</p> <p>CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA, CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL, CENTRO DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL, CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA</p>
	<p>FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES</p>

Otros:	
---------------	--

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre: Lina Marcela Florez	Nombre: Jairo Romero	Nombre: Cargo:
Firma: 	Firma: 	Firma:

	Grupo Administrativo Intercentros CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA, CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL, CENTRO DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL, CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA
	FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES

NOMBRE DE LA MÁQUINA, EQUIPO Y/O SERVICIO:

ITEM 12. BOLSA DE COLOCACIÓN PRÓTESIS

Descripción General: BOLSA DE COLOCACIÓN PROTESIS

Bolsa de Colocación prótesis

Esquema: (plasmee una imagen genérica de la máquina, equipo y/o servicio, que no corresponda a una marca específica)



Especificaciones técnicas de la máquina, equipo y/o servicio:


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERIZACIÓN
1	Bolsa de Colocación de prótesis	Bolsa de postura rápida que facilita la colocación de la prótesis, gracias a la superficie deslizante del material del medio auxiliar la colocación de una prótesis transfemoral y de miembro superior con encaje de succión es más fácil para el paciente. Material: Tejido 100% poliamida (PA) Recubrimiento 100% poliuretano (PUR). Disponible en tallas.

Condiciones y soporte:

Garantías:	30 días.
Plazo de Entrega:	15 días hábiles luego de la confirmación de la compra.
Experiencia:	El proveedor debe relacionar y certificar la experiencia en representación y comercialización de equipos y dispositivos médicos cumpliendo requisitos de los entes regulatorios.

 <p>Regional Distrito Capital Centro de Diseño y Metrología</p>	<p>Grupo Administrativo Intercentros</p> <p>CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA, CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL, CENTRO DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL, CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA</p>
	<p>FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES</p>

Otros:	
---------------	--

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre: Lina Marcela Florez	Nombre: Jairo Romero	Nombre: Cargo:
Firma: 	Firma: 	Firma:

Regional Distrito Capital Centro de Diseño y Metrología	Grupo Administrativo Intercentros CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA, CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL, CENTRO DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL, CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA
	FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES