HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.			
Proceso	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA	**Código**	GTE-FOR-001-V03
Subproceso	Tecnología Biomédica	**Fecha Elaboración**	26/01/16
Nombre del documento	HOJA DE VIDA EQUIPO BIOMÉDICO	**Última actualización**	11/02/19
		Vigencia hasta	10/02/22
Responsable: Ing. Biomédico	**Revisado:** Comité de Calidad	**Aprobado:** Gerencia	

HOJA DE VIDA EQUIPO BIOMÉDICO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 2	CÓDIGO DEL PRESTADOR (REPS)	7334900926	SEDE	01



DATOS BÁSICOS	
NOMBRE	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION
MARCA	LOS PINOS
MODELO	C374
SERIE	708672
CLASIFICACIÓN POR RIESGO	I
INVIMA /PERMISO COMERCIALIZACIÓN	2023DM-0027454

ACCESORIOS	

DATOS DE UBICACIÓN					
SERVICIO	PEDIATRIA	UBICACIÓN	PEDIATRIA	NRO INVENTARIO	

DATOS DE PROPIEDAD			
FORMA DE ADQUISICIÓN	COMPRA	FABRICANTE	LOS PINOS
FECHA DE COMPRA	2/12/24	E-MAIL FABRICANTE	NO REGISTRA
FECHA DE INSTALACIÓN	3/12/24	PROVEEDOR	EQUIMEDICAS
VENCIMIENTO GARANTÍA	2/12/25	TELÉFONO PROVEEDOR	2612358
COSTO ADQUISICIÓN	$ 13.800.000	VIDA ÚTIL	NO REGISTRA

REGISTRO TÉCNICO					
VOLTAJE	N/A	PRESIÓN		N/A	
CORRIENTE	N/A	VELOCIDAD		N/A	
POTENCIA	N/A	CAPACIDAD		230KG	
FRECUENCIA	N/A	PESO		NO REGISTRA	
TEMPERATURA	N/A	BATERÍA		N/A	
HUMEDAD	N/A	MÓVIL		FIJO	X

CLASIFICACIÓN			
BIOMÉDICA		**DE USO**	
DIAGNÓSTICO		MÉDICO	
TTO. DE LA VIDA		BÁSICO	
REHABILITACIÓN	X	APOYO	X
PREVENCIÓN		OTRO	
ANÁLISIS LAB		CUÁL:	

FUENTES DE ALIMENTACIÓN			
ELECTRICIDAD		ENERGÍA SOLAR	
AGUA		DERIV PETRÓLEO	
AIRE		ACEITE	
GAS		MECÁNICA	
VAPOR		OTRA:	

MANUALES			
OPERACIÓN			
SERVICIO			
PLANO			
FÍSICO		DIGITAL	X
LUGAR:			

TECNOLOGÍA PREDOMINANTE			
ELÉCTRICO		NEUMÁTICO	
ELECTRÓNICO		VAPOR	
MECÁNICO	X	SOLAR	
HIDRAÚLICO		ÓPTICO	
OTRO:			

PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO		
CUATRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL
x		

PERIODICIDAD DE CALIBRACIÓN		
NO REQUIERE	ANUAL	BIANUAL
X		

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE	

EQUIMEDICAS
NIT 93406518-5 IVA REGIMEN COMUN

Importación y venta de equipos Biomédicos
Venta de Material Medico Quirúrgico e Insumos
Hospitalarios, Mantenimiento Hospitalario

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION	MARCA	LOS PINOS
MODELO	C374	REG.SANITARIO/ PERMISO COMERCIALIZACION	2023DM-0027454
SERIE	708672		

CANT	ACCESORIOS	MARCA	MODELO	SERIE

REGISTRO FOTOGRAFICO



USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		CLASIFICACION RIESGO SEGÚN 4725 DE 2005		TIPO DE TECNOLOGIA			
		DIAGNOSTICO							
MEDICO		TRATAMIENTO Y MTTO DE LA VIDA		I	X	ELECTRICO		HIDRAULICO	
BASICO		PREVENCION		IIA		ELECTRONICO		NEUMATICO	
APOYO	X	REHABILITACION	X	IIB		MECANICO	X	VAPOR	
OTRO		ANALISIS DE LABORATORIO		III		ELECTROMECANICO		SOLAR	

PROVEEDOR	EQUIMEDICAS	TEL.	2612358	CORREO	Equimedicas1@yahoo.com
FABRICANTE	LOS PINOS S.A	TEL.	N/A	PAIS	COLOMBIA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS				OTROS SUMINISTROS	
VOLTAJE AC	N/A	PRESION	N/A	GRASA	
VOLTAJE DC	N/A	VELOCIDAD	N/A	AGUA	
CORRIENTE ELÉCTRICA	N/A	VACIO	N/A	AIRE	
POTENCIA	N/A	PESO DEL EQUIPO	N/R	VAPOR	
FRECUENCIA	N/A	CAPACIDAD DE CARGA	230 Kg	REFRIGERANTE	
CONDICIONES AMBIENTALES		DIMENSIONES	208 X 78 X 82 cm	GAS	
PRESIÓN	N/R	FLUJO	N/R	ENERGIA	
TEMPERATURA	N/R	AÑOS DE VIDA UTIL DEFINIDOS POR EL FABRICANTE		ACEITE	
HUMEDAD RELATIVA	N/R	N/R		OTROS	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN EL AÑO												REQUIERE CALIBRACIÓN		NUMERO DE CALIBRACIONES EN EL AÑO											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SI	NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2023037613 de 16 de Agosto de 2023
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, Ley 1437 de 2011 y la Resolución No. 2023030257 del 7 de julio de 2023.

CONSIDERANDO

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMATICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.

EN CONSECUENCIA, A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARA EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - Conceder REGISTRO SANITARIO por el término de DIEZ (10) años a

PRODUCTO:	CAMAS HOSPITALARIAS, CAMILLAS HOSPITALARIAS, SILLAS MULTIPROPÓSIT
MARCA:	LOS PINOS
REGISTRO SANITARIO No.:	INVIMA 2023DM-0027454
TIPO DE REGISTRO:	FABRICAR Y VENDER
TITULAR(ES):	JOSE FERNANDO DUQUE CORREA con domicilio en ITAGUI - ANTIOQUIA
FABRICANTE(S):	INDUSTRIAS METÁLICAS LOS PINOS S.A. con domicilio en ITAGUI - ANTIOQUIA
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO:	NO INVASIVO I
SISTEMAS:	MECÁNICO, HIDRAÚLICO, ELÉCTRICO, NEUMÁTICO
SUBSISTEMAS:	

PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO	COMPOSICIÓN CUALITATIVA
Estructura Base - Estructura Marco - Estructura cuatro planos	Estructura en acero al carbono y con acabado en pintura epóxica con aplicación electrostática
Superficie un plano, dos planos, tres planos y cuatro planos (sección espalda - sección fijo - sección móvil - sección pies)	Superficie en plástico de alta resistencia (polietileno de alta densidad)
Barandas de Seguridad laterales independientes y/o descanza brazos	Plástico resistente a impacto (polietileno de alta densidad)
Tablero Espalda - Tablero Pies	Plástico resistente a impacto (polietileno de alta densidad)
Rueda Bomper	Componente de Naylon

RESOLUCIÓN No. 2023037613 de 16 de Agosto de 2023
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, Ley 1437 de 2011 y la Resolución No. 2023030257 del 7 de julio de 2023.

Rueda para bloqueo individual y Bloqueo Central	Rueda giratoria de 5" (12,5 cm) de diámetro antiestáticas, con posición freno central, nuetral y direccional, con cubierta plástica que evita la oxidación y la acumulación de residuos y suciedad
Control Mano - Control Baranda	Controles: Fabricación en PCB ensamblado con elementos electrónicos de uso común como resistencia, diodos, leds, acelerómetros, etc.
Accionadores Mecánicos	Estructura en acero al carbono, con acabado en pintura epóxica con aplicación electrostática y/o acabado cromado

USOS: USO EN CUIDADOS EN CASA, CON SUPERVISIÓN CONSTANTE DE PERSONAL CAPACITADO. USO HOSPITALARIO EN ENTORNOS DE APLICACIÓN 1,2,3 Y 5 (CUIDADOS DE LARGO PLAZO EN UN ÁREA CON SUPERVISIÓN MÉDICA), CUIDADOS AGUDOS (CUIDADOS POSQUIRÚRGICOS, PEDIÁTRICOS, GERIÁTRICOS, PSIQUIATRICOS, AMBULATORIOS, ENTRE OTROS QUE REQUIERAN PERMANECER EN UN ESTABLECIMIENTO MÉDICO CON SUPERVISIÓN CONSTANTE DE PERSONAL CAPACITADO) O UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (QUE REQUIEREN DE SUPERVISIÓN PERMANENTE DE PERSONAL MÉDICO), BUSCA COMPLEMNTAR LOS SERVICIOS MÉDICOS CON UN SISTEMA CÓMODO Y VERSÁTIL PARA LA RECUPERACIÓN DEL PACIENTE EN CUALQUIER LUGAR QUE REQUIERA DE UNA CAMA, CAMILLA O SILLA.

PRESENTACIÓN COMERCIAL: CAMAS, CAMILLAS Y SILLAS DE ACCIONAMIENTO MECÁNICO, HIDRAÚLICO, ELÉCTRICO, NEUMÁTICO, ELECTROHIDRÁULICO, ACCIONADAS MANUAL Y/O CON CONTROL REMOTO ALÁMBRICOS O INCRUSTRADOS

OBSERVACIONES: EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS DEL EQUIPO PARA LAS REFERENCIAS:

Familia (si aplica)	Código, Modelo o Referencia (si aplica)
HOME CARE	HOME CARE
	440
CAMAS HOSPITALARIAS	B-216
	B-218
	B-218P

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 742 2121 - Bogotá

www.invima.gov.co
@Invimacolombia

RESOLUCIÓN No. 2023037613 de 16 de Agosto de 2023
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, Ley 1437 de 2011 y la Resolución No. 2023030257 del 7 de julio de 2023.

	700L
	740
	740P
	760
	800L
	840
	860
	972OB
	980
	1040
	1040P
	1060
CAMILLAS	C-368
	C-369
	C-370
	C-371
	C-374
	C-375

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 742 2121 - Bogotá

www.invima.gov.co
@Invimacolombia

RESOLUCIÓN No. 2023037613 de 16 de Agosto de 2023
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora (E) Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, Ley 1437 de 2011 y la Resolución No. 2023030257 del 7 de julio de 2023.

	C-376
	C-379
	C-385
SILLAS MULTIPROPÓSITO	SMM 251
	SMM 200
	SMM 253

EXPEDIENTE No.: 20260183
RADICACIÓN No.: 20231205286
FECHA DE RADICACIÓN: 02/08/2023

ARTICULO SEGUNDO. - CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

ARTICULO TERCERO. - LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

ARTICULO CUARTO. - LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 2005.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 16 de Agosto de 2023
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

MABEL CONSTANZA BARBOSA ROMERO
DIRECTORA (E) TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: , Técnico: nnoguerab

Signature Not Verified
Firmado digitalmente por MABEL CONSTANZA BARBOSA ROMERO
Fecha: 2023/08/17 17:09:24 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia


Guía Rápida de Uso


Camilla CS4 (C374)

Camilla de Operación Manual

los pinos
Mejora tu Vida

Para garantizar la vida útil y el buen estado de los productos marca **LOS PINOS®** es necesario seguir las siguientes instrucciones de uso.

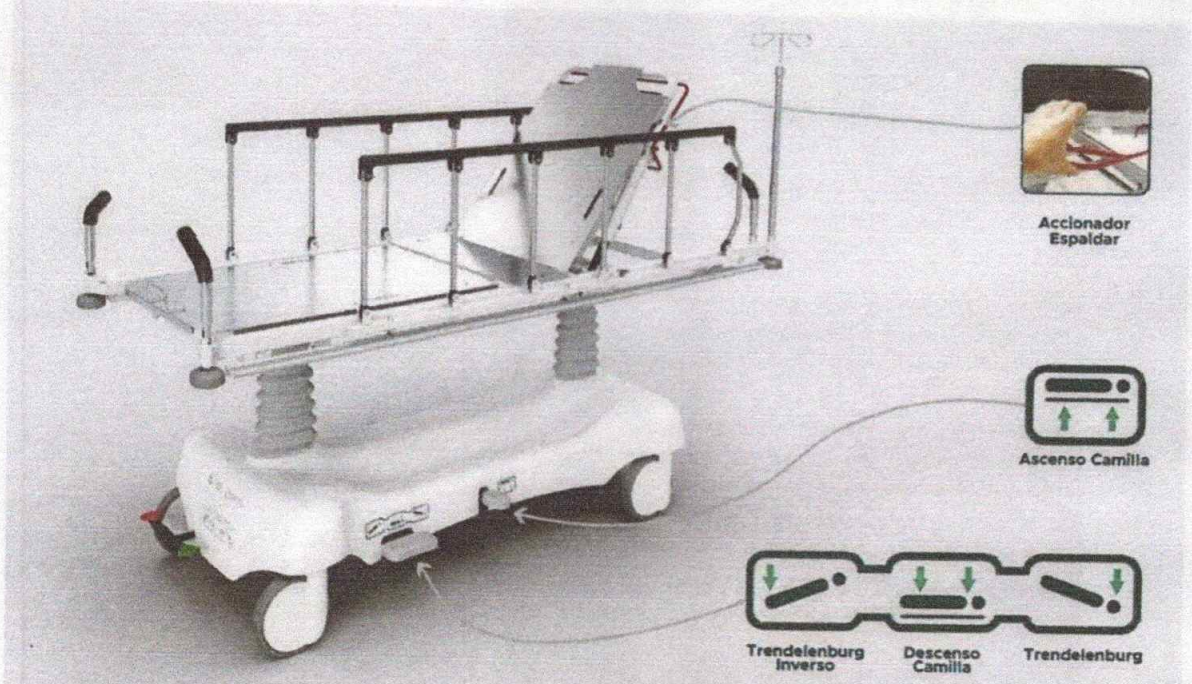

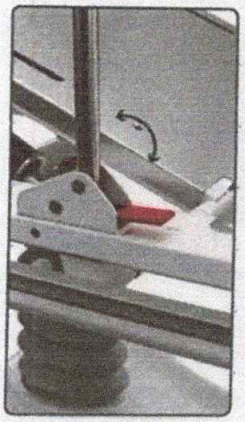

Subir Las Barandas


Hale hacia arriba hasta que estas aseguren firmemente en el trinquete.

Bajar Las Barandas

Haga presión en el accionador, sosteniendo la baranda para que no vaya a caer bruscamente.

Deje caer la baranda permitiendo que se posicione sobre el tendido.

Para desplazar la camilla asegúrese que no esté frenada.

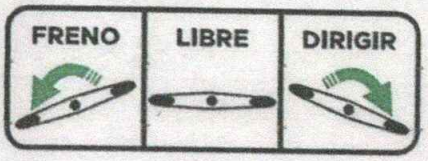

1. Posición segura de ingreso y egreso de paciente: Camilla en Altura Mínima.
2. Antes de realizar cualquier movimiento verifique que el atril porta suero no choque con ningún objeto, pared o techo.
3. Siempre asegúrese que no hayan obstáculos (personas, objetos, accesorios, entre otros), antes de cualquier movimiento de la camilla.
4. La camilla debe tener las barandas arriba siempre que se encuentre en uso.
5. Para la correcta limpieza de la camilla siga las instrucciones al respaldo.

Protocolo de Limpieza

Para garantizar la vida útil y el buen estado de los productos marca LOS PINOS® es necesario seguir las siguientes instrucciones de uso.

los pinos
Mejora tu Vida

Utilizar químicos de limpieza a base de:

A. Peróxido Orgánico.
B. Ácido Acético.
C. Biguadina Polimérica.
D. Tensoactivos Aniónicos.

Nunca Utilizar:

A. Cloro.
B. Hipoclorito.
C. Amonios Cuaternarios.
D. Alcalino Clorado.

1. Seguir las instrucciones de correcta titulación del químico dadas por el fabricante del mismo (% de concentración).
2. Bajo ninguna circunstancia aplique los químicos sin ser diluidos.
3. Humedecer (sin saturar) un paño limpio con el químico a utilizar. Verifique que este no quede goteando.
4. Aplicar el producto sobre la zonas de mayor contacto con el paciente y/o los agentes contaminantes. Dejar reposar por un tiempo no mayor a 1 minuto.
5. Con un paño seco (diferente al inicial) remover el exceso de químico dejando las superficies completamente secas.
6. En caso de tener desprendimiento de pintura por cualquier causa, comuníquese con LOS PINOS para realizar la reparación y evitar oxidación química.
7. En caso de identificar una mancha de óxido sin desprendimiento de pintura, humedezca un paño con agua y frote con fuerza hasta eliminar la mancha superficial. Verifique que la superficie quede completamente seca.
8. No realice la limpieza del equipo utilizando elementos a presión. (Mangueras o hidrolavadoras).
9. Para la limpieza de los componentes electrónicos, desconecte el equipo y limpie con un paño húmedo, garantizando que no se almacenen líquidos dentro de las conexiones. Con un paño seco (diferente al inicial) remover el exceso de químico dejando las superficies completamente secas.

En caso de presentar novedades con las protecciones superficiales o componentes comuníquese con Industrias Metálicas Los Pinos. No seguir las recomendaciones indicadas podría causar la pérdida de garantía del equipo.

PBX (57 604) 372 30 31 | **Línea Gratuita Nacional** 01 8000 180 654 | **Escríbanos a** servicioteenico@lospinos-sa.com | **Nuestra Página Web** www.lospinos.com.co

los pinos
Mejora tu Vida

CAMILLA DE
TRANSPORTE HIDRÁULICA
C-374



ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
DE PRODUCTO

Imágenes de referencia

CARACTERÍSTICAS


los pinos

• Estructura fabricada en acero cold rolled resistente a la aplicación de desinfectantes de grado hospitalario y acabado en pintura de características antibacteriales de aplicación electrostática en polvo, que aumenta la resistencia, la adhesión, profundidad y la protección ante la corrosión, de fino acabado, resistente a impactos y desinfección.
• El espaldar de la camilla de transporte y traspaso es de alta capacidad de carga, resistente a la corrisión y sustancias químicas, reclinable mediante sistema neumático de doble pistón.
• Base con dos columnas (cilindros) hidráulicos verticales para elevación, con cubiertas plásticas para protección.
• Superficie o tendido: De dos (2) planos, uno (1) fijo y uno (1) móvil, fabricados en plástico de grado hospitalario.
• Cuenta con un porta suero fijo plegable de dos servicios.

Dimensiones externas	208 cm x 78 cm ±1 cm
Dimensiones internas	208 cm x 66 cm ±1 cm
Altura máxima	82 cm ±1 cm
Altura mínima	53 cm ±1 cm
Trendelenburg / Trend. Inverso	15° / 15° ±1°
Ángulo espaldar (Semisentado)	0° - 84° ±1°
Peso máximo paciente	180 kg
Carga segura de trabajo	230 kg
Carga máxima estática	400 kg

MANIJAS DE EMPUJE

Dos (2) manijas ergonómicas plegables ubicadas en las esquinas de cabecero y piesero de la camilla.

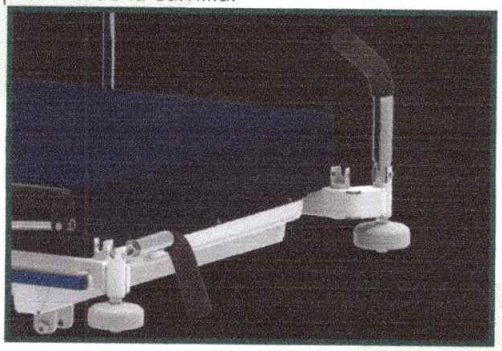


CABECERO

La camilla de transporte posee un sistema neumático que le permite subir o bajar el cabecero con gran facilidad. El accionamiento de este sistema se hace por medio de una palanca ubicada debajo del tendido correspondiente a la cabeza.



POSICIONES

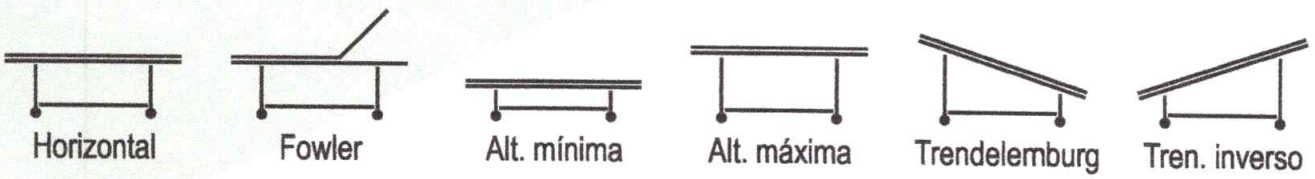

Imágenes de referencia


CARACTERÍSTICAS

los pinos
Mejora tu Vida

BARANDAS DE SEGURIDAD ABATIBLES


Las barandas de la camilla de transporte están diseñadas para plegar por debajo de la superficie de la colchoneta lo cual facilita el acceso y la colocación del paciente entre camillas. Cuentan con trinquete de seguridad para mantenerlas en posición de trabajo cuando se requiera. Estas barandas son fabricadas en plástico y aluminio de alta resistencia. Sistema de bloqueo en cada baranda.

Dimensiones de la baranda: Alto 29 cm ::: Largo 170

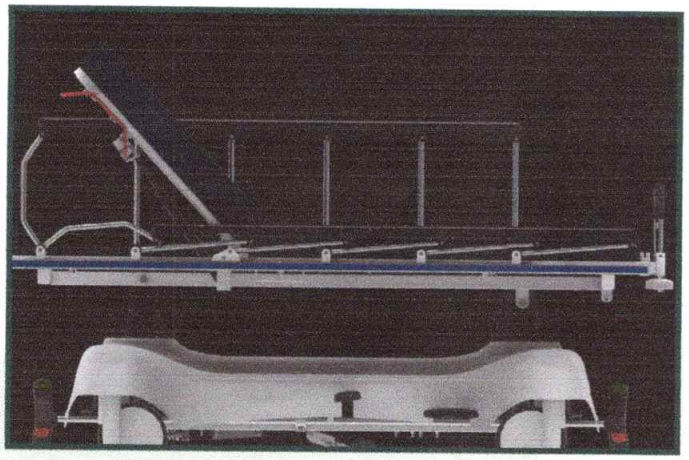

SISTEMA DE BLOQUEO CENTRAL

La camilla de transporte esta equipada con un sistema de freno que brinda seguridad. El sistema de bloqueo central es el encargado de bloquear simultáneamente las cuatro ruedas impidiendo el desplazamiento de la cama.

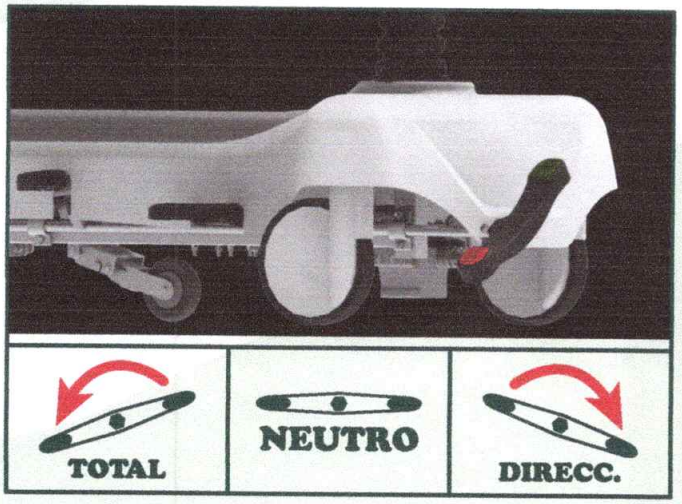

PALANCA EN POSICIÓN VERDE


En esta posición el pedal activa la quinta rueda, lo que permite el fácil movimiento de la camilla en cualquier dirección y puede ser llevada por una sola persona.

PALANCA EN POSICIÓN MEDIA O CENTRADA

En esta posición el freno se desactiva y la camilla se podrá trasladar fácilmente.

PALANCA EN POSICIÓN ROJA

En esta posición se activa el freno total de la camilla.

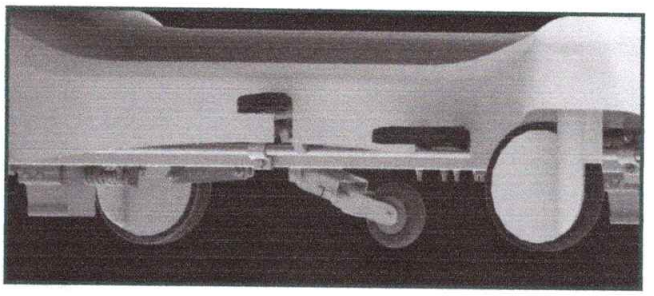


QUINTA RUEDA

El sistema Quinta Rueda, accionado por pedales los cuales hacen que esta despliegue hacia el piso, facilita el manejo de la camilla de transporte en cualquier sentido en espacios pequeños, al facilitar el giro y la maniobrabilidad cómodamente. Ésta se encuentra ubicada al centro de la camilla. Facilita el manejo en rampas.


RUEDA BOMPER

Una (1) rueda de caucho resistente, en cada una de las cuatro esquinas de la camilla de transporte para protección contra golpes.

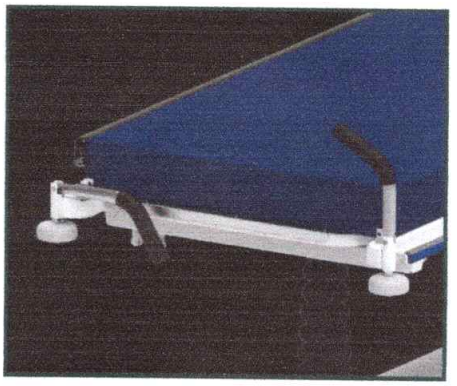

COLCHÓN

Colchoneta desmontable de 10 cm de espesor, fabricada en espuma de poliuretano de alta densidad, forrado en tela vinílica color azul oscuro, lavable, antiestático, impermeable, retardante al fuego y resistente a la aplicación de jabones y desinfectantes de grado hospitalario. Cuenta con velcro en una de sus caras para sujetarlo a la superficie de la camilla y con 2 correas para sujeción de paciente.

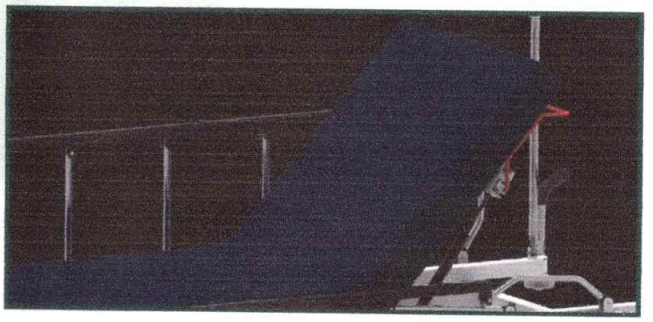


Imágenes de referencia

CARACTERÍSTICAS

los pinos
Mejora tu vida


RUEDAS

Cuatro (4) ruedas giratorias de 20 cms de diámetro, grado hospitalario, antiestáticas con sistema de freno central, total, axial y direccional; accionado por medio de pedales ubicados a ambos lados (Cabecero y piecero) de la camilla, provistas con cubierta plástica resistente que evita la oxidación, no permiten la acumulación de residuos, suciedades ni pelusas. Estas pueden dirigirse en cualquiera dirección según se requiera en su manejo.

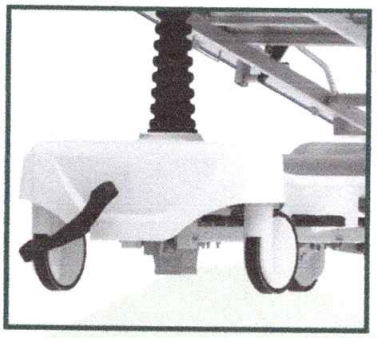

PEDALES

La camilla de transporte está equipada con un sistema hidráulico que le permite realizar las posiciones de cambio de altura, trendelenburg y trendelenburg inverso en una forma ágil y rápida por medio de pedales ubicados lateralmente lo que permite tener las manos libres para la atención del paciente.

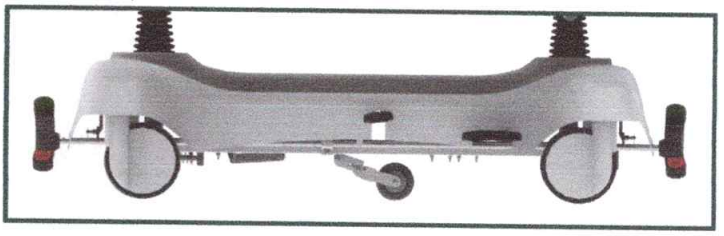

PORTA SUERO


Un (1) atril porta suero integrado de 2 ganchos ubicado en el cabecero, plegable y fijado en la camilla, fabricado con varilla en acero inoxidable, con altura ajustable y con posibilidad de ubicar una bomba de infusión de hasta 13 kg de peso.

RECEPTÁCULOS DE INTRAVENOSA

Cuatro (4) receptáculos de intravenosas ubicados en las esquinas de la camilla.

SOPORTE CILINDRO DE OXÍGENO

Soporte horizontal que se ubica debajo del tendido y da mejor accesibilidad.

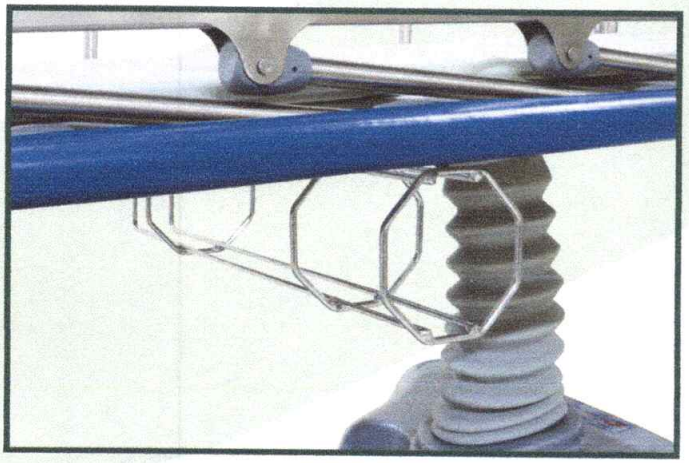

BASE TERMOFORMADA

La camilla de transporte cuenta con una cubierta termoformada en plástico ABS que cuenta con un lugar para almacenamiento de objetos personales o radiografías y adicionalmente un sitio para colocar un cilindro de oxígeno.

Imágenes de referencia

los pinos

Mejora tu Vida

INDUSTRIAS METÁLICAS LOS PINOS S.A.
PBX: (+57 604) 372 30 31 · 01 8000 180 654
Calle 67B No. 45A - 82 · Itagüí - Colombia
servicioalcliente@lospinos-sa.com · www.lospinos-sa.com
Copyright © 2022

CERTIFICADOS DE PROCESOS

icontec ISO 9001 CODIGO N° 1332-1

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

Sello de Calidad icontec

IEC 60601-1-2
IEC 60601-2-52

IEC Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission

CE

DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES · USA FDA

icontec ISO 13485