


CERTIFICADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS

Certificamos la existencia en el mercado de los insumos (accesorios, consumibles y repuestos) necesarios para el correcto funcionamiento del equipo y la prestación de servicio técnico durante 10 años posteriores a la puesta de operación de los equipos relacionados a continuación.

FECHA	2024-12-10
CLIENTE	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E
CIUDAD	Popayan
EQUIPO	Ventilador mecánico de transporte HAMILTON-T1. Con soporte universal
MARCA	HAMILTON MEDICAL
MODELO	HAMILTON-T1


NRO.SERIE(S) 30531

OBSERVACIONES

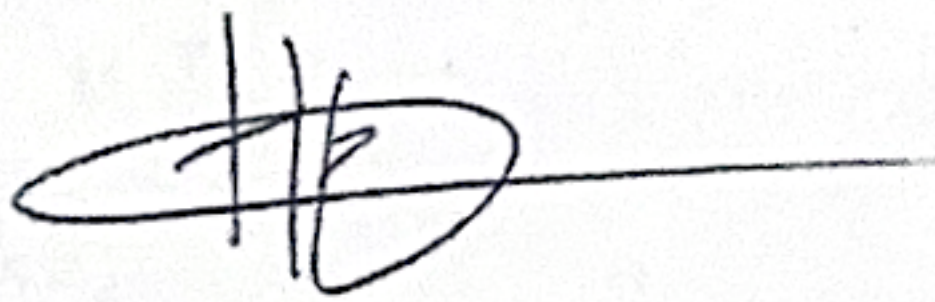

FIRMA Y SELLO EMCO S.A

Ing. Paul Eduardo Muñoz
ESP. ELECTROMEDICINA GTH
MGS AUTOMATICA
RH / 201003 - 277

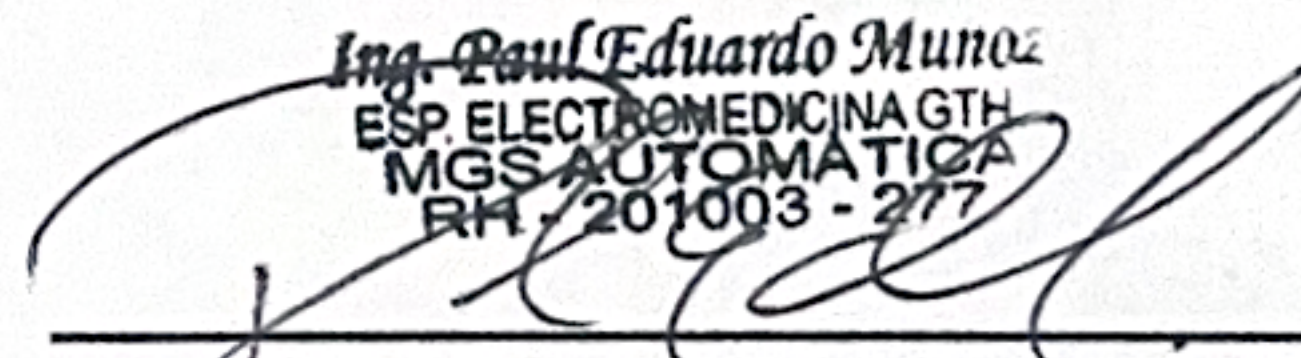

FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN

1. INICIO DEL PERÍODO DE GARANTÍA

El equipo suministrado a continuación por ELECTRÓNICA MÉDICA Y CONTROL EMCO S.A.S. tiene una garantía, por defectos de fabricación y/o en el ensamble del equipo, según lo especificado en este certificado y tres meses (3) para sus accesorios y repuestos de desgaste con el uso. La garantía ofrecida inicia a partir de la fecha de instalación del equipo, siempre y cuando se realice dentro de los 30 días calendario siguientes a la entrega del equipo por parte de EMCO S.A.S., en la sede de instalación señalada por el comprador. Transcurridos los 30 días sin que se haya realizado o completado la instalación por razones ajenas a EMCO S.A.S., iniciará el período de garantía correspondiente.

Durante el período de garantía EMCO S.A.S. prestará sus servicios de mantenimiento preventivo y las visitas serán pactadas de acuerdo a las condiciones de la negociación; la mano de obra para el soporte técnico de su equipo estará cubierta de manera ilimitada siempre y cuando los servicios requeridos obedezcan a un comportamiento inadecuado del equipo ocasionado por defectos de fabricación. Se suministrará asesoría especializada y capacitación para el usuario asistencial y técnico sin ningún costo adicional. Si el equipo lo requiere, se realizarán las actualizaciones de software sin costo para su

2. TÉRMINOS Y CONDICIONES

La garantía solo será cubierta si se cumplen los siguientes criterios:

- a. Instalación adecuada y correcta de la tecnología por parte de personal de EMCO S.A.S.
- b. Suministros dentro de valores exigidos, de acuerdo, a las instrucciones de instalación previamente entregadas por la compañía tales como agua, energía, aire, vacío, vapor y energía de back up. Según aplique de acuerdo a la tecnología adquirida.
- c. Manejo adecuado de la tecnología según las condiciones de fabricante.
- d. Realización de actividades de mantenimiento propias del usuario tales como cambio de filtros, membranas, limpieza y ejecución permanente de revisión de suministros, pruebas de estanqueidad y demás rutinas propias del usuario.
- e. Cuando el dispositivo médico, se encuentre dentro de su periodo de garantía el cual va desde la fecha de entrega hasta el vencimiento de la misma según el contrato de compraventa.
- f. Que el defecto o daño del equipo corresponda a un defecto de fabricación o calidad de alguno de los elementos que hacen parte de su conjunto siempre y cuando estas sean originales propias de la marca.
- g. Este documento hace parte integral del contrato de compraventa.
- h. La prestación de un servicio de mantenimiento durante la garantía, no alarga el período de la misma.

3. EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

La garantía ofrecida por EMCO S.A.S., NO cubre:

- a. Visitas para limpieza, cambio o sustitución de piezas consumibles ni supervisión o corrección de suministros del equipo.
- b. Repuestos o piezas de desgaste natural asociados al uso del equipo.
- c. Accesorios y/o material fungible.
- d. Daños o defectos derivados del almacenamiento o uso indebido del dispositivo médico.
- e. Daños causados por eventos tales como asonada, inundación, terremotos, incendios, vibraciones, calor excesivo, ventilación inadecuada, sobrecargas eléctricas, radiación, descargas electrostáticas, hurto y aquellos derivados de fallas en los suministros de aire, oxígeno, agua, etc.
- f. Daños o mal funcionamiento ocasionado por las variaciones de corriente (rayos, plantas eléctricas en mal estado, instalaciones sin polo a tierra) o por conexiones de energía inestables o fuera de los rangos especificados.
- g. Mal funcionamiento o daños ocasionados por el uso de partes y/o accesorios no aprobados por el fabricante o por EMCO S.A.S.
- h. Mal funcionamiento o daño ocasionado por el reprocesamiento no autorizado de forma escrita por el fabricante o EMCO S.A.S. de accesorios y/o consumibles.
- i. La garantía no incluye reinstalaciones de los equipos en sitio distinto al original asignado.

4. PERDIDA DE GARANTÍA

La garantía ofrecida EMCO S.A.S se pierde en los siguientes casos:

- a. Uso del equipo por parte del cliente, para funciones diferentes para los que fue fabricado, o hace modificaciones sin autorización escrita de EMCO S.A.S.
- b. Si el equipo es instalado de forma incompatible con los requisitos de preinstalación exigidos.
- c. Manejo por personal que no haya sido entrenado y capacitado por EMCO S.A.S.
- d. Uso de partes, accesorios y/o consumibles no aprobados de forma escrita por el fabricante o por EMCO S.A.S.
- e. Reprocesamiento no autorizado de forma escrita por el fabricante o EMCO S.A.S. de accesorios y/o consumibles.
- f. Personal no autorizado de forma escrita por EMCO S.A.S., intenta desarmar, reparar o viole los sellos de seguridad del equipo.

5. INFORMACIÓN DEL EQUIPO

CLIENTE HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E
EJECUTIVO COMERCIAL Angele Culma
CIUDAD Popayan
EQUIPO Ventilador mecánico de transporte HAMILTON-T1. Con soporte universal
MARCA HAMILTON MEDICAL
MODELO HAMILTON-T1
NRO. SERIE(S) 30531
CANTIDAD 1
GARANTÍA 2 Años en Mantenimiento Preventivo y Correctivo
OBSERVACIONES

6. ACEPTACIÓN DE LA GARANTÍA

La firma de este documento legaliza la aceptación de las condiciones y términos de garantía de mi

Firma del Cliente:

Nombre y Apellidos:

No. Identificación:

Cargo:

Fecha:

[Firma manuscrita]

Paul S. Lopez

76'328 229

Lider biomédico

23-12-2024

ESP. ELECTROMEDICINA
MSS AUTOMATICA
MUNOZ



ACTA DE ENTREGA

En la fecha EMCO S.A hace entrega final y a satisfacción de los equipos relacionados a continuación.


FECHA	2024-12-10
PROPIETARIO	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E
CIUDAD	Popayan
LUGAR DE ENTREGA	Calle 15 N° 17 A 196
EQUIPO	Ventilador mecánico de transporte HAMILTON-T1. Con soporte universal
MARCA	HAMILTON MEDICAL
MODELO	HAMILTON-T1
CANTIDAD	1

NRO.SERIE(S) 30531

OBSERVACIONES

Los equipos se entregan con los siguientes accesorios:

- Opción neonatal para Hamilton-T1. PN: 161078 x1
- Manguera de Oxígeno (3mts) con conector DISS y adaptador chemetron x1 + adaptador de baja presión de oxígeno x1
- Circuito desechable adulto/pediátrico y neonatal x2
- Batería para C1/T1/MR1 (instalada en el equipo) x1
- Sensor de flujo adulto/pediátrico y neonatal x2
- Válvula espiratoria reusable adulto/pediátrica y neonatal para Hamilton T1 x2
- Celda de oxígeno para T1 instalada en el equipo x1
- Cable de alimentación para T1 x1
- Manual de Usuario Impreso x1
- Pulmón de prueba neonatal x1

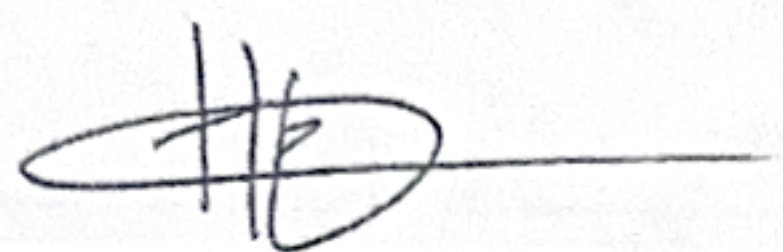

FIRMA Y SELLO EMCO S.A



Ing. Paul Eduardo Muñoz
ESP ELECTROMEDICINA GTH
MGS AUTOMATICA
201002-277

FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN