	HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E		
	NIT. 892.000.264 – 4		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA		
	FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISIÓN DEL CONTRATO		
	Fecha: 02/04/2024	Código: GJ-SP1-FR-04	Versión: 02

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:			
NOMBRE	**SIKUANY S.A.S. / JUAN DAVID LÓPEZ MOLINA C.C.71.777.324**	**IDENTIFICACION**	**830.512.772-6**

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS:			
CONTRATO No.	826 DE CINCO (05) DE DICIEMBRE DE 2024		
REGISTRO PRESUPUESTAL Nº	1913 DE 2024		
FECHA DE SUSCRIPCION	5/12/2024	**FECHA DE INICIO**	05/12/2024
FECHA DE TERMINACION	09/12/2024	**PLAZO DEL CONTRATO**	CINCO (05) DIAS

Balance Económico:

BALANCE FINANCIERO	
PERIODO EJECUTADO	**VALOR EJECUTAD**
VALOR CONTRATO INICIAL	**$ 326,732,622**
FEV No.12489462	$ 326,732,622
TOTAL EJECUTADO	**$ 326,732,622.00**
SALDO CONTRATO	**$ 0.00**

Nombre del Supervisor:	**HUGO FERNANDO ROJAS OSPINA / FREDY ANTONIO VALERO GOMEZ**

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, EQUIPOS INDUSTRIALES, EQUIPOS TIC´S Y MOBILIARIO REQUERIDO PARA LA DOTACION DEL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO LA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS - META DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMMINISTRATIVO No. OCA-986-2024.

3. CONCEPTO DEL SUPERVISOR	
CUENTA DE COBRO O DOCUMENTO EQUIVALENTE	Presenta en dos (2) folios documento equivalente a FACTURA ELECT DE VENTA No 12489462 EXPEDIDA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2024. Actividades desarrolladas entre el 05 al 09 de diciembre de 2024.
SEGURIDAD SOCIAL	Presenta en un (01) folio la planilla de seguridad social No.9473724776, periodo de cotizacion diciembre 2024. Se verifica soporte de cédula del representante legal, encontrándose en Adres compensados, paga seguridad social hasta el mes de diciembre de 2024. Se adjunta certificación del contador por paz y salvo en aportes al sistema de seguridad integral, con tarjeta profesional y certificación de junta de contadores, en tres (3) folios.
RELACION DE ACTIVIDADES	Se presenta en un folio (01) copia de certificación bancaria. Presenta en sesenta y siete (67) folios la relación de las actividades y acciones realizadas en el periodo de comprendido entre el 05 al 09 de diciembre de 2024 con el ánimo de realizar la entrega de los equipos biomédicos, industriales, tic´s y mobiliaio requerido para la dotación del centro de salud del Barrio La Independencia; actividades conformes a las expresadas en el contrato No.826.
ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	Anexa en un (01) folio.
RETENCION EN LA FUENTE	N/A
ACTA DE FINALIZACION CONTRATO	Será presentada en el último pago.

OBSERVACIONES: En virtud de lo anterior, certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las especificaciones y en el tiempo pactado de acuerdo con lo establecido en el objeto y obligaciones contratadas, por lo cual se autoriza el pago que corresponde al periodo comprendido entre el 05 al 09 de diciembre de 2024.

Ciudad y fecha: Acacias, diciembre de 2024.

Firma: DE SUPERVISOR

HUGO FERNANDO ROJAS OSPINA / FREDY ANTONIO VALERO GOMEZ
- Supervisores

SIKUANY SAS
830512772
CR 50 A 36 90 IN 137 138 139
6726246

Segun resolución DIAN:
AUTORIZACIÓN 18764076158436 Desde 2024-07-31
Hasta 2025-07-31 12 Habilita Del No. 394230 al 500000
Prefijo: 12

Contado
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

12489462
F. Exp: 2024-12-24

Distribución:

Razon Social:	HOSPITAL MUNICIPAL ACACIAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	**NIT:** 892000264-4	
Dirección:	DG 15 26 21 BRR SAN JORGE	**Ciudad:** ACACÍAS	
Teléfono:		**Forma Pago:**	
Condición:	0	**Favor cancelar antes de:** 2024-12-24	
CUFE:	f5bf968856758b24ec58cd2ff61da7adf15bfd4d4533afa2e0a24c9fef3f1e2ffcfd8bb55b3513da13dd2be0caf6359f		

Ref.	Descripción	Laboratorio	Lote	Vencimiento	Cant.	% IVA	PR. Bruto	% DCTO	Total
DM102361	COMPUTADOR ALL IN ONE HP PAVILION 27-CA1101LA - UNIDAD	HEWLETT-PACKARD	N/A	12-30-2030	8,00	19	4.119.565,00	0,00	32.956.520,00
DM102362	COMPUTADOR PORTATIL HP MOD 14-DQ5016LA - UNIDAD	HEWLETT-PACKARD	N/A	12-30-2030	2,00	19	2.247.035,00	0,00	4.494.070,00
DM102363	INFANTOMETRO PLEXIGLASS FC-00-0069 2024 - UNIDAD	FABRICLINICOS	N/A	12-30-2030	3,00	19	254.294,00	0,00	762.882,00
DM102364	BALANZA PESA BEBE DIGITAL - UNIDAD	VEROS HEALTH	N/A	12-30-2030	5,00	19	1.117.353,00	0,00	5.586.765,00
DM102366	TALLIMETRO EN ACRILICO FC-00-107-2024 - UNIDAD	GENERICO	N/A	12-30-2030	5,00	19	131.000,00	0,00	655.000,00
DM102367	BASCULA DE PISO DIGITAL IF1013A - UNIDAD	PRESTIGE	N/A	12-30-2030	6,00	19	446.941,00	0,00	2.681.646,00
DM102368	FONENDOSCOPIO PROFES - UNIDAD	WELCH ALLYN	N/A	12-30-2030	5,00	19	869.224,00	0,00	4.346.120,00
DM102369	KIT DE PIEZA DE MANO MD Y1002910 - UNIDAD	NSK	N/A	12-30-2030	1,00	19	5.116.706,00	0,00	5.116.706,00
DM102370	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA - UNIDAD	ORMEDICAL	N/A	12-30-2030	2,00	19	11.558.824,00	0,00	23.117.648,00
DM102371	UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL - UNIDAD	TEXVO	N/A	12-30-2030	1,00	19	4.161.176,00	0,00	4.161.176,00
DM102372	CAVITRON MOD PL5 - UNIDAD	BAOLA	N/A	12-30-2030	1,00	19	1.202.118,00	0,00	1.202.118,00
DM102373	AUTOCLAVE MOD AUTOMAT 1000 - UNIDAD	DENTOMAT	N/A	12-30-2030	1,00	19	46.235.294,00	0,00	46.235.294,00
DM102374	IMPRESORA ECOSYS M2640IDW/L - UNIDAD	KYOCERA	N/A	12-30-2030	2,00	19	5.548.233,00	0,00	11.096.466,00
DM102381	LAMPARA CUELLO DE CISNE FC-00-253 MOD2024 - UNIDAD	FABRICLINICOS	N/A	12-30-2030	2,00	19	431.529,00	0,00	863.058,00
DM102383	CAMILLA DIVAN DE LEVANTE PARA CONSULTORIO FC-00-209 - UNIDAD	FABRICLINICOS	N/A	12-30-2030	5,00	19	593.353,00	0,00	2.966.765,00

Observaciones:

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 274.565.229,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 274.565.229,00**
IVA	$ 52.167.393,51
ReteIVA	$ 0,00
Rte Fte	$ 0,00
ReteICA	$ 0,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 326.732.622,51**

SIKUANY SAS
830512772
CR 50 A 36 90 IN 137 138 139
6726246

Segun resolución DIAN:
AUTORIZACIÓN 18764076158436 Desde 2024-07-31
Hasta 2025-07-31 12 Habilita Del No. 394230 al 500000
Prefijo: 12

Contado
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

12489462
F. Exp: 2024-12-24

Distribución:

DM10238 4	ESCALERILLA DE DOS PASOS FC-00-211 - UNIDAD	FABRICLINICOS	N/A	12-30-2030	5,00	19	200.353,00	0,00	1.001.765,00
DM10238 5	BUTACO GIRATORIO HOSPITALARIO FC-00-976 - UNIDAD	FABRICLINICOS	N/A	12-30-2030	4,00	19	285.118,00	0,00	1.140.472,00
DM10238 6	ATRIL PORTA SUERO FC-00-564 - UNIDAD	FABRICLINICOS	N/A	12-30-2030	4,00	19	847.647,00	0,00	3.390.588,00
DM10238 7	DIVAN GINECOLOGICO DE GABINETE FC-00-976 - UNIDAD	FABRICLINICOS	N/A	12-30-2030	1,00	19	1.510.353,00	0,00	1.510.353,00
DM10238 8	ESTUCHE INSTRUMENTAL PARA PEQUEÑA CIRUGIA - UNIDAD	FABRICLINICOS	N/A	12-30-2030	2,00	19	2.404.235,00	0,00	4.808.470,00
DM10239 0	BIOMBO DE TRES CUERPOS FC-00-98 - UNIDAD	FABRICLINICOS	N/A	12-30-2030	5,00	19	739.765,00	0,00	3.698.825,00
DM10239 1	TENSIOMETRO DE PARED TYCOS 7670-01 - UNIDAD	WELCH ALLYN	N/A	12-30-2030	5,00	19	2.003.529,00	0,00	10.017.645,00
DM10239 2	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS - UNIDAD	WELCH ALLYN	N/A	12-30-2030	3,00	19	6.010.588,00	0,00	18.031.764,00
DM10239 5	NEBULIZADOR - UNIDAD	SCHILLER	N/A	12-30-2030	2,00	19	493.176,00	0,00	986.352,00
DM10239 6	DESFIBRILADOR DEA - UNIDAD	MINDRAY	N/A	12-30-2030	1,00	19	6.472.941,00	0,00	6.472.941,00
DM10239 7	CARRO DE PARO - UNIDAD	MINDRAY	N/A	12-30-2030	1,00	19	4.592.706,00	0,00	4.592.706,00
DM10239 8	EQUIPO INSTRUMENTAL BASICO ODONTOLOGÍCO - UNIDAD	DENTOMAT	N/A	12-30-2030	20,00	19	49.318,00	0,00	986.360,00
MI10414	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU - UNIDAD	PANASONIC	N/A	12-30-2030	4,00	19	2.851.176,00	0,00	11.404.704,00
MI10415	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU - UNIDAD	PANASONIC	N/A	12-30-2030	4,00	19	4.931.765,00	0,00	19.727.060,00
MI10416	AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU - UNIDAD	HISENSE	N/A	12-30-2030	2,00	19	9.092.940,50	0,00	18.185.881,00
MI10418	ESCRITORIO - UNIDAD	AYA	N/A	12-30-2030	10,00	19	835.342,00	0,00	8.353.420,00
MI10421	SILLA PARA MEDICO - UNIDAD	ATLANTIS	N/A	12-30-2030	9,00	19	375.580,00	0,00	3.380.220,00
MI10422	SILLA INTERLOCUTORA PARA PACIENTE - UNIDAD	AYA	N/A	12-30-2030	8,00	19	216.283,00	0,00	1.730.264,00
MI10423	TANDEM DE CUATRO PUESTOS - UNIDAD	AYA	NA	12-30-2030	6,00	19	982.985,00	0,00	5.897.910,00
MI10425	LAMPARA DE FOTOCURADO - UNIDAD	3G	N/A	12-30-2030	3,00	19	1.001.765,00	0,00	3.005.295,00

Observaciones:

RECIBI CONFORME

Subtotal	$ 274.565.229,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal - Dcto	**$ 274.565.229,00**
IVA	$ 52.167.393,51
ReteIVA	$ 0,00
Rte Fte	$ 0,00
ReteICA	$ 0,00
Anticipo/Copago	$ 0,00
TOTAL NETO:	**$ 326.732.622,51**

HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E

892,000,264 - 4

ACTA DE RECEPCIÓN MERCANCIA ALMACEN

Docum: FCA - 475 **Factura: 12489462** **FECHA: 24 dic. 2024**

PROVEEDOR: SIKUANY S.A.S **FECHA RECEPCION: 24 dic. 2024**

NIT: 830512772

Item	Producto	Nombre del Producto	Cantidad	Unidad	Valor Unidad	Valor I.V.A.	Valor Total
1	1COMP2974	COMPUTADOR ALL IN ONE	8.00	UNIDAD	4,119,565	6,261,739	39,218,259.00
2	1COMP2975	COMPUTADOR PORTATIL 14"	2.00	UNIDAD	2,247,035	853,873	5,347,943.00
3	EQBMM20	INFANTOMETRO PLEXIGLASS	3.00	UNIDAD	254,294	144,948	907,830.00
4	EQBMM21	BALANZA PESA BEBE DIGITAL	5.00	UNIDAD	1,117,353	1,061,485	6,648,250.00
5	EQBMM22	TALLIMETRO EN ACRILICO	5.00	UNIDAD	131,000	124,450	779,450.00
6	EQBMM23	BASCULA DE PISO DIGITAL	6.00	UNIDAD	446,941	509,513	3,191,159.00
7	EQBMM24	FONENDOSCOPIO PROFES	5.00	UNIDAD	869,224	825,763	5,171,883.00
8	EQBMM25	KIT DE PIEZA DE MANO	1.00	UNIDAD	5,116,706	972,174	6,088,880.00
9	EQBMM26	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA	2.00	UNIDAD	11,558,824	4,392,353	27,510,001.00
10	EQBMM27	UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL	1.00	UNIDAD	4,161,176	790,623	4,951,799.00
11	EQBMM28	CAVITRON PL5	1.00	UNIDAD	1,202,118	228,402	1,430,520.00
12	EQBMM29	AUTOCLAVE AUTOMAT	1.00	UNIDAD	46,235,294	8,784,706	55,020,000.00
13	1COMP2976	IMPRESORA ECOSYS	2.00	UNIDAD	5,548,233	2,108,329	13,204,795.00
14	EQBMM30	LAMPARA CUELLO CISNE	2.00	UNIDAD	431,529	163,981	1,027,039.00
15	EQBMM31	CAMILLA DIVAN DE LEVANTE	5.00	UNIDAD	593,353	563,685	3,530,450.00
16	EQBMM32	ESCALERILLA DE DOS PASOS	5.00	UNIDAD	200,353	190,335	1,192,100.00
17	EQBMM33	BUTACO GIRATORIO HOSPITALARIO	4.00	UNIDAD	285,118	216,690	1,357,162.00
18	EQBMM34	ATRIL PORTA SUERO	4.00	UNIDAD	847,647	644,212	4,034,800.00
19	EQBMM35	DIVAN GINECOLOGICO	1.00	UNIDAD	1,510,352	286,967	1,797,319.00
20	EQBMM36	ESTUCHE INSTRUMENTAL PQÑA CIRUGIA	2.00	UNIDAD	2,404,235	913,609	5,722,079.00
21	EQBMM37	BIOMBO DE TRES CUERPOS	5.00	UNIDAD	739,765	702,777	4,401,602.00
22	EQBMM38	TENSIOMETRO DE PARED	5.00	UNIDAD	2,003,529	1,903,353	11,920,998.00
23	EQBMM39	EQUIPO DE ORGANOS	3.00	UNIDAD	6,010,588	3,426,035	21,457,799.00
24	EQBMM40	NEBULIZADOR	2.00	UNIDAD	493,176	187,407	1,173,759.00
25	EQBMM41	DESFIBRILADOR DEA	1.00	UNIDAD	6,472,941	1,229,859	7,702,800.00
26	EQBMM42	CARRO DE PARO	1.00	UNIDAD	4,592,706	872,614	5,465,320.00
27	EQBMM43	EQUIPO INSTRUMENTAL BASICO	20.00	UNIDAD	49,318	187,408	1,173,768.00
28	1MTOAD71	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU	4.00	UNIDAD	2,851,176	2,166,894	13,571,598.00
29	1MTOAD72	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU	4.00	UNIDAD	4,931,765	3,748,141	23,475,201.00
30	1MTOAD73	AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU	2.00	UNIDAD	9,092,941	3,455,317	21,641,198.00
31	4ME000ME7	ESCRITORIO	10.00	UNIDAD	835,342	1,587,150	9,940,570.00
32	4ME000ME8	SILLA PARA MEDICO	9.00	UNIDAD	375,580	642,242	4,022,462.00
33	4ME000ME9	SILLA INTERLOCUTORA	8.00	UNIDAD	216,283	328,750	2,059,014.00
34	4ME000ME10	TANDEM DE CUATRO PUESTOS	6.00	UNIDAD	982,985	1,120,603	7,018,513.00
35	EQBMM44	LAMPARA DE FOTOCURADO	3.00	UNIDAD	1,001,765	571,006	3,576,301.00
36	1COMP28	AJUSTE AL APESO	1.00	UNIDAD	1		1.00

892,000,264 - 4

ACTA DE RECEPCIÓN MERCANCIA ALMACEN

Docum: FCA - 475	**Factura: 12489462**	**FECHA: 24 dic. 2024**
PROVEEDOR: SIKUANY S.A.S		**FECHA RECEPCION: 24 dic. 2024**
NIT: 830512772		

Item	Producto	Nombre del Producto	Cantidad	Unidad	Valor Unidad	Valor I.V.A.	Valor Total

Valor Total : 326,732,622.00

Elaborado Por:

Revisado Por:

SIKUANY S.A.S.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA


GERENCIA Y DIRECCIONAMIENTO

Fecha de aprobación: .

ACTA DE ENTREGA CONTRATO DE SUMISTRO N°826 DEL 2024

ITEM	EQUIPO	DESCRIPCION	CANT	NOMBRE	FIRMA
1	INFANTOMETRO	1. INFANTOMETRO EN PLEXIGLASS Y ALUMINIO. 2. GRADUADO EN DOBLE ESCALA PULGADAS Y CENTIMETROS. 3. RANGO DE MEDIDA 1 cm/1 m . 4. RESOLUCION 1mm.	3		
2	BALANZA PESA BEBE DIGITAL	1. BLOQUEO DE MEDICION(HOLD),TARA Y CONVERSION lb-kg. 2. CAPACIDAD 20 kg. 3. RESOLUCION 10 kg. 4. DISPLAY LCD.	5		
3	TALLIMETRO	1. TALLIMETRO TIPO REGLA EN ACRILICO. 2. RANGO DE MEDIDA 3,5 cm / 230 cm	5		
4	BASCULA DE PISO DIGITAL	1. BALANZA DIGITAL PARA MEDICION DE MASA COPORAL. 2. VIDRIO DE SEGURIDAD DE 6 mm. 3. PANTALLA LCD. 4. CAPACIDAD: 180 kg. 5. RESOLUCION: 50g.	6		
5	FONENDOSCOPIO	1. CAMPANA DE DOS SERVICIOS. 2. ALTA SENSIBILIDAD ACUSTICA. 3. PIEZA PECTORAL Y BINAURALES DE ACERO INOXIDABLE. 4. BINAURALES AJUSTABLES Y OLIVAS GIRATORIAS. 5. MEMBRANA EN POLICARBONATO. 6. ANILLO DE GOMA GRADO MEDICO. 7. LIBRE DE LATEX.	5		
6	TENSIOMETRO DE PARED	1. CARATULA GRABADA CON LASER PARA MAYOR PRECISION. 2. AGULA ROJA DE ALTO CONTRASTE. 3. PRECISION DE ± 3 mmHg. 4. CESTILLO PARA ALMACENAMIENTO INTEGRADO PARA BRAZALESTE. 5. RANGO DE MEDICION: 0-300 mmHg. 6. INTERVALO DE 10 mmHg. 7. RESOLUCION: 2mmHg. 8. LIBRE DE LATEX Y MERCURIO.	5		
7	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	1. OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO LUZ LED. 2. OFTALMOSCOPIO CON SISTEMA OPTICO COAXIAL DE 3,5v. 3. FILTROS:POLARIZADO LINEAL CRUZADO,LIBRE DE ROJO,AZUL COBALTO. 4. 15 COMBINACIONES DE APERTURAS. 5. CORDONES EN ESPIRAL 6. ANILLO DE GOMA GRADO MEDICO. 7. LIBRE DE LATEX.	3		

8	LAMPARA DE FOTOCURADO	1. VOLTAJE DE ENTRADA 110-220 Vac. 2. VOLTAJE DE SALIDA 5 VDc . 3. INTENSIDAD DE LUZ: 1000-1200 mw/ cm¨2. 4. LONGITUD DE ONDA:420-480 nm. 5. MODOS: NO RAMPA,RAMPA,PULSO,ESCALONADO. 6. BASE DE CARGA.	3		
9	NEBULIZADOR	1. COMPRESOR NEBULIZADOR DE TRABAJO CONTINUO. 2. RATA DE NEBULIZACION: ≥ 0,02 ml/min. 3. TAMAÑO DE PARTICULA : 0,8 µ 4. CAPACIDAD DE NEBULIZADOR: 2 ml (mínimo) - 6 ml (máximo) 5. PORCENTAJE DE PARTICULA NEBULIZADA:3,9 um> 65% . 6. MAXIMA COMPRESION: 32 PSI. 7. DIMENSIONES: 21 cm x 22 cm x 24 cm./ 2,2 kg 8. NIVEL DE RUIDO:65db.	2		
10	INSTRUMENTAL BASICO ODONTOLOGICO	1. EQUIPO INSTRUMENTAL BASICO PARA ODONTOLOGIA . 2. PINZA ALGODONERA. 3. EXPLORADOR. 4. CUCHARILLA N°5. 5. LUNA DE ESPEJO CON MANGO.	20		
11	INSTRUMENTAL DE PEQUEÑA CIRUGIA	1. (1) MANGO PARA BISTURI N°4 2. (4) CUATRO PINZAS KELLY CURVA HEMOSTATICA 14 cm. 3. (4) PINZAS MOSQUITO CURVA HEMOSTATICA 12,5 cm. 4. (6) PINZA JONES PARA SUJETAR CAMPOS 9 cm. 5. (1) PINZA ALLYS INTESTINAL 44X5 DIENTES DE 15 cm. . 6. (1) TIJERA METZEMBAUM CURVA . 7. SEPARADORES FERABEUF 12cm. 8. SONDA ACANALADA 14,5 cm 9. PORTA AGUJAS MAYO HEGAR 16cm. 10. (1) PINZA DE DISECCION ESTANDAR 14,5cm SIN GARRA . 12. (1) PINZA DE DISECCION ESTANDAR 14,5cm CON GARRA	2		
12	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA	1. SILLON Y ESPALDAR ELECTRICO. . 2. ESTRUCTURA Y TAPAS EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD. 3. SOPORTA 150 kg. 4. CAJA DE CONEXIONES INDEPENDIENTE . 5. MODULO TERMOFORMADO DE 3 SERVICIOS. 6. 3 SERVICIOS AUTOMATICOS, JERINGA TRIPLE. 7. SISTEMA REGULADOR DE AGUA Y MANOMETRO REGULADOR DE PRESION. 8. LAMAPRA LED .	2		
13	UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL	1. SILLON TAPIZADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA,CON VINILO PROTECTOR EN CABECERO. 2. ESPALDAR MECANICO AJUSTABLE. 3. CONSTRUIDA EN TUBERIA DE ACERO DE 1,5 mm. 4. SOPORTA 150kg. 5. SILLA PORTATIL PLEGABLE METALICA. 6. ESCUPIDERA EN ACERO INOXIDABLE,CON SOPORTE ABATIBLE 7. LAMPARA LED DE UN FOCO .	1		

14	CAVITRON	1. SCALER ULTRASONICO P5L. 2. VOLTAJE DE ENTRADA 110 V- 50 Hz . 3. POTENCIA: 3w - 20w. . 4. PESO: 0,55 kg. 5. DIMENSIONES: 254 mm X 214 mm X 195 mm. 6. PUNTAS ESTERILIZABLES . 7. PIEZA DE MANO ESTERILIZABLES A 135°C.	1		
15	KIT DE PIEZA DE MANO	1. PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PANA-MAX2. 2. MICROMOTOR NEUMATICO FX205. 3. PIEZA RECTA FX65. 4. CONTRA ANGULO FX23. 5. COMPATIBLE CON BORDEN 2/3 VIAS.. 6. ESTERILIZABLES A 135°C.	1		
16	DEA	1. DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO. 2. TECNOLOGIA BIFASICA 360 J. 3. RESISTENCIA IP55 AL AGUA Y POLVO. 4. RESISTENCIA A CAIDAS 1,5 m. 5. MODO RCP CONFIGURABLE. 6. RESULTADOS RCP EN TIEMPO REAL. 7. CARGA RAPIDA DE POTENCIA.	1		
17	LAMPARA CUELLO DE CISNE	1. LAMPARA CUELLO DE CISNE METALICA 2. CUELLO FLEXIBLE METALICO DE 54 cm. 3. TOLVA DE ACERO INOXIDABLE. 4. ALIMENTACION ELECTRICA: 110VAc- 60Hz	2		
18	CAMILLA DIVAN RECLINABLE	1. ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO 1 1/4" . 2. ESPUMA 5 cm TAPIZADO . 3. CABECERO AJUSTABLE. 4. TAPONES ANTIDESLIZANTES . 5. PINTURA ELECTROSTATICA . 6. DIMENSIONES 1,80 X 0,55 X 0,85 m.	5		
19	ESCALERILLA DE DOS PASOS	1. ESCALERILLA DE DOS PASOS EN ESTRUCTURA METALICA 2. PINTURA ELECTROSTATICA. 3. HUELLA ANTIDESLIZANTE.	5		
20	BUTACO	1.Butaco hospitalario giratorio 2. Dimensiones: Diámetro 0.30 cm Altura mínima 60 cm Altura máxima 75 cm. 3. Base soportada en ruedas de 3" o elavadores de piso 4. Estructura en tubo de 2" cold rolled con altura graduable a través graduable. 5. Asiento en alma madera acolchado con espuma de densidad 30, tapizado en cordobán 6. Acabado en pintura electrostática	4		
21	ATRIL RODABLE	1. FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 7/8 EN ACERO INOXIDABLE . 2. ALTURA GRADUABLE. 3. GANCHO DE DOS SERVICIOS. 4. TRES RUEDAS DE 2" . 5. ALTURA MINIMA 110 cm . 6. ALTURA MAXIMA 210 cm	4		
22	BIOMBO DE TRES CUERPOS	1. ESTRUCTURA TUBULAR 7/8 CALIBRE 18. 2. TELA ANTIFLUIDO. 3. MEDIDAS: ALTURA 176 cm,ANCHO 125 cm. 4. ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA.	5		
23	SILLA PARA MEDICO	1. SILLA GIRATORIA OPERATIVA. 2. ESPALDAR EN MALLA . 3. MARCO EN POLIPROPILENO Y SOPORTE LUMBAR. 4. SISTEMA BASCULANTE A 45°. 5. BASE CROMADA 5 ASPAS CON RUEDAS EN NYLON .	9		

24	SILLA INTERLOCUTORA PARA PACIENTE	1. Asiento y espaldar tapizado en paño. 2. Estructura con tubo elíptico color negro.	8		
25	ESCRITORIO	1. ESCRITORIO RECTO CON CAJONERA . 2. ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO DE 2X2 .cm 3. MEDIDA 120X60 cm.	10		
26	DIVAN GINECOLOGICO	1. CAMILLA MESA GINECOLOGA GABINETE Y TACONERAS . 2. PANELES EN ACERO COLD ROLLED . 3. CABECERO Y PIECERO DE ACCION MECANICA. 4. TAPIZADO EN CORDOBAN Y ESPUMA DE 5 cm . 5. TACONERAS FUNDIDAS EN ALUMINIO CON SOPORTE EN VARILLA CROMADA Y PERILLAPARA ASEGURAR . 6. 4 NIVELADORES ANTIDESLIZANTES DE 3/8". 7. DIMMENSIONES: 1,80 X 0,50 X 0,85 m.	1		
27	CARRO DE PARO	1. MATERIAL: ABS DE ALTA RESISTENCIA . 2. (4) RUEDAS DE GOMA, (2) CON FRENO. 3. CERRADURA CENTRALIZADA CON BLOQUEO DE GABETAS,2LLAVES. 4. CINCO CAJONES ABS,2PEQUEÑOS,2 MEDIANOS Y 1 GRANDE. 5. ESTANTE PARA DESFIBRILADOR. 6. SOPORTE PARA TANQUE DE OXIGENO. 7. SEPARADORES DE MEDICAMENTOS. 8. TOMA DE CORRIENTE MULTIPLE,CON TOMA A TIERRA . 9. ATRIL PORTA SUERO EN ACERO. 10. DIMENSIONE: 750 *480 *920 mm	1		
28	TANDEM DE CUATRO PUESTOS	1. Estructura en tubería de acero pintado, travesaño en pintura electrostática 2. Asientos en lámina de acero cal. 20 acabado en pintura electrostática con bordes en tubería cromada 3. color gris 2. 4 puestos	6		
29	AIRE ACONDICIONADO 1200BTU	1. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INVERTER . 2. NVERTER DE 12000 BTU . 3. REFRIGERANTE ECOLOGICO R410. 4. VOLTAJE DE ALIMENTACION DE 230V - 60 Hz . 5. CORRIENTE NOMINAL 4,2 A 6. FILTRO DE CARBON ACTIVADO 7. SISTEMA DE ILUMINACION DYSPLAY LED. 8. AREA REFRIGERADA 15-22 m3	4		
30	AIRE ACONDICIONADO 2400BTU	1. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INVERTER . 2. NVERTER DE 24000 BTU . 3. REFRIGERANTE ECOLOGICO R410. 4. VOLTAJE DE ALIMENTACION DE 230V - 60 Hz . 5. CORRIENTE NOMINAL 9,36 A 6. REFRIGERANTE ECOLOGICO R410 7. SISTEMA DE ILUMINACION DYSPLAY LED. 8. AREA REFRIGERADA 28-41 m3	4		
31	AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU	1. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT . 2. SERIE LUSO INVERTER DE 36000 BTU TIPO D . 3. REFRIGERANTE ECOLOGICO R410. 4. VOLTAJE DE ALIMENTACION DE 230V - 60 Hz. 5. SISTEMA DE ILUMINACION DISPLAY LED . 6. MODO ECONOMICO,SISTEMA DE AUTOLIMPIEZA,FILTRO 3 EN 1.	2		

32	AUTOCLAVE	1. AUTOCLAVE DIGITAL AUTOMAT 1000. 2. CAPACIDAD DE 100LITROS. 3. DIMENSIONES: 780 X 555 X 900 mm . 4. VOLTAJE DE ALIMENTACION: 220 Vac - 50Hz. 5. PESO :150 kg. 6. CONSUMO PROMEDIO DE POTRNCIO 3,5 kw. 7. PORTABANDEJAS Y 3 BANDEJAS EN ACERO QUIRURJICO. 8. DIMENSIONES BANDEJAS:367 X 350 X 656 mm . 9. ACCESORIOS: BOMBA DE VACIO DE ALTA EFICIENCIA. 10. CUATRO PROGRAMAS DE ESTERILIZACION: INSTRUMENTAL EMPACADO INSTRUMENTAL LIBRE DE EMPAQUE ROPA,TELA, GASAS LIQUIDOS O ENVASES DE LABORATORIO	1		
33	COMPUTADOR ALL IN ONE	1. Sistema operativo: Windows 11 home 2. Procesador: Intel Core I-5 o AMD Ryzen 7 de 8 núcleos. 3. Memoria Ram: 16 GB DDR4 3200 Mhz 4. Disco duro: Unidad de estado sólido de 512 GB 5. Tarjeta gráfica: Integrada 6. Pantalla: 27" QHD 7. Conectividad: Wi-fi 6 y Bluetooth 5.2 8. Sonido: parlantes integrados 9. Teclado y mouse inalámbricos	8		
34	COMPUTADOR PORTATIL	1. Sistema operativo: Windows 2. Procesador: Intel Core I-5 o AMD Ryzen 7 de 10 núcleos. 3. Memoria Ram: 8 GB DDR4 3200 Mhz 4. Disco duro: Unidad de estado sólido de 512 GB 5. Tarjeta gráfica: Integrada 6. Pantalla: 14" HD 7. Conectividad: Wi-fi y Bluetooth 5.2 8. Sonido: parlantes integrados 9. Teclado sin retroiluminación y tackpad integrados. 10. Batería de litio de 3 celdas a 41 Wh 11. Cámara: HD integrada 12. Cargador: Adaptador alimentación CA de 45 W	2		
35	IMPRESORA	1.Impresora multifuncional láser. 2. Tamaño de impresión: carta, media carta, oficio. 3. Páginas por minuto: carta 42, a4:40, legal: 34 4. Escaner: A color y B/N 5. Tipo de escáner: Por bandeja de alimentación y visor 6. Resolución de escaneo: 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi, fine 1200 dpi 7.Dimensiones: 475mm an. x 412 mm pr. x 437mm al. / 19kg 8.Requrimiento eléctrico: : 120v, 60hz, 8.7a. 9. Tipo de conexión: USB, wifi, cable de red. 10. Formato de digitalización: pdf, jpg, tiff. 11. Bandeja papel: 2 12,Panel de control a color y touch	2		

Jhon Alexander Camacho N.

Entrega: 86078702

JHON ALEXANDER CAMACHO NOVOA

Aux. administrativo sikuany

Recibe:

Fredy Antonio Valero

Tec. Administrativo

Almacen

SIKUANY S.A.S.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA

GERENCIA Y DIRECCIONAMIENTO

Fecha de aprobación: .

ACTA DE ENTREGA CONTRATO DE SUMISTRO N°826 DEL 2024

ITEM	EQUIPO	DESCRIPCION	CANT	NOMBRE	FIRMA
1	INFANTOMETRO	1. INFANTOMETRO EN PLEXIGLASS Y ALUMINIO. 2. GRADUADO EN DOBLE ESCALA PULGADAS Y CENTIMETROS. 3. RANGO DE MEDIDA 1 cm/1 m . 4. RESOLUCION 1mm.	3	Hugo Fdo Rojas Ospina	
2	BALANZA PESA BEBE DIGITAL	1. BLOQUEO DE MEDICION(HOLD),TARA Y CONVERSION lb-kg. 2. CAPACIDAD 20 kg. 3. RESOLUCION 10 kg. 4. DISPLAY LCD.	5	Hugo Fdo Rojas Ospina	
3	TALLIMETRO	1. TALLIMETRO TIPO REGLA EN ACRILICO. 2. RANGO DE MEDIDA 3,5 cm / 230 cm	5	Hugo Fdo Rojas Ospina	
4	BASCULA DE PISO DIGITAL	1. BALANZA DIGITAL PARA MEDICION DE MASA COPORAL. 2. VIDRIO DE SEGURIDAD DE 6 mm. 3. PANTALLA LCD. 4. CAPACIDAD: 180 kg. 5. RESOLUCION: 50g.	6	Hugo Fdo Rojas Ospina	
5	FONENDOSCOPIO	1. CAMPANA DE DOS SERVICIOS. 2. ALTA SENSIBILIDAD ACUSTICA. 3. PIEZA PECTORAL Y BINAURALES DE ACERO INOXIDABLE. 4. BINAURALES AJUSTABLES Y OLIVAS GIRATORIAS. 5. MEMBRANA EN POLICARBONATO. 6. ANILLO DE GOMA GRADO MEDICO. 7. LIBRE DE LATEX.	5	Hugo Fdo Rojas Ospina	
6	TENSIOMETRO DE PARED	1. CARATULA GRABADA CON LASER PARA MAYOR PRECISION. 2. AGULA ROJA DE ALTO CONTRASTE. 3. PRECISION DE ± 3 mmHg. 4. CESTILLO PARA ALMACENAMIENTO INTEGRADO PARA BRAZALESTE. 5. RANGO DE MEDICION: 0-300 mmHg. 6. INTERVALO DE 10 mmHg. 7. RESOLUCION: 2mmHg. 8. LIBRE DE LATEX Y MERCURIO.	5	Hugo Fdo Rojas Ospina	
7	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	1. OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO LUZ LED. 2. OFTALMOSCOPIO CON SISTEMA OPTICO COAXIAL DE 3,5v. 3. FILTROS:POLARIZADO LINEAL CRUZADO,LIBRE DE ROJO,AZUL COBALTO. 4. 15 COMBINACIONES DE APERTURAS. 5. CORDONES EN ESPIRAL 6. ANILLO DE GOMA GRADO MEDICO. 7. LIBRE DE LATEX.	3	Hugo Fdo. Rojas Ospina	

8	LAMPARA DE FOTOCURADO	1. VOLTAJE DE ENTRADA 110-220 Vac. 2. VOLTAJE DE SALIDA 5 VDc . 3. INTENSIDAD DE LUZ: 1000-1200 mw/ cm¨2. 4. LONGITUD DE ONDA:420-480 nm. 5. MODOS: NO RAMPA,RAMPA,PULSO,ESCALONADO. 6. BASE DE CARGA.	3	Hugo Fdo Rojas Ospina	
9	NEBULIZADOR	1. COMPRESOR NEBULIZADOR DE TRABAJO CONTINUO. 2. RATA DE NEBULIZACION: ≥ 0,02 ml/min. 3. TAMAÑO DE PARTICULA : 0,8 µ 4. CAPACIDAD DE NEBULIZADOR: 2 ml (mínimo) - 6 ml (máximo) 5. PORCENTAJE DE PARTICULA NEBULIZADA:3,9 um> 65% . 6. MAXIMA COMPRESION: 32 PSI. 7. DIMENSIONES: 21 cm x 22 cm x 24 cm./ 2,2 kg 8. NIVEL DE RUIDO:65db.	2	Hugo Fdo Rojas Ospina	
10	INSTRUMENTAL BASICO ODONTOLOGICO	1. EQUIPO INSTRUMENTAL BASICO PARA ODONTOLOGIA . 2. PINZA ALGODONERA. 3. EXPLORADOR. 4. CUCHARILLA N°5. 5. LUNA DE ESPEJO CON MANGO.	20	Hugo Fdo Rojas Ospina	
11	INSTRUMENTAL DE PEQUEÑA CIRUGIA	1. (1) MANGO PARA BISTURI N°4 2. (4) CUATRO PINZAS KELLY CURVA HEMOSTATICA 14 cm. 3. (4) PINZAS MOSQUITO CURVA HEMOSTATICA 12,5 cm. 4. (6) PINZA JONES PARA SUJETAR CAMPOS 9 cm. 5. (1) PINZA ALLYS INTESTINAL 44X5 DIENTES DE 15 cm. . 6. (1) TIJERA METZEMBAUM CURVA . 7. SEPARADORES FERABEUF 12cm. 8. SONDA ACANALADA 14,5 cm 9. PORTA AGUJAS MAYO HEGAR 16cm. 10. (1) PINZA DE DISECCION ESTANDAR 14,5cm SIN GARRA . 12. (1) PINZA DE DISECCION ESTANDAR 14,5cm CON GARRA	2	Hugo Fdo. Rojas Ospina	
12	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA	1. SILLON Y ESPALDAR ELECTRICO. . 2. ESTRUCTURA Y TAPAS EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD. 3. SOPORTA 150 kg. 4. CAJA DE CONEXIONES INDEPENDIENTE . 5. MODULO TERMOFORMADO DE 3 SERVICIOS. 6. 3 SERVICIOS AUTOMATICOS, JERINGA TRIPLE. 7. SISTEMA REGULADOR DE AGUA Y MANOMETRO REGULADOR DE PRESION. 8. LAMAPRA LED .	2	Hugo Fdo. Rojas Ospina	
13	UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL	1. SILLON TAPIZADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA,CON VINILO PROTECTOR EN CABECERO. 2. ESPALDAR MECANICO AJUSTABLE. 3. CONSTRUIDA EN TUBERIA DE ACERO DE 1,5 mm. 4. SOPORTA 150kg. 5. SILLA PORTATIL PLEGABLE METALICA. 6. ESCUPIDERA EN ACERO INOXIDABLE,CON SOPORTE ABATIBLE 7. LAMPARA LED DE UN FOCO .	1	Hugo Fdo. Rojas Ospina	

14	CAVITRON	1. SCALER ULTRASONICO P5L. 2. VOLTAJE DE ENTRADA 110 V- 50 Hz . 3. POTENCIA: 3w - 20w. . 4. PESO: 0,55 kg. 5. DIMENSIONES: 254 mm X 214 mm X 195 mm. 6. PUNTAS ESTERILIZABLES . 7. PIEZA DE MANO ESTERILIZABLES A 135°C.	1	Hugo Fdo. Rojas Ospina	
15	KIT DE PIEZA DE MANO	1. PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PANA-MAX2. 2. MICROMOTOR NEUMATICO FX205. 3. PIEZA RECTA FX65. 4. CONTRA ANGULO FX23. 5. COMPATIBLE CON BORDEN 2/3 VIAS.. 6. ESTERILIZABLES A 135°C.	1	Hugo Fdo Rojas Ospina	
16	DEA	1. DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO. 2. TECNOLOGIA BIFASICA 360 J. 3. RESISTENCIA IP55 AL AGUA Y POLVO. 4. RESISTENCIA A CAIDAS 1,5 m. 5. MODO RCP CONFIGURABLE. 6. RESULTADOS RCP EN TIEMPO REAL. 7. CARGA RAPIDA DE POTENCIA.	1	Hugo Fdo Rojas Ospina	
17	LAMPARA CUELLO DE CISNE	1. LAMPARA CUELLO DE CISNE METALICA 2. CUELLO FLEXIBLE METALICO DE 54 cm. 3. TOLVA DE ACERO INOXIDABLE. 4. ALIMENTACION ELECTRICA: 110VAc- 60Hz	2	Hugo Fdo. Rojas Ospina	
18	CAMILLA DIVAN RECLINABLE	1. ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO 1 1/4" . 2. ESPUMA 5 cm TAPIZADO . 3. CABECERO AJUSTABLE. 4. TAPONES ANTIDESLIZANTES . 5. PINTURA ELECTROSTATICA . 6. DIMENSIONES 1,80 X 0,55 X 0,85 m.	5	Hugo Fdo. Rojas Ospina	
19	ESCALERILLA DE DOS PASOS	1. ESCALERILLA DE DOS PASOS EN ESTRUCTURA METALICA 2. PINTURA ELECTROSTATICA. 3. HUELLA ANTIDESLIZANTE.	5	Hugo Fdo. Rojas Ospina	
20	BUTACO	1.Butaco hospitalario giratorio 2. Dimensiones: Diámetro 0.30 cm Altura mínima 60 cm Altura máxima 75 cm. 3. Base soportada en ruedas de 3" o elavadores de piso 4. Estructura en tubo de 2" cold rolled con altura graduable a través graduable. 5. Asiento en alma madera acolchado con espuma de densidad 30, tapizado en cordobán 6. Acabado en pintura electrostática	4	Hugo Fdo. Rojas Ospina	
21	ATRIL RODABLE	1. FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 7/8 EN ACERO INOXIDABLE . 2. ALTURA GRADUABLE. 3. GANCHO DE DOS SERVICIOS. 4. TRES RUEDAS DE 2" . 5. ALTURA MINIMA 110 cm . 6. ALTURA MAXIMA 210 cm	4	Hugo Fdo. Rojas Ospina	
22	BIOMBO DE TRES CUERPOS	1. ESTRUCTURA TUBULAR 7/8 CALIBRE 18. 2. TELA ANTIFLUIDO. 3. MEDIDAS: ALTURA 176 cm,ANCHO 125 cm. 4. ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA.	5	Hugo Fdo. Rojas Ospina	
23	SILLA PARA MEDICO	1. SILLA GIRATORIA OPERATIVA. 2. ESPALDAR EN MALLA . 3. MARCO EN POLIPROPILENO Y SOPORTE LUMBAR. 4. SISTEMA BASCULANTE A 45°. 5. BASE CROMADA 5 ASPAS CON RUEDAS EN NYLON .	9	Hugo Fdo Rojas Ospina	

24	SILLA INTERLOCUTORA PARA PACIENTE	1. Asiento y espaldar tapizado en paño. 2. Estructura con tubo elíptico color negro.	8	Hugo Fdo. Rojas Ospina	
25	ESCRITORIO	1. ESCRITORIO RECTO CON CAJONERA . 2. ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO DE 2X2 .cm 3. MEDIDA 120X60 cm.	10	Hugo Fdo. Rojas Ospina	
26	DIVAN GINECOLOGICO	1. CAMILLA MESA GINECOLOGA GABINETE Y TACONERAS . 2. PANELES EN ACERO COLD ROLLED . 3. CABECERO Y PIECERO DE ACCION MECANICA. 4. TAPIZADO EN CORDOBAN Y ESPUMA DE 5 cm . 5. TACONERAS FUNDIDAS EN ALUMINIO CON SOPORTE EN VARILLA CROMADA Y PERILLAPARA ASEGURAR . 6. 4 NIVELADORES ANTIDESLIZANTES DE 3/8". 7. DIMMENSIONES: 1,80 X 0,50 X 0,85 m.	1	Hugo Fdo. Rojas Ospina	
27	CARRO DE PARO	1. MATERIAL: ABS DE ALTA RESISTENCIA . 2. (4) RUEDAS DE GOMA, (2) CON FRENO. 3. CERRADURA CENTRALIZADA CON BLOQUEO DE GABETAS,2LLAVES. 4. CINCO CAJONES ABS,2PEQUEÑOS,2 MEDIANOS Y 1 GRANDE. 5. ESTANTE PARA DESFIBRILADOR. 6. SOPORTE PARA TANQUE DE OXIGENO. 7. SEPARADORES DE MEDICAMENTOS. 8. TOMA DE CORRIENTE MULTIPLE,CON TOMA A TIERRA . 9. ATRIL PORTA SUERO EN ACERO. 10. DIMENSIONE: 750 *480 *920 mm	1	Hugo Fdo. Rojas Ospina	
28	TANDEM DE CUATRO PUESTOS	1. Estructura en tubería de acero pintado, travesaño en pintura electrostática 2. Asientos en lámina de acero cal. 20 acabado en pintura electrostática con bordes en tubería cromada 3. color gris 2. 4 puestos	6	Hugo Fdo. Rojas Ospina	
29	AIRE ACONDICIONADO 1200BTU	1. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INVERTER . 2. NVERTER DE 12000 BTU . 3. REFRIGERANTE ECOLOGICO R410. 4. VOLTAJE DE ALIMENTACION DE 230V - 60 Hz . 5. CORRIENTE NOMINAL 4,2 A 6. FILTRO DE CARBON ACTIVADO 7. SISTEMA DE ILUMINACION DYSPLAY LED. 8. AREA REFRIGERADA 15-22 m3	4	Hugo Fdo. Rojas Ospina	
30	AIRE ACONDICIONADO 2400BTU	1. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INVERTER . 2. NVERTER DE 24000 BTU . 3. REFRIGERANTE ECOLOGICO R410. 4. VOLTAJE DE ALIMENTACION DE 230V - 60 Hz . 5. CORRIENTE NOMINAL 9,36 A 6. REFRIGERANTE ECOLOGICO R410 7. SISTEMA DE ILUMINACION DYSPLAY LED. 8. AREA REFRIGERADA 28-41 m3	4	Hugo Fdo. Rojas Ospina	
31	AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU	1. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT . 2. SERIE LUSO INVERTER DE 36000 BTU TIPO D . 3. REFRIGERANTE ECOLOGICO R410. 4. VOLTAJE DE ALIMENTACION DE 230V - 60 Hz. 5. SISTEMA DE ILUMINACION DISPLAY LED . 6. MODO ECONOMICO,SISTEMA DE AUTOLIMPIEZA,FILTRO 3 EN 1.	2	Hugo Fdo. Rojas Ospina	

32	AUTOCLAVE	1. AUTOCLAVE DIGITAL AUTOMAT 1000. 2. CAPACIDAD DE 100LITROS. 3. DIMENSIONES: 780 X 555 X 900 mm . 4. VOLTAJE DE ALIMENTACION: 220 Vac - 50Hz. 5. PESO :150 kg. 6. CONSUMO PROMEDIO DE POTRNCIO 3,5 kw. 7. PORTABANDEJAS Y 3 BANDEJAS EN ACERO QUIRURJICO. 8. DIMENSIONES BANDEJAS:367 X 350 X 656 mm . 9. ACCESORIOS: BOMBA DE VACIO DE ALTA EFICIENCIA. 10. CUATRO PROGRAMAS DE ESTERILIZACION: INSTRUMENTAL EMPACADO INSTRUMENTAL LIBRE DE EMPAQUE ROPA,TELA, GASAS LIQUIDOS O ENVASES DE LABORATORIO	1	Hugo Fdo. Rojas Ospina	
33	COMPUTADOR ALL IN ONE	1. Sistema operativo: Windows 11 home 2. Procesador: Intel Core I-5 o AMD Ryzen 7 de 8 núcleos. 3. Memoria Ram: 16 GB DDR4 3200 Mhz 4. Disco duro: Unidad de estado sólido de 512 GB 5. Tarjeta gráfica: Integrada 6. Pantalla: 27" QHD 7. Conectividad: Wi-fi 6 y Bluetooth 5.2 8. Sonido: parlantes integrados 9. Teclado y mouse inalámbricos	8	Hugo Fdo. Rojas Ospina	
34	COMPUTADOR PORTATIL	1. Sistema operativo: Windows 2. Procesador: Intel Core I-5 o AMD Ryzen 7 de 10 núcleos. 3. Memoria Ram: 8 GB DDR4 3200 Mhz 4. Disco duro: Unidad de estado sólido de 512 GB 5. Tarjeta gráfica: Integrada 6. Pantalla: 14" HD 7. Conectividad: Wi-fi y Bluetooth 5.2 8. Sonido: parlantes integrados 9. Teclado sin retroiluminación y tackpad integrados. 10. Batería de litio de 3 celdas a 41 Wh 11. Cámara: HD integrada 12. Cargador: Adaptador alimentación CA de 45 W	2	Hugo Fdo. Rojas Ospina	
35	IMPRESORA	1.Impresora multifuncional láser. 2. Tamaño de impresión: carta, media carta, oficio. 3. Páginas por minuto: carta 42, a4:40, legal: 34 4. Escaner: A color y B/N 5. Tipo de escáner: Por bandeja de alimentación y visor 6. Resolución de escaneo: 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi, fine 1200 dpi 7.Dimensiones: 475mm an. x 412 mm pr. x 437mm al. / 19kg 8.Requrimiento eléctrico: : 120v, 60hz, 8.7a. 9. Tipo de conexión: USB, wifi, cable de red. 10. Formato de digitalización: pdf, jpg, tiff. 11. Bandeja papel: 2 12,Panel de control a color y touch	2	Hugo Fdo. Rojas Ospina	

Jhon A. Camacho N

Entrega: cc 86079102
JHON ALEXANDER CAMACHO NOVOA
Aux. administrativo sikuany

Recibe: Hugo Fdo Rojas Ospina.
Jefe Oficina Asesora de Planeación
HMA.

Señores
HOSPITAL MINUCIPAL DE ACACIAS E.S.E
Diagonal 15 # 26-21 Barrio San José
Acacias-Meta

Asunto: informe de finalización para el contrato de suministro n°826 de 2024

Tenemos el placer de presentarle el informe elaborado por nuestro equipo de especialistas de SIKUANY S.A.S. Este informe documenta la revisión, adecuación y entrega de equipos biomédicos, industriales, tecnológicos y mobiliario en las instalaciones del hospital Municipal de Acacías y del centro de salud la Independencia

ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. Entrega y recepción de equipos.
2. Revisión minuciosa de documentación.
3. Instalación de equipos.
4. Socialización y capacitación al personal.

ENTREGA Y RECEPCIÓN.

Se realiza la entrega de los equipos biomédicos, industriales, tecnológicos y mobiliario en las sedes correspondientes. Haciendo constar


- Verificación de cantidades
- Inspección visual del estado de los equipos

Evidencia fotográfica.

INFANTOMETROS



BALANZAS PESA BEBÉ

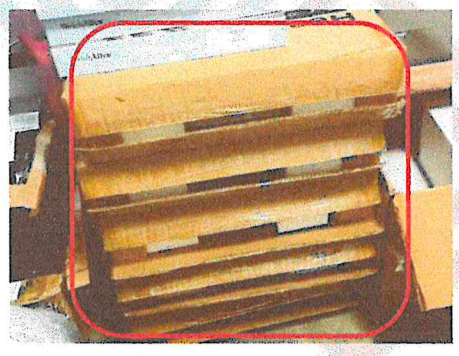


TALLIMETROS




BASCULAS DE PISO.



FONENDOSCOPIOS.

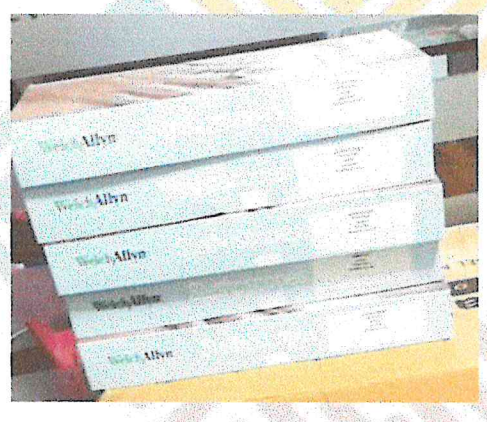

TENSIOMETRO DE PARED.

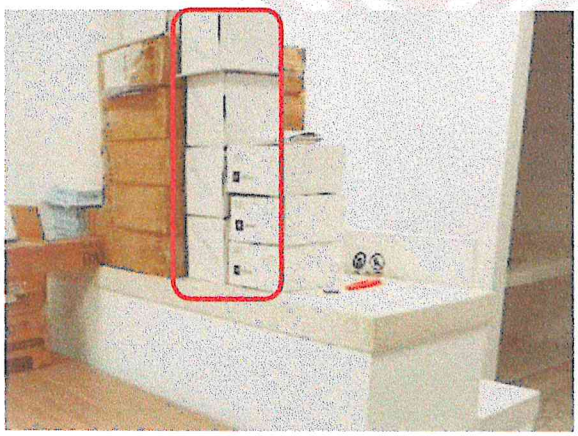


Calle 26 B No. 38 - 76 Barrio Siete de Agosto
TELÉFONO: (608) 6 0611620
Email: sikuanyltda@hotmail.com
Sitio web: http://www.sikuany.com.co
VILLAVICENCIO - META

EQUIPO DE ORGANOS DE PARED.



LAMPARA DE FOTOCURADO

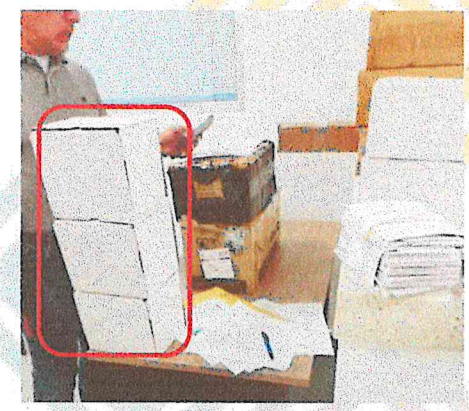

INSTRUMENTAL BASICO ODONTOLOGICO



Calle 26 B No. 38 - 76 Barrio Siete de Agosto
TELÉFONO: (608) 6 0611620
Email: sikuanyltda@hotmail.com
Sitio web: http://www.sikuany.com.co

Sikuany SAS
Red de servicios farmacéuticos

INSTRUMENTAL PEQUEÑA CIRUGIA



UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA




UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL



Calle 26 B No. 38 - 76 Barrio Siete de Agosto
TELÉFONO: (608) 6 0611620
Email: sikuanyltda@hotmail.com
Sitio web: http://www.sikuany.com.co
VILLAVICENCIO – META

CAVITRON

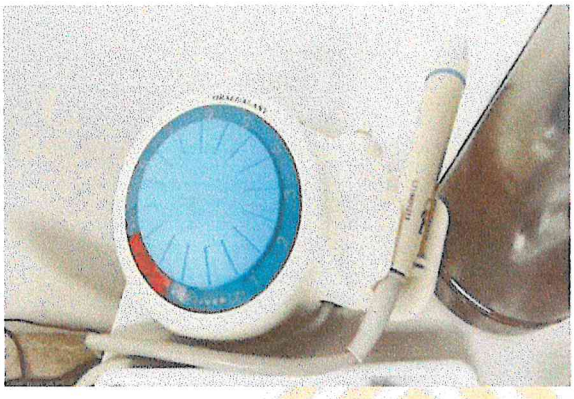

KIT DE PIEZAS DE MANO



DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA)




Calle 26 B No. 38 - 76 Barrio Siete de Agosto
TELÉFONO: (608) 6 0611620
Email: sikuanyltda@hotmail.com
Sitio web: http://www.sikuany.com.co
VILLAVICENCIO – META

LAMPARA CUELLO DE CISNE



CAMILLA DIVAN RECLINABLE

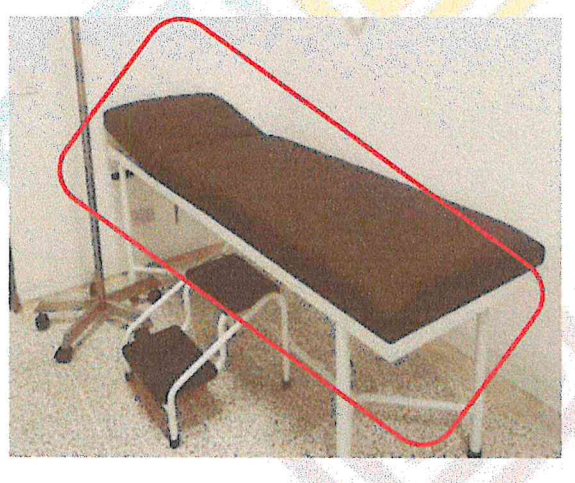


ESCALERILLA DE DOS PASOS



Calle 26 B No. 38 - 76 Barrio Siete de Agosto
TELÉFONO: (608) 6 0611620
Email: sikuanyltda@hotmail.com
Sitio web: http://www.sikuany.com.co
VILLAVICENCIO – META

BUTACO

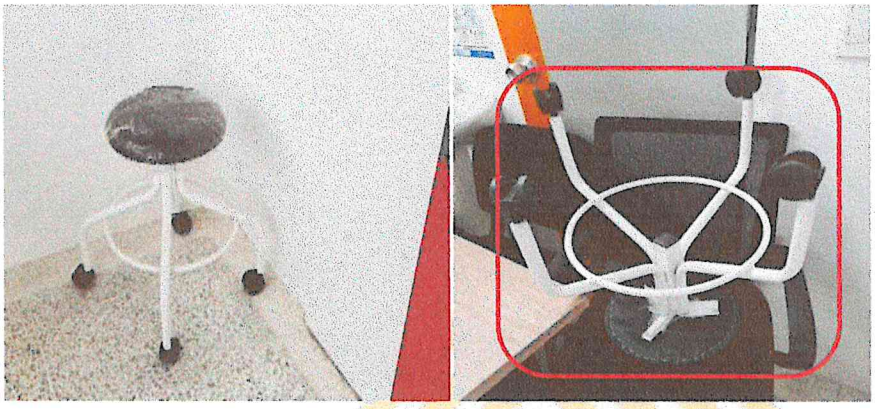

ATRIL RODABLE




BIOMBO DE TRES CUERPOS




Calle 26 B No. 38 - 76 Barrio Siete de Agosto
TELÉFONO: (608) 6 0611620
Email: sikuanyltda@hotmail.com
Sitio web: http://www.sikuany.com.co
VILLAVICENCIO - META

Sikuany SAS
Red de servicios farmacéuticos

SILLA PARA MEDICO

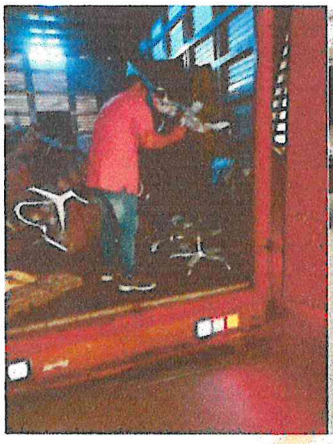


SILLA INTERLOCUTORA

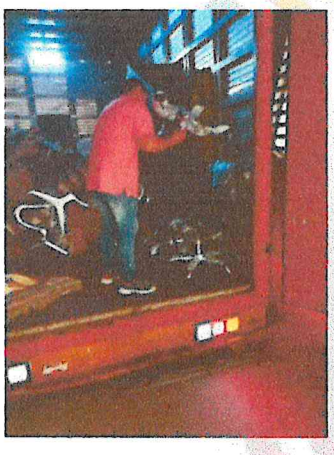


ESCRITORIO




Calle 26 B No. 38 - 76 Barrio Siete de Agosto
TELÉFONO: (608) 6 0611620
Email: sikuanyltda@hotmail.com
Sitio web: http://www.sikuany.com.co
VILLAVICENCIO - META

DIVAN GINECOLOGICO



CARRO DE PARO



TANDEM DE CUATRO PUESTO







Calle 26 B No. 38 - 76 Barrio Siete de Agosto
TELÉFONO: (608) 6 0611620
Email: sikuanyltda@hotmail.com
Sitio web: http://www.sikuany.com.co
VILLAVICENCIO - META

AIRES ACONDICINADO



AUTOCLABE



COMPUTADORES



IMPRESORA



Calle 26 B No. 38 - 76 Barrio Siete de Agosto
TELÉFONO: (608) 6 0611620
Email: sikuanyltda@hotmail.com
Sitio web: http://www.sikuany.com.co
VILLAVICENCIO - META

REVISIÓN MINUCIOSA DE DOCUMENTACIÓN.

Se realiza la entrega de la documentación requerida para cada uno de los equipos biomédicos, industriales y tecnológicos.

- Hojas de vida de equipos biomédicos
- Certificados de mantenimiento preventivo
- Manuales de uso o servicio
- Registro invima
- Fichas técnicas
- Certificados de calibración metrológica
- Certificado de importación
- Actas de capacitación
- Cronograma de mantenimiento y calibración

Evidencia fotográfica.



Calle 26 B No. 38 - 76 Barrio Siete de Agosto
TELÉFONO: (608) 6 0611620
Email: sikuanyltda@hotmail.com
Sitio web: http://www.sikuany.com.co
VILLAVICENCIO – META

INSTALACION DE EQUIPOS.

Se realiza la adecuación de las instalaciones eléctricas para garantizar el buen funcionamiento de los equipos de aire acondicionado, aire comprimido y esterilización.se ubican y configuran los equipos de cómputo en cada punto correspondiente, estas configuraciones aseguran que los equipos estén completamente operativos y funcionales para la operación continua.

- Puntos de suministro electico
- Soportes para equipos industriales y biomédicos.
- Drenajes
- Equipo de aire comprimido odontológico
- Líneas de aire presurizado

Evidencia fotográfica.





Calle 26 B No. 38 - 76 Barrio Siete de Agosto
TELÉFONO: (608) 6 0611620
Email: sikuanyltda@hotmail.com
Sitio web: http://www.sikuany.com.co
VILLAVICENCIO - META




Se instalan baterías (9v x1) y se verifica el correcto funcionamiento de las básculas pesa bebé




Se instalan baterías (AAAx2) y se verifica el correcto funcionamiento de las básculas digitales




Calle 26 B No. 38 - 76 Barrio Siete de Agosto
TELÉFONO: (608) 6 0611620
Email: sikuanyltda@hotmail.com
Sitio web: http://www.sikuany.com.co
VILLAVICENCIO - META

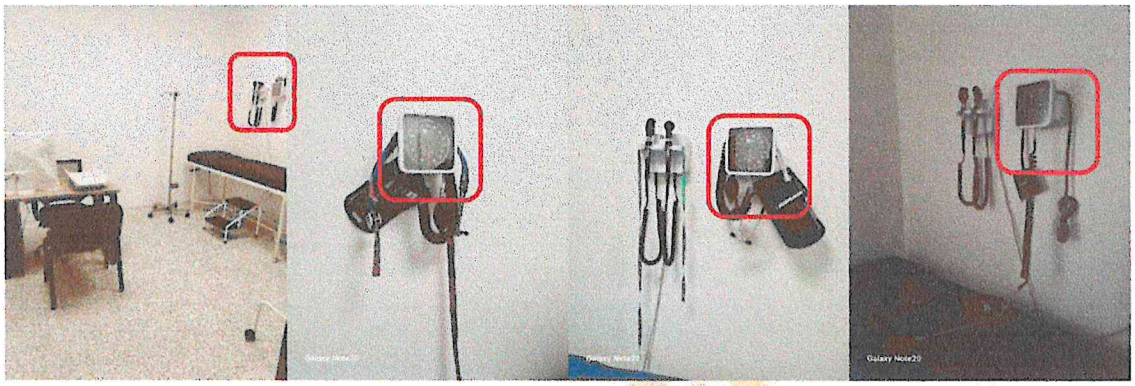

Se instalan pernos metálicos para la correcta sujeción de los tensiómetros

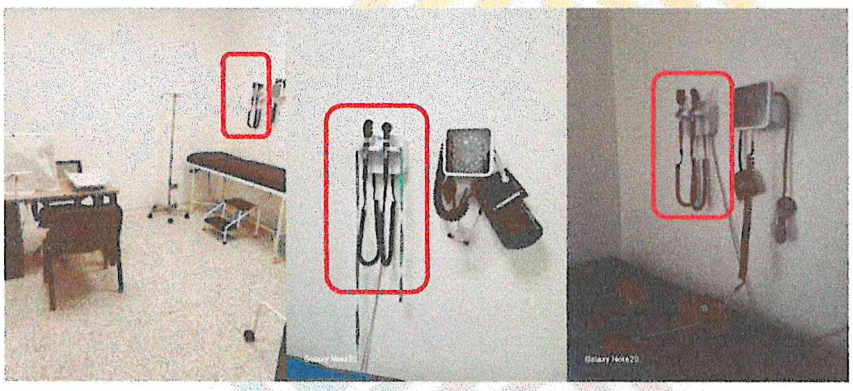

Se instalan pernos metálicos para la correcta sujeción de los equipos de órganos

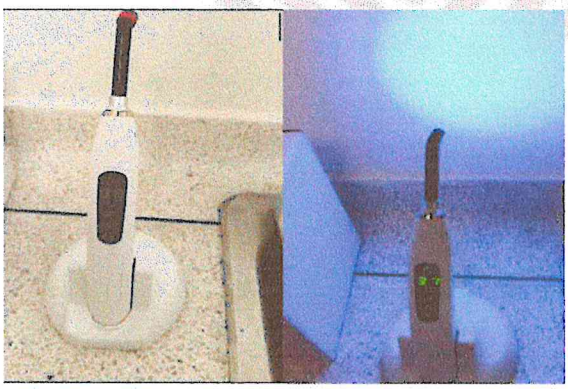







Durante la inspección se evidencia la falta de alimentación eléctrica en los puntos de conexión para las unidades odontológicas fijas, fue necesario emplear extensiones eléctricas calibre 18 con su respectivo polo a tierra.



Sikuany SAS
Red de servicios farmacéuticos










Calle 26 B No. 38 - 76 Barrio Siete de Agosto
TELÉFONO: (608) 6 0611620
Email: sikuanyltda@hotmail.com
Sitio web: http://www.sikuany.com.co
VILLAVICENCIO - META

Sikuany SAS
Red de servicios farmacéuticos







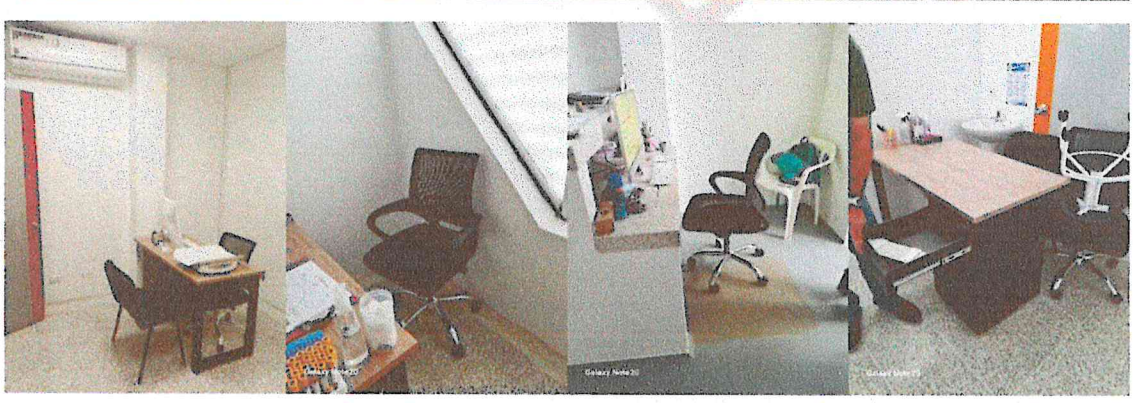

Calle 26 B No. 38 - 76 Barrio Siete de Agosto
TELÉFONO: (608) 6 0611620
Email: sikuanyltda@hotmail.com
Sitio web: http://www.sikuany.com.co
VILLAVICENCIO - META

Sikuany SAS
Red de servicios farmacéuticos









Calle 26 B No. 38 - 76 Barrio Siete de Agosto
TELÉFONO: (608) 6 0611620
Email: sikuanyltda@hotmail.com
Sitio web: http://www.sikuany.com.co
VILLAVICENCIO - META

Sikuany SAS
Red de servicios farmacéuticos









Como parte de las mejoras del sistema de climatización, se instaló tubería en PVC de 1/2" con protección UV para el drenaje de cada uno de los equipos

Calle 26 B No. 38 - 76 Barrio Siete de Agosto
TELÉFONO: (608) 6 0611620
Email: sikuanyltda@hotmail.com
Sitio web: http://www.sikuany.com.co
VILLAVICENCIO - META

Sikuany SAS
Red de servicios farmacéuticos









Calle 26 B No. 38 - 76 Barrio Siete de Agosto
TELÉFONO: (608) 6 0611620
Email: sikuanyltda@hotmail.com
Sitio web: http://www.sikuany.com.co
VILLAVICENCIO - META

Durante la inspección se evidencia la necesidad de reubicar el sistema de aire comprimido para evitar el deterioro prematuro del equipo debido a la exposición directa a las condiciones ambientales, fue necesario emplear una extensión eléctrica encauchetada calibre 14 y mangueras de alta presión de uso exterior calibre 3/8. Como resultado directo de estas acciones, se logró eliminar el ruido en los consultorios aledaños







Calle 26 B No. 38 - 76 Barrio Siete de Agosto
TELÉFONO: (608) 6 0611620
Email: sikuanyltda@hotmail.com
Sitio web: http://www.sikuany.com.co
VILLAVICENCIO - META

Sikuany SAS
Red de servicios farmacéuticos









Calle 26 B No. 38 - 76 Barrio Siete de Agosto
TELÉFONO: (608) 6 0611620
Email: sikuanyltda@hotmail.com
Sitio web: http://www.sikuany.com.co
VILLAVICENCIO - META

Se llevó a cabo una verificación exhaustiva de los equipos de cómputo e impresoras, en la cual se realizaron ajustes significativos y configuraciones. Además, se verifico la vigencia de licencias, conexión a internet y funcionamiento de los accesorios como mouse y teclados.

SOCIALIZACION Y CAPACITACION.

Se realiza la socialización de la correcta limpieza, desinfección y uso de los equipos con el fin de prolongar la vida útil y garantizar el buen funcionamiento de los equipos, también así para cumplir con los criterios de garantías de los fabricantes. Además se capacita al personal y efectúan evaluaciones para evidenciar adherencia de conocimientos.

ANEXOS

Se presentan los siguientes anexos al presente informe:

ANEXO N°1 ACTAS DE ENTREGA
ANEXO N°2 CERTIFICACION BANCARIA
ANEXO N°3 COPIA ACTA DE INICIO
ANEXO N°4 PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
ANEXO N°5 CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL
ANEXO N°6 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ANEXO N°7 ACTAS DE CAPACITACION
ANEXO N°8 CERTIFICADO DE LICENCIAS MICROSOFT
ANEXO N°9 CRONOGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION
ANEXO N°10 RELACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS

Atentamente,

JHON ALEXANDER CAMACHO NOVOA
ADMINSTRATIVO SIKUANY

Sikuany SAS Red de servicios farmacéuticos	HOSPITAL MUNICIPAL ACACIAS E.S.E CAPACITACION Página: 1

ACTA DE SOCIALIZACION

ACTA DE REUNIÓN	
Tema: CARACTERISTICAS, LIEMPIEZA Y BUEN USO DEL DESFIBRILADOR AUTOMATICO EXTERNO	**Acta No 5**
Solicitud: CAPACITACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL CONTRATO 826 DEL 2024 **Realizada por: INGENIERO BIOMEDICO JHON JAIRO URBINA ZEPEDA**	**Lugar: CENTRO DE SALUD LA INDEPENDENCIA**

PUNTOS DE DISCUSION	
1	Presentación del tema de socialización
2	Presentación
3	Conclusiones y resolución de dudas

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

DA INICIO A LA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA CON EL FIN DE PROLONGAR LA VIDA UTIL DEL DESFIBRILADOR AUTOMATICO EXTERNO (DEA) POR MEDIO DE LA CORRECTA LIMPIEZA, DESINFECCION Y USO.

ResQNavi™ inteligente

En intervenciones de salvamento no profesionales, la habilidad de los rescatadores en el proceso de reanimación es muy variable. Los que carecen de experiencia en reanimación necesitan un asesoramiento más detallado, mientras que las indicaciones demasiado complicadas podrían reducir la eficiencia de los rescatadores.

Basándose en numerosas investigaciones sobre comportamientos y datos psicológicos de los usuarios, la tecnologíaResQNavi™ puede identificar la condición de cada rescatador y proporcionar instrucciones paso a paso apropiadas para el rescatador en cuestión durante todo el proceso de reanimación.

Guía de salvamento interactiva

BeneHeart C1A sabe qué necesita. Cuando el rescatador está muy nervioso o es inexperto y tarda en colocar los parches, ResQNavi™ es capaz de reconocer el problema y proporciona instrucciones más detalladas mediante voz.



Rengo de energía por defecto

200 – 300 - 360 J (adulto)

50 - 70 - 100 J (pediátrico)



Cómo se acelera la aplicación de la primera descarga con la tecnología QShock™

QShock™ no solo acorta en gran medida el tiempo de encendido y el análisis del ritmo cardíaco, sino que además realiza una precarga sincrónica en el proceso de análisis del ritmo cardíaco.
Una vez completado el análisis del ritmo, se puede suministrar energía inmediatamente, para que las víctimas reciban una descarga eléctrica lo antes posible, y los rescatadores trabajen con menos estrés.






Soporte de capacitación

SE DA POR FINALIZADA LA CAPACITACION SE RESUELVEN DUDAS SOBRE LOS TEMAS SOCIALIZADOS Y SE REALIZA EVALUCION PARA MEDICION DE ADHERENCIA DE CONOCIMIENTOS.



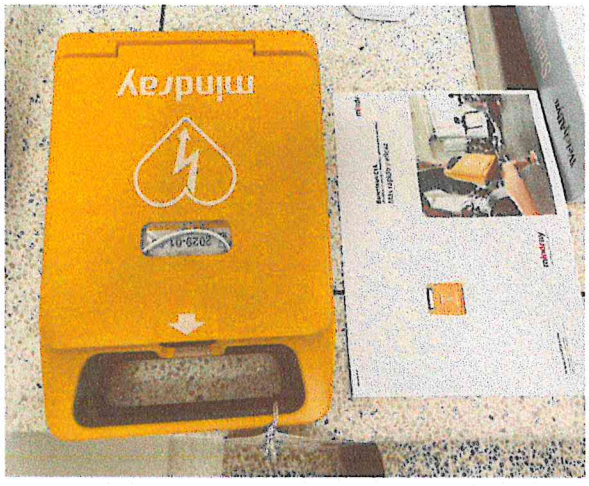


mindray

Sikuany SAS Red de servicios farmaceuticos	HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E	
	FORMATO ACTA DE REUNIONES Y/O CAPACITACIONES	Página 1 de 1

ACTA DE REUNIÓN	
Tema: Formato de Asistencia	Acta No 005
Citada por: hospital municipal de acacias e.s.e	Equipo: DEA
Lugar: hospital municipal de acacias e.s.e	

PARTICIPANTES				
No.	Nombre	Cargo	Teléfono	Firma
1	Alexandra Margo Gómez	Médico	3208506999	Alexandra Margo
2	Jair Steven Mayorga G	Coor. Asistencial	3105802782	
3.	Dayanne Yurissa Herrera	Medico SSO	3204313189	

Sikuany SAS Red de servicios Farmacéuticos	HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E	5/6
	ACACÍAS-META	
	EVALUACION DE INDUCCION O REINDUCCION	Página 1 de 1
EVALUACION (UNICA RESPUESTA)		

1. ¿Cuáles son los partes que compone el equipo?

   a) cable de poder, electrodos, batería
   b) cargador, batería, electrodos
   c) electrodos, batería, consola central ✓
   d) Bandeja, soporte ,batería, cable de poder

2. ¿Qué protección tiene el equipo?

   a) IP55
   b) IP100 ✓
   c) IP69
   d) ninguna

3. ¿Cuántas veces se pueden reutilizar los electrodos?

   a) 10 veces
   b) Hasta que pierdan el adhesivo ✓
   c) Ninguna porque son desechables
   d) 2 veces

4. ¿Cuáles son los niveles de energía para paciente pediátrico?

   a) 5, 15, 50 julios
   b) 10 , 20, 50 julios ✗
   c) 50, 70, 200 julios
   d) 50, 70, 100 julios

5. ¿Cuáles son los niveles de energía para paciente adulto?

   a) 50, 100, 250 julios
   b) 80, 150, 300 julios
   c) 200, 300,360 julios ✓
   d) 200, 250, 350 julios

6. ¿Cuándo se debe usar el DEA?

   a) Paciente presenta una fractura
   b) Paciente inconsciente o con dificulta para respirar ✓
   c) Paciente desorientado
   d) Todo lo anterior

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	SEDE	FIRMA
TRABAJADOR:	Alexandra Marcela Gamez	medico	Resto de salud. Independencia Acacias	Alexandra Marcela Gamez
CALIFICÓ:				

Sikuany SAS Red de servicios farmacéuticos	HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E	6/6
	ACACÍAS-META	
	EVALUACION DE INDUCCION O REINDUCCION	Página 1 de 1
EVALUACION (UNICA RESPUESTA)		

1. ¿Cuáles son los partes que compone el equipo?

   a) cable de poder, electrodos, batería
   b) cargador, batería, electrodos
   c) electrodos, batería, consola central ✓
   d) Bandeja, soporte ,batería, cable de poder

2. ¿Qué protección tiene el equipo?

   a) IP55 ✓
   b) IP100
   c) IP69
   d) ninguna

3. ¿Cuántas veces se pueden reutilizar los electrodos?

   a) 10 veces
   b) Hasta que pierdan el adhesivo
   c) Ninguna porque son desechables ✓
   d) 2 veces

4. ¿Cuáles son los niveles de energía para paciente pediátrico?

   a) 5, 15, 50 julios
   b) 10 , 20, 50 julios
   c) 50, 70, 200 julios
   d) 50, 70, 100 julios ✓

5. ¿Cuáles son los niveles de energía para paciente adulto?

   a) 50, 100, 250 julios
   b) 80, 150, 300 julios
   c) 200, 300,360 julios ✓
   d) 200, 250, 350 julios

6. ¿Cuándo se debe usar el DEA?

   a) Paciente presenta una fractura
   b) Paciente inconsciente o con dificulta para respirar ✓
   c) Paciente desorientado
   d) Todo lo anterior

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	SEDE	FIRMA
TRABAJADOR:	Jair Steven Payonga G	Coor. Urgencias	HMA	
CALIFICÓ:				

Sikuany SAS	HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E	5/6
	ACACÍAS-META	
	EVALUACION DE INDUCCION O REINDUCCION	Página 1 de 1
EVALUACION (UNICA RESPUESTA)		

1. ¿Cuáles son los partes que compone el equipo?

   a) cable de poder, electrodos, batería
   b) cargador, batería, electrodos
   c) electrodos, batería, consola central ✓
   d) Bandeja, soporte ,batería, cable de poder

2. ¿Qué protección tiene el equipo?

   a) IP55 ✓
   b) IP100
   c) IP69
   d) ninguna

3. ¿Cuántas veces se pueden reutilizar los electrodos?

   a) 10 veces
   b) Hasta que pierdan el adhesivo ✓
   c) Ninguna porque son desechables
   d) 2 veces

4. ¿Cuáles son los niveles de energía para paciente pediátrico?

   a) 5, 15, 50 julios
   b) 10 , 20, 50 julios ✓
   c) 50, 70, 200 julios
   d) 50, 70, 100 julios

5. ¿Cuáles son los niveles de energía para paciente adulto?

   a) 50, 100, 250 julios
   b) 80, 150, 300 julios X
   c) 200, 300,360 julios
   d) 200, 250, 350 julios

6. ¿Cuándo se debe usar el DEA?

   a) Paciente presenta una fractura
   b) Paciente inconsciente o con dificulta para respirar ✓
   c) Paciente desorientado
   d) Todo lo anterior

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	SEDE	FIRMA
TRABAJADOR:	Dayanne Yurissa Herrera Rodriguez	Medico SSO	Independencia	
CALIFICÓ:				

Sikuany SAS Red de servicios farmacéuticos	HOSPITAL MUNICIPAL ACACIAS E.S.E CAPACITACION Página: 1

ACTA DE SOCIALIZACION


ACTA DE REUNIÓN	
Tema: CARACTERISTICAS, LIEMPIEZA Y BUEN USO DEL COMPRESOR ODONTOLOGICO	**Acta No 2**
Solicitud: CAPACITACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL CONTRATO 826 DEL 2024 **Realizada por: INGENIERO BIOMEDICO JHON JAIRO URBINA ZEPEDA**	**Lugar: CENTRO DE SALUD LA INDEPENDENCIA**

PUNTOS DE DISCUSION	
1	Presentación del tema de socialización
2	Presentación
3	Conclusiones y resolución de dudas

DESARROLLO DE LA REUNIÓN


SE DA INICIO A LA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA CON EL FIN DE PROLONGAR LA VIDA UTIL DEL COMPRESOR POR MEDIO DEL CORRECTO USO.


Compresor dental Remac-Dent

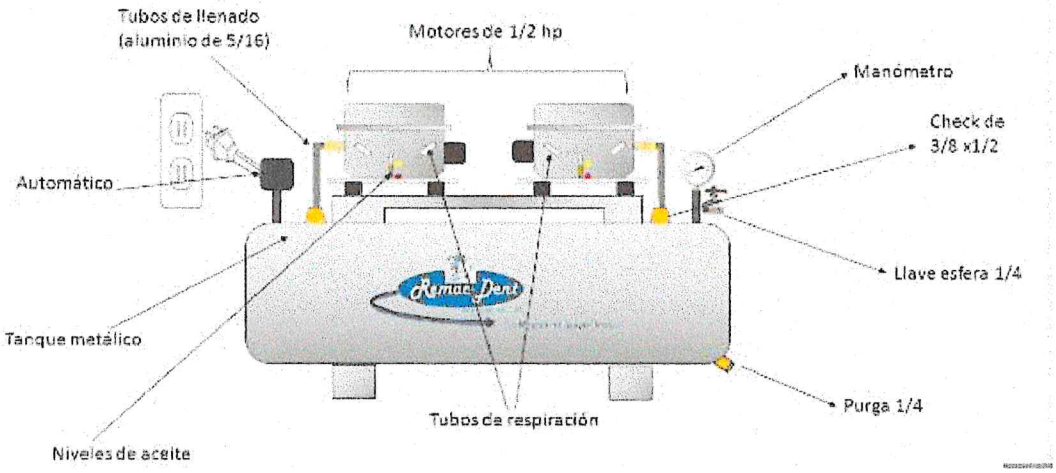


Mantención

1. Para garantizar la seguridad, el compresor de aire no tiene que tocar ninguna parte de la máquina mientras esté operando.
2. Esta máquina posee un compresor libre de aceite y por consiguiente no requiere aceite lubricante.
3. La temperatura de funcionamiento es de entre 5 y 40°C.
4. Corte la energía del compresor cuando esté limpiándolo, y no le rocíe agua. A su vez, solo debe utilizar una tela suave y seca para remover el polvo. Sea cuidadoso, no dañe ninguno de los componentes.
5. Corte la energía cuando el compresor de aire no esté siendo utilizado.

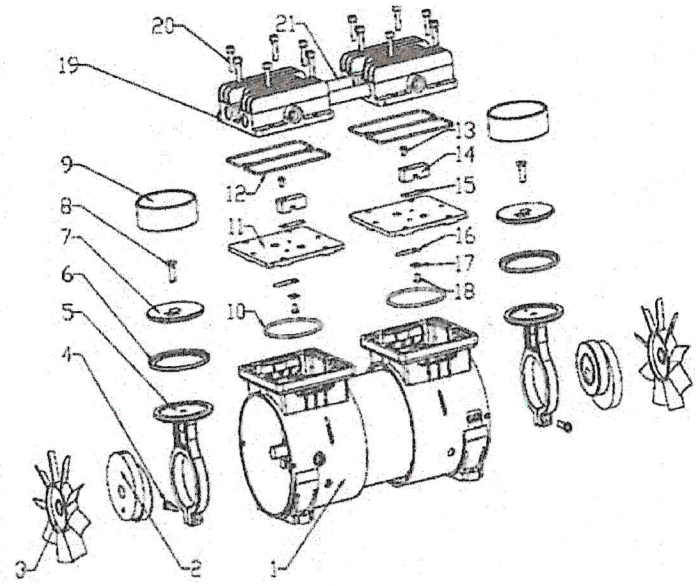

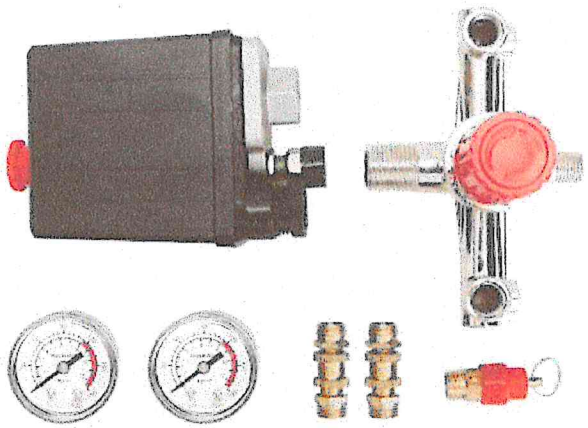


4. Caracteristica Principal

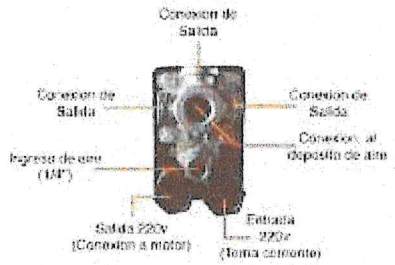

Conexion de salida: Manguera, Manometro, valvula de alivio.

5.Conexion electrica Monofasica 220v

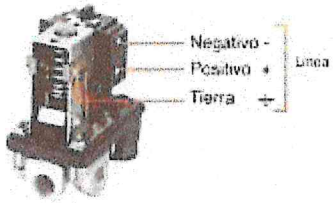

Soporte de capacitación

SE DA POR FINALIZADA LA CAPACITACION SE RESUELVEN DUDAS SOBRE LOS TEMAS SOCIALIZADOS Y SE REALIZA EVALUCION PARA MEDICION DE ADHERENCIA DE CONOCIMIENTOS.

	HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS	
Sikuany SAS	FORMATO ACTA DE REUNIONES Y/O CAPACITACIONES	Página 1 de 1

ACTA DE REUNIÓN	
Tema: Formato de Asistencia	Acta No 002
Citada por: hospital municipal de acacias e.s.e	Equipo: Compresor
Lugar: centro de salud la independencia	

PARTICIPANTES				
No.	Nombre	Cargo	Teléfono	Firma
	Martha Milena Piedrahita	Higienista Oral	3102274565	
	Maria Jose Cepeda	Odontologa	3123146675	

Sikuany SAS	HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS	5/5
	LA INDEPENDENCIA	
	EVALUACION DE INDUCCION O REINDUCCION	Página 1 de 1
EVALUACION (UNICA RESPUESTA)		

1. ¿Cuándo se debe drenar el compresor?

a) Entre paciente y paciente
b) Al finalizar la jornada laboral ✓
c) Cuando se llene el tanque
d) Una vez al mes

2. ¿Qué protección tiene el equipo?

a) Control de presión y válvula de alivio ✓
b) Registros para el paso del aire
c) Alarma de temperatura
d) ninguna

3. ¿Cuáles son los límites de presión del compresor?

a) 10 psi / 90psi
b) 40 psi / 70 psi ✓
c) 25 psi / 50 psi
d) Ninguna de las anteriores

4. ¿Cuáles son las partes del compresor?

a) Motor, tanque, presostato, filtros y acoples
b) Motor, tanque, cables, mangueras ✓
c) Pedal, motor ,filtros y mangueras
d) Ninguna de las anteriores

5. ¿Qué función cumple el presostato?

a) Impedir el paso del agua generada por condensación
b) Retener la presión del tanque ✓
c) Liberar el aire comprimido
d) Interrumpir el flujo eléctrico.

..

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	SEDE	FIRMA
TRABAJADOR:	Maria Jose Cepeda.	Odontologa	Independencia	
CALIFICÓ:	Ivan Jairo Urbina Zapata	Ing Biomedico	Sikuany	

Sikuany SAS	HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS	5/5
	LA INDEPENDENCIA	
	EVALUACION DE INDUCCION O REINDUCCION	Página 1 de 1
EVALUACION (UNICA RESPUESTA)		

1. ¿Cuándo se debe drenar el compresor?

   a) Entre paciente y paciente
   (b) Al finalizar la jornada laboral ✓
   c) Cuando se llene el tanque
   d) Una vez al mes

2. ¿Qué protección tiene el equipo?

   (a) Control de presión y válvula de alivio ✓
   b) Registros para el paso del aire
   c) Alarma de temperatura
   d) ninguna

3. ¿Cuáles son los límites de presión del compresor?

   a) 10 psi / 90psi
   (b) 40 psi / 70 psi ✓
   c) 25 psi / 50 psi
   d) Ninguna de las anteriores

4. ¿Cuáles son las partes del compresor?

   (a) Motor, tanque, presostato, filtros y acoples ✓
   b) Motor, tanque, cables, mangueras
   c) Pedal, motor ,filtros y mangueras
   d) Ninguna de las anteriores

5. ¿Qué función cumple el presostato?

   a) Impedir el paso del agua generada por condensación
   b) Retener la presión del tanque
   c) Liberar el aire comprimido ✓
   (d) Interrumpir el flujo eléctrico.

..

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	SEDE	FIRMA
TRABAJADOR:	Martha Piedad Ortiz	Higienista O.	Hospital	
CALIFICÓ:	Ivan Jaime Ubaque Zapata	Ing Biomedico	Silkuny	

ACTA DE SOCIALIZACION

ACTA DE REUNIÓN	
Tema: LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y BUEN USO DEL CAVITRON ULTRASONICO	**Acta No 1**
Solicitud: CAPACITACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL CONTRATO 826 DEL 2024 **Realizada por: INGENIERO BIOMEDICO JHON JAIRO URBINA ZEPEDA**	**Lugar: CENTRO DE SALUD LA INDEPENDENCIA**

	PUNTOS DE DISCUSION
1	Presentación del tema de socialización
2	Presentación
3	Conclusiones y resolución de dudas

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

SE DA INICIO A LA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA DE ODONTOLOGIA CON EL FIN DE PROLONGAR LA VIDA UTIL DEL CAVITRON ULTRASONICO Y SUS RESPECTIVAS PUNTAS POR MEDIO DE LA CORRECTA LIMPIEZA, DESINFECCION Y USO.

3.2 Uso previsto

Un dispositivo energizado utilizando una punta ultrasónica vibratoria para remover cálculos y otras acumulaciones de la superficie de los dientes durante la limpieza dental, terapia periodontal y tratamiento del canal radicular.


3.3 Contraindicación

3.3.1 Los enfermos con enfermedad de hemofilia o pacientes con trombocitopenia púrpura tienen prohibido usar este equipo.


3.3.2 Los pacientes o doctores con marcapasos tienen prohibido usar este equipo.


3.3.3 Los enfermos del corazón, mujeres embarazadas y niños deberían ser cautelosos para usar el equipo.

1.3.5 Dibujo de instalación de insertos y mandril con llave para endodoncias

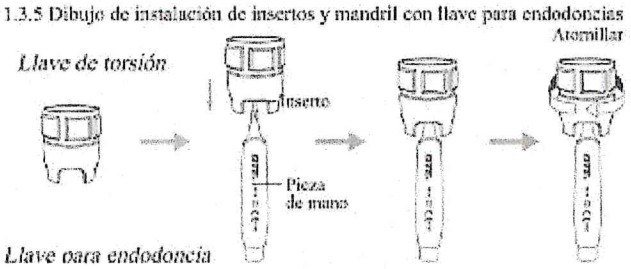

Mapa esquemático para saber cómo instalar la punta

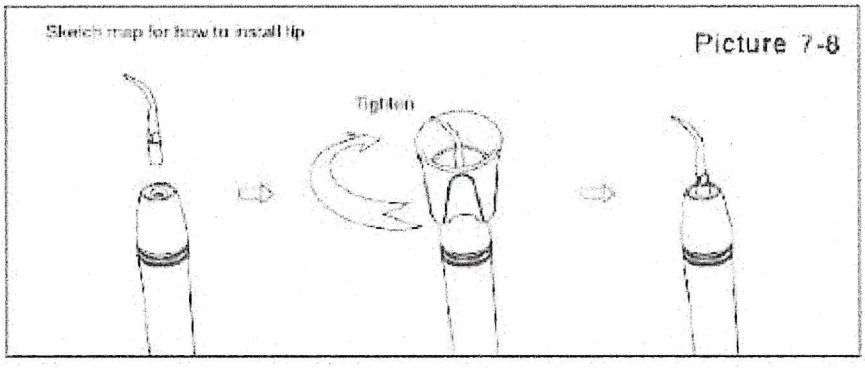

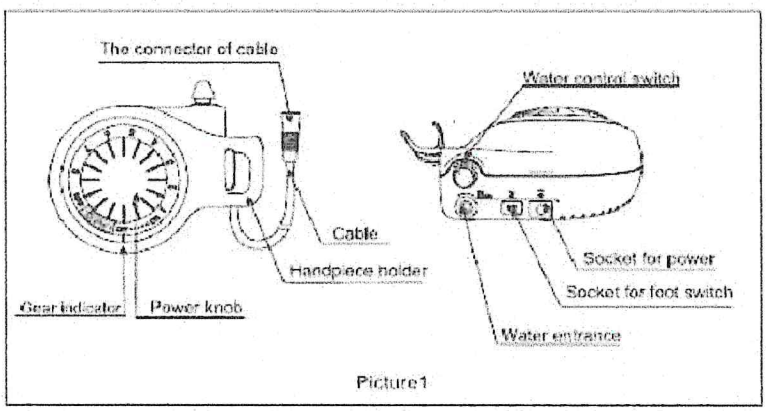

Picture1

The connector of cable – Cable para conexión

Power knob – Botón para encender

Gear indicator – Indicador de engrane

Handpiece holder – Soporte de la pieza de mano


Cable – Cable

Water control switch – Interruptor para control del agua

Water entrance – Entrada de agua

Socket for power- Enchufe para toma de corriente

Socket for foot switch – Enchufe para el interruptor de pedal

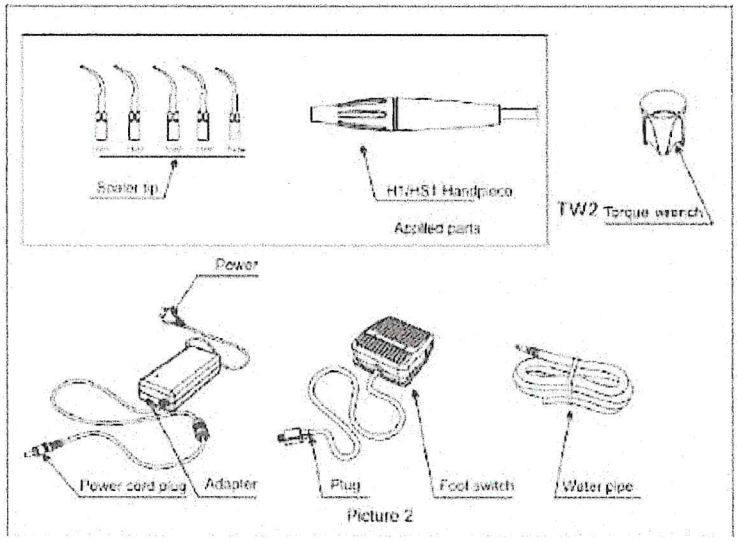

Picture 2

Scaler tip – Puntas del escareador

H1/HS1 Handpiece – Pieza de mano H1/HS1

Power – Cable de alimentación eléctrica

Power cord plug - Enchufe del cable de alimentación

Adapter - Adaptador

Plug – Enchufe

Foot switch – Interruptor de pedal

Water pipe – Conducto de agua

Torque wrench - Llave de torsión

5. PRECAUCIONES

5.1 Tener en cuenta cuando se utilice el equipo

5.1.1 Mantener el aparato limpio antes y después de cada utilización.

5.1.2 Es imprescindible esterilizar los insertos, la llave, y la pieza manual antes de cada utilización.

5.1.3 No enroscar o desenroscar los insertos cuando se tiene el pie sobre el pedal de control.

5.1.4 Enroscar el inserto y es imprescindible tener agua que sale del inserto durante la operación.

5.1.5 Cuando la punta y la lima ultrasónica están dañadas o demasiado gastadas es necesario cambiarlas por otras nuevas.

5.1.6 No torcer ni frotar los insertos.

5.1.7 No utilizar fuente de agua impura y asegurarse de no utilizar agua del mar en lugar de una fuente de agua pura.

5.1.8 En caso de utilización de una fuente de agua sin presión, la superficie de agua debe ser un metro más alto que una cabeza del paciente.

5.1.9 Asegurarse de que el conector de la pieza de mano y el enchufe del cable estén secos antes de instalar la pieza de mano.

5.1.10 No tirar con fuerza del cable en caso de que la pieza de mano se desprenda del cable.

5.1.11 No golpear o frotar.

5.1.12 Tras la operación, desconectar la corriente y sacar el enchufe.

5.1.13 El fabricante no se responsabiliza en caso de incumplimiento de las siguientes condiciones de utilización:

- El mantenimiento, las reparaciones y las modificaciones las realiza el fabricante o los distribuidores autorizados.
- Los componentes que hay que cambiar proceden del fabricante de origen y funcionan según el manual de utilización.

5.1.14 La rosca interna del tornillo de las puntas de eliminación de sarro

Soporte de capacitación

SE DA POR FINALIZADA LA CAPACITACION SE RESUELVEN DUDAS SOBRE LOS TEMAS SOCIALIZADOS Y SE REALIZA EVALUCION PARA MEDICION DE ADHERENCIA DE CONOCIMIENTOS.

Sikuany SAS	**HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS**	
	FORMATO ACTA DE REUNIONES Y/O CAPACITACIONES	Página 1 de 1

ACTA DE REUNIÓN	
Tema: Formato de Asistencia	**Acta No 001**
Citada por: hospital municipal de acacias e.s.e	**Equipo: Cavitron**
Lugar: centro de salud la independencia	

PARTICIPANTES				
No.	**Nombre**	**Cargo**	**Teléfono**	**Firma**
	Martha Milena Piedrahita	Higienista Oral	3102274565	
	Maria Jose Cepeda	Odontologa	3123146675	

Sikuany SAS Red de servicios farmacéuticos	HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS	5/6
	LA INDEPENDENCIA	
	EVALUACION DE INDUCCION O REINDUCCION	Página 1 de 1
EVALUACION (UNICA RESPUESTA)		

1. ¿Cuáles son los partes que compone el equipo?

   a) Mango, manguera, cargador
   (b) Fuente de poder, pedal, lápiz ultrasónico y cabezote ✓
   c) Pedal, fuente de poder, puntas esterilizarble
   d) Bandeja, soporte ,cable de poder

2. ¿a qué temperatura se deben desinfectar las puntas metálicas

   a) 121°C
   b) 180°C
   (c) 134°C ✓
   d) 75°C

3. ¿con que herramienta se deben ajustar las puntas en el mango?

   a) Pinzas
   b) Con la mano
   c) Copa con tope X
   (d) Llave expansiva

4. ¿Qué sucede si se opera el equipo sin una adecuada irrigación de agua?

   a) Se apaga el equipo
   b) Trabaja más rápido
   (c) Se recalienta la punta ✓
   d) Proporciona menos sensibilidad

5. ¿Qué producto se utiliza en el proceso de limpieza y desinfección?

   a) cloro
   b) glutaraldehido
   c) jabón liquido ✓
   (d) eucida

6. ¿Cómo remueve los cálculos dentales?

   a) Percusión
   (b) Ondas de ultrasonido ✓
   c) Fuerza del agua
   d) Todo lo anterior

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	SEDE	FIRMA
TRABAJADOR:	Martha Rebeca Mata B	Independencia	Higiene O	Martha Mata
CALIFICÓ:	Jhon Jairo Ubaque Zapata	Ing biomedico	Sikuany	

Sikuany SAS Red de servicios farmacéuticos	HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E	4/6
	LA INDEPENDENCIA	
	EVALUACION DE INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN	Página 1 de 1
EVALUACION (UNICA RESPUESTA)		

1. ¿Cuáles son los partes que compone el equipo?

a) Mango, manguera, cargador
b) Fuente de poder, pedal, lápiz ultrasónico y cabezote ✓
c) Pedal, fuente de poder, puntas esterilizarble
d) Bandeja, soporte ,cable de poder

2. ¿a qué temperatura se deben desinfectar las puntas metálicas

a) 121°C
b) 180°C
c) 134°C ✓
d) 75°C

3. ¿con que herramienta se deben ajustar las puntas en el mango?

a) Pinzas
b) Con la mano
c) Copa con tope ✓
d) Llave expansiva

4. ¿Qué sucede si se opera el equipo sin una adecuada irrigación de agua?

a) Se apaga el equipo
b) Trabaja más rápido
c) Se recalienta la punta ✓
d) Proporciona menos sensibilidad

5. ¿Qué producto se utiliza en el proceso de limpieza y desinfección?

a) cloro
b) glutaraldehido X
c) jabón liquido
d) eucida

6. ¿Cómo remueve los cálculos dentales?

a) Percusión
b) Ondas de ultrasonido
c) Fuerza del agua X
d) Todo lo anterior

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	SEDE	FIRMA
TRABAJADOR:	Maria Jose Cepeda	Odontologa	Independencia	
CALIFICÓ:	Jhon Jairo Ubinas Zapata	Ing Biomedico	Sikuany	

Sikuany SAS Red de servicios farmacéuticos	HOSPITAL MUNICIPAL ACACIAS E.S.E
	CAPACITACION
	Página: 1

ACTA DE SOCIALIZACION


ACTA DE REUNIÓN	
Tema: CARACTERISTICAS, LIEMPIEZA, DESINFECCIÓN Y BUEN USO DEL AUTOCLAVE	**Acta No 4**
Solicitud: CAPACITACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL CONTRATO 826 DEL 2024 **Realizada por: INGENIERO BIOMEDICO JHON JAIRO URBINA ZEPEDA**	**Lugar: HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E**

PUNTOS DE DISCUSION	
1	Presentación del tema de socialización
2	Presentación
3	Conclusiones y resolución de dudas


DESARROLLO DE LA REUNIÓN

DA INICIO A LA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA CON EL FIN DE PROLONGAR LA VIDA UTIL DEL AUTOCLAVE AUTOMAT 100 LITROS POR MEDIO DE LA CORRECTA LIMPIEZA, DESINFECCION Y USO.

Autoclave AUTOMAT modelos 3000,1800, 2400, 3400, 5000, 8000, 10000 Y 15000

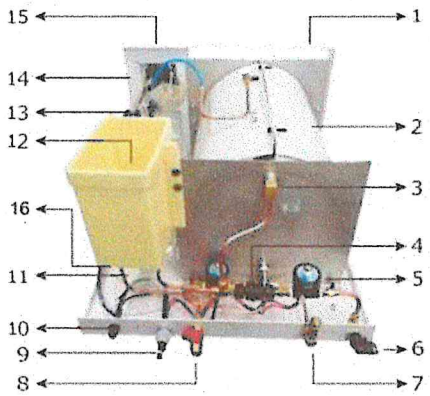

1. Puerta.
2. Resistencias (cubren la cámara del autoclave).
3. Red de flujo (salida vapor).
4. Filtro red de flujo (despresurización).
5. Válvula de despresurización.
6. Conector rápido para manguera desagüe.
7. Válvula de seguridad de sobre-presión.
8. Llave de paso tanque de reserva.
9. Cable de alimentación eléctrica.
10. Portafusible.
11. Válvula de llenado de agua a cámara.
12. Tanque de reserva de agua.
13. Ventilador.
14. Tarjeta electrónica (tarjeta principal).
15. Pantalla de control y visualización.
16. Bomba de Vacío (**Opcional**).

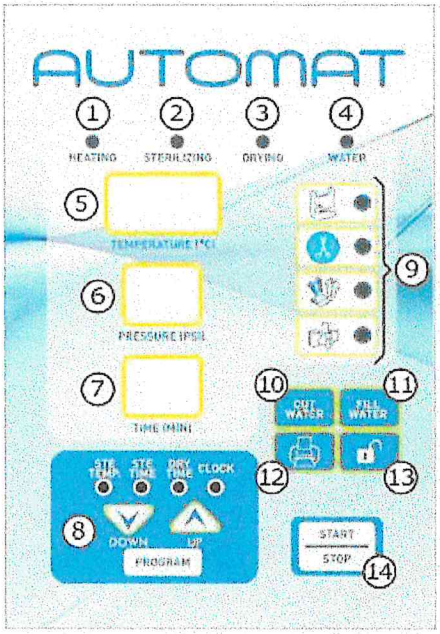

ITEM	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1	HEATING	LED indicador de la etapa de calentamiento.
2	STERILIZING	LED indicador de la etapa de esterilización.
3	DRYING	LED indicador de la etapa de secado.
4	WATER	LED indicador de tanque de reserva sin agua. Sólo aplica para los autoclaves ensamblados con sensor de nivel en el tanque de reserva.
5	DISPLAY NUMERICO	Visualización de temperatura en °C. Resolución ±1°C.
6	DISPLAY NUMERICO	Visualización de presión en PSI. Resolución de ±1 PSI.
7	DISPLAY NUMERICO	Visualización de tiempo en minutos.
8	BOTON PROGRAM	Permite navegar en el menú de programación de parámetros para modificar la temperatura y tiempo de las fases de esterilización y secado. También permite configurar la fecha y hora del equipo.
	BOTONES	Permite aumentar o disminuir el valor de una variable o parámetro seleccionado cuando se está en el menú de programación.
9	BOTONES DEL MENÚ DE PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN	Instrumental envuelto o empacado.
		Instrumental libre o sin empaque.
		Ropa, telas y gasas.
		Líquidos, medios de cultivo o envases de vidrio/cerro.
10	CUT WATER	Botón inhabilitado.
11	FILL WATER	Botón que permite el llenado de agua de la cámara desde el tanque de reserva. El llenado de la cámara requiere supervisión continua del usuario.
12	BOTON IMPRESORA	Imprime el registro de los datos de temperatura y tiempo minuto a minuto con la respectiva fecha y hora de terminación del ciclo de esterilización. La impresión debe realizarse una vez finalice el ciclo de esterilización sin antes haber abierto el autoclave, si se apaga el equipo antes de imprimir, se pierden los datos del proceso. El papel de la impresora es papel comercial térmico 57mm x 10m. No se deben poner rollos de papel más largo ya que estos no entrarán en el compartimento de la impresora.
13	BOTON DESBLOQUEO	Presione para despresurizar la cámara una vez que haya culminado el ciclo de esterilización y para desbloquear el equipo en caso de errores.
14	BOTON START / STOP	Iniciar ciclo de esterilización – Detener ciclo de esterilización.

MODELO AUTOMAT 10000 – 100 LITROS	
Voltaje de línea	220V
Corriente de entrada	17 Amperios
Consumo de potencia	3800 Vatios +/- 10 %
Breakers del circuito	20 Amperios
Medidas externas	Ancho: 78,0 cm Alto: 65,0 cm Largo: 85,0 cm
Medidas internas de cámara redonda	Diámetro: 45,0 cm Profundidad: 70,0 cm

CARACTERÍSTICAS DEL VAPOR SATURADO

El vapor saturado es parecido al aire con un 100% de humedad relativa. La calidad del vapor es medida en términos de presencia de agua como mezcla sobresaturada comparada con el vapor seco o sobrecalentado. Los estándares de calidad actuales sugieren que un volumen de vapor se considera saturado cuando su mezcla vapor-agua es mayor al 97%, es decir, que el vapor usado para esterilizar debe contener menos de un 3% de agua líquida en la mezcla.

El vapor saturado tiene una propiedad importante: la presión ejercida es uniforme para una determinada temperatura, esto es, ejerce la misma fuerza sobre todas las superficies y varía en proporción directa con la temperatura, mientras mayor sea la temperatura habrá mayor presión dentro del contenedor y viceversa.

De acuerdo a esta propiedad y asegurando que se tiene vapor saturado dentro del autoclave, se puede determinar la presión del vapor a partir de la temperatura como se ilustra en la siguiente tabla:

TEMPERATURA	PRESIÓN RELATIVA (MANOMÉTRICA)
121 °C	18 – 20 PSI (124 – 138 kPa)
123 °C	20 – 22 PSI (138 – 152 kPa)
*134 °C	32 – 34 PSI (220 – 234 kPa)

TABLA 1. PROGRAMAS Y PARÁMETROS DE OPERACIÓN

No.	PROGRAMA	Temperatura de Esterilización	Tiempo de esterilización	Temperatura de Secado	Tiempo de secado
1	Instrumental empacado	123 °C	20 min	98°C	20min
2	Instrumental sin empacar	121 °C	20 min	98°C	20min
3	Ropa, telas, gasas	123 °C	15 min	98°C	20min
4	Líquidos y envases *	121 °C	20 min	98°C	10min

Soporte de capacitación

SE DA POR FINALIZADA LA CAPACITACION SE RESUELVEN DUDAS SOBRE LOS TEMAS SOCIALIZADOS Y SE REALIZA EVALUCION PARA MEDICION DE ADHERENCIA DE CONOCIMIENTOS.







Sikuany SAS Red de servicios farmacéuticos	HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E	7/7
	ACACÍAS-META	
	EVALUACION DE INDUCCION O REINDUCCION	Página 1 de 1
EVALUACION (UNICA RESPUESTA)		

1. ¿Cuáles son los parámetros físicos más comunes para llevar a cabo un ciclo de esterilización por calor húmedo?

a) 2h A 180°C
b) 24h A 37°C
c) 8 min. 134°C ✓
d) 24°C 70% humedad

2. ¿Qué tipos de material se pueden esterilizar por vapor húmedo?

a) Todo tipo de material
b) Instrumental quirúrgico, aceites, grasas, polvos termoestables y material de vidrio ✓
c) Plástico, guantes, agujas, jeringas, cánulas en su envase definitivo
d) Ropa textil, gasas, instrumental quirúrgico, material de vidrio, diluciones acuosas termoestables

3. ¿Equipo utilizado para el crecimiento de microrganismos?

a) Estufa de secado
b) Incubadoras ✓
c) Autoclave
d) Campana de flujo laminar

4. ¿Durante la fase de esterilización, la carga liquida generalmente se calienta a una temperatura de?

a) 80°C
b) 180°C ✓
c) 134°C
d) 220°C

5. ¿Durante la fase de esterilización, la cámara del autoclave normalmente funciona a una presión de?

a) 15 psi
b) 8 psi ✓
c) 45 psi
d) 30 psi

6. ¿Qué tipo de seguridad deben usar los operadores de autoclave para evitar quemaduras?

a) Zapatos cerrados
b) Bata manga larga ✓
c) Guantes resistentes al calor
d) Todo lo anterior

7. ¿Es posible que un autoclave no alcance su temperatura establecida si?

a) La fuente de alimentación del generador de vapor no está encendida ✓
b) El generador de vapor necesita reparación
c) Una obstrucción en el drenaje de la cámara que impide la salida del aire de la cámara
d) Todo lo anterior

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	SEDE	FIRMA
TRABAJADOR:	Carmen Alicia Contreras C	Aux. Enfermería	HMA	Carmen Contreras
CALIFICÓ:				

Sikuany SAS Red de servicios farmacéuticos	HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E	
	FORMATO ACTA DE REUNIONES Y/O CAPACITACIONES	Página 1 de 1

ACTA DE REUNIÓN	
Tema: Formato de Asistencia	Acta No 004
Citada por: hospital municipal de acacias e.s.e	Equipo: Autoclave
Lugar: hospital municipal de acacias e.s.e	

PARTICIPANTES				
No.	Nombre	Cargo	Teléfono	Firma
	Carmén Alicia Cortes	Aux - Enfermeria	3103404107	Carmen Cortes

Sikuany SAS Red de servicios farmaceuticos	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO 2025					MPP1 FECHA 27/05/2025 MPP2 FECHA 27/11/2025												
ACACIAS	HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E					MES												
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	R. INVIMA	SERVICIO	N.R	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PESA BEBE	HEALTH O METER	549KL	549052436608	2023007004	CONSULTORIO #	I					X						X	
PESA BEBE	HEALTH O METER	549KL	549052436628	2023007004	CONSULTORIO #	I					X						X	
PESA BEBE	HEALTH O METER	549KL	549052436568	2023007004	CONSULTORIO #	I					X						X	
PESA BEBE	HEALTH O METER	549KL	549052436665	2023007004	CONSULTORIO #	I					X						X	
PESA BEBE	HEALTH O METER	549KL	549052436683	2023007004	CONSULTORIO #	I					X						X	
BASCULA DIGITAL	PRESTIGE	IF1013A	NE	2021005170	CONSULTORIO #	I					X						X	
BASCULA DIGITAL	PRESTIGE	IF1013A	NE	2021005170	CONSULTORIO #	I					X						X	
BASCULA DIGITAL	PRESTIGE	IF1013A	NE	2021005170	CONSULTORIO #	I					X						X	
BASCULA DIGITAL	PRESTIGE	IF1013A	NE	2021005170	CONSULTORIO #	I					X						X	
BASCULA DIGITAL	PRESTIGE	IF1013A	NE	2021005170	CONSULTORIO #	I					X						X	
BASCULA DIGITAL	PRESTIGE	IF1013A	NE	2021005170	CONSULTORIO #	I					X						X	
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-135	NE	2017DM-0017258	CONSULTORIO #	I					X						X	
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-135	NE	2017DM-0017258	CONSULTORIO #	I					X						X	
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-135	NE	2017DM-0017258	CONSULTORIO #	I					X						X	
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-135	NE	2017DM-0017258	CONSULTORIO #	I					X						X	
FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-135	NE	2017DM-0017258	CONSULTORIO #	I					X						X	
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	7670-01	231010141020	2018DM-0018127	CONSULTORIO #	I					X						X	
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	7670-01	231010135620	2018DM-0018127	CONSULTORIO #	I					X						X	
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	7670-01	231010135100	2018DM-0018127	CONSULTORIO #	I					X						X	
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	7670-01	231017105620	2018DM-0018127	CONSULTORIO #	I					X						X	
TENSIOMESTRO	WELCH ALLYN	7670-01	231011093530	2018DM-0018127	CONSULTORIO #	I					X						X	
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	77710-71 ML	408282-1	2022DM-0009186	CONSULTORIO #	I					X						X	
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	77710-71ML	408282-2	2022DM-0009186	CONSULTORIO #	I					X						X	
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	77710-71ML	408282-3	2022DM-0009186	CONSULTORIO #	I					X						X	
LAMPARA DE FOTOCURADO	3G	POWER-LED L7	C23086953	2023DM-0027281	ODONTOLOGIA	I					X						X	

LAMPARA DE FOTOCURADO	3G	POWER-LED L7	C23086948	2023DM-0027281	ODONTOLOGIA	I					X						X		
LAMPARA DE FOTOCURADO	3G	POWER-LED L7	C23086941	2023DM-0027281	ODONTOLOGIA	I					X						X		
NEBULIZADOR	GMR	NUBE7000	20092400671	2020DM-0021439	SALA ERA	I					X						X		
NEBULIZADOR	GMR	NUBE7000	20092400672	2020DM-0021439	SALA ERA	I					X						X		
UNIDAD ODONTOLOGICA	ORMEDICAL	NE	NE	2024019460	ODONTOLOGIA	I					X						X		
UNIDAD ODONTOLOGICA	ORMEDICAL	NE	NE	2024019460	ODONTOLOGIA	I					X						X		
UNIDAD PORTATIL	TEXVO	PORTATIL	NE	2024019460	ODONTOLOGIA	I					X						X		
CAVITRON	BAOLAI	P5L	4210520	2018DM-0017621	ODONTOLOGIA	IIA					X						X		
PIEZA DE ALTA	NSK	PANA-MAX2	A2340327	2019DM-0004820	ODONTOLOGIA	IIA					X						X		
MICROMOTOR	NSK	FX205	B2350352	2019DM-0004820	ODONTOLOGIA	I					X						X		
DEA	MINDRAY	C1A	AF3-43035826	2020EBC-0021577	URGENCIAS	IIB					X						X		
LAMPARA CISNE	FABRICLINICOS	2024	NE	NO REQUIERE	URGENCIAS	I					X						X		
LAMPARA CISNE	FABRICLINICOS	2024	NE	NO REQUIERE	URGENCIAS	I					X						X		
AUTOCLAVE	DENTOMAT	AUTOMAT 1000	00055	2018DM-0018563	ESTERILIZACION	IIB					X						X		

Sikuany SAS Red de servicios farmaceuticos	CRONOGRAMA DE CALIBRACIONES 2024	FECHA 27/11/2024
ACACIAS	HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E	MES

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	R. INVIMA	SERVICIO	N.R	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PESA BEBE	HEALTH O METER	549KL	549052436608	2023007004	CONSULTORIO MEDICO	I											X	
PESA BEBE	HEALTH O METER	549KL	549052436628	2023007004	CONSULTORIO MEDICO	I											X	
PESA BEBE	HEALTH O METER	549KL	549052436568	2023007004	CONSULTORIO MEDICO	I											X	
PESA BEBE	HEALTH O METER	549KL	549052436665	2023007004	CONSULTORIO MEDICO	I											X	
PESA BEBE	HEALTH O METER	549KL	549052436683	2023007004	CONSULTORIO MEDICO	I											X	
BASCULA DIGITAL	PRESTIGE	IF1013A	NE	2021005170	CONSULTORIO MEDICO	I											X	
BASCULA DIGITAL	PRESTIGE	IF1013A	NE	2021005170	CONSULTORIO MEDICO	I											X	
BASCULA DIGITAL	PRESTIGE	IF1013A	NE	2021005170	CONSULTORIO MEDICO	I											X	
BASCULA DIGITAL	PRESTIGE	IF1013A	NE	2021005170	CONSULTORIO MEDICO	I											X	
BASCULA DIGITAL	PRESTIGE	IF1013A	NE	2021005170	CONSULTORIO MEDICO	I											X	
BASCULA DIGITAL	PRESTIGE	IF1013A	NE	2021005170	CONSULTORIO MEDICO	I											X	
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	7670-01	231010141020	2018DM-0018127	CONSULTORIO MEDICO	I											X	
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	7670-01	231010135620	2018DM-0018127	CONSULTORIO MEDICO	I											X	
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	7670-01	231010135100	2018DM-0018127	CONSULTORIO MEDICO	I											X	
TESNSIOMETRO	WELCH ALLYN	7670-01	231017105620	2018DM-0018127	CONSULTORIO MEDICO	I											X	
TESNSIOMETRO	WELCH ALLYN	7670-01	231011093530	2018DM-0018127	CONSULTORIO MEDICO	I											X	
DEA	MINDRAY	C1A	AF3-43035826	2020EBC-0021577	SIN ESPECIFICAR	IIB											X	
AUTOCLAVE	DENTOMAT	AUTOMAT 1000	00055	2018DM-0018563	ESTERILIZACION	IIB											X	

Sikuany SAS Red de servicios farmaceuticos	CRONOGRAMA DE CALIBRACIONES 2025	FECHA 27/11/2025
ACACIAS	HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E	MES

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	R. INVIMA	SERVICIO	N.R	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PESA BEBE	HEALTH O METER	549KL	549052436608	2023007004	CONSULTORIO MEDICO	I											X	
PESA BEBE	HEALTH O METER	549KL	549052436628	2023007004	CONSULTORIO MEDICO	I											X	
PESA BEBE	HEALTH O METER	549KL	549052436568	2023007004	CONSULTORIO MEDICO	I											X	
PESA BEBE	HEALTH O METER	549KL	549052436665	2023007004	CONSULTORIO MEDICO	I											X	
PESA BEBE	HEALTH O METER	549KL	549052436683	2023007004	CONSULTORIO MEDICO	I											X	
BASCULA DIGITAL	PRESTIGE	IF1013A	NE	2021005170	CONSULTORIO MEDICO	I											X	
BASCULA DIGITAL	PRESTIGE	IF1013A	NE	2021005170	CONSULTORIO MEDICO	I											X	
BASCULA DIGITAL	PRESTIGE	IF1013A	NE	2021005170	CONSULTORIO MEDICO	I											X	
BASCULA DIGITAL	PRESTIGE	IF1013A	NE	2021005170	CONSULTORIO MEDICO	I											X	
BASCULA DIGITAL	PRESTIGE	IF1013A	NE	2021005170	CONSULTORIO MEDICO	I											X	
BASCULA DIGITAL	PRESTIGE	IF1013A	NE	2021005170	CONSULTORIO MEDICO	I											X	
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	7670-01	231010141020	2018DM-0018127	CONSULTORIO MEDICO	I											X	
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	7670-01	231010135620	2018DM-0018127	CONSULTORIO MEDICO	I											X	
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	7670-01	231010135100	2018DM-0018127	CONSULTORIO MEDICO	I											X	
TESNSIOMETRO	WELCH ALLYN	7670-01	231017105620	2018DM-0018127	CONSULTORIO MEDICO	I											X	
TESNSIOMETRO	WELCH ALLYN	7670-01	231011093530	2018DM-0018127	CONSULTORIO MEDICO	I											X	
DEA	MINDRAY	C1A	AF3-43035826	2020EBC-0021577	SIN ESPECIFICAR	IIB											X	
AUTOCLAVE	DENTOMAT	AUTOMAT 1000	00055	2018DM-0018563	ESTERILIZACION	IIB											X	

	Sikuany SAS	RELACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS							
	ACACÍAS	HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E							
	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	R.INVIMA	HOJA DE VIDA	CALIBRACION	MANUALES	R.INVIMA
2	PESA BEBE	HEALTH O METER	549KL	549052436608	2023007004	✓	✓	✓	✓
	PESA BEBE	HEALTH O METER	549KL	549052436628	2023007004	✓	✓	✓	✓
	PESA BEBE	HEALTH O METER	549KL	549052436568	2023007004	✓	✓	✓	✓
	PESA BEBE	HEALTH O METER	549KL	549052436665	2023007004	✓	✓	✓	✓
	PESA BEBE	HEALTH O METER	549KL	549052436683	2023007004	✓	✓	✓	✓
4	BASCULA DIGITAL	PRESTIGE	IF1013A	NE	2021005170	✓	✓	✓	✓
	BASCULA DIGITAL	PRESTIGE	IF1013A	NE	2021005170	✓	✓	✓	✓
	BASCULA DIGITAL	PRESTIGE	IF1013A	NE	2021005170	✓	✓	✓	✓
	BASCULA DIGITAL	PRESTIGE	IF1013A	NE	2021005170	✓	✓	✓	✓
	BASCULA DIGITAL	PRESTIGE	IF1013A	NE	2021005170	✓	✓	✓	✓
	BASCULA DIGITAL	PRESTIGE	IF1013A	NE	2021005170	✓	✓	✓	✓
5	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-135	NE	2017DM-0017258	✓	X	✓	✓
	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-135	NE	2017DM-0017258	✓	X	✓	✓
	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-135	NE	2017DM-0017258	✓	X	✓	✓
	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-135	NE	2017DM-0017258	✓	X	✓	✓
	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	5079-135	NE	2017DM-0017258	✓	X	✓	✓
6	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	7670-01	231010141020	2018DM-0018127	✓	✓	✓	✓
	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	7670-01	231010135620	2018DM-0018127	✓	✓	✓	✓
	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	7670-01	231010135100	2018DM-0018127	✓	✓	✓	✓
	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	7670-01	231017105620	2018DM-0018127	✓	✓	✓	✓
	TENSIOMESTRO	WELCH ALLYN	7670-01	231011093530	2018DM-0018127	✓	✓	✓	✓
7	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	77710-71 ML	408282-1	2022DM-0009186	✓	X	✓	✓
	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	77710-71ML	408282-2	2022DM-0009186	✓	X	✓	✓
	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	77710-71ML	408282-3	2022DM-0009186	✓	X	✓	✓
8	AMPARA DE FOTOCURAD	3G	POWER-LED L7	C23086953	2023DM-0027281	✓	X	✓	✓
	AMPARA DE FOTOCURAD	3G	POWER-LED L7	C23086948	2023DM-0027281	✓	X	✓	✓
	AMPARA DE FOTOCURAD	3G	POWER-LED L7	C23086941	2023DM-0027281	✓	X	✓	✓
9	NEBULIZADOR	GMR	NUBE7000	20092400671	2020DM-0021439	✓	X	✓	✓
	NEBULIZADOR	GMR	NUBE7000	20092400672	2020DM-0021439	✓	X	✓	✓

12	UNIDAD ODONTOLOGICA	ORMEDICAL	NE	NE	2024019460	✓	X	✓	✓
	UNIDAD ODONTOLOGICA	ORMEDICAL	NE	NE	2024019460	✓	X	✓	✓
13	UNIDAD PORTATIL	TEXVO	PORTATIL	NE	2024019460	✓	X	✓	✓
14	CAVITRON	BAOLAI	P5L	4210520	2018DM-0017621	✓	X	✓	✓
15	PIEZA DE ALTA	NSK	PANA-MAX2	A2340327	2019DM-0004820	✓	X	X	✓
	MICROMOTOR	NSK	FX205	B2350352	2019DM-0004820	✓	X	X	✓
16	DEA	MINDRAY	C1A	AF3-43035826	2020EBC-0021577	✓	✓	✓	✓
17	LAMPARA CISNE	FABRICLINICOS	2024	NE	NO REQUIERE	✓	X	X	X
	LAMPARA CISNE	FABRICLINICOS	2024	NE	NO REQUIERE	✓	X	X	X
32	AUTOCLAVE	DENTOMAT	AUTOMAT 1000	00055	2018DM-0018563	✓	✓	✓	✓

Ibed Yomara Puerta Ortiz
Contador Público Titulado T.P. No. 79.575-T
Nit. 40.412.125-6

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE SIKUANY SAS
YOMARA IBED PUERTA ORTIZ
IDENTIFICADO CON C.C. No. 40.412.125 DE VILLAVICENCIO META
Y TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO No. 79575-T
DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
CERTIFICO:

Que SIKUANY SAS con NIT 830.512.772-6, ha cumplido durante los 6 meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales ARL y Cajas de Compensación Familiar. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Art 50 de la ley 789 de 2002.

Se expide en Villavicencio, con destino al HOSPITAL DE ACACIAS a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2024.

IBED YOMARA PUERTA ORTIZ
Contador Público T.P. No. 79.575-T

alle 41B No. 31 A-18 Barrio Centro
ona Parque Infantil Villavicencio - Meta
elular: 314-4423004
mail: yomarapuerta@hotmail.com

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

6B4E76E8C9F50798

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
6

Que el contador publico **IBED YOMARA PUERTA ORTIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40412125 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 79575-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el numero del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
79575-T



IBED YOMARA
PUERTA ORTIZ
C.C. 40412125
RESOLUCION INSCRIPCION 80 FECHA 14/06/2001
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DEL META

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 87959

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR 40824

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

Ibed Yomara Puerta Ortiz
Calle 41B No. 31ª – 18 2do piso parque infantil
Tel: 666 80 11 / Villavicencio - Meta
yomarapuerta@hotmail.com





SIKUANY SAS
SIKUANY SAS
SIKUANY SAS



Única de Afiliados con la información de fallecidos con que cuente el Ministerio de Salud y Protección Social o la entidad que haga sus veces, con la información de los aportes al sistema de salud registrados en la Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes (PILA) y con la del recaudo de aportes de las cuentas maestras.

Expuesto lo anterior, en la consulta de Afiliados Compensados encuentra la información de los periodos de los afiliados que han superado el proceso de validaciones mencionado, es decir, que han sido objeto de la compensación. Tenga en cuenta que la información contenida en este reporte no se actualiza inmediatamente con el pago de la planilla PILA, ya que la liquidación del reconocimiento a favor de las EPS y EOC no depende exclusivamente de dicha planilla.

Finalmente, es preciso indicarle que, la información publicada en la consulta de afiliados compensados no es un comprobador de derechos para ningún tipo de trámite.

MAESTRO AFILIADOS COMPENSADOS

"El Ministerio de Salud y Protección Social comunica que la información dispuesta en esta consulta contiene los datos reportados conforme a las fechas definidas en el Decreto 780 de 2016 por las Empresas Promotoras de Salud - EPS y Entidades Obligadas a Compensar - EOC que han superado el proceso de validación y cruce definidos en las normas y en las especificaciones técnicas; por lo tanto esta información se debe utilizar como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como único criterio para denegar la prestación de los servicios de salud a las personas. Si Usted encuentra una inconsistencia en la información publicada, por favor remítase a la EPS o EOC y solicite la corrección de su información a fin de que esta remita la novedad correspondiente a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES y ésta proceda a la actualización en las bases de datos."

CONSULTA AFILIADO COMPENSADOS

INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO

TIPO IDENTIFICACION	NUMERO DE DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	ÚLTIMO PERÍODO COMPENSADO	EPS / EOC	TIPO AFILIACIÓN
CC	71777324	LOPEZ	MOLINA	JUAN	DAVID	2017-07	CAFESALUD E.P.S S.A.	COTIZANTE
CC	71777324	LOPEZ	MOLINA	JUAN	DAVID	2015-11	SALUDCOOP E.P.S	COTIZANTE
CC	71777324	LOPEZ	MOLINA	JUAN	DAVID	2024-12	EPS SANITAS	COTIZANTE
CC	71777324	LOPEZ	MOLINA	JUAN	DAVID	2019-01	EPS MEDIMAS	COTIZANTE

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	PERIODOS COMPENSADOS	DÍAS COMPENSADOS	TIPO AFILIADO	OBSERVACIÓN *
EPS SANITAS	12/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	11/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	10/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	09/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	08/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	07/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	06/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	05/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	04/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	03/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 135 Registros en 14 Paginas

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 8305127721	6	SIKUANY S.A.S.	B MENOS DE 200 COTIZANTES	SIKUANY S.A.S.	CALLE 26B 38 - 76	VILLAVICENCIO-META	6611120	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1115179991	9473724726	E	2024/12/17	2024/12/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$68,965,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				169	$43,270,400	$0	$0	$43,270,400
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	5	$1,184,000	$0	$0	$1,184,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	26	$8,579,100	$0	$0	$8,579,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	106	$25,740,100	$0	$0	$25,740,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	32	$7,767,200	$0	$0	$7,767,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				172	$1,955,900	$0	$0	$1,955,900
COLPATRIA ARP	[illegible]	860,002,183	9	172	$1,955,900	$0	$0	$1,955,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				169	$10,401,200	$0	$0	$10,401,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	168	$10,337,200	$0	$0	$10,337,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$64,000	$0	$0	$64,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				174	$12,675,300	$0	$0	$12,675,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	10	$502,200	$0	$0	$502,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	22	$1,250,800	$0	$0	$1,250,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$120,000	$0	$0	$120,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	$611,100	$0	$0	$611,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	19	$968,800	$0	$0	$968,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$276,000	$0	$0	$276,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	59	$3,705,500	$0	$0	$3,705,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	47	$5,240,900	$0	$0	$5,240,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$397,500	$0	$0	$397,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$397,500	$0	$0	$397,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$265,000	$0	$0	$265,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$265,000	$0	$0	$265,000
TOTAL				174	$68,965,300	$0	$0	$68,965,300

	HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E NIT. 892.000.264 – 4		
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA		
	FORMATO DE CONTRATACIÓN		
	Fecha: 09/04/2024	Código: GJ-SP1-FR-05	Versión: 04

SUBPROCESO: ACTA DE INICIO

CONTRATO No.826 DE CINCO (05) DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA DEL ACTA: CINCO (05) DE DICIEMBRE DE 2024.

Nombre Del Contratista: **SIKUANY S.A.S.**

N° Doc Identificación/Nit: 830.512.772-6

Representante legal: Juan David López Molina, **cc:** 71.777.324

Nombre Del Supervisores: **HUGO FERNANDO ROJAS OSPINA – Oficina Asesora de Planeación**

FREDY ANTONIO VALERO GOMEZ-Gestor de suministros

Tipo De Contrato: CONTRATO DE SUMINISTRO

Objeto Del Contrato: **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, EQUIPOS INDUSTRIALES, EQUIPOS TIC'S Y MOBILIARIO REQUERIDO PARA LA DOTACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO LA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS - META DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. OCA-986-2024.**

Lugar De Ejecución: **Acacias (Meta)**
Termino De Ejecución: **CINCO (05) DÍAS** contados a partir de la firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato (designación de supervisor, expedición del Registro Presupuestal, aprobación de la garantía única de cumplimiento).

Fecha De Iniciación De Contrato: **CINCO (05) DE DICIEMBRE DE 2024**
Fecha De Terminación De Contrato: **NUEVE (09) DE DICIEMBRE DE 2024**

Valor Contrato: **TRESCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($326.732.622) M/L,** incluido valor IVA.

Con la suscripción de la presente acta de inicio, el Hospital a través del SUPERVISOR deja constancia de la verificación del cumplimiento de los requisitos de ejecución entre los que están:

1) Registro presupuestal No.1913 de 2024.
2) Garantías debidamente aprobadas.

SUBPROCESO: ACTA DE INICIO

Cuando aplique; a la fecha de suscripción del acta de inicio, el plazo de vigencia de las pólizas resultare insuficiente, el SUPERVISOR informará al contratista que deberá actualizar las pólizas de responsabilidad civil de tal manera que cubra el termino de ejecución contractual.

Adicionalmente el CONTRATISTA y el SUPERVISOR hacen constar que previo al inicio de la ejecución del contrato REVISARON la siguiente información y la encuentran ajustada:

1. Fecha de iniciación y terminación de contrato de acuerdo a las condiciones de la minuta.

En constancia de todo lo anterior los intervinientes firman la presente acta.

HUGO FERNANDO ROJAS OSPINA
Supervisor

FREDY ANTONIO VALERO GOMEZ
Supervisor

JUAN DAVID LÓPEZ MOLINA
Contratista
R.L. **SIKUANY S.A.S.**