INFORME DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 4051-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	EXPO ARCO SAS
Identificación	844004371-8
Fecha de suscripción del Contrato	2024-12-17
Objeto	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURAS, DEBIDAMENTE CERTIFICADOS, ASI COMO BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL.
Plazo de Ejecución	OCHO (08) DIAS
Fecha de Iniciación	2024-12-19
Fecha de Finalización	2024-12-26

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS ($ 58.083.416,00)
Valor ejecutado	CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS ($ 58.083.416,00)
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$ 0,00
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	00,00%
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.

3. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

1. Certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista cumplió a cabalidad con la totalidad de las actividades del contrato, tal y como consta en los informes de actividades revisados y aprobados durante la ejecución del contrato y relacionados a continuación:

<table>
<tr><th>Actividad</th><th>Evidencias o Soportes</th></tr>
<tr><td>1. Entregar los elementos objeto de la contratación de acuerdo con las condiciones y características técnicas establecidas en el anexo de fichas técnicas del estudio previo que es parte integral del respectivo contrato, el cual deberá cumplir con las disposiciones legales vigentes, normas técnicas de calidad y seguridad.</td><td>SE EVIDENCIO QUE EL CONTRATISTA REALIZO LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES, CONDICIONES Y CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO ASI:
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>1</td><td>GASA ESTERIL 7.5x 7.5 cm (3” x 3”) y 10 x 10 cm (4 “ x 4”) Descripción: Gasa estéril no tejida, compuesta por 70% viscosa + 30% poliéster para uso individual. Para absorción de exudados u otros líquidos de drenaje.
Bajo desprendimiento de partículas.
Material Liviano, suave al contacto con las heridas. Es de alta resistencia debido a su fabricación con poliéster. Disminución de adhesión a la herida. Impide la contaminación
Material: 70% viscosa + 30% poliéster.
Tamaño: 7.5x 7.5 cm (3” x 3”) y 10 x 10 cm (4 “ x 4”)
Color: BLANCO
Peso: 0,01 kg
Dimensiones: 10 x 10 x 1 cm</td><td>UNIDAD</td><td>22</td></tr>
<tr><td>2</td><td>ESPARADRAPO DE TELA ROLLO DE 4” X 5 Yd
Descripción: Dispositivo médico compuesto por un soporte de tela blanca y un adhesivo tipo caucho. El soporte de tela es de fácil rasgado y está recubierto en una de sus caras con un adhesivo tipo caucho.
Composición: Soporte de tela Adhesivo tipo caucho Antioxidantes Emolientes.
Aplicación: Protección de heridas, Fijación de Apósitos y de dispositivos médicos.
Almacenamiento: Almacenar en los empaques originales y en un lugar fresco, seco, ventilado y protegido de la luz directa del sol, del polvo, el calor y la humedad (T: 25±5°C - HR: 70±5%).
Esterilidad: Se recomienda utilizar el método de esterilización con óxido de etileno (ETO) o por radiación. Los métodos de esterilización al vapor o calor seco, no son recomendables para este tipo de productos, porque las altas temperaturas pueden afectar las propiedades adhesivas del producto.
Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación del producto.
Instrucciones de Uso: Fácil Rasgado - Úselo sobre la piel limpia y seca. - Recomendado para vendajes extrafuertes. Inmovilización de articulaciones; ideal para deportistas. - Coloque Cureband. Espadrapo sobre el</td><td>UNIDAD</td><td>10</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		apósito o dispositivo médico. - Presione ligeramente con los dedos para adherir sobre la piel. - Para evitar molesticas al remover el esparadrapo, levántelo en sentido del crecimiento del vello. Recomendaciones de Uso: Usar solo una vez.		
	3	BAJALENGUAS Descripción: El baja lenguas o depresor lingual es un instrumento médico para deprimir la lengua y permitir el examen de la boca y la garganta. Uso único, no reutilizable. Material: Madera Peso: 0,1 kg Dimensiones: 2 × 8 × 19 cm PAQUETE POR 20	UNIDAD	10
	4	VENDA ELASTICA 2X5 Y Descripción: Fabricada con caucho en filamentos y poliéster crudo sin compactar, con una elongación de 220%, suave al tacto. Por su excelente tejido favorece la respiración de la piel y evita la maceración de la misma. Material: Caucho en filamentos y poliéster crudo sin compactar. Peso: 0,01 kg Dimensiones: 2 × 2 × 10 cm Tamaño: 2"x5Y, 3"X5Y, 4"X5Y, 5"X5Y, 6"X5Y	UNIDAD	5
	5	VENDA ELASTICA 3X5 Y Descripción: Fabricada con caucho en filamentos y poliéster crudo sin compactar, con una elongación de 220%, suave al tacto. Por su excelente tejido favorece la respiración de la piel y evita la maceración de la misma. Material: Caucho en filamentos y poliéster crudo sin compactar. Peso: 0,01 kg Dimensiones: 2 × 2 × 10 cm Tamaño: 2"x5Y, 3"X5Y, 4"X5Y, 5"X5Y, 6"X5Y	UNIDAD	10
	6	VENDA ELASTICA 5X5 Y Descripción: Fabricada con caucho en filamentos y poliéster crudo sin compactar, con una elongación de 220%, suave al tacto. Por su excelente tejido favorece la respiración de la piel y evita la maceración de la misma. Material: Caucho en filamentos y poliéster crudo sin compactar. Peso: 0,01 kg Dimensiones: 2 × 2 × 10 cm Tamaño: 2"x5Y, 3"X5Y, 4"X5Y, 5"X5Y, 6"X5Y	UNIDAD	6
	7	VENDA DE ALGODON 3X5 Y Descripción: Fabricado en algodón 100% puro, no tejido. La característica más importante es la máxima absorción, específicamente del sudor, evitando que se queme la piel produciéndose la maceración de la misma y ayudando a fijar prótesis impidiendo su desplazamiento. Material: Algodón 100% puro. Peso: 0,01 kg	UNIDAD	4

		Dimensiones: 2 × 2 × 10 cm Tamaño: 3"X5Y, 4"X5Y, 5"X5Y, 6"X5Y		
	8	VENDA DE ALGODON 5X5 Y Descripción: Fabricado en algodón 100% puro, no tejido. La característica más importante es la máxima absorción, específicamente del sudor, evitando que se queme la piel produciéndose la maceración de la misma y ayudando a fijar prótesis impidiendo su desplazamiento. Material: Algodón 100% puro. Peso: 0,01 kg Dimensiones: 2 × 2 × 10 cm Tamaño: 3"X5Y, 4"X5Y, 5"X5Y, 6"X5Y	UNIDAD	3
	9	YODOPOVIDONA (Jabón Quirúrgico). Descripción: Utilizada para desinfección de pequeñas heridas, también para preparación de la piel antes de una operación quirúrgica, la yodopovidona mata las bacterias, hongos, virus.Aplique la solución abundantemente sobre la piel o área a lavar, friccionar levemente con algodón o gasa esterilizados, en caso de presentar hipersensibilidad, enrojecimiento en la piel o reacciones alérgicas, suspender su uso y consultar a su médico.Material: YODO POLIVINILPIRROLIDONAPeso: 0,12 kgDimensiones: 4 × 5 × 11 cmTamaño: 120ml	UNIDAD	1
	10	SOLUCION SALINA Descripción: Cloruro de Sodio 0.9%, Solución inyectable, solución traslúcida e incolora de sabor salado, Ph 4,5-7,0, solución inyectable. Bolsa Grado médico en PVC con sobre bolsa. Adminístrese con precaución en pacientes con falla cardiaca congestiva, Edema Periférico o Pulmonar, Insuficiencia Renal, Hipertensión y Toxemia Gravídica. Úsese bajo estricta vigilancia médica. Material: Cloruro de Sodio 0.9%. Bolsa Grado Médico en PVC con sobre bolsa. Peso: 0,2 kg Dimensiones: 2 × 5 × 10 cm Medida: 500ml	UNIDAD	3
	11	GUANTES DE LATEX Descripción: Los guantes desechables de látex para examen son un dispositivo médico el cual protege las manos del usuario. La principal función de usar guantes es proteger a quien los usa de la contaminación o materiales infecciosos particularmente virus, bacterias, infecciones sanguíneas y fluidos corporales. Precaución: Almacenar en un lugar fresco y seco, evitar el calor excesivo (40oC, 104 oF). Si la caja está abierta debe ser protegida de la exposición a la luz directa del sol o luz fluorescente. Medida: S - M - L	UNIDAD	2

		Caja por 100 unidades. Color: BLANCO Peso: 0,5 kg Dimensiones: 5 × 10 × 10 cm		
	12	TERMÓMETRO DIGITAL Descripción: Dispositivo para medir la temperatura corporal en adultos por vía oral, rectal o axilar, fabricado en ABS, pantalla LCD y punta en acero inoxidable, batería de 1.5 voltios tipo botón, botón de encendido y apagado. Modo de uso: • Colocar el termómetro en el lugar deseado para tomar la temperatura, al prenderlo este emitirá un sonido y comenzará la medición. • Durante la medición en la pantalla aparecerá el símbolo de grados °. • Al finalizar la medición emitirá un sonido durante 10 segundos aproximadamente y el resultado aparecerá en la pantalla • Después de 10 minutos el termómetro se apagará automáticamente o también puede hacerlo oprimiendo el botón nuevamente para apagarlo. Recomendaciones: • Mantener el termómetro en un lugar fresco y seco, donde no le dé la luz solar directamente. • No usar el termómetro en el oído. • Si se va dejar de usar por mucho tiempo, retirar la batería. • No realizar mediciones si el termómetro esta mojado o húmedo, esto puede alterar el resultado. • No morderlo cuando se esté haciendo mediciones orales. • desinfectar el termómetro después de cada uso, en caso de que sea usado en más de 1 persona. Peso: 0,1 kg Dimensiones: 5 × 5 × 10 cm	UNIDAD	7
	13	TIJERA DE TRAUMA Descripción: Tijera de trauma corta todo, ideal para separar vendas de la piel sin peligro. Sus hojas curvas permiten mayor control, mientras que la punta doble función facilitan el corte. Material Acero inoxidable Largo hasta el mango o soporte 18,5 Cms Peso: 0,1 kg Dimensiones: 1 × 10 × 10 cm	UNIDAD	1
	14	LINTERNA CON BOTON RECARGABLE Definición: Linterna recargable para iluminar espacios de difícil visualización en situación de evacuación. Libre de batería. Especificación: Linterna de luz LED. Linterna con interruptor on/off, manivela de palanca de bloqueo y una correa para la	UNIDAD	2

		muñeca. La linterna debe medir 101x50x26 mm, peso de 65 gramos, fuente de 2 LED. Accesorios que incluye: N/A. Vida Útil: 05 años.			
	15	MEGAFONO CON SIRENA MULTI-TONO Definición: Silbato.Especificación: Con cuerda para cargar al hombro de mínimo 25", con sirena multi-tono, grabador de 15 segundos, batería recargable y micrófono de mano. Equipo portátil a batería. Potencia acústica de 25 Watts (aproximadamente). Alcance mínimo de 100 metros. Peso menor a 2 kg. Con micrófono interno y externo. Cable de micrófono externo extensible de 0.5 metros o más. Batería recargable con cargador incorporado (incluida). Autonomía con batería recargable: superior a 2 horas a máximo volumen. Tiempo de carga de la batería: 10 horas aproximadamente, 8 pilas LR20-D, Entrada para 12 V CC, Sonido: Sirena, silbato (1600 ~ 2400 Hz). Diámetro 23 cms y largo 34 cms.	UNIDAD	2	
	16	ARNÉS CUATRO ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR Diseño: arnés en reata polyester de alta tenacidad estilo en X, posee una argolla dorsal en "D" para detención y restricción de caídas, y argollas laterales en "D" para posicionamiento a un punto fijo, argolla frontal en "D" para ascenso y descenso controlado, soporte lumbar con diseño ergonómico. Rango de capacidad: mínimo 130 lbs - máximo 310 lbs (1 persona), certificación ANSI Z359.11-2021 y resolución colombiana 4272 de 2021. Material: • Reata de alta tenacidad con tratamiento ignifugo (retardante al fuego) Reata resistente a la rotura 5000 lbf • Reata negra de alta tenacidad con tratamiento ignifugo (retardante al fuego) Reata resistente a la rotura 5000 lbf • Argolla en D inyectada en puente Fabricada en acero resistencia 5000 lbf • Hebilla trabilla de Puente Fabricada en acero resistencia 5000 lbf • Hebilla trabilla eslabón Fabricada en acero resistencia 5000 lbf • Mariposa ergonómica dorsal grande Plástico • Mariposa pequeña Plástico • Triángulo porta eslinga Plástico • Tensor, Pasador, Punta reata Plástico • Costuras en Hilo color blanco y naranja para facilitar su inspección. Polyester • Soporte Lumbar	UNIDAD	2	

		• Estilo en X • Etiqueta Única de producto Talla: Universal		
	17	ARNÉS CUATRO ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT Material: • Reata de alta tenacidad con tratamiento ignifugo (retardante al fuego) Reata resistente a la rotura 5000 lbf • Reata negra de alta tenacidad tratamiento ignifugo (retardante al fuego) Reata resistente a la rotura 5000 lbf • Argollas en D Dieléctricas light. En nylon inyectado con resistencia 5000 lbf • Hebillas trabilla Puente Dieléctrico light. En nylon inyectado con resistencia 5000 lbf • Hebilla trabilla eslabón Dieléctrico light. En nylon inyectado con resistencia 5000 lbf • Herrajes con capacidad de carga dieléctrica. 3Kv • Mariposa ergonómica dorsal grande. Plástico • Mariposa Pequeña. Plástico • Triángulos porta eslinga. Plástico • Tensores, Pasadores, Punta reata. Plástico • Costuras en hilo blanco y naranja para facilitar su inspección. Polyester • Estilo en X • Talla: Universal	UNIDAD	2
	18	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN EN "Y" REGULABLE DIELÉCTRICA Diseño: Eslinga para posicionamiento en "Y" Regulable, en reata polyester de alta tenacidad ganchos de seguridad dieléctricos de 2 1/4 y 3/4 con resistencia de 5000 lbf. Rango de capacidad: mínimo 130 lbs - máximo 310 lbs (1 persona), certificación ANSI Z359.3-2019 y resolución colombiana 4272 de 2021. Material: • Reata de alta tenacidad con tratamiento ignifugo (retardante al fuego) Reata resistente a la rotura 5000 lbf • Ganchos de 2 1/4 de apertura. En nylon inyectado con resistencia 5000 lbf • Gancho de 3/4 de apertura. En nylon inyectado con resistencia 5000 lbf • Capacidad de carga dieléctrica. 9Kv • Pasador elástico. Polyester • Costuras en Hilo color blanco para facilitar su inspección. Polyester • Longitud Max. 1.8m (Regulable)	UNIDAD	1

	19	ESLINGA EN "Y" CON ABSORBEDOR, REGULABLE Y GANCHOS DIELÉCTRICOS Diseño: Eslinga en reata polyester de alta tenacidad con doble terminal (tipo Y) con absorbedor de energía, ganchos Dieléctricos de seguridad 2 1⁄4 y 3⁄4 con resistencia de 5000 lbf. Sistema graduable a través de las hebillas de graduación dieléctrica para aumentar o reducir la longitud, Con absorbedor de energía de elongación máxima de 1.2m (48 pulgadas), en caso de una caída reduce la fuerza de impacto a 900 lbf (4kN) o menos.Rango de capacidad: mínimo 130 lbs - máximo 310 lbs (1 persona), Certificación ANSI Z359.13-2013 y resolución colombiana 4272 de 2021.Material: • Reata negra de alta tenacidad tratamiento ignifugo (retardante al fuego). Reata resistente a la rotura 5000 lbf• Reata de alta tenacidad con tratamiento ignifugo. Reata resistente a la rotura 5000 lbf• Argolla en D. En Fibra de Vidrio, nylon inyectado resistencia 5000 lbf• Gancho de 3⁄4 de apertura. En Fibra de Vidrio, nylon inyectado resistencia 5000 lbf• Ganchos de 2 1⁄4 de apertura. En Fibra de Vidrio, nylon inyectado resistencia 5000 lbf• Hebillas de graduación. En Fibra de Vidrio, nylon inyectado resistencia 5000 lbf• Herrajes con capacidad de carga dieléctrica. 9Kv• Termoencogible Negro y transparente. Doble recubrimiento para cubrir el paquete de absorbedor.• Costuras en Hilo blanco para facilitar su inspección. Polyester• Pasadores elásticos. Polyester• La eslinga con absorbedor se activa con un peso superior a 59 kg. Incluido el peso del equipo y soporta hasta los 140 kg• Longitud Max. 1.8m (Regulable)	UNIDAD	1	
	20	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR REGULABLE Diseño: Eslinga en reata polyester de alta tenacidad con doble terminal (tipo Y) regulable con absorbedor de energía, ganchos de seguridad 2 1⁄4 y 3⁄4 con resistencia de 5000 lbf. Sistema graduable a través de hebillas para aumentar o reducir la longitud de la eslinga, Con absorbedor de energía de elongación máxima de 1,2m (48 pulgadas), en caso de una caída reduce la fuerza de impacto a 900 lbf (4kN) o menos. Rango de capacidad: mínimo 130 lbs - máximo 310 lbs (1 persona), Certificación ANSI Z359.13-2013 y resolución colombiana 4272 de 2021. Material: • Reata negra de alta tenacidad tratamiento ignifugo (retardante al fuego). Reata resistente a la rotura 5000 lbf	UNIDAD	9	

		• Reata de alta tenacidad tratamiento ignifugo (retardante al fuego). Reata resistente a la rotura 5000 lbf • Ganchos de 2 1⁄4 de apertura. En acero con resistencia 5000 lbf • Gancho de 3⁄4 de apertura. En acero con resistencia 5000 lbf • Argolla en D. En acero con resistencia 5000 lbf • Hebillas para graduación En acero con resistencia 5000 lbf • Pasadores elásticos. Polyester • Costuras en Hilo blanco para facilitar su inspección. Polyester • Termo encogible Negro y transparente. Doble recubrimiento para cubrir el paquete de absorbedor • La eslinga con absorbedor se activa con un peso superior a 59 kg. Incluido el peso del equipo y soporta hasta los 140 kg. • Longitud Max.1.8m (Regulable)		
	21	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL REGULABLE Diseño: Elemento para posicionamiento y/o restricción eslinga en reata de alta tenacidad con doble terminal (tipo Y), ganchos de seguridad 3⁄4 y 2 1⁄4 con resistencia de 5000 lbf, Sistema graduable a través de las hebillas para aumentar o reducir la longitud de la eslinga de acuerdo al punto de apoyo para posicionarse. Rango de capacidad: mínimo 130 lbs - máximo 310 lbs (1 persona), conforme ANSI Z359.3-2019 y resolución colombiana 4272 de 2021. Material: • Reata de alta tenacidad tratamiento ignifugo (retardante al fuego) Reata resistente a la rotura 5000 lbf • Gancho de 3⁄4 de apertura. En acero con resistencia 5000 lbf • Ganchos de 2 1⁄4 de apertura. En acero con resistencia 5000 lbf • Hebillas de graduación en acero con resistencia 5000 lbf • Pasador elástico. Polyester • Costuras en Hilo blanco para facilitar su inspección. Polyester • Longitud Max 1.8 m (Regulable) Diseño: Elemento para posicionamiento y/o restricción eslinga en reata de alta tenacidad con doble terminal (tipo Y), ganchos de seguridad 3⁄4 y 2 1⁄4 con resistencia de 5000 lbf, Sistema graduable a través de las hebillas para aumentar o reducir la longitud de la eslinga de acuerdo al punto de apoyo para posicionarse.	UNIDAD	9

		Rango de capacidad: mínimo 130 lbs - máximo 310 lbs (1 persona), conforme ANSI Z359.3-2019 y resolución colombiana 4272 de 2021. Material: • Reata de alta tenacidad tratamiento ignifugo (retardante al fuego) Reata resistente a la rotura 5000 lbf • Gancho de 3⁄4 de apertura. En acero con resistencia 5000 lbf • Ganchos de 2 1⁄4 de apertura. En acero con resistencia 5000 lbf • Hebillas de graduación en acero con resistencia 5000 lbf • Pasador elástico. Polyester • Costuras en Hilo blanco para facilitar su inspección. Polyester • Longitud Max 1.8 m (Regulable)		
	22	MOSQUETÓN CARABINERO AUTOMÁTICO 2 SEGUROS Diseño: Mosquetón AutomáticoResistencia 50 kN/11240 lbf.PortátilNormativaCSA Z259. 12ANSI Z359. 12Gate 3600 lbs Material: Acero	UNIDAD	14
	23	FRENO ARRESTADOR AUTOMÁTICO PARA CUERDA DE 5/8 O 16MM Diseño: Freno arrestador automático Normativa ANSI Z359.1(07) ANSI A10.14 Material: Acero Inoxidable	UNIDAD	2
	24	PUNTO DE ANCLAJE FIJO EN ACERO INOXIDABLE Diseño: Anclaje fijo de una perforación para detención de caídas. Diseño tipo D fabricado en acero inoxidable Resistente a la oxidación y corrosión. Resistencia 5000 lbs (22,2KN). Conforme a requisitos ANSI Z359.1:2007 y Resolución colombiana 4272 de 2021 Material: Acero Inoxidable	UNIDAD	4
	25	KIT DE RESCATE PARA ALTURAS Descripción: Kit para rescate de alturas compuesto por: 1 Ascendedor en puño tipo Yumar 1 Descendedor tipo 8 en Aluminio 1 Descendedor rescate 1 Ascendedor bloqueador 4 Mosquetones automáticos de 3 seguros en acero 2 Poleas dobles en aluminio 1 Conector de anclaje de 90 cm graduable, doble argolla. (Tie Off) 1 Cuerda poliéster semiestática de 13mm con	UNIDAD	1

		ojal, de 100. Mts 1 Maletín tipo tula en lona para cuerda de 100 Mts Descripción: • Ascendedor de puño tipo Yumar - Material Aluminio - Azul (derecho) - Normativa EN 567 • Descendedor tipo 8 - capacidad 2 personas - • Descendedor rescate con palanca de cierre automático - Para cuerda de 13 mm - Capacidad 2 personas - Material Aluminio - Normativa EN 12841-C:2006 - EN 341-2A:2011 y resolución colombiana 4272 de 2021 • Ascendedor bloqueador - Material Aluminio - Normativa EN 567 • Mosquetón automático de 3 seguros - Normativa ANSI Z359. 12 y resolución colombiana 4272 de 2021 - Resistencia 50 KN - Material Acero • Polea doble en aluminio - Resistencia mínima 45 KN - Material Aluminio - Color gris o Rojo y negro - Normativa EN 12278:2007 y resolución colombiana 4272 de 2021 • Anclaje portátil (Tie Off) de 90 cm graduable doble argolla - Resistencia 5000 lbs (22,2KN) - Material Poliéster y acero - Normativa ANSI Z359.18-2017 y resolución colombiana 4272 de 2021 • Cuerda 13 mm semiestatica de 100 Mts con ojal - Resistencia 5000 lbs (22,2KN) - Material Poliéster Color Blanco y Negro. • Maletín tipo tula en lona para cuerda de 100 Mts		
	26	ANDAMIO CERTIFICADO MOVIL 2.07m X 2.07m - Altura 9M DESCRIPCIÓN:Ø Torre de 8m de altura + 1m de baranda que permite estar de pie máximo a 8.5 metros de altura.Ø Alcance aproximado de 10 metros con la altura del trabajador.Ø Torre con base de 2.07m X 2.07m.Ø Acceso interno por medio de escaleras para 2m.Ø Plataformas antideslizantes y drenantes sin puerta de acceso de 2.07m X 0.32m.Ø Plataformas con puerta de acceso de 2.07m X 0.60m.Ø Barandas de seguridad a 0.5 y 1m en todos los niveles.Ø Pasadores para unión de verticales.Ø Rodapiés para el área de trabajo.Ø Torre auto estable con base fija en espacios cerrados.Compuesta por 135 elementos que se relacionan a continuación:DESCRIPCIÓN PESO CANT. TOTAL kgVERTICAL DE 1m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm SIN ESPIGO - GALVANIZADO 4.9 10 49.0VERTICAL DE 2m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm CON ESPIGO - GALVANIZADO 10.6 16 169.6HORIZONTAL DE 0.73m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO 3.4	UNIDAD	1

	12 40.8HORIZONTAL DE 2.07m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 3.25mm - GALVANIZADO 8.2 40 328.0DIAGONAL PARA 2.07m EN TUBERIA ESTRUCTURAL CAL. 2.5mm - 2.81ml - GALVANIZADO 9.6 16 153.6BASE COLLAR GALVANIZADA 2.3 4 9.2PASADOR VERTICAL 0.2 12 2.4ESCALERA INTERNA ANTIDESLIZANTE PARA 2m GALVANIZADA IMPORTADA 9.9 4 39.6PLATAFORMA METALICA DE 2.07x0.32m GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO 17.9 5 89.5PLATAFORMA EN ACERO Y ALUMINIO DE 2.07x0.60m CON PUERTA DE ACCESO 27.3 4 109.2RODAPIE DE 2.07x0.15m 5.2 4 20.8TORNILLO NIVELADOR BASE PLANA EN TUBO ROSCADO DE 38mm 3.6 4 14.4RUEDA EN POLIPROPILENO DE 8" CON TORNILLO NIVELADOR DE 500mm 1200 Kg 9.6 4 38.4Normas aplicables: Ø CERTIFICADO EN COLOMBIA bajo las Normas Técnicas Colombianas NTC 1642:1981 y NTC 1735:1982, bajo las Normas Europeas UNE-EN-12810-1:2005 y UNE-EN-12811-1:2005 y bajo la Norma Americana OSHA 1926.451.Ø Que cumpla con la RESOLUCIÓN 4272 DE 2021 emitida por el ministerio de trabajo, que establece los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas.LUGAR DE ENTREGA: Alcaldía de Yopal.GARANTÍA: Un (1) año por defectos de fabricación.Que incluya:Ø Una capacitación sobre la secuencia y recomendaciones para el armado y desarmado seguro del sistema sin límite de asistentes.Ø Manual de armado del sistema en español. Ø Certificación de las torres adquiridas a nombre de la Alcaldía de Yopal.Ø Tarjetas de montaje (rojas, amarillas y verdes).		

COMO SE PUEDE EVIDENCIAR EN REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ELEMENTOS ENTREGADOS Y ENTRADA A ALMACÉN.

ITEM 1


OftoSafe
GAN5002
Gasa Estéril
Esponjas de Gasa No Tejida
6


ITEM 2


CQT006
OftoSafe
Esparadrapo
Tipo tela
Color Blanco

ITEM 3



ITEM 4

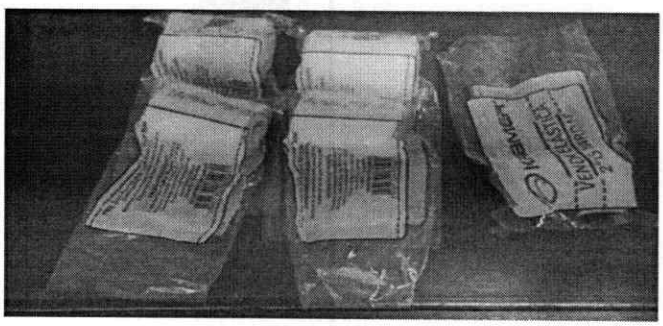

ITEM 5



ITEM 6




ITEM 7



ITEM 8




ITEM 9

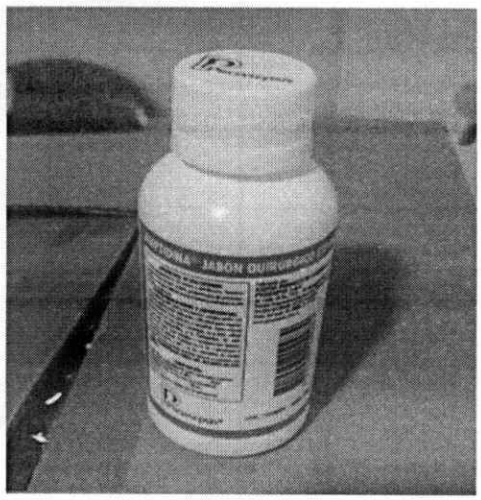


ITEM 10



ITEM 11

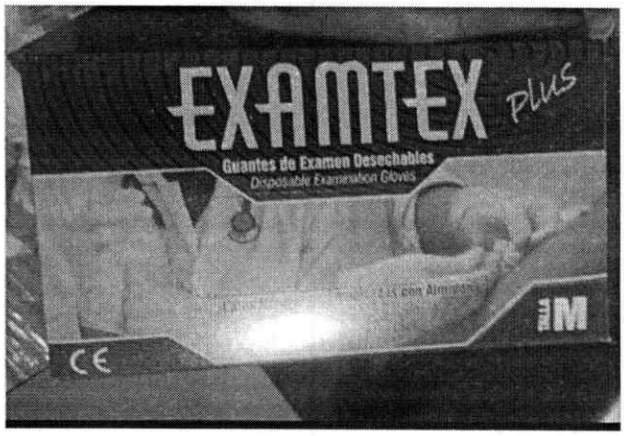


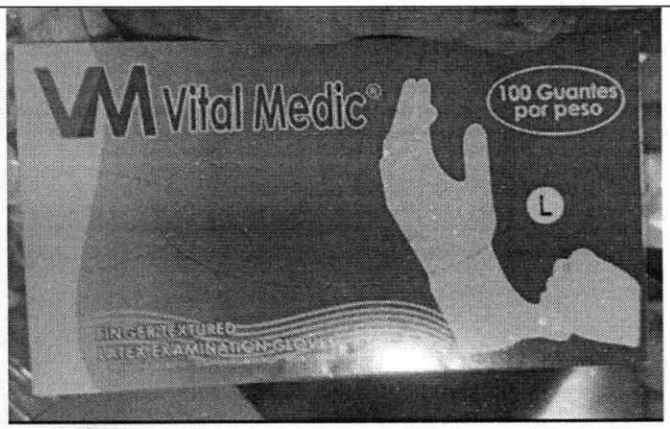

ITEM 12



ITEM 13

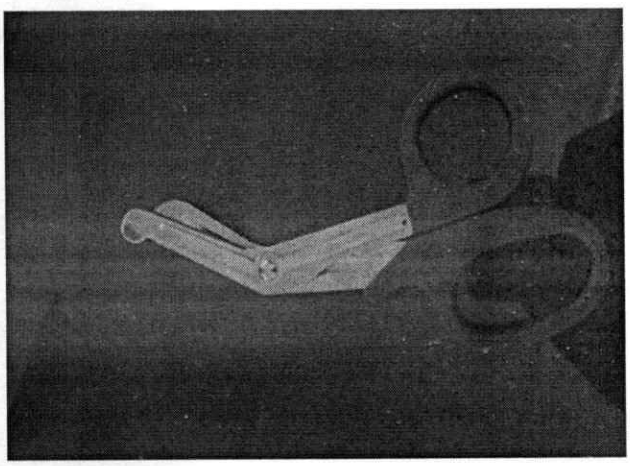


ITEM 14




ITEM 15

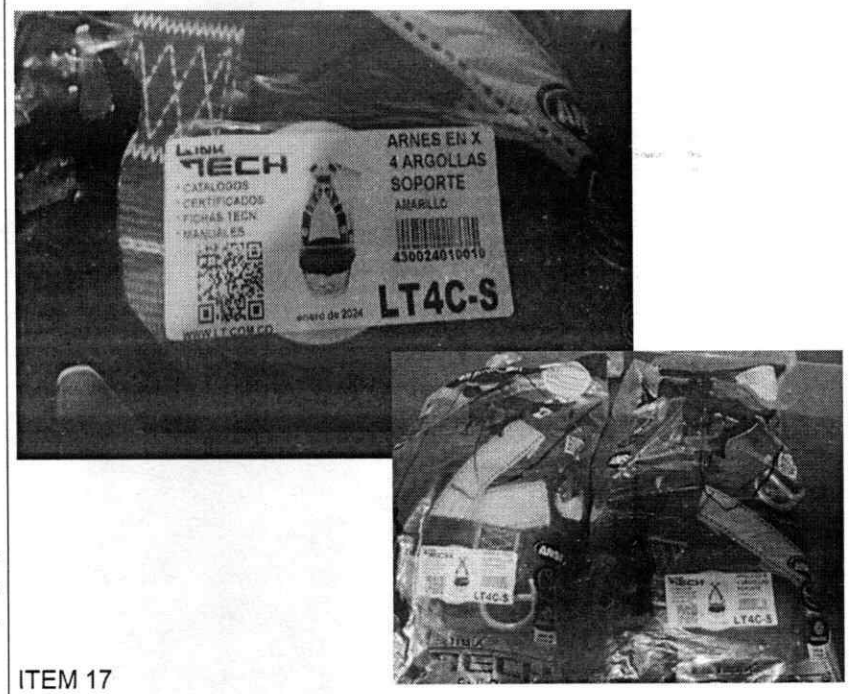


2.El equipo de andamio y equipos de alturas deberá cumplir con las contenidas en la Resolución Nro. 4272 de 2021.	SE EVIDENCIO QUE EL CONTRATISTA REALIZO LA ENTREGA DEL EQUIPO DE ANDAMIOS Y EQUIPOS DE ALTURAS EN CUMPLIMIENTO CON LAS CONTENIDAS EN LA RESOUCION No. 4272 de 2021, CONDICIONES Y CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO COMO SE EVIDENCIA EN REGISTRO FOTOGRAFICO ASI: ITEM 16  ITEM 17 


LANIX TECH
• CATALOGOS
• CERTIFICADOS
• FICHAS TECN
• MANUALES
ARNES EN X
DIELECTNICO
4 ARGOLLAS CON
SOPORTE
AMARILLO
432024100051
WWW.LT.COM.CO
octubre de 2024
LT4C-SDE

ITEM 18

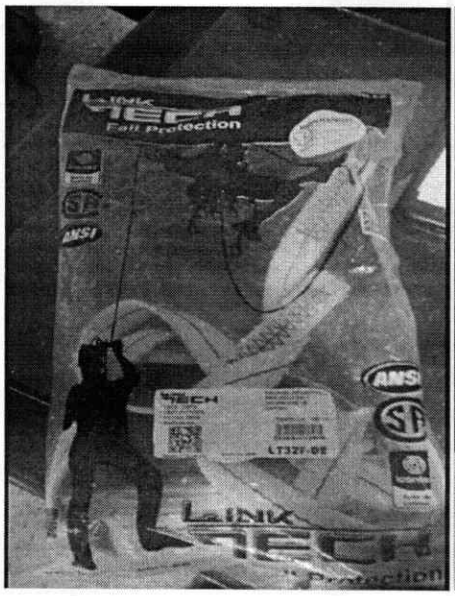
LANIX TECH
Fall Protection
ANSI
LT32F-DE

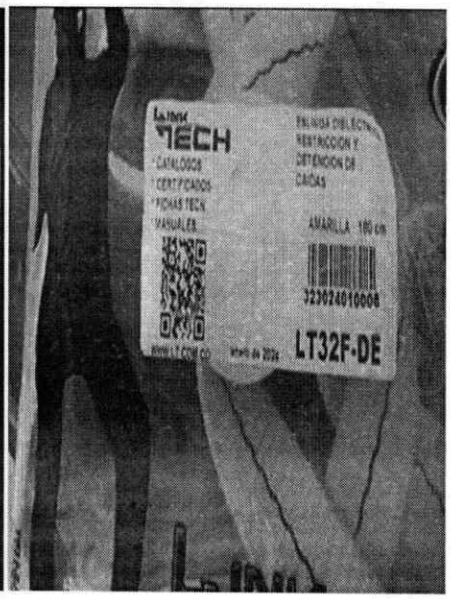
LANIX TECH
• CATALOGOS
• CERTIFICADOS
• FICHAS TECN
• MANUALES
AMARILLA 100 cm
323024010008
LT32F-DE


ITEM 19





ITEM 20




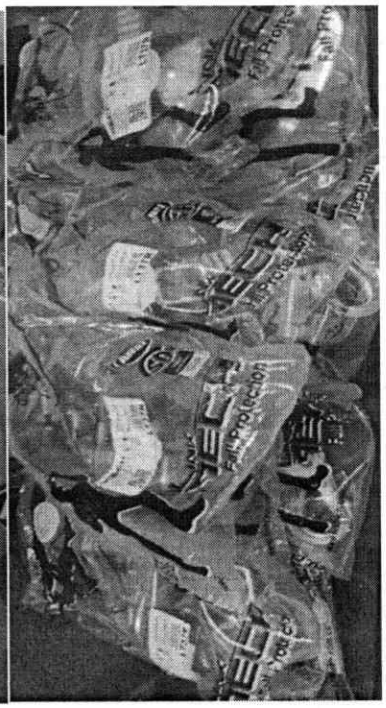


ITEM 21




ITEM 22

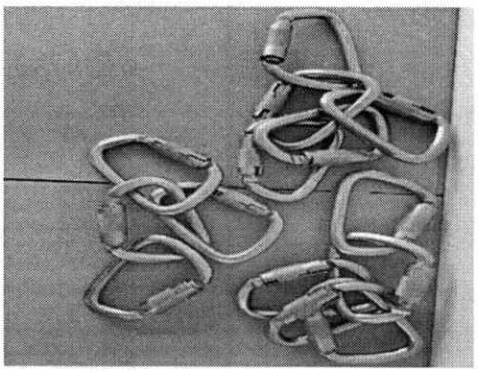


ITEM 23

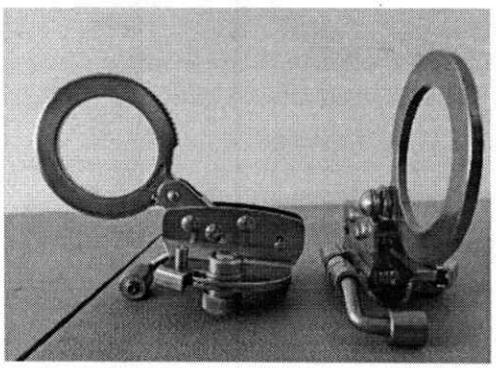


ITEM 24

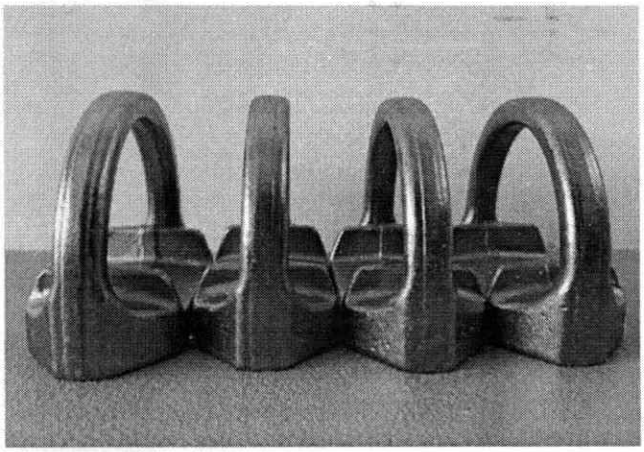



ITEM 25

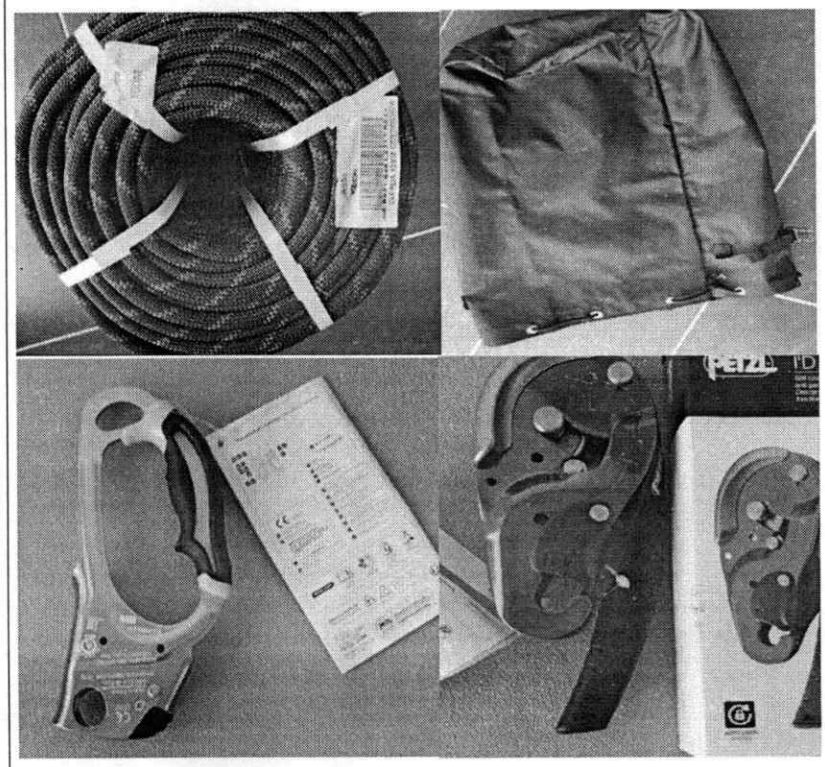



ITEM 26

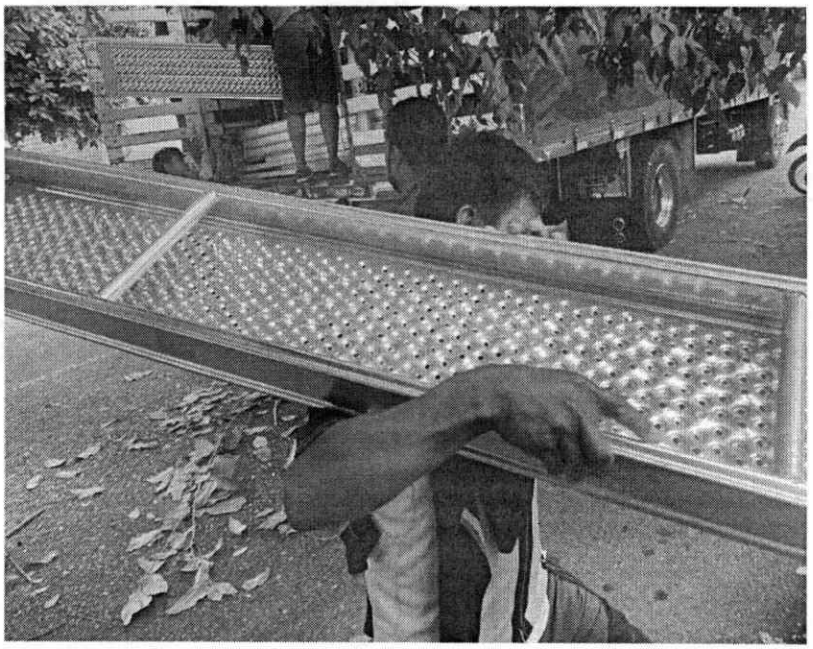


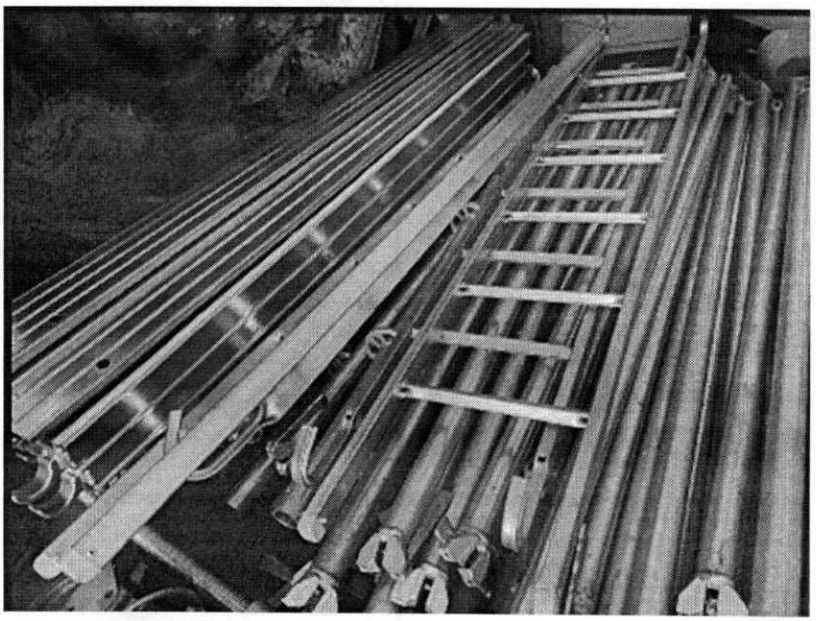


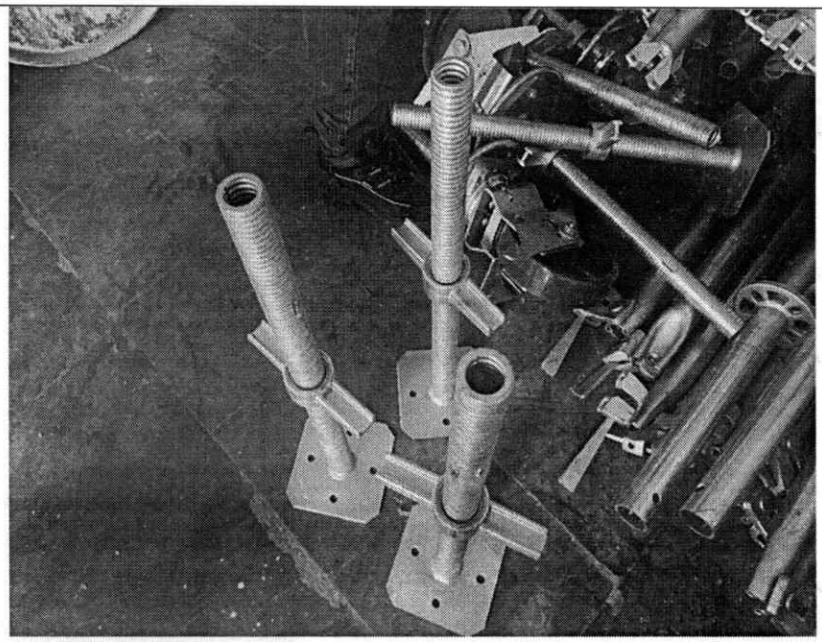


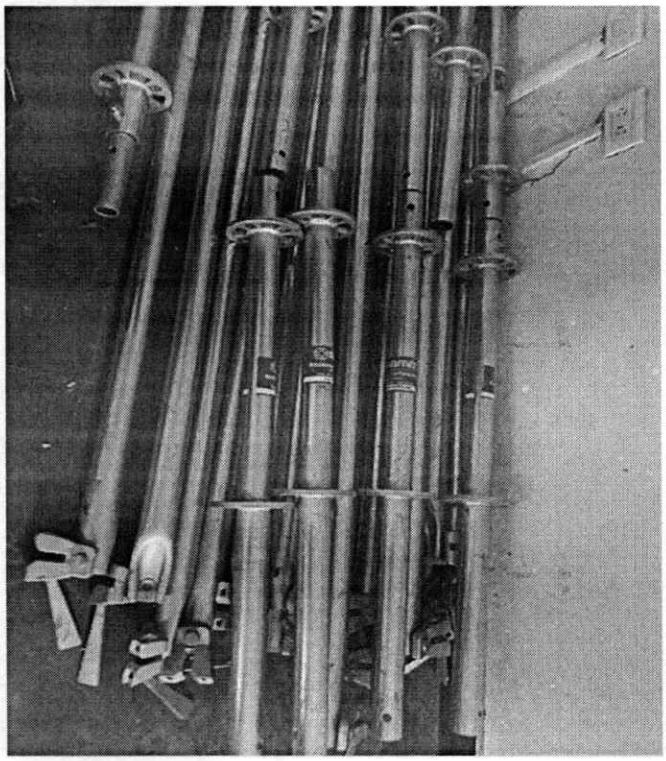


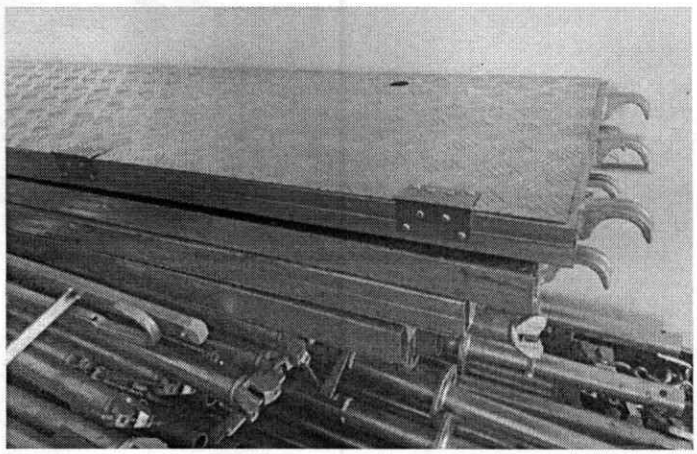


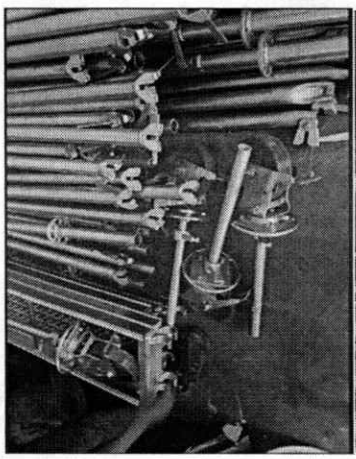


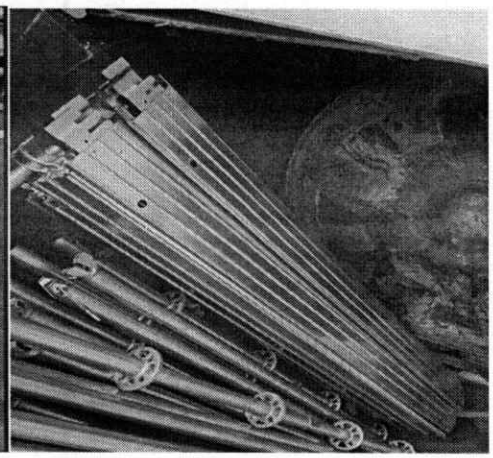

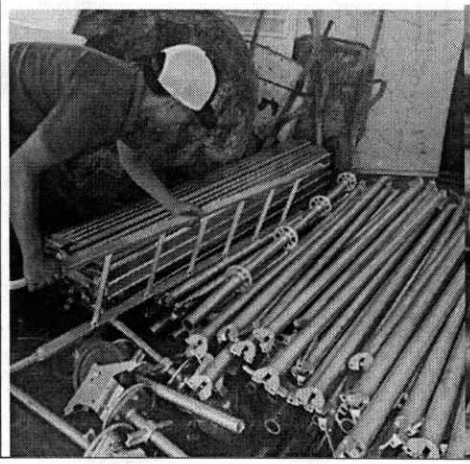

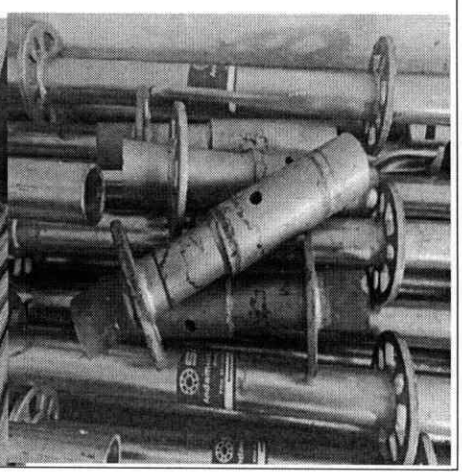

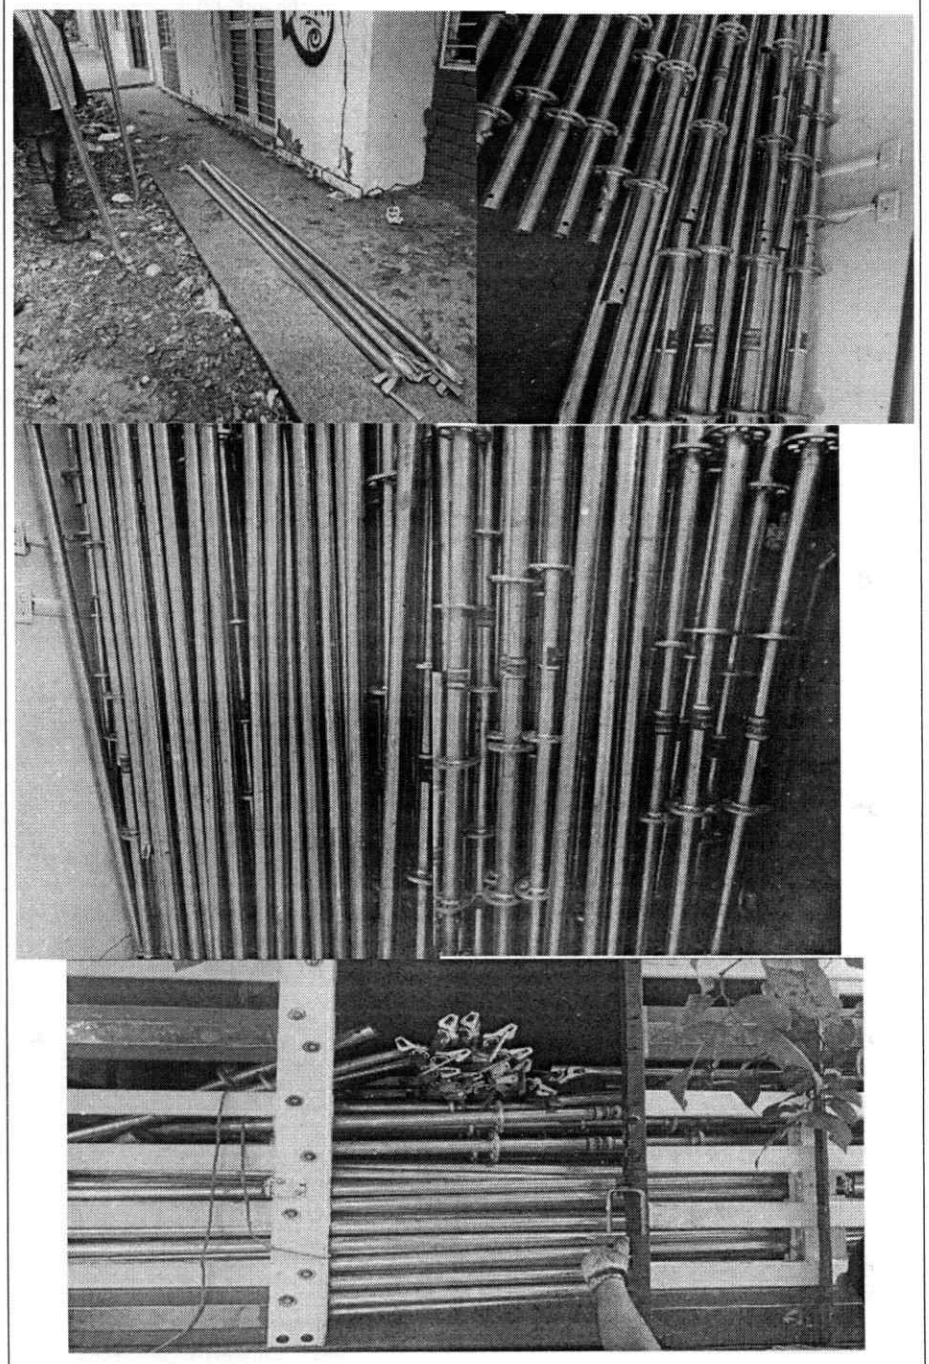

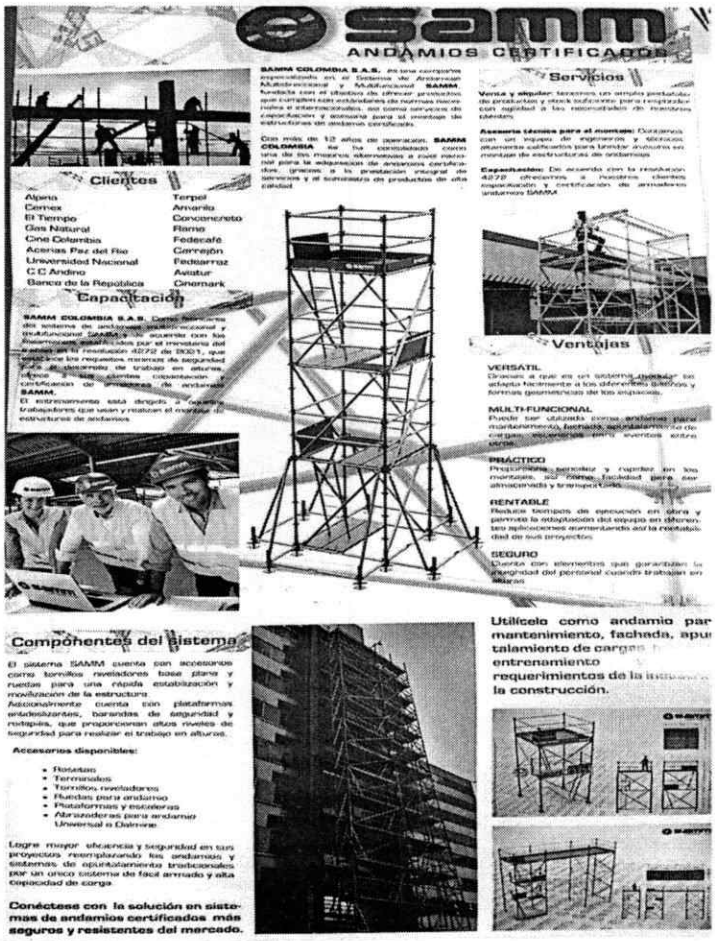3.Entregar los elementos contratados, en la cantidad solicitada por la entidad, previo visto bueno de la supervisión durante la ejecución del contrato	SE EVIDENCIO QUE EL CONTRATISTA REALIZO LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS OBJETO DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES, CONDICIONES Y CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO PREVIO VISTO BUENO DE LA SUPERVISION. COMO SE PUEDE EVIDENCIAR EN REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ELEMENTOS ENTREGADOS Y ENTRADA A ALMACÉN.
4.Entregar la certificación del elemento (andamio) de conformidad con la Resolución 4272 de 2021, previo visto bueno de la supervisión para su ingreso al Almacén municipal.	SE EVIDENCIO QUE EL CONTRATISTA REALIZO LA ENTREGA DE LA CERTIFICACION DEL EQUIPO DE ANDAMIOS EN CUMPLIMIENTO CON LAS CONTENIDAS EN LA RESOUCION No. 4272 de 2021 COMO SE PUEDE EVIDENCIAR ADJUNTO EN IMAGEN Y ENTRADA A ALMACÉN. 

5.De presentarse devoluciones por calidad, defectos de fabricación, especificaciones diferentes, el contratista repondrá el (los) elemento (s) dentro de las 24 horas siguientes al reclamo presentado.	SE EVIDENCIO QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS CARACTERISTICAS DE CADA ELEMENTO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y NO SE PRESENTO DEVOLUCIONES, NI DEFECTOS EN LOS ELEMENTOS ENTREGADOS. COMO SE PUEDE EVIDENCIAR EN ENTRADA A ALMACÉN.
6.Hacer la entrega de los elementos objeto y todos sus accesorios en el Almacén de la Alcaldía ubicado en la Sede Central del Palacio Municipal de Yopal.	SE EVIDENCIO QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS OBJETO Y TODOS SUS ACCESORIOS EN EL ALMACEN DE LA ALCALDIA. COMO SE PUEDE EVIDENCIAR EN ENTRADA A ALMACÉN.

2. El (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexaron con cada uno de los informes de actividades, los cuales han sido verificados por el suscrito.

3. Que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

Mediante comprobante de ingreso N°24-1631 de fecha 2024-12-19, por un valor de $3.184.000.00, discriminado así:

ESTAMPILLA PRO-CULTURA $ 490.000,00
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR $ 1.469.000,00
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE $ 1.225.000,00

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. MYCA-SG-MC-064-2024, así mismo los documentos físicos que hacen parte de la carpeta del expediente contractual correspondiente.

4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas.

5. LOGROS OBTENIDOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PROGRAMA	ACTIVIDAD	META	RESULTADO
N/A	N/A	N/A	SE REALIZO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTVIDADES CONTRATADAS LOGRANDO LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURAS, DEBIDAMENTE CERTIFICADOS, ASI COMO ELEMENTOS PARA BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL CUMLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. CONSISTENTE EN LA ENTREGA DE 26 ITEM, CADA UNO CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN LAS FICHAS TECNICAS, DEL PROCESO.

6. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El supervisor procede a evaluar el cumplimiento del contratista en la ejecución del contrato, estableciendo si se ha desarrollado eficientemente la ejecución contractual, y concluirá su evaluación con pronunciamientos oficiales sobre la aplicación de correctivos necesarios y requerimientos específicos sobre la ejecución contractual.

PERIODO DE EVALUACIÓN

PERIODO DE EVALUACIÓN		DICIEMBRE 19 DE 2024 A DICIEMBRE 26 DE 2024	
ASPECTO	**PUNTAJE**	**CRITERIOS**	**CALIFICACIÓN**
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA	5,0	EXCELENTE.- El contrato se terminó antes de lo estipulado por cumplimiento y entrega del bien o servicio.	5,0
	4,0	BUENO.- El contrato se terminó en la fecha estipulada.	
	3,5	REGULAR.- El contrato se entregó posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contrato se entregó en fecha posterior a la estipulada, superior al 20% de la duración del mismo.	
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE	5,0	EXCELENTE.- El contratista supera las expectativas y mejora las especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	5,0

PERIODO DE EVALUACIÓN		DICIEMBRE 19 DE 2024 A DICIEMBRE 26 DE 2024	
ASPECTO	**PUNTAJE**	**CRITERIOS**	**CALIFICACIÓN**
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	4,0	BUENO.- El contratista cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	
	3,5	REGULAR.- El contratista faltó a uno o más requisitos y/o especificaciones técnicas, que previo requerimiento fueron subsanadas sin incurrir en perjuicios para la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista presentó inconformidades graves en la calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas exigidas, ocasionando incumplimiento del contrato y dando lugar a la aplicación de garantías.	
GARANTÍAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista constituye las garantías para el perfeccionamiento del contrato del término señalado en la Minuta.	5,0
	4,0	BUENO.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías dentro del término pactado.	
	3,5	REGULAR.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías en fecha posterior al término pactado.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista se rehúsa a constituir la garantías requeridas.	
ATENCIÓN A INFORMES Y PQRS	5,0	EXCELENTE.- El contratista presenta los informes señalados en el contrato y da respuesta a las PQRS asignadas, sin petición y/o requerimiento de la Entidad.	5,0
	4,0	BUENO.- El contratista atiende dentro del término señalado por la Entidad, los informes, las peticiones y/o requerimientos.	
	3,5	REGULAR.- El contratista atiende posterior a la fecha estipulada, la presentación de informes, la respuesta a las peticiones y/o requerimientos de la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista desatiende la entrega de informes, las peticiones y/o requerimientos de la entidad.	
PRECIO	5,0	EXCELENTE: El precio es competitivo	5,0
	0,0	NO CUMPLE: el precio no es competitivo	
SEGURIDAD SOCIAL	5,0	EXCELENTE: El contratista realizó antes de las fechas estipuladas el pago a seguridad social.	5,0
	4,0	BUENO: El contratista cumplió oportunamente con el pago a seguridad social.	
	3,5	REGULAR: El contratista realizó el pago a seguridad social posterior a las fechas estipuladas.	

PERIODO DE EVALUACIÓN		DICIEMBRE 19 DE 2024 A DICIEMBRE 26 DE 2024	
ASPECTO	**PUNTAJE**	**CRITERIOS**	**CALIFICACIÓN**
	0,0	NO CUMPLE: El contratista no realizó los pagos a seguridad social	
CUENTAS DE COBRO O FACTURACIÓN	5,0	EXCELENTE: Presenta oportunamente la cuenta de cobro o facturación, sin requerimiento de la entidad.	5,0
	4,0	BUENO: Presenta la cuenta de cobro o facturación dentro de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	3,5	REGULAR: Presenta la cuenta de cobro o facturación por fuera de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	0,0	NO CUMPLE: No presenta la cuenta de cobro o facturación	
PROMEDIO			5,0

Criterios de Calificación Definida	**PUNTAJE**	**RESULTADO**
	4,5 - 5,0	Excelente - Proveedor y/o contratista confiable y recomendado.
	3,6 - 4,4	Bueno - Proveedor y/o contratista confiable.
	3,0 - 3,5	Regular - Proveedor y/o contratista poco confiable. Condicionado y/o Sancionado
	0,0 - 2,9	No Confiable - Proveedor y/o contratista NO confiable. Restringido.

El presente informe se firma en Yopal, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2024.

Atentamente,

DAVID LEONARDO ESPITIA CASTILLO
Profesional Universitario 4 – Supervisor