HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

Código	F-BIO-001
Versión	1
Fecha	Febrero 2017
Página	1 de 1

1. INFORMACION DE EQUIPO

EQUIPO	DEA			REGISTRO INVIMA	2017EBC-0018373		
MARCA	SCHILLER			SERVICIO	TAB		
MODELO	FRED EASY			UBICACIÓN	AMB. NXY747		
SERIE	058997071434			CALIBRACIÓN	ANUAL		
N.° INVENTARIO				TIPO DE EQUIPO	FIJO		MOVIL	X
FECHA DE COMPRA	13/12/2024	FECHA INSTALACION	13/12/2024	GARANTIA			
EQUIPO PROPIO		EQUIPO COMODATO		DONACION			

2. FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO

MENSUAL		BIMENSUAL		TRIMESTRAL		CUATRIMESTRAL	X	SEMESTRAL		ANUAL	

REGISTRO FOTOGRAFICO	ACCESORIOS	
	CANTIDAD	ACCESORIO
		

3. CARACTERISTICAS TECNICAS

VOLTAJE	14,8 VDC	CORRIENTE	N/A	POTENCIA	N/A	FRECUENCIA	N/A	TEMP. DE TRABAJO	

CLASIFICACION RIESGO SEGUN 4725 DE 2005		CLASIFICACION DE USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		TECNOLOGIA PREDOMINANTE			
				DIAGNOSTICO					
				MTTO DE LA VIDA	X	ELECTRICO		NEUMATICO	
RIESGO I		MEDICO	X	PREVENCION		ELECTRONICO	X	ACUSTICO	
RIESGO IIA		BASICO		REHABILITACIÓN		ELECTROMECANICO		SOLAR	
RIESGO IIB	X	APOYO		EQ. LABORATORIO		MECANICO		VAPOR	
RIESGO III		OTRO		EQ. ODONTOLOGIA		HIDRAULICO		OTRO	

4. RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

UTILICE EL DESFIBRILADOR SÓLO EN PERSONAS QUE PAREZCAN INCONSCIENTES Y SIN SIGNOS DE VIDA. ES IMPORTANTE NO UTILIZAR EL DESFIBRILADOR EN PERSONAS QUE NO REQUIERAN ESTE TRATAMIENTO. ASEGÚRESE DE QUE LA PIEL DE LA PERSONA ESTÉ LIMPIA Y SECA ANTES DE COLOCAR LOS ELECTRODOS DEL DESFIBRILADOR. ES IMPORTANTE ELIMINAR CUALQUIER RESTO DE SUCIEDAD O SUDOR DE LA PIEL, YA QUE PUEDE INTERFERIR EN LA TRANSMISIÓN DE LAS DESCARGAS ELÉCTRICAS. EVITE TOCAR A LA PERSONA MIENTRAS EL DESFIBRILADOR ESTÉ ADMINISTRANDO UNA DESCARGA ELÉCTRICA, YA QUE ESTO PUEDE CAUSAR INTERFERENCIAS ELÉCTRICAS Y PONER EN PELIGRO AL PACIENTE O AL CUIDADOR. COMPRUEBE PERIÓDICAMENTE LA BATERÍA Y LOS ELECTRODOS DEL DESFIBRILADOR PARA ASEGURARSE DE QUE FUNCIONAN CORRECTAMENTE. REALICE COMPROBACIONES PERIÓDICAS DEL DESFIBRILADOR PARA ASEGURARSE DE QUE ESTÁ LISTO PARA SU USO EN CASO DE EMERGENCIA. ES IMPORTANTE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE PARA EL MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL DESFIBRILADOR. MANTENGA EL DESFIBRILADOR EN UN LUGAR SECO Y ALEJADO DEL CALOR, LA HUMEDAD Y LOS GOLPES. SIGA LAS DIRECTRICES DE FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA UTILIZAR UN DESFIBRILADOR. ES IMPORTANTE RECIBIR UNA FORMACIÓN ADECUADA EN EL USO DEL DESFIBRILADOR PARA MINIMIZAR EL RIESGO PARA EL PACIENTE Y EL CUIDADOR.

HOSPITAL SAN VICENTE
ROVIRA TOLIMA



HOJA DE VIDA DE EQUIPO

EQUIPO: DESFIBRILADOR DEA	MARCA: SCHILLER	MODELO: FRED EASY
SERIE: 058997071434	CLASIFICACION DE DISPOSITIVO MEDICO: RIESGO ALTO (IIB) TRATAMIENTO	
FECHA DE COMPRA: 13-12-2024	FECHA DE INSTALACION: 13-12-2024	VENCIMIENTO DE GARANTIA: UN AÑO
DATOS DEL PROVEEDOR: OSMEC AMBULANCIA	TELEFONO: 3153083450	
PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO: ANUAL	UBICACIÓN: AMBULANCIA PLACA NXY 747	EQUIPO: MOVIL
REGISTRO INVIMA: 2017EBC-0018373 0016373		

FUNCION: Equipo utilizado en adultos y niños en situacion de parada cardiaca repentina. El paciente debe estar: inconciente, sin respiración o sin respiracion normal. .

RECOMENDACIONES DE FABRICANTE:

- La prueba funcional debe hacerse a diario a través del menú configuraciones
- No apoyar elementos arriba del equipo. Por ejemplo: soluciones, envases, cables, gasas, etc.
- No utilizar solventes para limpiar el equipo y los accesorios. Utilizar un paño húmedo.
- DEA: El equipo elimina automaticamente la energia almacenada internamente en las siguientes condiciones: Se detecta un cambio de ritmo y ya no es necesaria una descarga, Se detecta un fallo en el funcionamiento de los electrodos.

REGISTRO TECNICO DE INSTALACION

VOLTAJE: 110 VAC; DC 12V	PARAMETROS: DEA, DESFIB, MONITOR ECG, MARCAPASOS	FRECUENCIA: 60 Hz	DIMENCIONES: 30 * 21,5 * 28 cm
CORRIENTE: 1,1-0,5 Ah	PESO NETO: 6,50 KG	TECNOLOGIA PREDOMINANTE: ELECTRONICA	

REGISTRO TECNICO DE FUNCIONAMIENTO

TEMPERATURA: 0-40 °C	RESOLUCION PANTALLA: N/A	
Li-Ion, 14,8 VDC 4,4 A/h Duración 3 horas en modo monitor; 200 descargas a 200J	Instrucciones por voz, indicaciones visuales, instrucciones de RCP , USB 2.0 para sincroníar con PC, múltiple idiomas, tecnología PMS Prevención de Muerte Súbita.	Accesorios Bateria no recargable, electrodos PADS

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PLANIFICADO SEGÚN PARAMETROS DE FABRICANTE

EQUIPO	DESFIBRILADOR DEA
MARCA	SCHILLER
MODELO	FRED EASY
SERIE	058997071434
N° INVENTARIO	

- **Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo**
- **Efectuar limpieza integral externa del equipo**
- **Inspeccionar el equipo en forma externa**
- **Efectuar limpieza integral interna del equipo**
- **Realice la prueba de usuario de la siguiente manera: Ingresar al menú de configuración, elegir prueba funcional en la pantalla, seguir los pasos indicados por el menu de prueba, al finalizar la prueba puede continuar su uso sin necesidad de apagar el equipo.**

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION

- **La limpieza se debe hacer con el equipo apagado y sin bateria**
- **Utilice un paño suave, humedecido con una solución desinfectante**
- **El líquido no debe derramarse hacia el interior del equipo**
- **No utilizar esponjas metálicas no líquidos corrosivos como soluciones cloradas**
- **Realizar limpieza profunda del equipo se recomienda, luego de ello, proteger la superficie con algún producto siliconado que dará brillo y aumentará la vida útil de la pintura**
- **Cuando limpie o desinfecte el interior, utilice solo agentes de limpieza. No utilice desinfectantes alcalinos o liberadores de cloro porque son corrosivos.**

BIOMEDICAL SOLUTIONS
INGENIERIA

NIT. 53116519-2
REGIMEN COMUN

REPORTE DE SERVICIO

FECHA:	12/12/2024	**REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO**		HORA INICIO:	10:00
INSTITUCION:	HOSPITAL SAN VICENTE	PROCESO:	AMBULANCIA	AREA:	MOVIL NXY 747

DATOS DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	DEA			MARCA:	SCHILLER
SERIE:	58.997.071.434	MODELO:	FRED EASY	INV. N°.:	

ACCESORIOS DEL EQUIPO

PADS ADULTO, BATERIA, DISPLAY

DIAGNOSTICO INICIAL

	ESTADO		CONDICIONES AMBIENTALES DE USO SEGÚN LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE			
1	FISICO	BUENO	HUMEDAD:	46%	T°:	24,2 °C
2	FUNCIONAMIENTO	BUENO	SEGURIDAD DE LA INSTALACION:			
3	BATERIAS	BUENO	EQUIPO NUEVO, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO			
4	ACCESORIOS	BUENO				

DESCRIPCION DEL SERVICIO

LIMPIEZA INTERNA	☐	LIMPIEZA EXTERNA	☐	DESINFECCION	☐	DESMANCHADO	☐
LIMPIEZA CONTACTOS	☐	LUBRICACION	☐	ENGRASE	☐	REEMPLAZO DE PARTES	☐

Se realiza hoja de vida

ELEMENTOS UTILIZADOS:

PRUEBAS FUNCIONALES

VERIFICACION DE:

SISTEMA ELECTRICO	X	ENCENDIDO	X	CONFIGURACION A TRAVES DEL MENU	X
SISTEMA MECANICO	☐	ACCESORIOS	X	FUNCIONAMIENTO DEL DISPLAY, PANTALLA	X
SISTEMA HIDRAULICO	☐	ALARMAS VISUAL	X	FUNCIONAMIENTO DEL MANOMETRO	☐
SISTEMA NEUMATICO	☐	ALARMAS AUDIBLES	X	FUNCIONAMIENTO DEL TECLADO, PERILLAS, CONTROLES	X
VIDA DE LA BATERIA	X	FUGAS	☐	TARJETAS ELECTRONICAS Y CONECTORES	☐
SEGURIDAD ELECTRICA	X	FILTROS	☐	EMPAQUES	☐
PRUEBAS DE FABRICA	X	BOMBILLOS	☐	NIVELES DE FLUJO	☐
		ALMACENAMIENTO DE DATOS Y MEMORIA	☐	NIVELES DE PRESION	☐

REPUESTOS UTILIZADOS

OBSERVACIONES

EQUIPO NUEVO, SE VERIFICA AUTONOMIA DE LA BATERIA, LISTO PARA USAR

EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE	SI	X	NO	☐	HORA FINAL: 10:10

FECHA DEL PROXIMO MANTENIMIENTO: dic-25

ING. BIOMEDICO

FUNCIONARIO ENCARGADO

NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2017037742 DE 12 de Septiembre de 2017
Por la cual se CORRIGE PARCIALMENTE una Resolución

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA , en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 y Ley 1437 de 2011.

EXPEDIENTE: 20120050
PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN: INVIMA 2017EBC-0016373

RADICACIÓN: 2017098852
VIGENCIA: 01/06/2027

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2017022463 de 1 de Junio de 2017, el INVIMA concedió Permiso de Comercialización No. INVIMA 2017EBC-0016373, para el producto DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO- ACCESORIOS Y REPUESTOS, a favor de SCHILLER AMERICAS, INC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, en la modalidad de Importar y Vender.

Que mediante escrito numero 2017098852 radicado el 13/07/2017, el Doctor FRANCESCO IACONA, actuando en representación de la empresa SCHILLER AMERICAS, INC, solicitó Corrección a la Resolución No. 2017022463 de 1 de Junio de 2017, en el sentido de corregir la razón social del fabricante SCHILLER MEDICAL INC, con domicilio en FRANCIA.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que revisada la documentación que reposa en el expediente, se pudo comprobar que por error de la administración se digitó erróneamente la razón social del fabricante SCHILLER AG MEDICAL, siendo lo correcto SCHILLER MEDICAL, razón por la cual se corrige la Resolución No. 2017022463 de 1 de Junio de 2017 y la base de datos del Instituto.

En este sentido y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual a letra dice " *En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras...*" este Instituto considera procedente acceder a lo solicitado y en consecuencia la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: CORREGIR PARCIALMENTE la Resolución No. 2017022463 de 1 de Junio de 2017, en el sentido de aclarar la razon social del fabricante en el Permiso de Comercialización INVIMA 2017EBC-0016373, a favor de SCHILLER AMERICAS, INC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, quedando:

"(...)

FABRICANTE (S): *SCHILLER MEDICAL con domicilio en FRANCIA (...).*

(...)".

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante el DIRECTOR TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los DIEZ (10) dias siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 12 de Septiembre de 2017
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

Validez desconocida
Firmado digitalmente por ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
Fecha 2017/09/12 11:15:13
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C. Colombia

ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: cacevedog, Técnico: ydiazg Revisó: cordina_varios

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Carrera 10 No 64-28
PBX 2948700
Bogotá - Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2023**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

3520235643321 00-9

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	11. Apellidos y nombres o Razón Social
52048303	3	HE EQUIPOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CARRERA 13#43A-10	3505718137	48	13	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
91076655	9	AGENCIA DE ADUANAS CONTINENTAL DE ADUANAS S.A.S. NIVEL 1	26	101

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
66739450	BREEMEL ARTURO ESCORCIA MIRANDA

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34 No Formulario Anterior	35. Año - Mes - Dia	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Dia	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Dia	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Dia
CTG	7201	No. 116575013474341	2023 - 12 - 10	No. SSZ1365678	2023 - 12 - 10

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod Pais Exportador
ETG COMMODITIES LTD	MAURITIUS	756

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
OFFICE 19&20, 1827 BUILDING, VIVEA BUSINESS PARK	@NOTIENE

51. No. de factura	52. Año - Mes - Dia	53. Cod. pais procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
S2848	2023 - 12 - 10	105	1	169	13	FRONTIER AGENCIA MARITIMA	4,179.98

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. pais de origen	67. Cod. Acuerdo
	1701999000	XX	XX	C102	XX	XXXX	XX	105	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. pais compra	71. Peso bruto kgs. doms.	72. Peso neto kgs. doms.	73. Código embalaje	74. No bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad doms.
01	01	756	270,810.00	270,000.00	BG	5400	1	kg	270,000.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
185,230.00	17,000.00
80. Valor Seguros USD	**81. Valor Otros Gastos USD**
270.00	2,174.55
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	**83. Ajuste valor USD**
19,444.55	0.00
84. Valor aduana USD	**85. Código registro o licencia** / **86. Número**
204,674.55	R / 50081305
87. Cod. oficina / **88. Año**	**89. Programa No** / **90. Cód Interno del Producto**
3 / 2022	XXXXXXXXXX / 0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 855,535,526	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 5.00	98 855,535,526	99 42,777,000	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 42,777,000		126 0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

11XCL 6742/25 ENTRADA ADUADERA NO. 30205234 DEL 2023-12-10 /// --- / MERCANCÍA NUEVA /// CANTIDAD 30 NOS ACOGEMOS AL DECRETO 551 DEL 2020 Y DECRETO 410 DEL 25 DE 2020 AAF, I.. E AL DECRETO 463 DEL 29 MRZ 2020. AAF. 1. DESFIBRILADOR AUTOMATICO EXTERNO MARCA HEARTSINE SAMARITAN PAD 350P/360P SERIALES # 21D91087175E21, 65K72436632B15, 33N46039930Y52, 83P21376618S16, 34E26261316Z74, 89D59058878L55, 90P37432014C23, 15F67701004L91, 11P27101925V06, 52095155406S52, 95C22003807A67, 65V79347231C11, 85P23786435A07, 07S03238455C79, 70F92378123F33, 44M94848627Z25, 78N81283563P99, 43Y19206221T98, 01X79788980U14, 18L95574958B96, 49I56597813V82, 75Q45431683Z68, 64X79713481Q20, 97V80751604D58, (continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: **0**

128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX

129 Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático

No hay declaración posterior

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración
352023564332100

133 Feha: 2023 - 12 - 10

134. Levante No. 482023000311248

135. Fecha 2023 - 12 - 10

Firma funcionario responsable

136. Nombre

137. C.C. No

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

91035022854622

Fecha de Impresión: 2023 - 12 - 10 09 : 20 : 00

202395634496

Scanned with CamScanner

DIAN REPÚBLICA DE COLOMBIA	**Declaración de Importación**	Aceptación : **482019000819546-9** Subpartida : **2710193300** Página 1 de

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

```
85Q83711347M09, 07Z54337916A18, 84X46137815M83, 20032096782S21, 56H79479323Y21, 06E03762821R46.  4o mini Cod: NYTRO IZAR II.
LOTE: T211-190713 Cant (30) Tonelada metrica (30) (Item 1)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

352023564332100-9	Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

Scanned with CamScanner

BIOMEDICAL SOLUTIONS

DIAG. 5ª No. 37B 60 BLOQUE 15ª APTO. 503
NIT. 53116519-2

Certificado N° MP 704-24

INFORMACION DEL SOLICITANTE
Customer information

CLIENTE: HOSPITAL SAN VICENTE
Client

CIUDAD: ROVIRA (TOLIMA)

INFORMACION DEL EQUIPO BAJO PRUEBA.
Device under test information.

EQUIPO: **DESFIBRILADOR AUTOMATICO**
Equipment
MARCA: SCHILLER
Brand
MODELO: FRED EASY
Model
SERIE: 58.997.071.434
Serial
ID. Institución:
ID. Institution


LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRUEBA
Place and conditions of test

Lugar de la Calibración: LABORATORIO
Place of Calibration
Fecha de Calibración: 12-12-2024
Date of Calibration
Fecha de Recepción: 06-12-2024
Date of Receipt
TEMPERATURA: 20,4 °C
Temperature
HUMEDAD R: 58 %
Humidity

NOTAS:
Notes:

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso escrito de BIOMEDICAL SOLUTIONS. Los resultados contenidos en el presente documento se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos probados. El usuario es responsable del seguimiento de sus instrumentos a intervalos apropiados.

FIRMAS
Signatures:



FABIAN ALFONSO ARCE RAMIREZ
INGENIERO DE CALIBRACION

BIOMEDICAL SOLUTIONS
INGENIERIA

DIAG. 5ª No. 37B 60 BLOQUE 15ª APTO. 503
NIT. 53116519-2

Certificado N° MP704-24

Calibración del equipo

Método utilizado:

Comparación directa con el patrón de referencia. La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza de 95% utilizando un factor de cobertura k=2

Información de Trazabilidad


Los resultados de este certificado de calibración son trazables al SI a través de un instituto de medición reconocido nacionalmente y cumple con la norma ISO 17025:2017.

Información de los instrumentos utilizados

PATRON	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA CALIBRACION	CERTIFICADO
ANALIZADOR DE DESFIBRILACION	PHYSIO CONTROL	NO TIENE	31234158	08/03/2024	J5346-24

RESULTADOS DE CALIBRACION

CALIBRACION DE DESFIBRILACION			
ENERGIA INDICADA EN EL PATRON J	**ENERGIA ENTREGADA ITEM J**	**ERROR**	**INCERTIDUMBRE J**
360 J	350 J	10 J	2,59
360 J	340 J	20 J	3,49
360 J	320 J	40 J	3,59
360 J	320 J	40 J	3,59
360 J	320 J	40 J	3,59

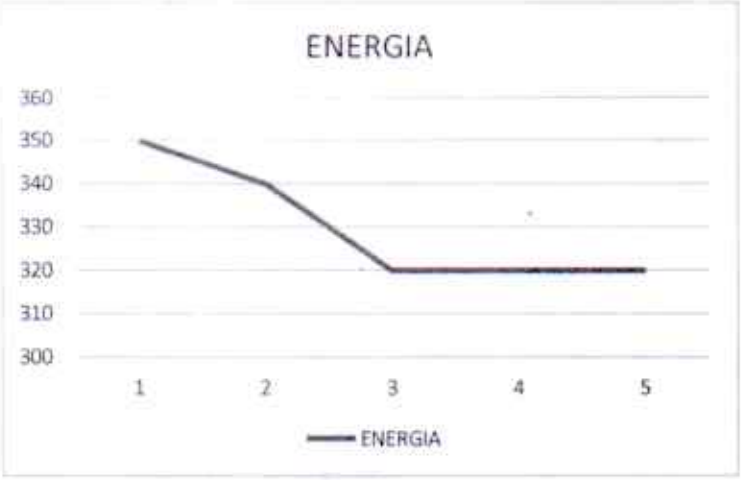

ERROR MAXIMO: 40 J

INCERTIDUMBRE MAXIMA: +/- 3,59 J

VALOR PROMEDIO (VP): 330J SELECCIONANDO EL PATRON A 360J

FIN DEL CERTIFICADO

SET∝GAD
Metrología

Certificado de Calibración

PLT-LAB-025

V.3 2022 / 02 / 22 Rev. 5 2023 / 10 / 11

Certificado # J5346-24

Laboratorio de Metrología Set & Gad S.A.S. – Bogotá

Descripción del equipo:	Analizador de desfibrilación	Condición como se recibió:	Operable
		Fecha de calibración:	2024-03-08
Fabricante:	Physio Control	Método de Calibración:	INS LAB IMPULSE-7000DP
Serie No.:	31234158	Temperatura:	21,6 °C
Nombre del cliente:	Biomedical Solutions	Humedad:	51%
Dirección:	Diag. 5A N°37b60		
Ciudad:	BOGOTA		
Fecha de recepción	08/03/2024		

Patrones de calibración

Instrumento	Número de Serie	Due Date	ID Certificado
IMPULSE 7000 GS	1551005	02/04/2023	1551005-1804180842

Descripción de la calibración

La calibración del equipo bajo prueba se hace con un instrumento patrón trazable al sistema internacional de unidades... Los resultados emitidos en este certificado de calibración, describe al equipo bajo prueba en el momento que está siendo calibrado.

Este certificado de calibración no puede ser reproducido ni parcial ni de forma completa, sin la aprobación escrita del laboratorio SET & GAT.

Calibración: Datos de calibración obtenidos sin haber realizado ninguna clase de ajustes y/o reparación.

Set & Gad mantiene los patrones de referencia en condiciones físicas adecuadas para su conservación, estos patrones han sido calibrados con trazabilidad internacional o nacional, bajo estándares definidos por casa matriz, dependiendo de sus especificaciones.

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos adecuados.

S∝G Metrología

Digitally signed by Felipe Uribe
DN: cn=Felipe Uribe, o=Set y Gad SAS, email=felipe.urib@esetgad.com, c=CO

Revisó y autorizó calibración
Ing. Luis Felipe Uribe Agudelo

SET GAD
Metrología

Certificado

J5346-24

RESULTADOS DE LA MEDICION

Calibración Resistencia a Carga

Nominal	EBC	Patrón	Corrección	Incertidumbre	k
50 — APEX (+) — STERNUM (—)	50	50,595	0,595	0,01	2

Calibración de Energía

Nominal — Monofásica	Especificación J	EBC J	Corrección J	Incertidumbre J	k
10 J	10,1	11	990	0,58	2
50 J	50,6	52	-1,4	0,61	2
100J	100,8	103	-2,2	0,67	2
200 J	202,3	205	-2,7	0,85	2
360 J	364,4	368	-3,6	1,2	2

FIN DEL CERTIFICADO

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

Código	F-BIO-001
Versión	1
Fecha	Febrero 2017
Página	1 de 1

1. INFORMACION DE EQUIPO

EQUIPO	FLUJOMETRO			REGISTRO INVIMA	2016DM-0015134		
MARCA	MCARE			SERVICIO	TAB		
MODELO	FM4546			UBICACIÓN	AMB. NXY747		
SERIE				CALIBRACIÓN	ANUAL		
N.° INVENTARIO				TIPO DE EQUIPO	FIJO	X	MOVIL
FECHA DE COMPRA	13/12/2024	FECHA INSTALACION	13/12/2024	GARANTIA			
EQUIPO PROPIO		EQUIPO COMODATO		DONACION			

2. FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO

MENSUAL		BIMENSUAL		TRIMESTRAL		CUATRIMESTRAL	X	SEMESTRAL		ANUAL	

REGISTRO FOTOGRAFICO	ACCESORIOS	
	CANTIDAD	ACCESORIO
		

3. CARACTERISTICAS TECNICAS

VOLTAJE	N/A	CORRIENTE	N/A	POTENCIA	N/A	FRECUENCIA	N/A	TEMP. DE TRABAJO	

CLASIFICACION RIESGO SEGUN 4725 DE 2005		CLASIFICACION DE USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		TECNOLOGIA PREDOMINANTE			
				DIAGNOSTICO					
				MTTO DE LA VIDA		ELECTRICO		NEUMATICO	X
RIESGO I		MEDICO		PREVENCION		ELECTRONICO		ACUSTICO	
RIESGO IIA	X	BASICO	X	REHABILITACIÓN	X	ELECTROMECANICO		SOLAR	
RIESGO IIB		APOYO		EQ. LABORATORIO		MECANICO		VAPOR	
RIESGO III		OTRO		EQ. ODONTOLOGIA		HIDRAULICO		OTRO	

4. RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

LIMPIEZA CON UN PAÑO SUAVE
NO GIRAR CON FUERZA LA PERILLA DE REGULACION
NO GOLPEAR NI DEJAR CAER EL EQUIPO

HOSPITAL SAN VICENTE
ROVIRA TOLIMA



HOJA DE VIDA DE EQUIPO

EQUIPO: FLUJOMETRO	MARCA: MCARE	MODELO: FM4546
SERIE: NO TIENE	CLASIFICACION DE DISPOSITIVO MEDICO: Riesgo Medio (IIA) TRATAMIENTO	
FECHA DE COMPRA: 13-12-2024	FECHA DE INSTALACION: 13-12-2024	VENCIMIENTO DE GARANTIA: UN AÑO
DATOS DEL PROVEEDOR: OSMEC AMBULANCIA		TELEFONO: 3153083450

PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO: ANUAL	UBICACIÓN: AMBULANCIA PLACA NXY 747	EQUIPO:	MOVIL X	FIJO	

REGISTRO INVIMA :	2016DM-0015134

FUNCIONES: Suministro de oxigeno medicinal a pacientes con fallas pulmonares o con alguna complicación medica que afecte el porcentaje de saturación de oxigeno.

RECOMENDACIONES DE FABRICANTE:

- No golpear el equipo, trate el oxigeno medicinal con precaución ya que es un compuesto infamable
- Verificar el funcionamiento antes de iniciar el turno.

REGISTRO TECNICO DE INSTALACION

VOLTAJE: N/A	TAMAÑO: 10 X 4 X 8 cm	POTENCIA: N/A
TEMPERATURA: +10° C + 40° C	PESO: 130 gr	FLUJO: 0-15 LPM

REGISTRO TECNICO DE FUNCIONAMIENTO

HUMEDAD: hasta 85% de humedad relativa	Condiciones de almacenamiento: Sin pila : -25°C a +70° C (-13° F a +158° F)	PRESION MAXIMA DE TRABAJO: 55 PSI Max.

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PLANIFICADO SEGÚN PARAMETROS DE FABRICANTE

EQUIPO	FLUJOMETRO
MARCA	M CARE
MODELO	FM4546
SERIE	N/A
N° INVENTARIO	

- Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo
- Efectuar limpieza integral externa del equipo
- Efectuar limpieza integral interna del equipo
- Inspeccionar sistema de conexión de oxigeno
- Verificar el funcionamiento de los empaques
- Verificar el tubo indicador y el balin indicador de flujo
- Verificar funcionamiento del equipo en conjunto.

Material Gastable	Repuestos Minimos	Herramientas y Equipos
•FRANELA •LIMPIADOR DE CONTACTOS • LIMPIADOR DE SUPERFICIES LIQUIDO • AGUA JABONOSA		• LLAVE EXPANSIVA

BIOMEDICAL SOLUTIONS
INGENIERIA

NIT. 53116519-2
REGIMEN COMUN

REPORTE DE SERVICIO

FECHA:	12/12/2024	**REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO**		HORA INICIO:	10:40
INSTITUCION:	HOSPITAL SAN VICENTE	PROCESO:	AMBULANCIA	AREA:	MOVIL NXY 747

DATOS DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	FLUJOMETRO			MARCA:	MCARE
SERIE:	NO TIENE	MODELO:	FM4546	INV. N°.:	

ACCESORIOS DEL EQUIPO

ESPIGO, VALVULA REGULADORA, ACOPLE TIPO DISS, TUBO INDICADOR DE FLUJO

DIAGNOSTICO INICIAL

	ESTADO		CONDICIONES AMBIENTALES DE USO SEGÚN LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE			
1	FISICO	BUENO	HUMEDAD:	49%	T°:	21,2 °C
2	FUNCIONAMIENTO	BUENO	SEGURIDAD DE LA INSTALACION:			
3	BATERIAS	N/A	EQUIPO NUEVO, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO			
4	ACCESORIOS	BUENO				

DESCRIPCION DEL SERVICIO

LIMPIEZA INTERNA ☐	LIMPIEZA EXTERNA ☐	DESINFECCION ☐	DESMANCHADO ☐
LIMPIEZA CONTACTOS ☐	LUBRICACION ☐	ENGRASE ☐	REEMPLAZO DE PARTES ☐

Se realiza hoja de vida

ELEMENTOS UTILIZADOS:

PRUEBAS FUNCIONALES

VERIFICACION DE:

SISTEMA ELECTRICO	☐	ENCENDIDO	☐	CONFIGURACION A TRAVES DEL MENU	☐
SISTEMA MECANICO	☐	ACCESORIOS	☒	FUNCIONAMIENTO DEL DISPLAY, PANTALLA	☐
SISTEMA HIDRAULICO	☐	ALARMAS VISUAL	☐	FUNCIONAMIENTO DEL MANOMETRO	☐
SISTEMA NEUMATICO	☒	ALARMAS AUDIBLES	☐	FUNCIONAMIENTO DEL TECLADO, PERILLAS, CONTROLES	☒
VIDA DE LA BATERIA	☐	FUGAS	☒	TARJETAS ELECTRONICAS Y CONECTORES	☐
SEGURIDAD ELECTRICA	☐	FILTROS	☐	EMPAQUES	☒
PRUEBAS DE FABRICA	☒	BOMBILLOS	☐	NIVELES DE FLUJO	☒
		ALMACENAMIENTO DE DATOS Y MEMORIA	☐	NIVELES DE PRESION	☐

REPUESTOS UTILIZADOS

OBSERVACIONES

EQUIPO NUEVO, LISTO PARA USAR, SE VERIFICAN FUGAS Y SALIDAD DE PRESION

EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE	SI	☒	NO	☐	HORA FINAL: 10:50
FECHA DEL PROXIMO MANTENIMIENTO:	dic-25				

ING. BIOMEDICO

FUNCIONARIO ENCARGADO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2024**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032024001521087-8

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830038639 | 6. DV.: 1 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: FUTUMEDICA SAS

13. Dirección: CL 78 63 45 | 35. Teléfono: 6300122 | 12. Cód. Admón.: 03 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860514173 | 25. DV.: 2 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 22

29. Número documento de identificación: 79443684 | 30. Apellidos y nombres: ROMERO DIAZ OSCAR MAURICIO

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No. Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9194415709	2024 - 10 - 31	No. CNLE240700693	2024 - 09 - 02

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: DANYANG MADICOM ELECTROMECHANICAL CO.,LTD | 47. Ciudad: DANYANG, JIANGSU | 48. Cod.País Exportación: 215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: N.2 QIANDONG ROAD, SITU TOWN 212300 | 50. E-mail: FAX. 008651186852677

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cve.
EEME240629	2024 - 07 - 24	215	1	169	11	MCT S.A.S	4.311,83

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. exotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	9026109000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
08	01	215	105.00	97.00	CT	338	8	u	400.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número	87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No.	90. Cód. interno del Producto
2.470.00	73.67	1.73	0	75.40	0.00	2.545.40	R	50166945	3	2024	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	10.975.332	0	0	0.00
I.V.A.	19.00	10.975.332	2.085.000	0	0.00
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0.00
Sancion	0	0	0	0	
Recaus	0	0	0	0	
		Total	2.085.000		0.00

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este Formulario)

DO 01244219. Declaracion(6-8). Producto: FLUJOMETRO (REPUESTO). Marca: NO TIENE. Modelo: NO TIENE. Referencia: NO TIENE, CATALOGO FM4546-S. Uso o destino: MEDICO, EXCLUSIVO PARA REGULADOR DE OXIGENO MARCA MCARE. EN UNIDADES DE TRATAMIENTO MÉDICO PARA EL SUMINISTRO DE OXÍGENO DE EMERGENCIA Y LA INHALACIÓN DE OXÍGENO PARA PACIENTES HIPÓXICOS. TIENE LA FUNCIÓN DE REGULAR EL FLUJO DE OXÍGENO E INDICAR EL VOLUMEN DE FLUJO. Principio de funcionamiento: MECANICO. REF: FM4546-S, OXIGEN FLOWMETER 0-15L, (NO CHEMETRON CONNECTOR) 0-15 L/min, Nombre según factura: FLOWMETER. Equipo a cual va destinado: REGULADOR DE OXIGENO. Marca: MCARE. FABRICANTE DEL EQUIPO Y DEL REPUESTO: DANYANG MADICOM ELECTROMECHANICAL CO. LTD. PAIS: CHINA, REGISTRO SANITARIO INVIM(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 032024001521087 133. Fecha: 2024 10 31

134. Levante No. 032024001428322	135. Fecha: 2024 - 10 - 31	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.

OSCAR MAURICIO ROMERO DIAZ

Firma declarante

Servade SA

AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL 1

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

998. Pago Total $ 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

91003042133477

Fecha de Impresión: 2024-10-31 10:42:03

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Declaración de Importación

Aceptación : 032024001521087-8
Subpartida : 9026109000

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otras)

A 2016DM-0015134, VIG: 2026-09-01, EXPEDIENTE: 20114221. MERCANCIA NUEVA, VIDA UTIL: 10 AÑOS, AÑO DE FABRICACION 2024 Cant (200)
NAR; Serial: FM24080001 FM24080002 FM24080003 FM24080004 FM24080005 FM24080006 FM24080007 FM24080008 FM24080009 FM24080010 FM2408
0011 FM24080012 FM24080013 FM24080014 FM24080015 FM24080016 FM24080017 FM24080018 FM24080019 FM24080020 FM24080021 FM24080022 FM2
4080023 FM24080024 FM24080025 FM24080026 FM24080027 FM24080028 FM24080029 FM24080030 FM24080031 FM24080032 FM24080033 FM24080034
FM24080035 FM24080036 FM24080037 FM24080038 FM24080039 FM24080040 FM24080041 FM24080042 FM24080043 FM24080044 FM24080045 FM240800
46 FM24080047 FM24080048 FM24080049 FM24080050 FM24080051 FM24080052 FM24080053 FM24080054 FM24080055 FM24080056 FM24080057 FM240
80058 FM24080059 FM24080060 FM24080061 FM24080062 FM24080063 FM24080064 FM24080065 FM24080066 FM24080067 FM24080068 FM24080069 FM
24080070 FM24080071 FM24080072 FM24080073 FM24080074 FM24080075 FM24080076 FM24080077 FM24080078 FM24080079 FM24080080 FM24080081
FM24080082 FM24080083 FM24080084 FM24080085 FM24080086 FM24080087 FM24080088 FM24080089 FM24080090 FM24080091 FM24080092 FM24080
093 FM24080094 FM24080095 FM24080096 FM24080097 FM24080098 FM24080099 FM24080100 FM24080101 FM24080102 FM24080103 FM24080104 FM24
080105 FM24080106 FM24080107 FM24080108 FM24080109 FM24080110 FM24080111 FM24080112 FM24080113 FM24080114 FM24080115 FM24080116 F
M24080117 FM24080118 FM24080119 FM24080120 FM24080121 FM24080122 FM24080123 FM24080124 FM24080125 FM24080126 FM24080127 FM2408012
8 FM24080129 FM24080130 FM24080131 FM24080132 FM24080133 FM24080134 FM24080135 FM24080136 FM24080137 FM24080138 FM24080139 FM2408
0140 FM24080141 FM24080142 FM24080143 FM24080144 FM24080145 FM24080146 FM24080147 FM24080148 FM24080149 FM24080150 FM24080151 FM2
4080152 FM24080153 FM24080154 FM24080155 FM24080156 FM24080157 FM24080158 FM24080159 FM24080160 FM24080161 FM24080162 FM24080163
FM24080164 FM24080165 FM24080166 FM24080167 FM24080168 FM24080169 FM24080170 FM24080171 FM24080172 FM24080173 FM24080174 FM240801
75 FM24080176 FM24080177 FM24080178 FM24080179 FM24080180 FM24080181 FM24080182 FM24080183 FM24080184 FM24080185 FM24080186 FM240
80187 FM24080188 FM24080189 FM24080190 FM24080191 FM24080192 FM24080193 FM24080194 FM24080195 FM24080196 FM24080197 FM24080198 FM
24080199 FM24080200 (Item 5) Producto: FLUJOMETRO (REPUESTO). Marca: NO TIENE. Modelo: NO TIENE. Referencia: NO TIENE, CATALOGO F
M4546-S. Uso o destino: MEDICO, EXCLUSIVO PARA REGULADOR DE OXIGENO MARCA MCARE. EN UNIDADES DE TRATAMIENTO MÉDICO PARA EL SUMINI
STRO DE OXÍGENO DE EMERGENCIA Y LA INHALACIÓN DE OXÍGENO PARA PACIENTES HIPÓXICOS. TIENE LA FUNCIÓN DE REGULAR EL FLUJO DE OXÍGEN
O E INDICAR EL VOLUMEN DE FLUJO. Principio de funcionamiento: MECANICO. REF: FM4546-S (CH), OXIGEN FLOWMETER 0-15L, (CHEMETRON CO
NNECTOR) 0-15 L/min CONECTOR CHEMETRON, Nombre según factura: FLOWMETER. Equipo a cual va destinado: REGULADOR DE OXIGENO, Marca:
MCARE. FABRICANTE DEL EQUIPO Y DEL REPUESTO: DANYANG MADICOM ELECTROMECHANICAL CO. LTD. PAIS: CHINA, REGISTRO SANITARIO INVIMA 2
016DM-0015134, VIG: 2026-09-01, EXPEDIENTE: 20114221. MERCANCIA NUEVA, VIDA UTIL: 10 AÑOS, AÑO DE FABRICACION 2024 Cant (200) NAR
; Serial: FM24080201 FM24080202 FM24080203 FM24080204 FM24080205 FM24080206 FM24080207 FM24080208 FM24080209 FM24080210 FM2408021
1 FM24080212 FM24080213 FM24080214 FM24080215 FM24080216 FM24080217 FM24080218 FM24080219 FM24080220 FM24080221 FM24080222 FM2408
0223 FM24080224 FM24080225 FM24080226 FM24080227 FM24080228 FM24080229 FM24080230 FM24080231 FM24080232 FM24080233 FM24080234 FM2
4080235 FM24080236 FM24080237 FM24080238 FM24080239 FM24080240 FM24080241 FM24080242 FM24080243 FM24080244 FM24080245 FM24080246
FM24080247 FM24080248 FM24080249 FM24080250 FM24080251 FM24080252 FM24080253 FM24080254 FM24080255 FM24080256 FM24080257 FM240802
58 FM24080259 FM24080260 FM24080261 FM24080262 FM24080263 FM24080264 FM24080265 FM24080266 FM24080267 FM24080268 FM24080269 FM240
80270 FM24080271 FM24080272 FM24080273 FM24080274 FM24080275 FM24080276 FM24080277 FM24080278 FM24080279 FM24080280 FM24080281 FM
24080282 FM24080283 FM24080284 FM24080285 FM24080286 FM24080287 FM24080288 FM24080289 FM24080290 FM24080291 FM24080292 FM24080293
FM24080294 FM24080295 FM24080296 FM24080297 FM24080298 FM24080299 FM24080300 FM24080301 FM24080302 FM24080303 FM24080304 FM24080
305 FM24080306 FM24080307 FM24080308 FM24080309 FM24080310 FM24080311 FM24080312 FM24080313 FM24080314 FM24080315 FM24080316 FM24
080317 FM24080318 FM24080319 FM24080320 FM24080321 FM24080322 FM24080323 FM24080324 FM24080325 FM24080326 FM24080327 FM24080328 F
M24080329 FM24080330 FM24080331 FM24080332 FM24080333 FM24080334 FM24080335 FM24080336 FM24080337 FM24080338 FM24080339 FM2408034
0 FM24080341 FM24080342 FM24080343 FM24080344 FM24080345 FM24080346 FM24080347 FM24080348 FM24080349 FM24080350 FM24080351 FM2408
0352 FM24080353 FM24080354 FM24080355 FM24080356 FM24080357 FM24080358 FM24080359 FM24080360 FM24080361 FM24080362 FM24080363 FM2
4080364 FM24080365 FM24080366 FM24080367 FM24080368 FM24080369 FM24080370 FM24080371 FM24080372 FM24080373 FM24080374 FM24080375
FM24080376 FM24080377 FM24080378 FM24080379 FM24080380 FM24080381 FM24080382 FM24080383 FM24080384 FM24080385 FM24080386 FM240803
87 FM24080388 FM24080389 FM24080390 FM24080391 FM24080392 FM24080393 FM24080394 FM24080395 FM24080396 FM24080397 FM24080398 FM240
80399 FM24080400 (Item 6) SE ANEXA CERTIFICACION DEL PROVEEDOR, QUE DECLARA QUE LOS PRODUCTOS OBJETO DE ESTA IMPORTACION, NO SE F
ABRICAN CON MERCURIO Y TAMPOCO CONTIENEN MERCURIO. LOS PRODUCTOS NO CORRESPONDEN A PRODUCTOS CON MERCURIO AÑADIDO DE QUE TRATA EL
ARTÍCULO 2 DEL DECRETO 419 DEL 22 DE ABRIL DE 2021 Y DECRETO 1433 DE 2022. NO REQUIEREN NI UTILIZAN FUENTE RADIACTIVA DE PODER.
MERCANCIA QUE NO SE ENCUENTRA SUJETA AL CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO TECNICO, DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 33883 DEL 2021 DE LA SUPER
INTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), SEGÚN CONCEPTO 22-6498 Y 22-032018, 09/02/2022. LA NORMA SOLAMENTE APLICA A LOS INSTRU
MENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO (BALANZAS); SURTIDORES, DISPENSADORES Y/O MEDIDORES DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS; ET
ILÓMETROS O ALCOHOSENSORES, ALCOHOLÍMETROS; Y TAXÍMETROS ELECTRÓNICOS. GRAVAMEN 0% SEGUN DECRETO 1881 DEL 2021. REGISTRO NO: REG-
50166948-20240927N DEL 2024-09-27 FECHA DE VIGENCIA 2025-03-27, VISTO BUENO DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA: VMME-24-02920 DEL
2024-09-26 (NO REQUIERE), VISTO BUENO INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MED, ALIM: VINVIMA-24-0123646 DEL 2024-09-26. MERCANCIA
NUEVAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

032024001521087-8

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

Código	F-BIO-001
Versión	1
Fecha	Febrero 2017
Página	1 de 1

1. INFORMACION DE EQUIPO

EQUIPO	FONENDOSCOPIO		REGISTRO INVIMA	2022DM-0026072			
MARCA	LENZ		SERVICIO	TAB			
MODELO	HS31C1		UBICACIÓN	AMB. NXY747			
SERIE			CALIBRACIÓN	NO REQUIERE			
N.° INVENTARIO			TIPO DE EQUIPO	FIJO		MOVIL	X
FECHA DE COMPRA	13/12/2024	FECHA INSTALACION	13/12/2024	GARANTIA			
EQUIPO PROPIO		EQUIPO COMODATO		DONACION			

2. FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO

MENSUAL		BIMENSUAL		TRIMESTRAL		CUATRIMESTRAL	X	SEMESTRAL		ANUAL	

REGISTRO FOTOGRAFICO	ACCESORIOS	
	CANTIDAD	ACCESORIO
		

3. CARACTERISTICAS TECNICAS

VOLTAJE	N/A	CORRIENTE	N/A	POTENCIA	N/A	FRECUENCIA	N/A	TEMP. DE TRABAJO	

CLASIFICACION RIESGO SEGUN 4725 DE 2005		CLASIFICACION DE USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		TECNOLOGIA PREDOMINANTE			
				DIAGNOSTICO	X				
				MTTO DE LA VIDA		ELECTRICO		NEUMATICO	
RIESGO I	X	MEDICO		PREVENCION		ELECTRONICO		ACUSTICO	X
RIESGO IIA		BASICO	X	REHABILITACIÓN		ELECTROMECANICO		SOLAR	
RIESGO IIB		APOYO		EQ. LABORATORIO		MECANICO		VAPOR	
RIESGO III		OTRO		EQ. ODONTOLOGIA		HIDRAULICO		OTRO	

4. RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

NO GOLPEE EL EQUIPO.
NO MANIPULE LA MEMBRANA.
LIMPIE PERIODICAMENTE LAS OLIVAS.

HOSPITAL SAN VICENTE
ROVIRA TOLIMA



HOJA DE VIDA DE EQUIPO

EQUIPO: FONENDOSCOPIO	MARCA: LENZ	MODELO: HS31C1
SERIE: N/A	CLASIFICACION DE DISPOSITIVO MEDICO: Riesgo Bajo (I) DIAGNOSTICO	
FECHA DE COMPRA: 13-12-2024	FECHA DE INSTALACION: 13-12-2024	VENCIMIENTO DE GARANTIA: UN AÑO
DATOS DEL PROVEEDOR: OSMEC AMBULANCIA		TELEFONO: 3153083450

PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO: ANUAL	UBICACIÓN: AMBULANCIA PLACA NXY 747	EQUIPO:	MOVIL X	FIJO	

REGISTRO INVIMA : 2022DM-0026072

FUNCIONES: Se emplea para escuchar los sonidos procedentes principalmente del corazon y de los pulmones

RECOMENDACIONES DE FABRICANTE:

- Limpiar el equipo después de cada uso.
- Verificar el perfecto estado del diafragma.
- Verificar la vida útil de la olivas.
- Revisión de estado fisico

REGISTRO TECNICO DE INSTALACION

PESO: 110 Gramos	LONGITUD: 71 cm	CAMPANA: Resina, 25 gramos
DIAMETRO DEL DIAGRAMA: 5.4 cm	ACABADOS: Compuesto de resina/metal	TECNOLOGIA PREDOMINANTE: ANALOGA

REGISTRO TECNICO DE FUNCIONAMIENTO

PACIENTE: Adulto	TIPO DE DIAFRAGMA: Ajustable.	TIPO DE OLIVA: Cierre suave
APLICACIONES: Auscultar; Evaluacion fisica y toma de presion sanguinea.	MATERIAL DE LOS AURICULARES: Aleacion aeroespacial de amplio diametro	MATERIAL DE DIAFRAGMA: Fibra de vidrio

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PLANIFICADO SEGÚN PARAMETROS DE FABRICANTE

EQUIPO	Fonendoscopio
MARCA	LENZ
MODELO	HS31C1
SERIE	N/A
N° INVENTARIO	

- Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo
- Efectuar limpieza integral externa del equipo
- Efectuar limpieza integral interna del equipo
- Verificar el estado de las olivas y membrana del equipo
- Inspeccionar el estado fisico del tubo del equipo

Material Gastable	Repuestos Minimos	Herramientas y Equipos
• Aceite 3 en 1 • Franela • Grasa • Lija de agua • Limpiador de superficies • Liquido		• Brocha • Destornillador philips • Destornillador plano

BIOMEDICAL SOLUTIONS
INGENIERIA

NIT. 53116519-2
REGIMEN COMUN

REPORTE DE SERVICIO

FECHA:	12/12/2024	**REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO**		HORA INICIO:	8:30
INSTITUCION:	HOSPITAL SAN VICENTE	PROCESO:	AMBULANCIA	AREA:	MOVIL NXY 747

DATOS DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	TENSIOMETRO ADULTO DIGITAL			MARCA:	DB LIFE
SERIE:	WZ 4040 9023 01	MODELO:	BP369A	INV. N°.:	

ACCESORIOS DEL EQUIPO

BRAZALETE PILAS AA

DIAGNOSTICO INICIAL

	ESTADO		CONDICIONES AMBIENTALES DE USO SEGÚN LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE			
1	FISICO	BUENO	HUMEDAD:	46%	T°:	24,2 °C
2	FUNCIONAMIENTO	BUENO	SEGURIDAD DE LA INSTALACION:			
3	BATERIAS	N/A	EQUIPO NUEVO, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO			
4	ACCESORIOS	BUENO				

DESCRIPCION DEL SERVICIO

LIMPIEZA INTERNA		LIMPIEZA EXTERNA		DESINFECCION		DESMANCHADO	
LIMPIEZA CONTACTOS		LUBRICACION		ENGRASE		REEMPLAZO DE PARTES	

Se realiza hoja de vida

ELEMENTOS UTILIZADOS:

PRUEBAS FUNCIONALES

VERIFICACION DE:

SISTEMA ELECTRICO		ENCENDIDO		CONFIGURACION A TRAVES DEL MENU	
SISTEMA MECANICO	X	ACCESORIOS	X	FUNCIONAMIENTO DEL DISPLAY, PANTALLA	
SISTEMA HIDRAULICO		ALARMAS VISUAL		FUNCIONAMIENTO DEL MANOMETRO	X
SISTEMA NEUMATICO	X	ALARMAS AUDIBLES		FUNCIONAMIENTO DEL TECLADO, PERILLAS, CONTROLES	
VIDA DE LA BATERIA	X	FUGAS	X	TARJETAS ELECTRONICAS Y CONECTORES	
SEGURIDAD ELECTRICA		FILTROS		EMPAQUES	
PRUEBAS DE FABRICA		BOMBILLOS		NIVELES DE FLUJO	
		ALMACENAMIENTO DE DATOS Y MEMORIA		NIVELES DE PRESION	X

REPUESTOS UTILIZADOS

OBSERVACIONES

EQUIPO NUEVO LISTO PARA USAR

EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE	SI	X	NO		HORA FINAL: 8:40
FECHA DEL PROXIMO MANTENIMIENTO:	dic-25				

ING. BIOMEDICO

FUNCIONARIO ENCARGADO

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2022036531 de 27 de Septiembre de 2022
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

CONSIDERANDO

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMATICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.
EN CONSECUENCIA, A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARA EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - Conceder REGISTRO SANITARIO por el término de DIEZ (10) años a

PRODUCTO:	ESTETOSCOPIO DE DOS CABEZAS (PARTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS) - ESTETOSCOPIO RAPPAPORT
MARCA:	LENZ DIAGNOSTIC, LIFEN DIAGNOSTIC, ROSH DIAGNOSTIC, LORD
REGISTRO SANITARIO No.:	**INVIMA 2022DM-0026072**
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	G4 MEDICAL S.A.S con domicilio en CALI - VALLE
FABRICANTE(S):	WENZHOU YIHONG MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. con domicilio en CHINA
IMPORTADOR(ES):	G4 MEDICAL S.A.S con domicilio en CALI - VALLE
ACONDICIONADOR(ES):	G4 MEDICAL S.A.S con domicilio en CALI - VALLE
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO:	NO INVASIVO I

COMPOSICIÓN:

PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO	COMPOSICIÓN
CABEZAL CON DIAFRAGMA GRANDE Y PEQUEÑO	1 PIEZA
BINEURALES CON OLIVAS PLÁSTICAS MEDIANAS EN COLOR BLANCO	1 PAR
MANGUERAS GRUESAS CON GANCHOS METÁLICOS	1 PAR
CABEZAL DE CAMPANAS INTERCAMBIABLES	1 PIEZA (ADULTO), 1 PIEZA (PEDIÁTRICO), 1 PIEZA (INFANTE)
OLIVAS EXTRAS, PEQUEÑAS Y GRANDES	1 PAR
DIAFRAGMA PLÁSTICO TRANSPARENTE EXTRA, PEQUEÑO Y GRANDE	2 PIEZAS
ESTUCHE PLÁSTICO PARA GUARDAR ACCESORIOS	1 UNIDAD

USOS: UN ÚTIL INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO AUSCULTATORIO PARA REGISTRAR VARIOS SONIDOS DEL CORAZÓN, LOS PULMONES Y OTROS ÓRGANOS DEL CUERPO HUMANO. EL ESTETOSCOPIO POSEE LA SIGUIENTE VENTAJA:

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2022036531 de 27 de Septiembre de 2022
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

UNA BUENA TRANSMISIÓN DEL SONIDO, FACILITANDO LAS ESTRUCTURAS Y LA PRACTICIDAD DE USO Y TRANSPORTE
PRESENTACIÓN COMERCIAL: CAJA X 1 UNIDAD DE ESTETOSCOPIO.

OBSERVACIONES: SE AMPARAN LAS REFERENCIAS:

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
HS-31A1, HS-31A2, HS-31A3, HS-31B1, HS-31B2, HS-31B3, HS-31C1, HS-31C2, HS-31C3, HS-31D1, HS-31D2, HS-31D3	DUAL HEAD STETHOSCOPE
HS-30A1, HS-30A2, HS-30A3, HS-30B1, HS-30B2, HS-30B3, HS-30C1, HS-30C2, HS-30C3, HS-30D1, HS-30D2, HS-30D3	SINGLE HEAD STETHOSCOPE

EXPEDIENTE No.: 20238159
RADICACIÓN No.: 20221214382
FECHA RADICACIÓN: 16/09/2022

ARTICULO SEGUNDO. - CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

ARTICULO TERCERO. - LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

ARTICULO CUARTO. - LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 2005.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 27 días de Septiembre de 2022
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTOR(A) TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: fmoscosom, Técnico: ldiazc

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2023**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario
8820230000772l5-4

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 901148750 | 6. DV: 0 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: G 4 MEDICAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

13. Dirección: CL 13 65 B 16 BRR EL LIMONAR | 15. Teléfono: 3104891979 | 82. Cód. Admón.: 88 | 16. Cód. Dpto: 76 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 800254610 | 25. DV: 5 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS AGECOLDEX S.A NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 28 | 28. Cód. usuario: 0001

29. Número documento de identificación: 1113646176 | 30. Apellidos y nombres: HUERTAS GUACA MONICA ANDREA

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BUN	4803	No. 116575013694115	2023 - 08 - 31	No. KYBUEH2300438	2023 - 07 - 28

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior | 47. Ciudad | 48. Cod.País Exportador: 215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior | 50. E-mail: 86 21 57753176

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Sanders	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
23S035	2023 - 07 - 28	215	1	434	76		4,099.20

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Medidas	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	9018909090	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	215			YY	95	1	U	.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
000.00	

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
	0.00

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código negativa o licencia	86. Número
	R	50161933

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód interno del Producto
3	2022	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 .00	93	94	95 0	96 0
I.V.A.	97 .00	98	99	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Recaie	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125		126 0

131. Observación de: esta mercancía no exime la descargue de las mercancías a importar con lo se relacionó en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluye marcas, señales y otros) (Si el espacio no es suficiente, continúe en renglones de este formulario)

DO_ 01231786 PEDIDOS_ SST-2307_2308 DI_ 1 DE 2 PRODUCTO: KIT DE FONENDOSCOPIO Y TENSIÓMETRO. MARCA: LENI. MODELO: GZ-50. REFERENC
IA: GZ-50. SERIAL: 2023060001 2023060002 2023060003 2023060004 2023060005 2023060006 2023060007
2023060008 2023060009 2023060010 2023060011 2023060012 2023060013 2023060014 2023060015
2023060016 2023060017 2023060018 2023060019 2023060020 2023060021 2023060022 2023060023
2023060024 2023060025 2023060026 2023060027 2023060028 2023060029 2023060030 2023060031
2023060032 2023060033 2023060034 2023060035 2023060036 2023060037 20230600 (continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0 | 129. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX | 128. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración: 8820230000772l5
133. Fecha: 2023 09 08

134. Levante No. 8820230000867566 | 135. Fecha: 2023 - 09 - 11 | Firma funcionario diligenciador | 136. Nombre | 137. C.C. No.

Firma declarante

Agencia de Aduanas Agecoldex S.A. Nivel 1

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

9108012008837

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 882023000077215-4
Subpartida : 9018909090

108. Continuación descripción mercancías (incluye marcas, seriales y otros)

38	2023060039	2023060040	2023060041	2023060042	2023060043	2023060044	2023060045	20230600
46	2023060047	2023060048	2023060049	2023060050	2023060051	2023060052	2023060053	20230600
54	2023060055	2023060056	2023060057	2023060058	2023060059	2023060060	2023060061	20230600
62	2023060063	2023060064	2023060065	2023060066	2023060067	2023060068	2023060069	20230600
70	2023060071	2023060072	2023060073	2023060074	2023060075	2023060076	2023060077	20230600
78	2023060079	2023060080	2023060081	2023060082	2023060083	2023060084	2023060085	20230600
86	2023060087	2023060088	2023060089	2023060090	2023060091	2023060092	2023060093	20230600
94	2023060095	2023060096	2023060097	2023060098	2023060099	2023060100	2023060101	20230601
02	2023060103	2023060104	2023060105	2023060106	2023060107	2023060108	2023060109	20230601
10	2023060111	2023060112	2023060113	2023060114	2023060115	2023060116	2023060117	20230601
18	2023060119	2023060120	2023060121	2023060122	2023060123	2023060124	2023060125	20230601
26	2023060127	2023060128	2023060129	2023060130	2023060131	2023060132	2023060133	20230601
34	2023060135	2023060136	2023060137	2023060138	2023060139	2023060140	2023060141	20230601
42	2023060143	2023060144	2023060145	2023060146	2023060147	2023060148	2023060149	20230601
50	2023060151	2023060152	2023060153	2023060154	2023060155	2023060156	2023060157	20230601
58	2023060159	2023060160	2023060161	2023060162	2023060163	2023060164	2023060165	20230601
66	2023060167	2023060168	2023060169	2023060170	2023060171	2023060172	2023060173	20230601
74	2023060175	2023060176	2023060177	2023060178	2023060179	2023060180	2023060181	20230601
82	2023060183	2023060184	2023060185	2023060186	2023060187	2023060188	2023060189	20230601
90	2023060191	2023060192	2023060193	2023060194	2023060195	2023060196	2023060197	20230601
98	2023060199	2023060200	2023060201	2023060202	2023060203	2023060204	2023060205	20230602
06	2023060207	2023060208	2023060209	2023060210	2023060211	2023060212	2023060213	20230602
14	2023060215	2023060216	2023060217	2023060218	2023060219	2023060220	2023060221	20230602
22	2023060223	2023060224	2023060225	2023060226	2023060227	2023060228	2023060229	20230602
30	2023060231	2023060232	2023060233	2023060234	2023060235	2023060236	2023060237	20230602
38	2023060239	2023060240	2023060241	2023060242	2023060243	2023060244	2023060245	20230602
46	2023060247	2023060248	2023060249	2023060250	2023060251	2023060252	2023060253	20230602
54	2023060255	2023060256	2023060257	2023060258	2023060259	2023060260	2023060261	20230602
62	2023060263	2023060264	2023060265	2023060266	2023060267	2023060268	2023060269	20230602
70	2023060271	2023060272	2023060273	2023060274	2023060275	2023060276	2023060277	20230602
78	2023060279	2023060280	2023060281	2023060282	2023060283	2023060284	2023060285	20230602
86	2023060287	2023060288	2023060289	2023060290	2023060291	2023060292	2023060293	20230602
94	2023060295	2023060296	2023060297	2023060298	2023060299	2023060300	2023060301	20230603
02	2023060303	2023060304	2023060305	2023060306	2023060307	2023060308	2023060309	20230603
10	2023060311	2023060312	2023060313	2023060314	2023060315	2023060316	2023060317	20230603
18	2023060319	2023060320	2023060321	2023060322	2023060323	2023060324	2023060325	20230603
26	2023060327	2023060328	2023060329	2023060330	2023060331	2023060332	2023060333	20230603
34	2023060335	2023060336	2023060337	2023060338	2023060339	2023060340	2023060341	20230603
42	2023060343	2023060344	2023060345	2023060346	2023060347	2023060348	2023060349	20230603
50	2023060351	2023060352	2023060353	2023060354	2023060355	2023060356	2023060357	20230603
58	2023060359	2023060360	2023060361	2023060362	2023060363	2023060364	2023060365	20230603
66	2023060367	2023060368	2023060369	2023060370	2023060371	2023060372	2023060373	20230603
74	2023060375	2023060376	2023060377	2023060378	2023060379	2023060380	2023060381	20230603
82	2023060383	2023060384	2023060385	2023060386	2023060387	2023060388	2023060389	20230603
90	2023060391	2023060392	2023060393	2023060394	2023060395	2023060396	2023060397	20230603
98	2023060399	2023060400	2023060401	2023060402	2023060403	2023060404	2023060405	20230604
06	2023060407	2023060408	2023060409	2023060410	2023060411	2023060412	2023060413	20230604
14	2023060415	2023060416	2023060417	2023060418	2023060419	2023060420	2023060421	20230604
22	2023060423	2023060424	2023060425	2023060426	2023060427	2023060428	2023060429	20230604
30	2023060431	2023060432	2023060433	2023060434	2023060435	2023060436	2023060437	20230604
38	2023060439	2023060440	2023060441	2023060442	2023060443	2023060444	2023060445	20230604
46	2023060447	2023060448	2023060449	2023060450	2023060451	2023060452	2023060453	20230604
54	2023060455	2023060456	2023060457	2023060458	2023060459	2023060460	2023060461	20230604
62	2023060463	2023060464	2023060465	2023060466	2023060467	2023060468	2023060469	20230604
70	2023060471	2023060472	2023060473	2023060474	2023060475	2023060476	2023060477	20230604
78	2023060479	2023060480	2023060481	2023060482	2023060483	2023060484	2023060485	20230604
86	2023060487	2023060488	2023060489	2023060490	2023060491	2023060492	2023060493	20230604
94	2023060495	2023060496	2023060497	2023060498	2023060499	2023060500	2023060501	20230605
02	2023060503	2023060504	2023060505	2023060506	2023060507	2023060508	2023060509	20230605
10	2023060511	2023060512	2023060513	2023060514	2023060515	2023060516	2023060517	20230605
18	2023060519	2023060520	2023060521	2023060522	2023060523	2023060524	2023060525	20230605
26	2023060527	2023060528	2023060529	2023060530	2023060531	2023060532	2023060533	20230605
34	2023060535	2023060536	2023060537	2023060538	2023060539	2023060540	2023060541	20230605
42	2023060543	2023060544	2023060545	2023060546	2023060547	2023060548	2023060549	20230605
50	2023060551	2023060552	2023060553	2023060554	2023060555	2023060556	2023060557	20230605
58	2023060559	2023060560	2023060561	2023060562	2023060563	2023060564	2023060565	20230605
66	2023060567	2023060568	2023060569	2023060570	2023060571	2023060572	2023060573	20230605
74	2023060575	2023060576	2023060577	2023060578	2023060579	2023060580	2023060581	20230605
82	2023060583	2023060584	2023060585	2023060586	2023060587	2023060588	2023060589	20230605
90	2023060591	2023060592	2023060593	2023060594	2023060595	2023060596	2023060597	20230605
98	2023060599	2023060600	2023060601	2023060602	2023060603	2023060604	2023060605	20230606
06	2023060607	2023060608	2023060609	2023060610	2023060611	2023060612	2023060613	20230606
14	2023060615	2023060616	2023060617	2023060618	2023060619	2023060620	2023060621	20230606
22	2023060623	2023060624	2023060625	2023060626	2023060627	2023060628	2023060629	20230606
30	2023060631	2023060632	2023060633	2023060634	2023060635	2023060636	2023060637	20230606

882023000077215-4

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

105. Continuación descripción mercancías (incluye marcas, serales y otros)

38	2023060639	2023060640	2023060641	2023060642	2023060643	2023060644	2023060645	20230606
46	2023060647	2023060648	2023060649	2023060650	2023060651	2023060652	2023060653	20230606
54	2023060655	2023060656	2023060657	2023060658	2023060659	2023060660	2023060661	20230606
62	2023060663	2023060664	2023060665	2023060666	2023060667	2023060668	2023060669	20230606
70	2023060671	2023060672	2023060673	2023060674	2023060675	2023060676	2023060677	20230606
78	2023060679	2023060680	2023060681	2023060682	2023060683	2023060684	2023060685	20230606
86	2023060687	2023060688	2023060689	2023060690	2023060691	2023060692	2023060693	20230606
94	2023060695	2023060696	2023060697	2023060698	2023060699	2023060700	2023060701	20230607
02	2023060703	2023060704	2023060705	2023060706	2023060707	2023060708	2023060709	20230607
10	2023060711	2023060712	2023060713	2023060714	2023060715	2023060716	2023060717	20230607
18	2023060719	2023060720	2023060721	2023060722	2023060723	2023060724	2023060725	20230607
26	2023060727	2023060728	2023060729	2023060730	2023060731	2023060732	2023060733	20230607
34	2023060735	2023060736	2023060737	2023060738	2023060739	2023060740	2023060741	20230607
42	2023060743	2023060744	2023060745	2023060746	2023060747	2023060748	2023060749	20230607
50	2023060751	2023060752	2023060753	2023060754	2023060755	2023060756	2023060757	20230607
58	2023060759	2023060760	2023060761	2023060762	2023060763	2023060764	2023060765	20230607
66	2023060767	2023060768	2023060769	2023060770	2023060771	2023060772	2023060773	20230607
74	2023060775	2023060776	2023060777	2023060778	2023060779	2023060780	2023060781	20230607
82	2023060783	2023060784	2023060785	2023060786	2023060787	2023060788	2023060789	20230607
90	2023060791	2023060792	2023060793	2023060794	2023060795	2023060796	2023060797	20230607
98	2023060799	2023060800	2023060801	2023060802	2023060803	2023060804	2023060805	20230608
06	2023060807	2023060808	2023060809	2023060810	2023060811	2023060812	2023060813	20230608
14	2023060815	2023060816	2023060817	2023060818	2023060819	2023060820	2023060821	20230608
22	2023060823	2023060824	2023060825	2023060826	2023060827	2023060828	2023060829	20230608
30	2023060831	2023060832	2023060833	2023060834	2023060835	2023060836	2023060837	20230608
38	2023060839	2023060840	2023060841	2023060842	2023060843	2023060844	2023060845	20230608
46	2023060847	2023060848	2023060849	2023060850	2023060851	2023060852	2023060853	20230608
54	2023060855	2023060856	2023060857	2023060858	2023060859	2023060860	2023060861	20230608
62	2023060863	2023060864	2023060865	2023060866	2023060867	2023060868	2023060869	20230608
70	2023060871	2023060872	2023060873	2023060874	2023060875	2023060876	2023060877	20230608
78	2023060879	2023060880	2023060881	2023060882	2023060883	2023060884	2023060885	20230608
86	2023060887	2023060888	2023060889	2023060890	2023060891	2023060892	2023060893	20230608
94	2023060895	2023060896	2023060897	2023060898	2023060899	2023060900	2023060901	20230609
02	2023060903	2023060904	2023060905	2023060906	2023060907	2023060908	2023060909	20230609
10	2023060911	2023060912	2023060913	2023060914	2023060915	2023060916	2023060917	20230609
18	2023060919	2023060920	2023060921	2023060922	2023060923	2023060924	2023060925	20230609
26	2023060927	2023060928	2023060929	2023060930	2023060931	2023060932	2023060933	20230609
34	2023060935	2023060936	2023060937	2023060938	2023060939	2023060940	2023060941	20230609
42	2023060943	2023060944	2023060945	2023060946	2023060947	2023060948	2023060949	20230609
50	2023060951	2023060952	2023060953	2023060954	2023060955	2023060956	2023060957	20230609
58	2023060959	2023060960	2023060961	2023060962	2023060963	2023060964	2023060965	20230609
66	2023060967	2023060968	2023060969	2023060970	2023060971	2023060972	2023060973	20230609
74	2023060975	2023060976	2023060977	2023060978	2023060979	2023060980	2023060981	20230609
82	2023060983	2023060984	2023060985	2023060986	2023060987	2023060988	2023060989	20230609
90	2023060991	2023060992	2023060993	2023060994	2023060995	2023060996	2023060997	20230609
98	2023060999	2023061000	2023061001	2023061002	2023061003	2023061004	2023061005	20230610
06	2023061007	2023061008	2023061009	2023061010	2023061011	2023061012	2023061013	20230610
14	2023061015	2023061016	2023061017	2023061018	2023061019	2023061020	2023061021	20230610
22	2023061023	2023061024	2023061025	2023061026	2023061027	2023061028	2023061029	20230610
30	2023061031	2023061032	2023061033	2023061034	2023061035	2023061036	2023061037	20230610
38	2023061039	2023061040	2023061041	2023061042	2023061043	2023061044	2023061045	20230610
46	2023061047	2023061048	2023061049	2023061050	2023061051	2023061052	2023061053	20230610
54	2023061055	2023061056	2023061057	2023061058	2023061059	2023061060	2023061061	20230610
62	2023061063	2023061064	2023061065	2023061066	2023061067	2023061068	2023061069	20230610
70	2023061071	2023061072	2023061073	2023061074	2023061075	2023061076	2023061077	20230610
78	2023061079	2023061080	2023061081	2023061082	2023061083	2023061084	2023061085	20230610
86	2023061087	2023061088	2023061089	2023061090	2023061091	2023061092	2023061093	20230610
94	2023061095	2023061096	2023061097	2023061098	2023061099	2023061100	2023061101	20230611
02	2023061103	2023061104	2023061105	2023061106	2023061107	2023061108	2023061109	20230611
10	2023061111	2023061112	2023061113	2023061114	2023061115	2023061116	2023061117	20230611
18	2023061119	2023061120	2023061121	2023061122	2023061123	2023061124	2023061125	20230611
26	2023061127	2023061128	2023061129	2023061130	2023061131	2023061132	2023061133	20230611
34	2023061135	2023061136	2023061137	2023061138	2023061139	2023061140	2023061141	20230611
42	2023061143	2023061144	2023061145	2023061146	2023061147	2023061148	2023061149	20230611
50	2023061151	2023061152	2023061153	2023061154	2023061155	2023061156	2023061157	20230611
58	2023061159	2023061160	2023061161	2023061162	2023061163	2023061164	2023061165	20230611
66	2023061167	2023061168	2023061169	2023061170	2023061171	2023061172	2023061173	20230611
74	2023061175	2023061176	2023061177	2023061178	2023061179	2023061180	2023061181	20230611
82	2023061183	2023061184	2023061185	2023061186	2023061187	2023061188	2023061189	20230611
90	2023061191	2023061192	2023061193	2023061194	2023061195	2023061196	2023061197	20230611
98	2023061199	2023061200	2023061201	2023061202	2023061203	2023061204	2023061205	20230612
06	2023061207	2023061208	2023061209	2023061210	2023061211	2023061212	2023061213	20230612
14	2023061215	2023061216	2023061217	2023061218	2023061219	2023061220	2023061221	20230612
22	2023061223	2023061224	2023061225	2023061226	2023061227	2023061228	2023061229	20230612
30	2023061231	2023061232	2023061233	2023061234	2023061235	2023061236	2023061237	20230612

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

108. Continuación descripción mercancías (incluye marcas, serialas y otros)

38	2023062439	2023062440	2023062441	2023062442	2023062443	2023062444	2023062445	20230624
46	2023062447	2023062448	2023062449	2023062450	2023062451	2023062452	2023062453	20230624
54	2023062455	2023062456	2023062457	2023062458	2023062459	2023062460	2023062461	20230624
62	2023062463	2023062464	2023062465	2023062466	2023062467	2023062468	2023062469	20230624
70	2023062471	2023062472	2023062473	2023062474	2023062475	2023062476	2023062477	20230624
78	2023062479	2023062480	2023062481	2023062482	2023062483	2023062484	2023062485	20230624
86	2023062487	2023062488	2023062489	2023062490	2023062491	2023062492	2023062493	20230624
94	2023062495	2023062496	2023062497	2023062498	2023062499	2023062500	2023062501	20230625
02	2023062503	2023062504	2023062505	2023062506	2023062507	2023062508	2023062509	20230625
10	2023062511	2023062512	2023062513	2023062514	2023062515	2023062516	2023062517	20230625
18	2023062519	2023062520	2023062521	2023062522	2023062523	2023062524	2023062525 . USD O DESTI	

NO: KIT COMPUESTO DE DOS DISPOSITIVOS UTILIZADOS EN CONJUNTO PARA DETERMINAR LA TENSIÓN ARTERIAL SISTÓLICA Y DIASTÓLICA EN HUMANO S (EL TENSIÓMETRO, QUE ES EL QUE INTERPRETA O ARROJA PROPIAMENTE LA INFORMACIÓN SOBRE LA PRESIÓN Y UN FONENDOSCOPIO QUE SE EMPLEA PARA ESCUCHAR LOS SONIDOS PROCEDENTES PRINCIPALMENTE DEL CORAZÓN Y DE LOS PULMONES).. TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO: NO TIENE. KIT DE E SFIGMOMANÓMETRO CON ESTETOSCOPIO. (KIT FORMADO POR ESTETOSCOPIO CVL NO. 20190443 Y ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE MODELO XB.11.300 CVL NO. 20200989).REGISTRO SANITARIO. NÚMERO DEL REGISTRO SANITARIO_ INVIMA 2021DM-0024553. VIGENTE HASTA_ 12-11-2031.EXPEDIENTE_ 20 215002. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAIS DE ORIGEN_ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD CON DOMICILIO EN CHINA. NOMBRE COMERCI AL: KIT DE FONENDOSCOPIO Y TENSIÓMETRO. SPHYGMOMANOMETER KIT WITHRAPPAPORT STETHOSCOPE. , CANTIDAD: 2525 PIEZA, 2525 UNIDADES/XXX

	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS	Código	F-BIO-001
		Versión	1
		Fecha	Febrero 2017
		Página	1 de 1

1. INFORMACION DE EQUIPO

EQUIPO	FONENDOSCOPIO		REGISTRO INVIMA	2021DM-0024035			
MARCA	BOKANG		SERVICIO	TAB			
MODELO	BK3002		UBICACIÓN	AMB. NXY747			
SERIE			CALIBRACIÓN	NO REQUIERE			
N.° INVENTARIO			TIPO DE EQUIPO	FIJO		MOVIL	X
FECHA DE COMPRA	13/12/2024	FECHA INSTALACION	13/12/2024	GARANTIA			
EQUIPO PROPIO		EQUIPO COMODATO		DONACION			

2. FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO

MENSUAL		BIMENSUAL		TRIMESTRAL		CUATRIMESTRAL	X	SEMESTRAL		ANUAL	

REGISTRO FOTOGRAFICO	ACCESORIOS	
	CANTIDAD	ACCESORIO
		

3. CARACTERISTICAS TECNICAS

VOLTAJE	N/A	CORRIENTE	N/A	POTENCIA	N/A	FRECUENCIA	N/A	TEMP. DE TRABAJO	

CLASIFICACION RIESGO SEGUN 4725 DE 2005		CLASIFICACION DE USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		TECNOLOGIA PREDOMINANTE			
				DIAGNOSTICO	X				
				MTTO DE LA VIDA		ELECTRICO		NEUMATICO	
RIESGO I	X	MEDICO		PREVENCION		ELECTRONICO		ACUSTICO	X
RIESGO IIA		BASICO	X	REHABILITACIÓN		ELECTROMECANICO		SOLAR	
RIESGO IIB		APOYO		EQ. LABORATORIO		MECANICO		VAPOR	
RIESGO III		OTRO		EQ. ODONTOLOGIA		HIDRAULICO		OTRO	

4. RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

NO GOLPEE EL EQUIPO.
NO MANIPULE LA MEMBRANA.
LIMPIE PERIODICAMENTE LAS OLIVAS.

Elaboró: Diego Alejandro Osorio Campos Ingeniero Electrónico	Revisó:	Aprobó:

HOSPITAL SAN VICENTE
ROVIRA TOLIMA



HOJA DE VIDA DE EQUIPO

EQUIPO: FONENDOSCOPIO	MARCA: BOKANG	MODELO: BK3002
SERIE: N/A	CLASIFICACION DE DISPOSITIVO MEDICO: Riesgo Bajo (I) DIAGNOSTICO	
FECHA DE COMPRA: 13-12-2024	FECHA DE INSTALACION: 13-12-2024	VENCIMIENTO DE GARANTIA: UN AÑO
DATOS DEL PROVEEDOR: OSMEC AMBULANCIA		TELEFONO: 3153083450

PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO: ANUAL	UBICACIÓN: AMBULANCIA PLACA NXY 747	EQUIPO:	MOVIL X	FIJO	

REGISTRO INVIMA :	2021DM-0024035

FUNCIONES: Se emplea para escuchar los sonidos procedentes principalmente del corazon y de los pulmones

RECOMENDACIONES DE FABRICANTE:

- Limpiar el equipo después de cada uso.
- Verificar el perfecto estado del diafragma.
- Verificar la vida útil de la olivas.
- Revisión de estado fisico

REGISTRO TECNICO DE INSTALACION

PESO: 110 Gramos	LONGITUD: 71 cm	CAMPANA: Resina, 25 gramos
DIAMETRO DEL DIAGRAMA: 5.4 cm	ACABADOS: Compuesto de resina/metal	TECNOLOGIA PREDOMINANTE: ANALOGA

REGISTRO TECNICO DE FUNCIONAMIENTO

PACIENTE: Adulto	TIPO DE DIAFRAGMA: Ajustable.	TIPO DE OLIVA: Cierre suave
APLICACIONES: Auscultar; Evaluacion fisica y toma de presion sanguinea.	MATERIAL DE LOS AURICULARES: Aleacion aeroespacial de amplio diametro	MATERIAL DE DIAFRAGMA: Fibra de vidrio

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PLANIFICADO SEGÚN PARAMETROS DE FABRICANTE

EQUIPO	Fonendoscopio
MARCA	BOKANG
MODELO	BK3002
SERIE	N/A
N° INVENTARIO	

- Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo
- Efectuar limpieza integral externa del equipo
- Efectuar limpieza integral interna del equipo
- Verificar el estado de las olivas y membrana del equipo
- Inspeccionar el estado físico del tubo del equipo

Material Gastable	Repuestos Minimos	Herramientas y Equipos
• Aceite 3 en 1 • Franela • Grasa • Lija de agua • Limpiador de superficies • Liquido		• Brocha • Destornillador philips • Destornillador plano

BIOMEDICAL SOLUTIONS
INGENIERIA

NIT. 53116519-2
REGIMEN COMUN

REPORTE DE SERVICIO

FECHA:	12/12/2024	**REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO**		HORA INICIO:	9:20
INSTITUCION:	HOSPITAL SAN VICENTE	PROCESO:	AMBULANCIA	AREA:	MOVIL NXY 747

DATOS DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO			MARCA:	BOKANG
SERIE:	N/A	MODELO:	BK 3002	INV. N°.:	

ACCESORIOS DEL EQUIPO

OLIVAS, TUBO INTERCONECTOR, MANGUERA, MEMBRANA Y CAMPANA

DIAGNOSTICO INICIAL

	ESTADO		CONDICIONES AMBIENTALES DE USO SEGÚN LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE			
1	FISICO	BUENO	HUMEDAD:	46%	T°:	24,2 °C
2	FUNCIONAMIENTO	BUENO	SEGURIDAD DE LA INSTALACION:			
3	BATERIAS	N/A	EQUIPO NUEVO, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO			
4	ACCESORIOS	BUENO				

DESCRIPCION DEL SERVICIO

LIMPIEZA INTERNA	☐	LIMPIEZA EXTERNA	☐	DESINFECCION	☐	DESMANCHADO	☐
LIMPIEZA CONTACTOS	☐	LUBRICACION	☐	ENGRASE	☐	REEMPLAZO DE PARTES	☐

Se realiza hoja de vida

ELEMENTOS UTILIZADOS:

PRUEBAS FUNCIONALES

VERIFICACION DE:

SISTEMA ELECTRICO	☐	ENCENDIDO	☐	CONFIGURACION A TRAVES DEL MENU	☐
SISTEMA MECANICO	☐	ACCESORIOS	X	FUNCIONAMIENTO DEL DISPLAY, PANTALLA	☐
SISTEMA HIDRAULICO	☐	ALARMAS VISUAL	☐	FUNCIONAMIENTO DEL MANOMETRO	☐
SISTEMA NEUMATICO	X	ALARMAS AUDIBLES	☐	FUNCIONAMIENTO DEL TECLADO, PERILLAS, CONTROLES	☐
VIDA DE LA BATERIA	☐	FUGAS	☐	TARJETAS ELECTRONICAS Y CONECTORES	☐
SEGURIDAD ELECTRICA	☐	FILTROS	☐	EMPAQUES	☐
PRUEBAS DE FABRICA	☐	BOMBILLOS	☐	NIVELES DE FLUJO	☐
		ALMACENAMIENTO DE DATOS Y MEMORIA	☐	NIVELES DE PRESION	☐

REPUESTOS UTILIZADOS

OBSERVACIONES

EQUIPO NUEVO LISTO PARA USAR

EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE	SI	X	NO	☐	HORA FINAL: 9:30
FECHA DEL PROXIMO MANTENIMIENTO:	dic-25				

ING. BIOMEDICO

FUNCIONARIO ENCARGADO

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

Código	F-BIO-001
Versión	1
Fecha	Febrero 2017
Página	1 de 1

1. INFORMACION DE EQUIPO

EQUIPO	GLUCÓMETRO			REGISTRO INVIMA	2015DM-0013437		
MARCA	PRODIGY			SERVICIO	TAB		
MODELO	AUTOCODE			UBICACIÓN	AMB. NXY747		
SERIE	51850-6208347			CALIBRACIÓN	NO REQUIERE		
N.° INVENTARIO				TIPO DE EQUIPO	FIJO		MOVIL	X
FECHA DE COMPRA	13/12/2024	FECHA INSTALACION	13/12/2024	GARANTIA			
EQUIPO PROPIO		EQUIPO COMODATO		DONACION			

2. FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO

MENSUAL		BIMENSUAL		TRIMESTRAL		CUATRIMESTRAL	X	SEMESTRAL		ANUAL	

REGISTRO FOTOGRAFICO	ACCESORIOS	
	CANTIDAD	ACCESORIO



3. CARACTERISTICAS TECNICAS

VOLTAJE	3 VDC	CORRIENTE	N/A	POTENCIA	N/A	FRECUENCIA	N/A	TEMP. DE TRABAJO	

CLASIFICACION RIESGO SEGUN 4725 DE 2005		CLASIFICACION DE USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		TECNOLOGIA PREDOMINANTE			
				DIAGNOSTICO	X				
				MTTO DE LA VIDA		ELECTRICO		NEUMATICO	
RIESGO I		MEDICO		PREVENCION		ELECTRONICO	X	ACUSTICO	
RIESGO IIA	X	BASICO		REHABILITACIÓN		ELECTROMECANICO		SOLAR	
RIESGO IIB		APOYO	X	EQ. LABORATORIO		MECANICO		VAPOR	
RIESGO III		OTRO		EQ. ODONTOLOGIA		HIDRAULICO		OTRO	

4. RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

ASEGÚRESE DE QUE EL MEDIDOR ESTÉ LIMPIO Y LISTO PARA USARSE. DESPUÉS DE SACAR UNA TIRA DE PRUEBA (REACTIVA) DE INMEDIATO CIERRE BIEN EL RECIPIENTE. LAS TIRAS DE PRUEBA SE PUEDEN DAÑAR SI SE EXPONEN A LA HUMEDAD. LÁVESE LAS MANOS. SÉQUELAS BIEN. MASAJÉESE LA MANO PARA QUE LA SANGRE FLUYA A SU DEDO. NO USE ALCOHOL PORQUE SECA MUCHO LA PIEL. USE UNA LANCETA PARA PINCHARSE EL DEDO. PRESIONANDO DESDE LA BASE DEL DEDO, PONGA SUAVEMENTE UNA PEQUEÑA CANTIDAD DE SANGRE SOBRE LA TIRA REACTIVA. PONGA LA TIRA EN EL MEDIDOR DE GLUCOSA. DESPUÉS DE UNOS SEGUNDOS APARECERÁ EL VALOR. ANOTE Y HAGA SEGUIMIENTO A SUS RESULTADOS. AGREGUE NOTAS SOBRE CUALQUIER COSA QUE PUEDA HABER HECHO QUE LOS NÚMEROS NO ESTÉN DENTRO DE SU RANGO OBJETIVO, COMO ALIMENTOS, ACTIVIDAD, ETC. DESECHE LA LANCETA Y LA TIRA ADECUADAMENTE EN UN RECIPIENTE DE BASURA. NO COMPARTA CON NADIE, INCLUSO FAMILIARES, EL EQUIPO DE MONITOREO DEL AZÚCAR EN LA SANGRE, COMO LAS LANCETAS. PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN DE SEGURIDAD.

HOSPITAL SAN VICENTE
ROVIRA TOLIMA



HOJA DE VIDA DE EQUIPO

EQUIPO: GLUCOMETRO	MARCA: PRODIGY	MODELO: AUTOCODE
SERIE: 51850-6208347	CLASIFICACION DE DISPOSITIVO MEDICO: Riesgo Bajo (I) DIAGNOSTICO	
FECHA DE COMPRA: 13-12-2024	FECHA DE INSTALACION: 13-12-2024	VENCIMIENTO DE GARANTIA: UN AÑO
DATOS DEL PROVEEDOR: OSMEC AMBULANCIA		TELEFONO: 3153083450

PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO: ANUAL	UBICACIÓN: AMBULANCIA PLACA NXY 747	EQUIPO:	MOVIL X	FIJO	

REGISTRO INVIMA : 2015DM-0013437

FUNCIONES: Diagnóstico de niveles de glucosa en sangre

RECOMENDACIONES DE FABRICANTE:

- Leer el inserto que brinda el fabricante de manera cuidadosa y seguir las instrucciones
- Verifique la fecha de vencimiento de las tiras de glucometria, realice pruebas de funcionamiento con la solucion de control como se indica en el inserto

REGISTRO TECNICO DE INSTALACION

VOLTAJE: 3v	TAMAÑO: 94 x 50 x 19 mm	DIMENCIONES: 3,77"H X 2,11"w x 0,86"L x 9,4 cm x 5 cm x 1,9 cm
TEMPERATURA: +10° C + 40° C HR 10-85%	PESO: 79 gr CON PILAS	PANTALLA: LCD de 7 segmentos con simbolos

REGISTRO TECNICO DE FUNCIONAMIENTO

HUMEDAD: hasta 85% de humedad relativa	Condiciones de almacenamiento: Sin pila : 4°C - 40°C	Pilas AAA, dispositivo de puncion Ambito de medición: 20 mg/dl - 600 mg/dl o 1,1 mmol/L - 33,3 mmol/L

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PLANIFICADO SEGÚN PARAMETROS DE FABRICANTE

EQUIPO	GLUCOMETRO
MARCA	PRODIGY
MODELO	AUTOCODE
SERIE	51850-6208347
N° INVENTARIO	

RECOMENDACIONES

- Inspeccionar las condiciones ambientales den las que se encuentra el equipo.
- Efectuar limpieza general

BIOMEDICAL SOLUTIONS
INGENIERIA

NIT. 53116519-2
REGIMEN COMUN

REPORTE DE SERVICIO

FECHA:	12/12/2024	**REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO**		HORA INICIO:	10:10
INSTITUCION:	HOSPITAL SAN VICENTE	PROCESO:	AMBULANCIA	AREA:	MOVIL NXY 747

DATOS DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	GLUCOMETRO			MARCA:	PRODIGY
SERIE:	51850-6208347	MODELO:	AUTOCODE	INV. N°.:	

ACCESORIOS DEL EQUIPO

TIRAS REACTIVAS, BATERIAS AAA, SOLUCION DE CONTROL

DIAGNOSTICO INICIAL

	ESTADO		CONDICIONES AMBIENTALES DE USO SEGÚN LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE			
1	FISICO	BUENO	HUMEDAD:	46%	T°:	24,2 °C
2	FUNCIONAMIENTO	BUENO	SEGURIDAD DE LA INSTALACION:			
3	BATERIAS	BUENO	EQUIPO NUEVO, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO			
4	ACCESORIOS	BUENO				

DESCRIPCION DEL SERVICIO

LIMPIEZA INTERNA ☐	LIMPIEZA EXTERNA ☐	DESINFECCION ☐	DESMANCHADO ☐
LIMPIEZA CONTACTOS ☐	LUBRICACION ☐	ENGRASE ☐	REEMPLAZO DE PARTES ☐

Se realiza hoja de vida

ELEMENTOS UTILIZADOS:

PRUEBAS FUNCIONALES

VERIFICACION DE:

SISTEMA ELECTRICO	☐	ENCENDIDO	☒	CONFIGURACION A TRAVES DEL MENU	☒
SISTEMA MECANICO	☐	ACCESORIOS	☒	FUNCIONAMIENTO DEL DISPLAY, PANTALLA	☒
SISTEMA HIDRAULICO	☐	ALARMAS VISUAL	☒	FUNCIONAMIENTO DEL MANOMETRO	☐
SISTEMA NEUMATICO	☐	ALARMAS AUDIBLES	☒	FUNCIONAMIENTO DEL TECLADO, PERILLAS, CONTROLES	☒
VIDA DE LA BATERIA	☒	FUGAS	☐	TARJETAS ELECTRONICAS Y CONECTORES	☐
SEGURIDAD ELECTRICA	☐	FILTROS	☐	EMPAQUES	☐
PRUEBAS DE FABRICA	☒	BOMBILLOS	☐	NIVELES DE FLUJO	☐
		ALMACENAMIENTO DE DATOS Y MEMORIA	☒	NIVELES DE PRESION	☐

REPUESTOS UTILIZADOS

OBSERVACIONES

EQUIPO NUEVO, SE VERIFICA AUTONOMIA DE LA BATERIA, LISTO PARA USAR

EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE	SI	☒	NO	☐	HORA FINAL: 10:20
FECHA DEL PROXIMO MANTENIMIENTO:	dic-25				

ING. BIOMEDICO

FUNCIONARIO ENCARGADO

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020018088 DE 5 de Junio de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

CONSIDERANDO

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMATICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.
EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARA EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS A

PRODUCTO:	GLUCÓMETROS MARCA PRODIGY
MARCA:	PRODIGY
REGISTRO SANITARIO NO.:	**INVIMA 2020DM-0021710**
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	NELINCO LTDA CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
FABRICANTE(S):	OK BIOTECH CO LTD CON DOMICILIO EN TAIWAN BIONOSTICS, INC CON DOMICILIO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SHANDONG LIANFA MEDICAL PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. CON DOMICILIO EN CHINA TIANJIN HUAHONG TECHNOLOGY CO., LTD CON DOMICILIO EN CHINA PRODIGY DIABETES CARE LLC CON DOMICILIO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
IMPORTADOR(ES):	NELINCO LTDA CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
ACONDICIONADOR(ES):	NELINCO LTDA CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO:	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO IIA
SISTEMAS:	ELECTRÓNICOS
SUBSISTEMAS:	PARTES DEL EQUIPO: MEDIDOR PANTALLA LCD GOMA CONDUCTORA
USOS:	EL GLUCÓMETRO PRODIGY ESTÁ DISEÑADO PARA LA MEDICIÓN CUANTITATIVA DE GLUCOSA (AZÚCAR) EN MUESTRAS FRESCAS DE SANGRE CAPILAR ENTERA DE LA YEMA DEL DEDO, EL ANTEBRAZO, LA PARTE SUPERIOR DEL BRAZO, LA PALMA DE LA MANO, LA PANTORRILLA O EL MUSLO.
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	PRESENTACIÓN UNITARIA PRESENTACIÓN EN KIT
OBSERVACIONES:	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LOS SIGUIENTES MODELOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS DEL EQUIPO

DESCRIPCIÓN
PRODIGY AUTOCODE BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM
PRODIGY POCKET BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM
ACCESORIOS Y REPUESTOS

EXPEDIENTE NO: 20180317

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020018088 DE 5 de Junio de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

ARTICULO SEGUNDO.- CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE LA DIRECTORA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

ARTICULO TERCERO.- LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

ARTICULO CUARTO.- LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 2005.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN BOGOTÁ D.C. A LOS 5 DE JUNIO DE 2020
ESTE ESPACIO, HASTA LA FIRMA SE CONSIDERA EN BLANCO.

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTOR(A) TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
PROYECTO: LEGAL: FMOSCOSOM, TÉCNICO:MSANDOVALC,REVISÓ:CORDINA_VARIOS

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2024**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

032024001240050-1

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 800128935 | 6. DV: 4 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: NELINCO LTDA

13. Dirección: CL 44 A 50 96 | 14. Teléfono: 2224900 | 12. Cód. Admón.: 03 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830003960 | 25. DV: 0 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS COLMAS S.A.S NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cod. usuario: 0072

29. Número Documento de identificación: 1016037614 | 30. Apellidos y nombres: NIÑO ORTIZ MONICA LORENA

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No. de Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9194382070	2024 - 09 - 06	No. MIA24010407	2024 - 08 - 26

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: PRODIGY DIABETES CARE, LLC | 47. Ciudad: CHARLOTTE | 48. Cod País Exportador: 249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: STATEVILLE RD-SUITE A CHARLOTTE, NC 28269 | 50. E-mail: 1 404 8617650

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo transporte	55. Código de Aduana	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
INV000088735	2024 - 08 - 22	249	4	169	11	TAMPA CARGO S.A.S.	4.132,11

S

59. Subpartida arancelaria	62. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
9018909090	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	218	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso neto kgs.	72. Peso bruto kgs.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad comercial
01	01	249	13.20	11.88	YY	1	2	U	200.00

78. Valor FOB USD | 79. Valor fletes USD

80. Valor Seguros USD | 81. Valor Otros Gastos USD 0

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros pagos USD | 83. Ajuste valor USD 0.00

84. Valor aduana USD | 85. Código registro o licencia: R | 86. Número: 50014432

87. Cod. oficina: 3 | 88. Año: 2024 | 89. Programa No.: XXXXXXXXX | 90. Cod. Sistema del Producto: 0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	5.00	94	95 0	96	97 0.00
I.V.A.	19.00	98	99 0	100	101 0.00
Contraprestación	0.00	103 0	104 0	105 0	106 0.00
Derechos Compensatorios	0.00	0	109 0	110 0	111 0.00
Derechos Antidumping	0.00	0	114 0	115 0	116 0.00
Tasa de Cambio	0	118 0	119 0	120 0	
Recibo	0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125		126 0.00

91. Descripción de las mercancías según la descripción de las mercancías a importar con la señalada en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - (incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 230100719724-001 PEDIDO TRAMITE: PRODIGY DECLARACION(1-2) MERCANCIA NUEVA. // REGISTRO DE IMPORTACION NO. REG-50014432-2024012 0N.MO1 DE FECHA 2024-07-24 // VISTO BUENO INVIMA NO. VENVIMA-24-0051586 DE FECHA 2024-07-23. PRODUCTO: GLUCÓMETROS MARCA PRODIGY. MARCA: PRODIGY, MODELO: PRODIGY AUTOCODE BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM, REFERENCIA: 51880-S, USO O DESTINO: DISEÑADO PARA LA M EDICIÓN CUANTITATIVA DE GLUCOSA (AZUCAR EN MUESTRAS FRESCAS DE SANGRE CAPILAR ENTERA DE LA YEMA DEL DEDO, EL ANTEBRAZO, LA PARTE SUPERIOR DEL BRAZO, LA PALMA DE LA MANO, LA PANTORRILLA O EL MUSLO, TECNICA DE DIAGNOSTICO: REACCION QUIMICA, SERIAL: 51850 6208 261, 51850-6208262, 51850 6208263, 51850 6208264, 51850 6208265, 51850 6208266, 51850 6208267, 51850 620826(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera. Estado de levante / Levante autorizado. No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración: 032024001240050 / 133. Fecha: 2024 09 06
134. Levante No.: 032024001164714	135. Firma: 2024 - 09 - 06 / Firma funcionario responsable	136. Nombre / 137. C.C. No.

Firma declarante

907. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina

980. Pago Total $ 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

910030413516S9

DIAN
REPUBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **032024001240050-1**
Subpartida : **9018909090**

100. Continuación descripción mercancías (marcas, modelos, calidades y otros)

8, 51850 6208265, 51850 6208266, 51850 6208267, 51850 6208268, 51850 6208269, 51850 6208270, 51850 6208271, 51850 6208272, 51850 6208273, 51850 6208274, 51850 6208275, 51850 6208276, 51850 6208277, 51850 6208278, 51850 6208279, 51850 6208280, 51850 6208281, 51850 6208282, 51850 6208283, 51850 6208284, 51850 6208285, 51850 6208286, 51850 6208287, 51850 6208288, 51850 6208289, 51850 6208290, 51850 6208291, 51850 6208292, 51850 6208293, 51850 6208294, 51850 6208295, 51850 6208296, 51850 6208297, 51850 6208298, 51850 6208299, 51850 6208300, 51850 6208301, 51850 6208302, 51850 6208303, 51850 6208304, 51850 6208305, 51850 6208306, 51850 6208307, 51850 6208308, 51850 6208309, 51850 6208310, 51850 6208311, 51850 6208312, 51850 6208313, 51850 6208314, 51850 6208315, 51850 6208316, 51850 6208317, 51850 6208318, 51850 6208319, 51850 6208320, 51850 6208321, 51850 6208322, 51850 6208323, 51850 6208324, 51850 6208325, 51850 6208326, 51850 6208327, 51850 6208328, 51850 6208329, 51850 6208330, 51850 6208331, 51850 6208332, 51850 6208333, 51850 6208334, 51850 6208335, 51850 6208336, 51850 6208337, 51850 6208338, 51850 6208339, 51850 6208340, 51850 6208341, 51850 6208342, 51850 6208343, 51850 6208344, 51850 6208345, 51850 6208346, 51850 6208347, 51850 6208348, 51850 6208349, 51850 6208350, 51850 6208351, 51850 6208352, 51850 6208353, 51850 6208354, 51850 6208355, 51850 6208356, 51850 6208357, 51850 6208358, 51850 6208359, 51850 6208360, 51850 6208361, 51850 6208362, 51850 6208363, 51850 6208364, 51850 6208365, 51850 6208366, 51850 6208367, 51850 6208368, 51850 6208369, 51850 6208370, 51850 6208371, 51850 6208372, 51850 6208373, 51850 6208374, 51850 6208375, 51850 6208376, 51850 6208377, 51850 6208378, 51850 6208379, 51850 6208380, 51850 6208381, 51850 6208382, 51850 6208383, 51850 6208384, 51850 6208385, 51850 6208386, 51850 6208387, 51850 6208388, 51850 6208389, 51850 6208390, 51850 6208391, 51850 6208392, 51850 6208393, 51850 6208394, 51850 6208395, 51850 6208396, 51850 6208397, 51850 6208398, 51850 6208399, 51850 6208400, 51850 6208401, 51850 6208402, 51850 6208403, 51850 6208404, 51850 6208405, 51850 6208406, 51850 6208407, 51850 6208408, 51850 6208409, 51850 6208410, 51850 6208411, 51850 6208412, 51850 6208413, 51850 6208414, 51850 6208415, 51850 6208416, 51850 6208417, 51850 6208418, 51850 6208419, 51850 6208420, 51850 6208421, 51850 6208422, 51850 6208423, 51850 6208424, 51850 6208425, 51850 6208426, 51850 6208427, 51850 6208429, 51850 6208429, 51850 6208430, 51850 6208431, 51850 6208432, 51850 6208433, 51850 6208434, 51850 6208435, 51850 6208436, 51850 6208437, 51850 6208438, 51850 6208439, 51850 6208440, 51850 6208441, 51850 6208442, 51850 6208443, 51850 6208444, 51850 6208445, 51850 6208446, 51850 6208447, 51850 6208448, 51850 6208449, 51850 6208450, 51850 6208451, 51850 6208452, 51850 6208453, 51850 6208454, 51850 6208455, 51850 6208456, 51850 6208457, 51850 6208458, 51850 6208459, 51850 6208460, DESCRIPCION SEGUN FACTURA: 51880-8 PRODIGY METER AUTOCODE KIT // // CODIGO: 51880-8, PRESENTACION COMERCIAL: Presentación en Kit, FABRICANTE: GK BIOTECH CO., LTD, PAIS DE ORIGEN: TAIWAN, FABRICANTE: PRODIGY DIABETES CARE LLC ,PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS, FABRICANTE: BIOSYSTICS, INC ,PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS, REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2020DM-0021710 VENCIMIENTO: 2030/06/05 , EXPEDIENTE: 20160317 MERCANCIA NUEVA. VIDA UTIL. NO REGISTRA MES Y AÑO DE FABRICACIÓN: julio 2023 // Kit glucometro que contiene: 1 glucómetro, 2pilas AAA, 1 lancetero, 1 bolsa con 10 lancetas, 1 frasco con 10 tiras, 1 solucion de contro... , manual de usuario CANT (200) U (ITEM 1).

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2023**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032023001365058-4

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	11. Apellidos y nombres o Razón Social
901091299	2	ORTOPEDICOS DISALUD SAS

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
TV 93 53 32 IN 4	2002235	03	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
901335945	1	AGENCIA DE ADUANAS GLOBAL CARGO SAS NIVEL 2	26	597

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
16499878	PARRA YAÑEZ JOSE LEONARDO

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9194168007	2023 - 09 - 25	No. OFS-006838	2023 - 09 - 12

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
OK BIOTECH CO., LTD.	HSINCHU	218

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
NO. 91, SEC.2 GONGDAO 5TH RD. 300 HSINCHU	886-3-5160028

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto. destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
230911-003	2023 - 09 - 11	218	4	169	0	AVIANCA S.A. AEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA	3,948.25

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	3822190000	XX	XX	C201	XX	XXXX	XX	218	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
05	01	218	211.84	195.00	YY	64	2	KG	195.00

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
18,110.32	1,501.12	36.22	0.00	1,537.34	0.00	19,647.66	R	50076572

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No.	90. Cod. interno del Producto
3	2023	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	77,573,874	0	0	0
IVA	0.00	77,573,874	0	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	0		0

91. Descripción de las mercancías(No incie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO MYK231531 PEDIDO TRAMITE: PB232311 // 2023-05199 DECLARACION(2-2) MERCANCIA NUEVA // REGISTRO DE IMPORTACION NO. REG-50076572-20230519N DE 2023-05-19 // VISTO BUENO INVIMA NO VINVIMA-23-0059201 DE 2023-05-19 // MERCANCIA UBICADA EN ZONA FRANCA DE BOGOTA, DEPOSITO MELYAK INTERNATIONAL SERVICES SAS MZ 24 BG 144. PRODUCTO: ONMETER DIRECT BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS, COMPOSICION: ENZIMA: GLUCOSA OXIDASA, MEDIDOR:FERRICIANURO POTASICO, USO: REACTIVO DE DIAGNOSTICO, DEBE SER UTILIZADO SOLO PARA LA PRUEBA DE SANGRE DE GLUCOSA Y SOLO CON CAPILARES FRESCA MUESTRAS DE SANGRE ENTERA, MARCA: TRUE LIFE HEALTH CARE, REFERENCIA: 30-10-6200-5106, TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR LA GLUCOSA DE LA SANGRE, LOTE: L230814B EXPIRA: 2025/08 CANT (6000) CAJAS (ITEM 2). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 032023001365058 133. Feha: 2023 09 25

134. Levante No.	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	**980. Pago Total $** 0

Fecha de Impresión: 2023-09-25 16:07:49

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

Código	F-BIO-001
Versión	1
Fecha	Febrero 2017
Página	1 de 1

1. INFORMACION DE EQUIPO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES		REGISTRO INVIMA	2019EBC-0002816-R1			
MARCA	EDAN		SERVICIO	TAB			
MODELO	X12		UBICACIÓN	AMB. NXY747			
SERIE	261594-M23A12070092		CALIBRACIÓN	ANUAL			
N.° INVENTARIO			TIPO DE EQUIPO	FIJO		MOVIL	X
FECHA DE COMPRA	13/12/2024	FECHA INSTALACION	13/12/2024	GARANTIA			
EQUIPO PROPIO		EQUIPO COMODATO		DONACION			

2. FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO

MENSUAL		BIMENSUAL		TRIMESTRAL		CUATRIMESTRAL	X	SEMESTRAL		ANUAL	

REGISTRO FOTOGRAFICO



ACCESORIOS

CANTIDAD	ACCESORIO
1	CABLE ECG
1	SENSOR SPO2 ADULTO
1	SENSOR SPO2 PEDIATRICO
1	MANGUERA NIBP
1	BRAZALETE ADULTO
1	BRAZALETE NEONATAL

3. CARACTERISTICAS TECNICAS

VOLTAJE	120 VAC	CORRIENTE	1,4 A	POTENCIA	170 W	FRECUENCIA	60 Hz	TEMP. DE TRABAJO	

CLASIFICACION RIESGO SEGUN 4725 DE 2005		CLASIFICACION DE USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		TECNOLOGIA PREDOMINANTE			
				DIAGNOSTICO	X				
				MTTO DE LA VIDA		ELECTRICO		NEUMATICO	
RIESGO I		MEDICO		PREVENCION		ELECTRONICO	X	ACUSTICO	
RIESGO IIA		BASICO		REHABILITACIÓN		ELECTROMECANICO		SOLAR	
RIESGO IIB	X	APOYO	X	EQ. LABORATORIO		MECANICO		VAPOR	
RIESGO III		OTRO		EQ. ODONTOLOGIA		HIDRAULICO		OTRO	

4. RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

COLOQUE EL MONITOR SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA Y FIRME. COMPROBAR LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE 115 V. LOS BRAZALETES DEBEN SER USADOS CON LAS MANGUERAS ADECUADAS PARA LOGRAR UNOS RESULTADOS ADECUADOS, NO UBICAR EL BRAZALETE NI DEMASIADO APRETADO, TAMPOCO DEMASIADO FLOJO EN EL PACIENTE; USE EL TAMAÑO DEL BRAZALETE ADECUADO SEGÚN EL PACIENTE. VERIFIQUE QUE LOS CONECTORES DE LOS ELECTRODOS DEL PACIENTE Y EL CABLE ESTÉN BIEN CONECTADOS. ASEGÚRESE DE QUE LAS PIEZAS CONDUCTORAS DE LOS ELECTRODOS DEL ECG NO HAGAN CONTACTO CON OTRAS PIEZAS CONDUCTORAS. NO DEJE CAER AL SUELO EL SENSOR Y EVITAR ARRANQUES DE CABLES EN LOS SENSORES.NO EXPONER EL EQUIPO A UNA HUMEDAD RELATIVA SUPERIOR A 85%, NI A LA LUZ DIRECTA DEL SOL. EVITE CORRER MONTURAS RODANTES, CAMAS O EQUIPOS SOBRE EL CABLE DEL SENSOR. LOS MOVIMIENTOS DEL PACIENTE PUEDEN AFECTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR. NO COLOQUE EL SENSOR SOBRE ALGUNA EXTREMIDAD QUE TENGA CATÉTER O BRAZALETE DE PNI, YA QUE PUEDE OBSTRUIR EL FLUJO DE SANGRE. MANTENER EL EQUIPO CONECTADO A LA RED ELÉCTRICA PARA MANTENER BATERÍAS EN BUEN ESTADO. NO LIMPIE EL MONITOR MIENTRAS ESTÉ PRENDIDO O CONECTADO.

HOSPITAL SAN VICENTE
ROVIRA TOLIMA



HOJA DE VIDA DE EQUIPO

EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES	MARCA: EDAN	MODELO: X 12
SERIE: 261594-M23A12070092	CLASIFICACION DE DISPOSITIVO MEDICO: Riesgo Medio (IIA) DIAGNOSTICO	
FECHA DE COMPRA: 13-12-2024	FECHA DE INSTALACION: 13-12-2024	VENCIMIENTO DE GARANTIA: UN AÑO
DATOS DEL PROVEEDOR: OSMEC AMBULANCIA	TELEFONO: 3153083450	
PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO: ANUAL	UBICACIÓN: AMBULANCIA PLACA NXY 747	EQUIPO: MOVIL
REGISTRO INVIMA: 2019EBC-0002816-R1		

FUNCION: Equipo utilizado para monitorizar las funciones vitales del paciente y para el diagnostico de enfermedades

RECOMENDACIONES DE FABRICANTE:

- No apoyar elementos arriba del equipo. Por ejemplo: soluciones, envases, cables, gasas, etc.
- No utilizar solventes para limpiar el equipo y los accesorios. Utilizar un paño húmedo.
- Limpiar los accesorios después de cada uso. (brazalete adulto y pediatrico, cable ecg, sensor pinza SpO2)
- Realizar mantenimiento preventivo del equipo. Siempre que el equipo sea reparado verificar que el equipo cumple con la norma de seguridad eléctrica.
- Mantener el equipo conectado a la red eléctrica siempre que sea posible. Es posible encontrar los equipos sin batería al momento de ser utilizados.

REGISTRO TECNICO DE INSTALACION

VOLTAJE: AC 120 V/ DC 12V	PARAMETROS: ECG, NIBP, TEMP, SPO2, PLETISMOGRAF.	FRECUENCIA: 60 Hz	DIMENCIONES: 210 X 270 X 112cm
CORRIENTE: 1,1-0,5 Ah	PESO NETO: 3,2 KG	TECNOLOGIA PREDOMINANTE: ELECTRONICA	

REGISTRO TECNICO DE FUNCIONAMIENTO

TEMPERATURA: 0-40 °C	RESOLUCION PANTALLA: 800 X 600 PIXELES 8,4" LCD	
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA: ≥ 2 HORAS	TIPO DE BATERIA: IONES DE LITIO RECARGABLE 11,1 DVC 2,6 Ah	USO: MEDICO

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PLANIFICADO SEGÚN PARAMETROS DE FABRICANTE

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES
MARCA	EDAN
MODELO	X12
SERIE	261594-M23A12070092
N° INVENTARIO	

- **Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo**
- **Efectuar limpieza integral externa del equipo**
- **Inspeccionar el equipo en forma externa**
- **Efectuar limpieza integral interna del equipo**
- **Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cables de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)**
- **Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones**
- **Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG, CABLE EKG**
- **Verificar el pulso de calibración y amplitud del complejo QRS**
- **Verificar la velocidad, linealidad y centrado de trazo (ver prueba de funcionamiento)**
- **Verificar la respuesta en frecuencia y rechazo en modo común**
- **Verificar el brillo y el enfoque del trazo**
- **Verificar la función de congelamiento de la señal y la función de cascada**
- **Verificar el sistema de alarmas en cada modulo**
- **Verificar el funcionamiento del selector de monitor/diagnostico**
- **Verificar en dos puntos diferentes, la calibración de temperatura**
- **Verificar en cuatro puntos de prueba, la calibración de presión**
- **Realizar prueba de seguridad eléctrica (ver prueba de seguridad eléctrica para monitor multiparámetros)**
- **Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación**

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION

- **La limpieza se debe hacer con el equipo apagado**
- **Utilice un paño suave, humedecido con una solución de alcohol y agua**
- **El líquido no debe derramarse hacia el interior del equipo**
- **No utilizar esponjas metálicas no líquidos corrosivos como soluciones cloradas**
- **Realizar limpieza profunda del equipo se recomienda, luego de ello, proteger la superficie con algún producto siliconado que dará brillo y aumentará la vida útil de la pintura**
- **Cuando limpie o desinfecte el interior, utilice solo agentes de limpieza. No utilice desinfectantes alcalinos o liberadores de cloro porque son corrosivos.**

BIOMEDICAL SOLUTIONS
INGENIERIA

NIT. 53116519-2
REGIMEN COMUN

REPORTE DE SERVICIO

FECHA:	12/12/2024	**REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO**		HORA INICIO:	10:50
INSTITUCION:	HOSPITAL SAN VICENTE	PROCESO:	AMBULANCIA	AREA:	MOVIL NXY 747

DATOS DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	MONITOR MULTIPARAMETROS			MARCA:	EDAN
SERIE:	261594-M23A12070092	MODELO:	X-12	INV. N°.:	

ACCESORIOS DEL EQUIPO

CABLE DE PODER, BATERIA, CABLE ECG, SENSOR SPO2, BRAZALETE Y MANGUERA NIBP

DIAGNOSTICO INICIAL

	ESTADO		CONDICIONES AMBIENTALES DE USO SEGÚN LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE			
1	FISICO	BUENO	HUMEDAD:	49%	T°:	21,2 °C
2	FUNCIONAMIENTO	BUENO	SEGURIDAD DE LA INSTALACION:			
3	BATERIAS	BUENO	EQUIPO NUEVO, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO			
4	ACCESORIOS	BUENO				

DESCRIPCION DEL SERVICIO

LIMPIEZA INTERNA	☐	LIMPIEZA EXTERNA	☐	DESINFECCION	☐	DESMANCHADO	☐
LIMPIEZA CONTACTOS	☐	LUBRICACION	☐	ENGRASE	☐	REEMPLAZO DE PARTES	☐

Se realiza hoja de vida y pruebas de todos sus parametros

ELEMENTOS UTILIZADOS:

PRUEBAS FUNCIONALES

VERIFICACION DE:

SISTEMA ELECTRICO	x	ENCENDIDO	x	CONFIGURACION A TRAVES DEL MENU	x
SISTEMA MECANICO	x	ACCESORIOS	x	FUNCIONAMIENTO DEL DISPLAY, PANTALLA	x
SISTEMA HIDRAULICO		ALARMAS VISUAL	x	FUNCIONAMIENTO DEL MANOMETRO	
SISTEMA NEUMATICO	x	ALARMAS AUDIBLES	x	FUNCIONAMIENTO DEL TECLADO, PERILLAS, CONTROLES	X
VIDA DE LA BATERIA	x	FUGAS	X	TARJETAS ELECTRONICAS Y CONECTORES	
SEGURIDAD ELECTRICA	x	FILTROS	x	EMPAQUES	
PRUEBAS DE FABRICA	X	BOMBILLOS		NIVELES DE FLUJO	
		ALMACENAMIENTO DE DATOS Y MEMORIA	x	NIVELES DE PRESION	

REPUESTOS UTILIZADOS

OBSERVACIONES

EQUIPO NUEVO, LISTO PARA USAR, SE VERIFICAN PARAMETROS Y AUTONOMIA DE BATERIA

EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE	SI	X	NO		HORA FINAL: 11:20
FECHA DEL PROXIMO MANTENIMIENTO:	dic-25				

ING. BIOMEDICO

FUNCIONARIO ENCARGADO

RESOLUCION No. 2023000028 DE 2 de Enero de 2023
Por la cual se Modifica una Resolución

Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, modificado por el Decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

EXPEDIENTE: 19997263 **RADICACIÓN:** 20221264249 **FECHA:** 15/12/2022
PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN: INVIMA 2019EBC-0002816-R1 VIGENCIA: 20/12/2029

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2008035863 del 09/12/2008 el INVIMA concedió Permiso de Comercialización No. INVIMA2008EBC-0002816 para el producto MONITOR DE PACIENTE EDAN a favor de NOVAMEDICA LTDA CON DOMICILIO EN BARRANQUILLA en la modalidad IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante Resolución No. 2010008441 del 06 de Abril de 2010, el INVIMA modificó la Resolución No. 2008035863 del 09/12/2008 en el sentido de autorizar el cambio de los modelos autorizados.

Que mediante Resolución No. 2010013822 del 14 de Mayo de 2010 el INVIMA modificó la Resolución No. 2008035863 del 09/12/2008 en el sentido de autorizar la ADICIÓN DE REFERENCIAS.

Que mediante Resolución No. 2010020187 de 2 de Julio de 2010 el INVIMA REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución No. 2010013822 del 14/05/2010 en el sentido de corregir una de las referencias.

Que mediante Resolución No. 2011001032 de 21 de Enero de 2011 el INVIMA modificó la Resolución No.2008035863 del 09/12/2008 en el sentido de aprobar la ADICIÓN DE REFERENCIAS.

Que mediante Resolución No. 2013000781 de 10 de Enero de 2013 el INVIMA modificó la Resolución No. 2008035863 del 09/12/2008 en el sentido de adicionar referencias.

Que mediante Resolución No.2013029221 de 27 de Septiembre de 2013 el INVIMA modificó la Resolución No. 2008035863 del 09/12/2008 en el sentido de aprobar la adición de una referencia.

Mediante Resolución No. 2014016534 DE 4 de Junio de 2014 el INVIMA modificó la Resolución No. 2008035863 del 09/12/2008 en el sentido de APROBAR: ADICIÓN DE REFERENCIAS: iM60, iM70, Accesorios y Repuestos.

Que Mediante Resolución No. 2015028964 DE 27 de Julio de 2015 el INVIMA modificó la Resolución No. 2008035863 del 09/12/2008 en el sentido de APROBAR: ADICIÓN DE REFERENCIAS: IM20, ELITEV5, ELITEV6.

Que Mediante Resolución No. 2018001701 de fecha 18 de Enero de 2018 el INVIMA modificó la Resolución No. 2008035863 del 09/12/2008 en el sentido de APROBAR: CAMBIO DE NOMBRE DE PRODUCTO, CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE TITULAR, CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE ACONDICIONADOR, CAMBIO DE DOMICILIO DE FABRICANTE, EXCLUSIÓN DE REFERENCIAS y ACTUALIZACION DE ETIQUETAS.

Que mediante Resolución No. 2019058211 de 20 de Diciembre de 2019, el INVIMA concedió RENOVAR el Permiso de Comercialización No. INVIMA 2019EBC-0002816-R1 para el producto MONITOR DE PACIENTE / MONITOR DE SIGNOS VITALES, a favor de NOVA MEDICA LTDA con domicilio en BARRANQUILLA - ATLANTICO, en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante Resolución No. 2021032865 de 6 de Agosto de 2021, el INVIMA modificó la Resolución No. 2019058211 de 20 de Diciembre de 2019, en el sentido de aprobar CAMBIO DE ETIQUETAS, INSERTOS Y STICKERS Y ADICIÓN DE REFERENCIAS.

Que mediante escrito número 20221264249 radicado el 15/12/2022, el Señor JOHM BORELLY RAMIREZ, actuando en calidad de Representante Legal de la sociedad NOVA MEDICA S.A.S. , presentó

RESOLUCION No. 2023000028 DE 2 de Enero de 2023
Por la cual se Modifica una Resolución

Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, modificado por el Decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

solicitud de modificación al Registro Sanitario mencionado, en el sentido de OBTENER APROBACIÓN PARA ADICIÓN DE REFERENCIAS, CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR, IMPORTADOR Y ACONDICIONADOR.

CONSIDERACIONES

Que ante este Instituto se ha solicitado la concesión de una modificación con base en la verificación de la documentación técnico legal allegada ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, emitiendo concepto favorable para la expedición de esta modificación.

En consecuencia a lo anterior, de conformidad con el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017, el INVIMA de acuerdo con las facultades de inspección, vigilancia y control, podrá verificar en cualquier momento la información suministrada para la modificación automática, teniendo en cuenta el riesgo del dispositivo médico y en consecuencia este Instituto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución 2008035863 del 09/12/2008 que concedió Permiso de Comercialización número INVIMA 2019EBC-0002816-R1 a favor de NOVA MEDICA S.A.S. con domicilio en BARRANQUILLA - ATLANTICO para el producto MONITOR DE PACIENTE / MONITOR DE SIGNOS VITALES, en la modalidad IMPORTAR Y VENDER , en el sentido de **APROBAR:**

CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR QUEDANDO: NOVAMEDICA S.A.S.

CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL DEL IMPORTADOR QUEDANDO: NOVAMEDICA S.A.S.

CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL DEL ACONDICIONADOR QUEDANDO: NOVAMEDICA S.A.S.

ADICIÓN DE REFERENCIAS: MONITOR DE SIGNOS VITALES iM3s

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante el DIRECTOR(A) TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

ARTICULO CUARTO:- Los Derechos que se deriven de esta Resolución quedaran sujetas al control posterior que debe realizar la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA de conformidad con lo previsto por el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017 .

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 2 de Enero de 2023
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTOR(A) TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: agonzalezr, Técnico: ysanchezo

Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos
invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 742 2121

www.invima.gov.co
@invimacolombia

La salud es de todos | Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2021032865 DE 6 de Agosto de 2021
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

EXPEDIENTE: 19997263 **RADICACIÓN:** 20211145372 **FECHA:** 26/07/2021
PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN: INVIMA 2019EBC-0002816-R1 **VIGENCIA:** 20/12/2029

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2008035863 del 09/12/2008 el INVIMA concedió Permiso de Comercialización No. INVIMA2008EBC-0002816 para el producto MONITOR DE PACIENTE EDAN a favor de NOVAMEDICA LTDA CON DOMICILIO EN BARRANQUILLA en la modalidad IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante Resolución No. 2010008441 del 06 de Abril de 2010, el INVIMA modificó la Resolución No. 2008035863 del 09/12/2008 en el sentido de autorizar el cambio de los modelos autorizados.

Que mediante Resolución No. 2010013822 del 14 de Mayo de 2010 el INVIMA modificó la Resolución No. 2008035863 del 09/12/2008 en el sentido de autorizar la ADICIÓN DE REFERENCIAS.

Que mediante Resolución No. 2010020187 de 2 de Julio de 2010 el INVIMA REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución No. 2010013822 del 14/05/2010 en el sentido de corregir una de las referencias.

Que mediante Resolución No. 2011001032 de 21 de Enero de 2011 el INVIMA modificó la Resolución No.2008035863 del 09/12/2008 en el sentido de aprobar la ADICIÓN DE REFERENCIAS.

Que mediante Resolución No. 2013000781 de 10 de Enero de 2013 el INVIMA modificó la Resolución No. 2008035863 del 09/12/2008 en el sentido de adicionar referencias.

Que mediante Resolución No.2013029221 de 27 de Septiembre de 2013 el INVIMA modificó la Resolución No. 2008035863 del 09/12/2008 en el sentido de aprobar la adición de una referencia.

Mediante Resolución No. 2014016534 DE 4 de Junio de 2014 el INVIMA modificó la Resolución No. 2008035863 del 09/12/2008 en el sentido de APROBAR: ADICIÓN DE REFERENCIAS: iM60, iM70, Accesorios y Repuestos.

Que Mediante Resolución No. 2015028964 DE 27 de Julio de 2015 el INVIMA modificó la Resolución No. 2008035863 del 09/12/2008 en el sentido de APROBAR: ADICIÓN DE REFERENCIAS: IM20, ELITEV5, ELITEV6.

Que Mediante Resolución No. 2018001701 de fecha 18 de Enero de 2018 el INVIMA modificó la Resolución No. 2008035863 del 09/12/2008 en el sentido de APROBAR: CAMBIO DE NOMBRE DE PRODUCTO, CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE TITULAR, CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE ACONDICIONADOR, CAMBIO DE DOMICILIO DE FABRICANTE, EXCLUSIÓN DE REFERENCIAS y ACTUALIZACION DE ETIQUETAS.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2021032865 DE 6 de Agosto de 2021
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

Que mediante Resolución No. 2019058211 de 20 de Diciembre de 2019, el INVIMA concedió Permiso de Comercialización No. INVIMA 2019EBC-0002816-R1 para el producto MONITOR DE PACIENTE / MONITOR DE SIGNOS VITALES, a favor de NOVA MEDICA LTDA con domicilio en BARRANQUILLA - ATLANTICO, en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante escrito número 20211145372 radicado el 26/07/2021 , el Doctor EDIN FRANCISCO MORA FIGUEROA, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa NOVA MEDICA LTDA, presentó solicitud de modificación al Permiso de Comercialización mencionado, en el sentido de OBTENER APROBACIÓN PARA CAMBIO DE ETIQUETAS, INSERTOS Y STICKERS Y ADICIÓN DE REFERENCIAS.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la concesión de una modificación con base en la verificación de la documentación técnico legal allegada ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, emitiendo concepto favorable para la expedición de esta modificación.

En consecuencia a lo anterior, de conformidad con el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017, el INVIMA de acuerdo con las facultades de inspección, vigilancia y control, podrá verificar en cualquier momento la información suministrada para la modificación automática, teniendo en cuenta el riesgo del dispositivo médico.

En consecuencia este Instituto:

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución No. 2008035863 del 09 de diciembre de 2008 que concedió Permiso de Comercialización No. INVIMA 2019EBC-0002816-R1 a favor de NOVA MEDICA LTDA con domicilio en BARRANQUILLA - ATLANTICO para el producto MONITOR DE PACIENTE / MONITOR DE SIGNOS VITALES, en la modalidad IMPORTAR Y VENDER , en el sentido de **APROBAR:**

CAMBIO DE ETIQUETAS, INSERTOS Y STICKERS, QUENDANDO:

SE ACTUALIZA EL STICKER DE REGISTRO SANITARIO.

ADICIÓN DE REFERENCIAS:

X8, X10, X12.

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2021032865 DE 6 de Agosto de 2021
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

ARTICULO CUARTO:- Los Derechos que se deriven de esta Resolución quedaran sujetas al control posterior que debe realizar la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA de conformidad con lo previsto por el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 6 de Agosto de 2021
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTOR(A) TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: rolayaa, Técnico: lrivasm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La salud es de todos | Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2019058211 DE 20 de Diciembre de 2019
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Permiso de Comercialización

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y Ley 1437 de 2011.

De acuerdo con lo anterior y en cumplimiento de los requisitos preceptuados en el Decreto 4725 de 2005 se emitió concepto favorable para la autorización de este Permiso de Comercialización.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - Renovar PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN por el término de 10 años al

PRODUCTO:	MONITOR DE PACIENTE / MONITOR DE SIGNOS VITALES
MARCA(S):	EDAN
PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN No.:	**INVIMA 2019EBC-0002816-R1**
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	NOVA MEDICA LTDA con domicilio en BARRANQUILLA - ATLANTICO
FABRICANTE(S):	EDAN INSTRUMENTS INC con domicilio en CHINA
IMPORTADOR(ES):	NOVA MEDICA LTDA con domicilio en BARRANQUILLA - ATLANTICO
ACONDICIONADOR(ES):	NOVA MEDICA LTDA con domicilio en BARRANQUILLA - ATLANTICO
TIPO DE DISPOSITIVO	EQUIPO BIOMÉDICO PARA DIAGNÓSTICO
RIESGO:	IIb
SISTEMAS:	ELECTRICOS Y ELECTRONICOS
SUBSISTEMAS:	PARTES DEL EQUIPO: UNIDAD PRINCIPAL, CABLE AC, CABLE ECG, SENSOR Y CABLE EXTENSOR DE SPO2, MANGUERA DE NIPB, BRAZALETE DE BRAZO Y DE PIERNA, TRAMPA DE AGUA, IMPRESORA CABEZA TERMICA, CANULAS NASALES, CIRCUITO DE CAPNOGRAFIA, CABLE INTERFASE DE JBP Y CO, SENSOR DE TEMPERATURA DE GASTO CARDLACO, PAPEL TERMICO, LJNEA DE MUESTREO, ELECTRODOS PARA CABLE DE PACIENTE, CABLE DE CONEXIGN A TIERRA, BASE RODANTE (SOPORTE), BASE RODANTE, BATERIA, MANUAL DE OPERACIONES, SOFTWARE PARA DESCARGAR DATOS A PC, INTERFASE PC
USOS:	LOS MONITORES DE PACIENTE SON UTILIZADOS PARA LA MEDICIÓN DE PARÁMETROS ECG, FRECUENCIA CARDIACA, SPO2 (SATURACIÓN DE OXÍGENO), NIBP (PRESION ARTERIAL NO INVASIVA), TEMPERATURA, RESPIRACIÓN. PUEDE MEDIR PARÁMETROS ADICIONALES COMO IBP (PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA), CO (GASTO CARDIACO), ETCO2 (MEDIDA DE CO2 EXHALADO), MEDIDA DE GASES ANESTÉSICOS. SON UTILIZADOS EN UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO Y NEONATAL, URGENCIAS, CIRUGÍA, HOSPITALIZACIÓN, SALAS DE OBSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CLÍNICAS Y HOSPITALES.
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	PRESENTACIÓN INDIVIDUAL
OBSERVACIONES:	ESTE PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN AMPARA ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS DE LOS MODELOS Y/O REFERENCIAS: MONITOR DE PACIENTE: IM20, ELITEV5, ELITEV6, IM8, IM8A, IM8B, IM9, IM9A, IM9B, IM80, IM80A, IM50, IM50A, ELITE V8, IM60, IM70 MONITOR DE SIGNOS VITALES: M3, M3B **OBSERVACIÓN:** SE CONTINUARÁ REALIZANDO LA IMPORTACIÓN DE PARTES Y/O REPUESTOS PARA SOPORTAR LA BASE INSTALADA DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS EN EL PAIS QUE FUERON EXCLUIDOS DEL PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN: M8, M8A, M8B, M9B, M50, M80, M50A, M80A
EXPEDIENTE No.:	19997263

Oficina Principal:
Administrativo:
www.invima.gov.co

invima

La salud es de todos

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2019058211 DE 20 de Diciembre de 2019
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Permiso de Comercialización

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y Ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2008035863 del 09/12/2008 el INVIMA concedió Permiso de Comercialización No. INVIMA2008EBC-0002816 para el producto MONITOR DE PACIENTE EDAN a favor de NOVAMEDICA LTDA CON DOMICILIO EN BARRANQUILLA en la modalidad IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante escrito número 20181195977 de fecha 25/09/2018, el Doctor RICHARD BORELLY AYCARDI, actuando en calidad de Apoderado de la empresa NOVA MEDICA LTDA, solicitó Renovación al Permiso de Comercialización para el producto MONITOR DE PACIENTE / MONITOR DE SIGNOS VITALES a favor de NOVA MEDICA LTDA, en la modalidad de IMPORTAR y VENDER.

Que mediante auto número 2019004368 del 25 de abril de 2019, el INVIMA informa al interesado que una vez revisado el expediente y para continuar con el trámite solicitado debe cumplir con los siguientes requerimientos:

> *1. Allegar información científica que respalde la seguridad del producto, acorde al literal j del artículo 18 del Decreto 4725 de 2005, para lo cual debe anexar el DESARROLLO de pruebas de carácter técnico- científico que demuestren la compatibilidad electromagnética, conforme a las normas IEC u otros tipos de estándares. Lo anterior teniendo en cuenta que el interesado indica que esta información se encuentra en el expediente inicial, pero al revisar el expediente folio 132 del radicado inicial 2008102547 se evidencia, que dicha información es aportada para el modelo y/o referencia M9, modelo el cual no hace parte de esta solicitud de Renovación. Razón por la cual es necesario que allegue la información para al menos un modelo y/o referencia solicitada en el formulario M20, ELITEV5, ELITEV6, IM8, IM8A, IM8B, IM9, IM9A, IM9B, IM80, IM80A, IM50, IM50A, ELITE V8, IM60, IM70 M3, M3B.*
>
> *2. Allegar Certificado de Venta Libre - CVL debidamente apostillado o consularizado y legalizado, toda vez que rastreado el número de verificación de la legalización en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores, se evidenció autenticación sobre la traducción oficial; y no del documento original, como debe ser. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 44 del Decreto 4725 de 2005.*

Que mediante escrito 20191202476 del 16 de octubre de 2019, el Doctor RICHARD BORELLY AYCARDI, actuando en calidad de Apoderado de la empresa NOVA MEDICA LTDA, allega respuesta al requerimiento 2019004368 del 25 de abril de 2019.

CONSIDERACIONES

Que ante este Instituto se ha solicitado la Concesión de un Permiso de Comercialización con base en la documentación allegada, previo estudio técnico y legal de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías dando respuesta al requerimiento No. 2019004368 del 25 de abril de 2019 siendo **SATISFACTORIA** por cuanto el interesado aporta:

Para el numeral 1: El desarrollo de pruebas de compatibilidad electromagnética que respalda la seguridad del producto.
Para el numeral 2: El interesado allegó Certificado de Venta Libre – CVL de conformidad a los artículos 29 y 44 del Decreto 4725 de 2005.

Oficina Principal:
Administrativo:
www.invima.gov.co

invima

La salud es de todos Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2019058211 DE 20 de Diciembre de 2019
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Permiso de Comercialización
La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, en ejercicio de las facultades legales, Decreto 2078 de 2012, Decreto 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y Ley 1437 de 2011.

RADICACIÓN: 20181195977
FECHA: 25/09/2018

ARTICULO SEGUNDO. - SE APRUEBAN ETIQUETAS DE FABRICA Y DE IMPORTADOR APORTADAS MEDIANTE RADICADO 20181195977.

ARTICULO TERCERO: AUTORIZAR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTO QUE SE ENCUENTRE MARCADO CON EL PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN ANTERIOR No **INVIMA2008EBC-0002816**

ARTICULO CUARTO. - Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición que deberá interponerse ante la Directora Técnica De Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO QUINTO. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 20 de Diciembre de 2019
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

28 ENE 2020

ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE ESTA ENTIDAD

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTORA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Proyectó: Legal: salbam, Técnico: ysanchezo Revisó: cordina_varios

Firma válida
Firmado digitalmente por LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Fecha: 13:00:5
Razón: V
Locación: BOGOTA D C
Colombia

Oficina Principal:
Administrativo:
www.invima.gov.co

invima

novamedico	GESTION DE COMPRAS Y COMERCIO EXTERIOR FORMATO ACTA DE ENTREGA DE EQUIPO	Fecha: 14/11/2023 Version: 2 GCC-FO-009

EQUIPO: MONITOR DE PACIENTE **MARCA:** EDAN

MOD/REF: X12 **S/N:** **261594-M23A12070092**

ACCESORIOS	S/N/lote	Cant
Sensor SpO2	H23901060292	1
Bateria	IES-ID9952023022004993	1
Cable ECG		1
Brazalete/Manguera NIBP		1
Cable AC/Cable a Tierra		1
Sensor Temperatura		1
Set de Electrodos		1
Pad EVA		1
Manual Oper Inst y Mto y/o Guia Rápida (Español)/FQC		1
Certificado Inspeccion Final FQC		1
Cronograma Anual de Mantenimiento		1
	0	
Declaración de Importación Adjunta:	872024000001886-1	
Registro Sanitario/Perm de Comercialización	2019EBC-0002816 R1	

Entregue al Tenedor del Dispositivo Médico La documentación adjunta (Cap VII Decreto 4725/2005)
1) Manual de Oper , Inst y Mto y/o Guía Rápida de Uso
2) Cronograma Anual de Mto recomendado por el Fabricante
3) Declaración de Importación y Certificado de Inspección Final de Producto (FQC)
Reporte inconformidad en el producto o en los documentos referidos dentro de las (72h) siguientes al recibo de la mercancia al correo servicioalcliente@novamedicasas.com. de lo contrario se asumirá el RECIBO A SATISFACCION

ESTIMADO CLIENTE: Siga estas RECOMENDACIONES para garantizar el uso seguro del dispositivo y mantenerlo acorde a especificaciones del fabricante:

☐ Consulte nuestro Canal institucional www.youtube.com/novamedicasas donde podrá acceder a programas de capacitación en línea sobre la instalación y puesta en funcionamiento del Dispositivo Médico y Recomendaciones de Seguridad.

☐ Ejecute el Programa de mantenimiento preventivo dentro de los tiempos sugeridos. Le ofrecemos el Servicio de Soporte Técnico. Contáctenos en el correo: serviciotecnico@novamedicasas.com o en nuestro PBX: (5) 3780063 ext 107 y 105

☐ Nova Medica sas ofrece capacitación y entrenamiento técnico , consulte la programación anual a través de la web: www.novamedicasas.com o contacte a su Asesora Comercial

Esta PROHIBIDO retirar del dispositivo el sticker que permite garantizar al tenedor la información del Importador y el numero de Registro Sanitario (Art 57 Dec 4725/2005)

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2024**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

872024000001886-1

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 802001786 | 6. DV: 4 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: NOVA MEDICA S.A.S.

13. Dirección: CR 49 C 79 184 BRR ALTO PRADO | 15. Teléfono: 3780063 | 12. Cód. Admón.: 87 | 16. Cód. Dpto: 08 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 802016656 | 25. DV: 5 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS SIA TRADE S.A NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 443

29. Número documento de identificación: 72218389 | 30. Apellidos y nombres: GOMEZ MENDEZ ALVARO

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Deposito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BAQ	1501	No. 116575013999762	2023 - 12 - 15	No. EGLV010300985027	2023 - 11 - 04

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: EDAN INSTRUMENTS, INC. | 47. Ciudad: SHENZHEN | 48. Cod.País Exportador: 215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: No15 jinhui rd,jinsha community,kengzi subdistrict | 50. E-mail: 8675526898330

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
EDAN-IM-230911RC	2023 - 10 - 25	215	1	467	8	NAVEMAR SAS	3.822,05

S

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
9018901000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.		72. Peso neto kgs.		73. Código embalaje	74. No. cuotas	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad doms.
08	01	215	conta. 1.452,11		doms. 1.452,11		YY	350	15	U	200,00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
100.000,00	1.540,92

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
35,00	0

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
1.575,92	0,00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
101.575,92	R	50194342

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
3	2023	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	388.228.245	0	0	0,00
I.V.A.	19.00	388.228.245	73.763.000	0	0,00
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0,00
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0,00
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0,00
Sanción	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	73.763.000		0,00

91. Descripción de las mercancías/No omita la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO: I10936-23, PEDIDO BL EGLV010300985027 , DECLARACION 11 DE 15; FACTURA(S):EDAN-IM-230911RC;REFERENCIA: NO TIENE ,NOMBRE COMERC
IAL X12 PATIENT MONITOR,MARCA EDAN,MODELO X12 CANTIDAD: 200 UNIDAD PRODUCTO: MONITOR DE PACIENTE , SERIALES: 261594-M23A12060001;
261594-M23A12060002; 261594-M23A12060003; 261594-M23A12060004; 261594-M23A12060005; 261594-M23A12060006; 261594-M23A12060007; 26
1594-M23A12060008; 261594-M23A12060009; 261594-M23A12060010; 261594-M23A12060011; 261594-M23A12060012; 261594-M23A12060013; 26159
4-M23A12060014; 261594-M23A12060015; 261594-M23A12060016; 261594-M23A12060017; 261594-M23A12060018; 261594-M23A12060019; 261594-M
23A12060020; 261594-M23A12060021; 261594-M23A12060022; 261594-M23A12060023; 261594-M23A12060024; 261594-M23(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0

128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración: 872024000001886 | 133. Fecha: 2024 01 06

134. Levante No. 872024000001907 | 135. Fecha: 2024 - 01 - 09 | Firma funcionario responsable | 136. Nombre | 137. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

9108701242232 1

Fecha de Impresión: 2024-01-12 08:18:00

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **872024000001886-1**
Subpartida : **9018901000**

108. Continuación descripción mercancías (incluya marcas, serie/os y otros)

A12060025; 261594-M23A12060026; 261594-M23A12060027; 261594-M23A12060028; 261594-M23A12060029; 261594-M23A12060030; 261594-M23A12060031; 261594-M23A12060032; 261594-M23A12060033; 261594-M23A12060034; 261594-M23A12060035; 261594-M23A12060036; 261594-M23A12060037; 261594-M23A12060038; 261594-M23A12060039; 261594-M23A12060040; 261594-M23A12060041; 261594-M23A12060042; 261594-M23A12060043; 261594-M23A12060044; 261594-M23A12060045; 261594-M23A12060046; 261594-M23A12060047; 261594-M23A12060048; 261594-M23A12060049; 261594-M23A12060050; 261594-M23A12060051; 261594-M23A12060052; 261594-M23A12060053; 261594-M23A12060054; 261594-M23A12060055; 261594-M23A12060056; 261594-M23A12060057; 261594-M23A12060058; 261594-M23A12060059; 261594-M23A12060060; 261594-M23A12060061; 261594-M23A12060062; 261594-M23A12060063,261594-M23A12060064 261594-M23A12060065,261594-M23A12060066,261594-M23A12060067,261594-M23A12060068,261594-M23A12060069,261594-M23A12060070,261594-M23A12060071,261594-M23A12060072,261594-M23A12060073,261594-M23A12060074,261594-M23A12060075,261594-M23A12060076,261594-M23A12060077,261594-M23A12060078,261594-M23A12060079,261594-M23A12060080,261594-M23A12060081,261594-M23A12060082,261594-M23A12060083,261594-M23A12060084,261594-M23A12060085,261594-M23A12060086,261594-M23A12060087,261594-M23A12060088,261594-M23A12060089,261594-M23A12060090,261594-M23A12060091,261594-M23A12060092,261594-M23A12060093,261594-M23A12060094,261594-M23A12060095,261594-M23A12060096,261594-M23A12060097,261594-M23A12060098,261594-M23A12060099,261594-M23A12060100,261594-M23A12070001,261594-M23A12070002,261594-M23A12070003,261594-M23A12070004,261594-M23A12070005,261594-M23A12070006,261594-M23A12070007,261594-M23A12070008,261594-M23A12070009,261594-M23A12070010,261594-M23A12070011,261594-M23A12070012,261594-M23A12070013,261594-M23A12070014,261594-M23A12070015,261594-M23A12070016,261594-M23A12070017,261594-M23A12070018,261594-M23A12070019,261594-M23A12070020,261594-M23A12070021,261594-M23A12070022,261594-M23A12070023,261594-M23A12070024,261594-M23A12070025,261594-M23A12070026,261594-M23A12070027,261594-M23A12070028,261594-M23A12070029,261594-M23A12070030,261594-M23A12070031,261594-M23A12070032,261594-M23A12070033,261594-M23A12070034,261594-M23A12070035,261594-M23A12070036,261594-M23A12070037,261594-M23A12070038,261594-M23A12070039,261594-M23A12070040,261594-M23A12070041,261594-M23A12070042,261594-M23A12070043,261594-M23A12070044,261594-M23A12070045,261594-M23A12070046,261594-M23A12070047,261594-M23A12070048,261594-M23A12070049,261594-M23A12070050,261594-M23A12070051,261594-M23A12070052,261594-M23A12070053,261594-M23A12070054,261594-M23A12070055,261594-M23A12070056,261594-M23A12070057,261594-M23A12070058,261594-M23A12070059,261594-M23A12070060,261594-M23A12070061,261594-M23A12070062,261594-M23A12070063,261594-M23A12070064,261594-M23A12070065,261594-M23A12070066,261594-M23A12070067,261594-M23A12070068,261594-M23A12070069,261594-M23A12070070,261594-M23A12070071,261594-M23A12070072,261594-M23A12070073,261594-M23A12070074,261594-M23A12070075,261594-M23A12070076,261594-M23A12070077,261594-M23A12070078,261594-M23A12070079,261594-M23A12070080,261594-M23A12070081,261594-M23A12070082,261594-M23A12070083,261594-M23A12070084,261594-M23A12070085,261594-M23A12070086,261594-M23A12070087,261594-M23A12070088,261594-M23A12070089,261594-M23A12070090,261594-M23A12070091,261594-M23A12070092,261594-M23A12070093,261594-M23A12070094,261594-M23A12070095,261594-M23A12070096,261594-M23A12070097,261594-M23A12070098,261594-M23A12070099,261594-M23A12070100, USO MEDICO: MEDICION DE PARAMETROS ECG, FRECUENCIA CARDIACA, SPO2, NIBP), TEMPERATURA, RESPIRACION, OPCIONAL (PARAMETROS 2IBP/CO/CO2) USADOS EN UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO Y NEONATAL, URGENCIAS, CIRUGIA. HOSPITALIZACION Y SALAS DEOBSERVACION Y RECUPERACION DE CLINICAS Y HOSPITALES , TECNICA DE DIAGNOSTICO: EXPECTROFOTOMETRIA, OSCILOMETRIA, MEDIDA BIOPOTENCIAL. , INFORMACION ADICIONAL: CADA EQUIPO SUS ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO: (1) SENSOR DE OXIMETRIA REF: SH1 SERIALES # H23901060209;H23901060204,H23901060227,H23901060258,H23901060210,H23901060215,H23901060247,H23901060251,H23901060248,H23901060272,H23901060226,H23901060236,H23901060244,H23901060258,H23901060259,H23901060393,H23901060332,H23901060219,H23901060228,H23901060279,H23901060265,H23901060372,H23901060366,H23901060225,H23901060213,H23901060339,H23901060375,H23901060222,H23901060316,H23901060331,H23901060254,H23901060231,H23901060336,H23901060271,H23901060361,H23901060383,H23901060386,H23901060341,H23901060389,H23901060394,H23901060390,H23901060400,H23901060358,H23901060385,H23901060376,H23901060314,H23901060392,H23901060214,H23901060367,H23901060363,H23901060322,H23901060378,H23901060379,H23901060313,H23901060395,H23901060315,H23901060301,H23901060306,H23901060319,H23901060310,H23901060320,H23901060369,H23901060387,H23901060334,H23901060317,H23901060309,H23901060370,H23901060399,H23901060368,H23901060359,H23901060304,H23901060307,H23901060343,H23901060380,H23901060337,H23901060293,H23901060345,H23901060318,H23901060344,H23901060305,H23901060398,H23901060371,H23901060384,H23901060346,H23901060312,H23901060302,H23901060381,H23901060329,H23901060327,H23901060333,H23901060335,H23901060365,H23901060342,H23901060364,H23901060397,H23901060303,H23901060311,H23901060338,H23901060308,H23901060233,H23901060260,H23901060268,H23901060224,H23901060255,H23901060239,H23901060249,H23901060241,H23901060261,H23901060211,H23901060218,H23901060262,H23901060212,H23901060235,H23901060201,H23901060060,H23901060275,H23901060229,H23901060220,H23901060274,H23901060256,H23901060207,H23901060223,H23901060289,H23901060234,H23901060245,H23901060202,H23901060208,H23901060295,H23901060294,H23901060237,H23901060240,H23901060297,H23901060257,H23901060004,H23901060269,H23901060023,H23901060253,H23901060232,H23901060206,H23901060252,H23901060097,H23901060290,H23901060054,H23901060038,H23901060217,H23901060300,H23901060035,H23901060034,H23901060062,H23901060048,H23901060018,H23901060003,H23901060238,H23901060277,H23901060243,H23901060298,H23901060278,H23901060014,H23901060061,H23901060281,H23901060203,H23901060091,H23901060230,H23901060069,H23901060032,H23901060216,H23901060033,H23901060022,H23901060039,H23901060264,H23901060242,H23901060285,H23901060266,H23901060246,H23901060205,H23901060007,H23901060299,H23901060267,H23901060221,H23901060284,H23901060055,H23901060031,H23901060020,H23901060288,H23901060296,H23901060283,H23901060019,H23901060280,H23901060287,H23901060263,H23901060286,H23901060292,H23901060273,H23901060026,H23901060282,H23901060071,H23901060291,H23901060057,H23901060276,H23901060270, (1) BATERIA RECARGABLE LI-ION 12.6 V 2500 MAH (27.5 WH) MOD: ID995 SERIALES # IES-ID9952023022000703,IES-ID9952023022000393,IES-ID9952023022000386,IES-ID9952023022000706,IES-ID9952023022000398,IES-ID9952023022000716,IES-ID9952023022000701,IES-ID9952023022000384,IES-ID9952023022000382,IES-ID9952023022000700,IES-ID9952023022000819,IES-ID9952023022000707,IES-ID9952023022000395,IES-ID9952023022000705,IES-ID9952023022001539,IES-ID9952023022001664,IES-ID9952023022001667,IES-ID9952023022000391,IES-ID9952023022000389,IES-ID9952023022001666,IES-ID9952023022000699,IES-ID9952023022001651,IES-ID9952023022001640,IES-ID9952023022000387,IES-ID9952023022000704,IES-ID9952023022001631,IES-ID9952023022001657,IES-ID9952023022001663,IES-ID9952023022001675,IES-ID9952023022001513,IES-ID9952023022001639,IES-ID9952023022001641,IES-ID9952023022001670,IES-ID9952023022001648,IES-ID9952023022001564,IES-ID9952023022001637,IES-ID9952023022001354,IES-ID9952023022001324,IES-ID9952023022001486,IES-ID9952023022001352,IES-ID9952023022001353,IES-ID9952023022001647,IES-ID9952023022001355,IES-ID9952023022000275,IES-ID9952023022001646,IES-ID9952023022001645,IES-ID9952023022001325,IES-ID9952023022001665,IES-ID9952023022001340,IES-ID9952023022001366,IES-ID9952023022001374,IES-ID9952023022001638,IES-ID9952023022001501,IES-ID9952023022001500,IES-ID9952023022001559,IES-ID9952023022001394,IES-ID9952023022001410,IES-ID9952023022001404,IES-ID9952023022001671,IES-ID9952023022001544,IES-ID9952023022001658,IES-ID9952023022001655,IES-ID9952023022001626IES-ID9952023022001412,IES-ID9952023022001565,IES-ID9952023022001561,IES-ID9952023022001566,IES-ID9952023022001346,IES-ID9952023022001390,IES-ID9952023022001356,IES-ID9952023022001550,IES-ID9952023022001650,IES-ID9952023022001673,IES-ID9952023022001350,IES-ID9952023022001642,IES-ID9952023022001660,IES-ID9952023022001494,IES-ID9952023022001643,IES-ID9952023022001546,IES-ID9952023022001405,IES-ID9952023022001568,IES-ID9952023022001632,IES-ID9952023022001557,IES-ID9952023022001560,IES-ID9952023022001348,IES-ID9952023022001409,IES-ID9952023022001652,IES-ID9952023022001656,IES-ID9952023022001556,IES-ID9952023022001368,IES-ID9952023022001407,IES-ID9952023022001351,IES-ID9952023022001649,IES-ID9952023022001659,IES-ID9952023022001672,IES-ID9952023022001401,IES-ID9952023022001372,IES-ID9952023022001668,IES-ID9952023022001674,IES-ID9952023022000390,IES-ID9952023022000785,IES-ID9952023022000001,IES-ID9952023022000690,IES-ID9952023022000692,IES-ID9952023022000713,IES-ID9952023022000742,IES-ID9952023022005009,IES-ID9952023022000799,IES-ID9952023022000714,IES-ID9952023022000470,IES-ID9952023022005019,IES-ID9952023022000458,IES-ID9952023022000741,IES-ID9952023022000722,IES-ID9952023022005016,IES-ID9952023022000697,IES-ID9952023022000302,IES-ID9952023022000299,IES-ID9952023022005045,IES-ID9952023022000164,IES-ID9952023022000791,IES-ID9952023022000798,IES-ID9952023022005011,IES-ID9952023022000743,IES-ID9952023022000734,IES-ID9952023022000255,IES-ID9952023022000786,IES-ID9952023022005012,IES

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

872024000001886-1

105. Continuación descripción mercancías (incluya marcas, seriales y otros)

-ID9952023022000821,IES-ID9952023022000076,IES-ID9952023022000540,IES-ID9952023022005082,IES-ID9952023022000720,IES-ID9952023022000717,IES-ID9952023022000397,IES-ID9952023022000724,IES-ID9952023022000383,IES-ID9952023022000801,IES-ID9952023022000711,IES-ID9952023022000793,IES-ID9952023022000718,IES-ID9952023022000726,IES-ID9952023022004979,IES-ID9952023022000723,IES-ID9952023022000721,IES-ID9952023022000710,IES-ID9952023022000824,IES-ID9952023022000702,IES-ID9952023022000695,IES-ID9952023022000475,IES-ID9952023022005004,IES-ID9952023022005027,IES-ID9952023022000498,IES-ID9952023022005047,IES-ID9952023022005030,IES-ID9952023022005033,IES-ID9952023022000727,IES-ID9952023022000399,IES-ID9952023022005002,IES-ID9952023022005020,IES-ID9952023022000787,IES-ID9952023022005034,IES-ID9952023022000788,IES-ID9952023022005028,IES-ID9952023022005044,IES-ID9952023022000715,IES-ID9952023022004992,IES-ID9952023022004988,IES-ID9952023022005035,IES-ID9952023022005043,IES-ID9952023022000693,IES-ID9952023022005037,IES-ID9952023022000818,IES-ID9952023022000698,IES-ID9952023022000251,IES-ID9952023022005046,IES-ID9952023022004994,IES-ID9952023022000688,IES-ID9952023022005042,IES-ID9952023022005017,IES-ID9952023022005048,IES-ID9952023022004978,IES-ID9952023022005041,IES-ID9952023022005008,IES-ID9952023022000689,IES-ID9952023022005014,IES-ID9952023022005023,IES-ID9952023022000709,IES-ID9952023022000823,IES-ID9952023022005024,IES-ID9952023022004999,IES-ID9952023022004993,IES-ID9952023022005005,IES-ID9952023022000696,IES-ID9952023022000822,IES-ID9952023022005039,IES-ID9952023022005021,IES-ID9952023022005038,IES-ID9952023022000708,IES-ID9952023022000719,Y DEMAS ACCESORIOS: (1) CABLE ECG REF:EC05DAS121 (1) BRAZALETE NIBP REF: ADULT E9, (1) MANGUERA NIBP REF BPT2 (1) SENSOR DE TEMPERATURA REF: 01.15.040225 , (1) CABLE CONEXION A TIERRA REF:SZCNT F002, (1)SET ELECTRODOS BSS (1)CABLE AC REF : E219959 (2) MANUAL DE USUARIO ,(1) CERTIFICADO FQC,GUIA RAPIDA, (1), (1) SUPERFICIE DE EVA (1) MINI DESTORNILLADOR. FECHA DE FABRICACION:2023/10. PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN NO: INVIMA 2019EBC-0002816 R1 // NOS ACOGEMOS AL DECRETO NÚMERO 1881 DE 2021, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMOXXXXX

BIOMEDICAL SOLUTIONS
INGENIERIA

NIT. 53116519-2
REGIMEN COMUN
DIAG. 5ª No. 37B 60 BLOQUE 15ª APTO. 503
BOGOTA – COLOMBIA

Certificado N° MP-705-24

INFORMACION DEL SOLICITANTE
Customer information

CLIENTE: HOSPITAL SAN VICENTE E.S.E.
Client

CIUDAD: ROVIRA (TOLIMA)
City

INFORMACION DEL EQUIPO BAJO PRUEBA.
Device under test information.

EQUIPO: MONITOR MULTIPARAMETROS
Equipment
MARCA: EDAN
Brand
MODELO: X12
Model
SERIE: 261594-M23A12070092
Serial

ID. Institución:
ID. Institution

LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRUEBA
Place and conditions of test

Lugar de la Calibración: LABORATORIO
Place of Calibration
Fecha de Calibración: 2024/12/14
Date of Calibration
Fecha de Recepción: 2024/12/14
Date of Receipt
TEMPERATURA: 20,2 °C
Temperature

HUMEDAD R: 59 %
Humidity

NOTAS:
Notes:

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso escrito de BIOMEDICAL SOLUTIONS. Los resultados contenidos en el presente documento se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos probados.
El usuario es responsable del seguimiento de sus instrumentos a intervalos apropiados.

FIRMA:

FABIAN ALFONSO ARCE RAMIREZ
INGENIERO DE CALIBRACION

BIOMEDICAL SOLUTIONS
INGENIERIA

Certificado N° MP-705-24

Trabajo realizado:

Calibración del equipo

Método utilizado:

Comparación directa. La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura K=2

Información de Trazabilidad

Nuestros instrumentos son trazables a estándares internacionales

Información de los instrumentos utilizados

PATRON	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA CALIBRACION	CERTIFICADO
MANOMETRO DE PRESION DIGITAL	NO REGISTRA	LK-168A	01713093	2024-10-12	C5425-24
SIMULADOR DE SIGNOS VITALES	DNI NEVADA	214B	0285	2024-10-17	J2348-24
SIMULADOR DE PULSOXIMETRIA	CONTEC	MS 100	20080300004	2024-10-12	P9537-24

RESULTADOS DE CALIBRACION

MEDICIONES DE PRESION NIBP				
PROMEDIO DE PRESION INDICADA EN EL ITEM (mmHg)	PRESION INDICADA EN EL PATRON (mmHg)	ERROR (mmHg)	INCERTIDUMBRE (mmHg)	
0	0,0	0,0	±	0,70
50	50,4	0,4	±	0,74
100	100,4	0,4	±	0,74
150	150,4	0,4	±	0,74
200	200,2	0,2	±	0,74
250	250,3	0,3	±	0,73

ERROR MAXIMO: 0,4 mmHg

INCERTIDUMBRE MAXIMA: +/- 0,74 mmHg

La unidad de presión en el Sistema Internacional de Unidades es el Pascal: 1 mmHg = 133,322 Pa

CALIBRACION % SPO2			
SELECCION EN EL PATRON % SPO2	% SPO2 INDICADA EN EL ITEM	ERROR % SPO2	INCERTIDUMBRE % SPO2
78	79	1	1
85	86	1	1
90	91	1	1
96	97	1	1
100	101	1	1

ERROR MAXIMO: 1 %SPO2

INCERTIDUMBRE MAXIMA: 1 %SPO2

BIOMEDICAL SOLUTIONS
INGENIERIA

Certificado N° MP-705-24

CALIBRACION DE RESPIRACION			
RESPIRACION SELECCIONADA EN EL PATRON Resp/min	RESPIRACION INDICADA EN EL ITEM Resp/min	ERROR	INCERTIDUMBRE Resp/min
30	30	0	0,0021
40	40	0	0,0021
60	60	0	0,0021
100	100	0	0,0021

ERROR MAXIMO: 1 Resp/min
INCERTIDUMBRE MAXIMA: +/- 0,0021 Resp/min

CALIBRACION DE ECG			
SELECCION EN EL PATRON BPM	ECG INDICADA EN EL ITEM BPM	ERROR	INCERTIDUMBRE BPM
80	81	1	0,0021
150	150	0	0,0021
220	220	0	0,0021
350	350	0	0,0021

ERROR MAXIMO: 1 BPM
INCERTIDUMBRE MAXIMA: +/- 0,0021 BPM

Anomalías detectadas antes y durante la calibración: NINGUNA

FIN DEL CERTIFICADO

SET GAD Metrología

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-004

NVLAP CALIBRATION
NVLAP LAB CODE 201065-0

ilac-MRA

Certificado de Calibración

Certificado #
C5425-24

Laboratorio de Metrología Set y Gad S.A.S. — Bogotá

Descripción del equipo:	Manómetro de Presión digital	Condición como se recibió:	Operable
Fabricante:	LK-168A	Fecha de calibración:	2024-10-12
Serie No.:	01713093	Método de Calibración:	LAB-SIMSV-060
Nombre del cliente:	Biomedical Solutions	Temperatura:	21,6 °C
Dirección:	Diag. 5A N°37b60	Humedad:	51%
Ciudad:	BOGOTA		
Fecha de recepción	2024-10-02		

Patrones de calibración

Instrumento	Número de Serie	Due Date	ID Certificado
PATRON DE PRESION	34794	02/03/2023	FP021-23

Descripción de la calibración

La calibración del equipo bajo prueba se hace con un instrumento patrón trazable al sistema internacional de unidades... Los resultados emitidos en este certificado de calibración, describe al equipo bajo prueba en el momento que está siendo calibrado.
Este certificado de calibración no puede ser reproducido ni parcial ni de forma completa, sin la aprobación escrita del laboratorio SET & GAT.
Calibración: Datos de calibración obtenidos sin haber realizado ninguna clase de ajustes y/o reparación.
Set & Gad mantiene los patrones de referencia en condiciones físicas adecuadas para su conservación, estos patrones han sido calibrados con trazabilidad internacional o nacional, bajo estándares definidos por casa matriz, dependiendo de sus especificaciones.
El usuario es responsable de la caliración de sus instrumentos a intervalos adecuados.

S-G Metrología

Digitally signed by Felipe Uribe
DN: cn=Felipe Uribe, o=Set y Gad SAS, email=felipe.urib@esetgad.com, c=CO

Revisó y autorizó calibración
Ing. Luis Felipe Uribe Agudelo

Carrera 48 # 101 A - 69, Bogotá, Colombia
www.setgad.com

DIOS AYUDA A QUIEN CONFÍA EN ÉL

SET∝GAD Metrología

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-004

NVLAP CALIBRATION
NVLAP LAB CODE 201065-0

ilac-MRA

Certificado de Calibración

Certificado #
C5425-24

RESULTADOS DE LA MEDICION

Calibración de Presión

Precarga	IBC mmHg	Patrón mmHg	Corrección mmHg	Incertidumbre mmHg	k
300,0 mmHg	300	296,7	-3,3	0,72	2
Nominal	IBC mmHg	Patrón mmHg	Corrección mmHg	Incertidumbre mmHg	k
0,0 mmHg	0	0	0	0,58	2
50,0 mmHg	50	50,8	0,8	0,58	2
100,0 mmHg	100	100,7	0,7	0,58	2
150,0 mmHg	150	149,4	-0,6	0,58	2
200,0 mmHg	200	199,4	-0,6	0,58	2
250,0 mmHg	250	247,6	-2,4	0,58	2
300,0 mmHg	300	297,6	-2,4	0,72	2

Medición 1 mmHg	Medición 2 mmHg	Medición 3 mmHg	Medición 4 mmHg	Medición 5 mmHg
0	0	0	0	N/A
50,8	50,2	50,1	50,3	N/A
100,7	100,2	100,1	100,4	N/A
149,4	149,1	149,2	149,2	N/A
199,4	199,6	199,7	199,4	N/A
247,6	247,7	247,2	247,5	N/A
297,6	297,2	296,5	296,9	N/A

FIN DEL CERTIFICADO

SET GAD Metrología

Certificado de Calibración

PLT-LAB-025
V.3 2022 / 02 / 22 Rev. 5 2023 / 10 / 11

Certificado # J2348-24

Laboratorio de Metrología Set & Gad S.A.S. – Bogotá

Procedimiento de calibración: -P-LAB-106

Descripción del equipo:	Simulador de Signos vitales	Condición como se recibió:	Operable
		Fecha de calibración:	2024-10-17
Fabricante:	DNI NEVADA	Método de Calibración:	LAB-SIMSV-060
Serie No.:	0285	Temperatura:	21,6 °C
Nombre del cliente:	Biomedical Solutions	Humedad:	51%
Dirección:	Diag. 5A N° 37b60		
Ciudad:	BOGOTA		
Fecha de recepción	2024-10-10		

Patrones de calibración

Instrumento	Número de Serie	Due Date
FUENTE DE VOLTAJE	MY40010397	02/11/2023
MULTIMETRO	3031008	03/15/2023

Descripción de la calibración

La calibración del equipo bajo prueba se hace con un instrumento patrón trazable al sistema internacional de unidades... Los resultados emitidos en este certificado de calibración, describe al equipo bajo prueba en el momento que está siendo calibrado.
Este certificado de calibración no puede ser reproducido ni parcial ni de forma completa, sin la aprobación escrita del laboratorio SET & GAT.
Calibración: Datos de calibración obtenidos sin haber realizado ninguna clase de ajustes y/o reparación.
Set & Gad mantiene los patrones de referencia en condiciones físicas adecuadas para su conservación, estos patrones han sido calibrados con trazabilidad internacional o nacional, bajo estándares definidos por casa matriz, dependiendo de sus especificaciones.
El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos adecuados

Digitally signed by Felipe Uribe
DN: cn=Felipe Uribe, o=Set y Gad SAS, email=felipe.urib@setgad.com, c=CO

Revisó y autorizó calibración
Ing. Luis Felipe Uribe Agudelo

Carrera 48 # 101 A - 69, Bogotá, Colombia
www.setgad.com

DIOS AYUDA A QUIEN CONFÍA EN ÉL

SET∝GAD
Metrología

Certificado #
J2348-24

RESULTADOS DE LA MEDICION

Calibración de Respiración

	Especificación	Medido	Error	Incertidumbre	Tolerancia	Pasa/Falla	K
30 Resp/min	30	30	0	0,0021	0,6	Pasa	1,97
40 Resp/min	40	40	0	0,0021	0,8	Pasa	1,97
60 Resp/min	60	61	1	0.0021	1,2	Pasa	1,97
100 Resp/min	100	101	1	0,0021	2	Pasa	1,97

Calibración de ECG

	Especificación	Medido	Error	Incertidumbre	Tolerancia	Pasa/Falla	k
60 BPM	60	60	0	0,0021	0,6	Pasa	1 97
120 BPM	120	120	0	0,0021	1,2	Pasa	1,97
180 BPM	180	180	0	0,0021	1,8	Pasa	1,97
300 BPM	300	300	0	0,0021	3	Pasa	1,97

Calibración de Temperatura

Temperatura 400	Especificación	Medido	Error	Incertidumbre	Tolerancia	Pasa/Falla	k
30,0 °C	30	29,9	-0,1	0,0075	0,4	Pasa	1,97
37,0 °C	37	37,1	0,1	0,015	0,4	Pasa	1,97
40,0 °C	40	39,9	-0,1	0,016	0.4	Pasa	1,97

Temperatura 700 T1	Especificación	Medido	Error	Incertidumbre	Tolerancia	Pasa/Falla	k
30,0 °C	30	30,1	0,1	0,0055	4	Pasa	1,97
37,0 °C	37	36,9	0,1	0,0065	0,4	Pasa	1,97
40,0 °C	40	40	0	0,007	0,4	Pasa	1,97

Temperatura 700 T2	Especificación	Medido	Error	Incertidumbre	Tolerancia	Pasa/Falla	k
30,0 °C	30	30,1	0,1	0,0062	0,4	Pasa	1,97
37,0 °C	37	37,2	0,2	0,012	0,4	Pasa	1,97
40,0 °C	40	39,9	-0,1	0,013	0,4	Pasa	1,97

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

Código	F-BIO-001
Versión	1
Fecha	Febrero 2017
Página	1 de 1

1. INFORMACION DE EQUIPO

EQUIPO	REGULADOR DE OXIGENO		REGISTRO INVIMA	2018DM-0015134			
MARCA	MCARE		SERVICIO	TAB			
MODELO	MDC-870-L		UBICACIÓN	AMB. NXY747			
SERIE	06977495730016		CALIBRACIÓN	ANUAL			
N.° INVENTARIO			TIPO DE EQUIPO	FIJO		MOVIL	X
FECHA DE COMPRA	13/12/2024	FECHA INSTALACION	13/12/2024	GARANTIA			
EQUIPO PROPIO		EQUIPO COMODATO		DONACION			

2. FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO

MENSUAL		BIMENSUAL		TRIMESTRAL		CUATRIMESTRAL	X	SEMESTRAL		ANUAL	

REGISTRO FOTOGRAFICO	ACCESORIOS	
	CANTIDAD	ACCESORIO

3. CARACTERISTICAS TECNICAS

VOLTAJE	N/A	CORRIENTE	N/A	POTENCIA	N/A	FRECUENCIA	N/A	TEMP. DE TRABAJO	

CLASIFICACION RIESGO SEGUN 4725 DE 2005		CLASIFICACION DE USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		TECNOLOGIA PREDOMINANTE			
				DIAGNOSTICO					
				MTTO DE LA VIDA		ELECTRICO		NEUMATICO	X
RIESGO I		MEDICO		PREVENCION		ELECTRONICO		ACUSTICO	
RIESGO IIA	X	BASICO	X	REHABILITACIÓN	X	ELECTROMECANICO		SOLAR	
RIESGO IIB		APOYO		EQ. LABORATORIO		MECANICO		VAPOR	
RIESGO III		OTRO		EQ. ODONTOLOGIA		HIDRAULICO		OTRO	

4. RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

EVITAR GOLPES.
NO GIRAR MUY FUERTE LA PERILLA
NO SUMERGIR EL EQUIPO EN LÍQUIDOS.
EL EQUIPO SE DEBE LIMPIAR CON PAÑO SUAVE Y HÚMEDO.
EL USO DEL EQUIPO ESTÁ RESERVADO A PERSONAL CALIFICADO.

HOSPITAL SAN VICENTE
ROVIRA TOLIMA



DISS

HOJA DE VIDA DE EQUIPO

EQUIPO: REGULADOR DE OXIGENO	MARCA: MCARE	MODELO: MDC-870-L
SERIE: 06977495730016	CLASIFICACION DE DISPOSITIVO MEDICO: Riesgo Medio (IIA) TRATAMIENTO	
FECHA DE COMPRA: 13-12-2024	FECHA DE INSTALACION: 13-12-2024	VENCIMIENTO DE GARANTIA: UN AÑO
DATOS DEL PROVEEDOR: OSMEC AMBULANCIA		TELEFONO: 3153083450

PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO: ANUAL	UBICACIÓN: AMBULANCIA PLACA NXY 747	EQUIPO:	MOVIL X	FIJO	

REGISTRO INVIMA :	2018DM-0015134

FUNCIONES: Suministro de oxigeno medicinal a pacientes con fallas pulmonares o con alguna complicación medica que afecte el porcentaje de saturación de oxigeno.

RECOMENDACIONES DE FABRICANTE:

- No golpear el equipo, trate el oxigeno medicinal con precaución ya que es un compuesto infamable
- Verificar el funcionamiento antes de iniciar el turno.

REGISTRO TECNICO DE INSTALACION

VOLTAJE: N/A	TAMAÑO: 10 X 4 X 8 cm	POTENCIA: N/A
TEMPERATURA: +10° C + 40° C	PESO: 130 gr	PRESION 50Psi

REGISTRO TECNICO DE FUNCIONAMIENTO

HUMEDAD: hasta 85% de humedad relativa	Condiciones de almacenamiento: Sin pila : -25°C a +70° C (-13° F a +158° F)	PRESION MAXIMA DE TRABAJO: 50 PSI Max.

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PLANIFICADO SEGÚN PARAMETROS DE FABRICANTE

EQUIPO	REGULADOR DE OXIGENO
MARCA	M CARE
MODELO	MDC-870-L
SERIE	6977495730016
N° INVENTARIO	

- Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo
- Efectuar limpieza integral externa del equipo
- Efectuar limpieza integral interna del equipo
- Inspeccionar sistema de conexión de oxigeno
- Verificar el funcionamiento de los empaques
- Verificar el manometro
- Verificar funcionamiento del equipo en conjunto.

Material Gastable	Repuestos Minimos	Herramientas y Equipos
• FRANELA • LIMPIADOR DE CONTACTOS • LIMPIADOR DE SUPERFICIES LIQUIDO • AGUA JABONOSA	TEFLON	• LLAVE EXPANSIVA

BIOMEDICAL SOLUTIONS
INGENIERIA

NIT. 53116519-2
REGIMEN COMUN

REPORTE DE SERVICIO

FECHA:	12/12/2024	**REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO**		HORA INICIO:	10:20
INSTITUCION:	HOSPITAL SAN VICENTE	PROCESO:	AMBULANCIA	AREA:	MOVIL NXY 747

DATOS DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	REGULADOR DE OXIGENO			MARCA:	MCARE
SERIE:	231.200.916	MODELO:	MDC-540-UN	INV. N°.:	

ACCESORIOS DEL EQUIPO

ACOPLE, TORNILLO DE AJUSTE, EMPAQUE, MANOMETRO

DIAGNOSTICO INICIAL

	ESTADO		CONDICIONES AMBIENTALES DE USO SEGÚN LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE			
1	FISICO	BUENO	HUMEDAD:	49%	T°:	21,2 °C
2	FUNCIONAMIENTO	BUENO	SEGURIDAD DE LA INSTALACION:			
3	BATERIAS	N/A	EQUIPO NUEVO, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO			
4	ACCESORIOS	BUENO				

DESCRIPCION DEL SERVICIO

LIMPIEZA INTERNA ☐	LIMPIEZA EXTERNA ☐	DESINFECCION ☐	DESMANCHADO ☐
LIMPIEZA CONTACTOS ☐	LUBRICACION ☐	ENGRASE ☐	REEMPLAZO DE PARTES ☐

Se realiza hoja de vida

ELEMENTOS UTILIZADOS:

PRUEBAS FUNCIONALES

VERIFICACION DE:

SISTEMA ELECTRICO	☐	ENCENDIDO	☐	CONFIGURACION A TRAVES DEL MENU	☐
SISTEMA MECANICO	☐	ACCESORIOS	☒	FUNCIONAMIENTO DEL DISPLAY, PANTALLA	☐
SISTEMA HIDRAULICO	☐	ALARMAS VISUAL	☐	FUNCIONAMIENTO DEL MANOMETRO	☒
SISTEMA NEUMATICO	☒	ALARMAS AUDIBLES	☐	FUNCIONAMIENTO DEL TECLADO, PERILLAS, CONTROLES	☒
VIDA DE LA BATERIA	☐	FUGAS	☒	TARJETAS ELECTRONICAS Y CONECTORES	☐
SEGURIDAD ELECTRICA	☐	FILTROS	☐	EMPAQUES	☒
PRUEBAS DE FABRICA	☒	BOMBILLOS	☐	NIVELES DE FLUJO	☐
		ALMACENAMIENTO DE DATOS Y MEMORIA	☐	NIVELES DE PRESION	☒

REPUESTOS UTILIZADOS

OBSERVACIONES

EQUIPO NUEVO, LISTO PARA USAR, SE VERIFICAN FUGAS Y SALIDAD DE PRESION

EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE	SI	☒	NO	☐	HORA FINAL: 10:30

FECHA DEL PROXIMO MANTENIMIENTO: dic-25

ING. BIOMEDICO

FUNCIONARIO ENCARGADO

HOSPITAL SAN VICENTE
ROVIRA TOLIMA



DISS

HOJA DE VIDA DE EQUIPO

EQUIPO: REGULADOR DE OXIGENO	MARCA: MCARE	MODELO: MDC-870-L
SERIE: 06977495730016	CLASIFICACION DE DISPOSITIVO MEDICO: Riesgo Medio (IIA) TRATAMIENTO	
FECHA DE COMPRA: 13-12-2024	FECHA DE INSTALACION: 13-12-2024	VENCIMIENTO DE GARANTIA: UN AÑO
DATOS DEL PROVEEDOR: OSMEC AMBULANCIA		TELEFONO: 3153083450

PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO: ANUAL	UBICACIÓN: AMBULANCIA PLACA NXY 747	EQUIPO:	MOVIL X	FIJO	

REGISTRO INVIMA :	2018DM-0015134

FUNCIONES: Suministro de oxigeno medicinal a pacientes con fallas pulmonares o con alguna complicación medica que afecte el porcentaje de saturación de oxigeno.

RECOMENDACIONES DE FABRICANTE:

- No golpear el equipo, trate el oxigeno medicinal con precaución ya que es un compuesto infamable
- Verificar el funcionamiento antes de iniciar el turno.

REGISTRO TECNICO DE INSTALACION

VOLTAJE: N/A	TAMAÑO: 10 X 4 X 8 cm	POTENCIA: N/A
TEMPERATURA: +10° C + 40° C	PESO: 130 gr	PRESION 50Psi

REGISTRO TECNICO DE FUNCIONAMIENTO

HUMEDAD: hasta 85% de humedad relativa	Condiciones de almacenamiento: Sin pila : -25°C a +70° C (-13° F a +158° F)	PRESION MAXIMA DE TRABAJO: 50 PSI Max.

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PLANIFICADO SEGÚN PARAMETROS DE FABRICANTE

EQUIPO	REGULADOR DE OXIGENO
MARCA	M CARE
MODELO	MDC-870-L
SERIE	6977495730016
N° INVENTARIO	

- Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo
- Efectuar limpieza integral externa del equipo
- Efectuar limpieza integral interna del equipo
- Inspeccionar sistema de conexión de oxigeno
- Verificar el funcionamiento de los empaques
- Verificar el manometro
- Verificar funcionamiento del equipo en conjunto.

Material Gastable	Repuestos Minimos	Herramientas y Equipos
• FRANELA • LIMPIADOR DE CONTACTOS • LIMPIADOR DE SUPERFICIES LIQUIDO • AGUA JABONOSA	TEFLON	• LLAVE EXPANSIVA

BIOMEDICAL SOLUTIONS
INGENIERIA

NIT. 53116519-2
REGIMEN COMUN

REPORTE DE SERVICIO

FECHA:	12/12/2024	**REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO**		HORA INICIO:	10:30
INSTITUCION:	HOSPITAL SAN VICENTE	PROCESO:	AMBULANCIA	AREA:	MOVIL NXY 747

DATOS DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	REGULADOR DE O2 PORT.			MARCA:	MCARE
SERIE:	6.977.495.730.016	MODELO:	MDC-870-L	INV. N°.:	

ACCESORIOS DEL EQUIPO

ACOPLE, TUERCA DE AJUSTE, EMPAQUE, MANOMETRO

DIAGNOSTICO INICIAL

	ESTADO		CONDICIONES AMBIENTALES DE USO SEGÚN LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE			
1	FISICO	BUENO	HUMEDAD:	49%	T°:	21,2 °C
2	FUNCIONAMIENTO	BUENO	SEGURIDAD DE LA INSTALACION:			
3	BATERIAS	N/A	EQUIPO NUEVO, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO			
4	ACCESORIOS	BUENO				

DESCRIPCION DEL SERVICIO

LIMPIEZA INTERNA	☐	LIMPIEZA EXTERNA	☐	DESINFECCION	☐	DESMANCHADO	☐
LIMPIEZA CONTACTOS	☐	LUBRICACION	☐	ENGRASE	☐	REEMPLAZO DE PARTES	☐

Se realiza hoja de vida

ELEMENTOS UTILIZADOS:

PRUEBAS FUNCIONALES

VERIFICACION DE:

SISTEMA ELECTRICO	☐	ENCENDIDO	☐	CONFIGURACION A TRAVES DEL MENU	☐
SISTEMA MECANICO	☐	ACCESORIOS	☒	FUNCIONAMIENTO DEL DISPLAY, PANTALLA	☐
SISTEMA HIDRAULICO	☐	ALARMAS VISUAL	☐	FUNCIONAMIENTO DEL MANOMETRO	☒
SISTEMA NEUMATICO	☒	ALARMAS AUDIBLES	☐	FUNCIONAMIENTO DEL TECLADO, PERILLAS, CONTROLES	☒
VIDA DE LA BATERIA	☐	FUGAS	☒	TARJETAS ELECTRONICAS Y CONECTORES	☐
SEGURIDAD ELECTRICA	☐	FILTROS	☐	EMPAQUES	☒
PRUEBAS DE FABRICA	☒	BOMBILLOS	☐	NIVELES DE FLUJO	☐
		ALMACENAMIENTO DE DATOS Y MEMORIA	☐	NIVELES DE PRESION	☒

REPUESTOS UTILIZADOS

OBSERVACIONES

EQUIPO NUEVO, LISTO PARA USAR, SE VERIFICAN FUGAS Y SALIDAD DE PRESION

EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE	SI	☒	NO	☐	HORA FINAL: 10:40

FECHA DEL PROXIMO MANTENIMIENTO: dic-25

ING. BIOMEDICO

FUNCIONARIO ENCARGADO

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2016033972 DE 1 de Septiembre de 2016
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005.

CONSIDERANDO

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMATICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.
EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARA EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS A

PRODUCTO:	REGULADOR DE OXIGENO
MARCA:	MCARE
REGISTRO SANITARIO NO.:	INVIMA 2016DM-0015134
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	FUTUMEDICA S.A.S. CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
FABRICANTE(S):	DANYANG MADICOM ELECTROMECHANICAL CO., LTD. CON DOMICILIO EN CHINA
IMPORTADOR(ES):	FUTUMEDICA S.A.S. CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
ACONDICIONADOR(ES):	FUTUMEDICA S.A.S. CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
TIPO DE DISPOSITIVO	NO INVASIVO
RIESGO:	IIA
COMPOSICIÓN:	MANÓMETRO DE PRESIÓN, YUGO O ROSCA, SALIDA EN ROSCA O NIPLE, CUERPO DEL REGULADOR, EMPAQUE.
USOS:	INDICACIONES: LOS REGULADORES DE OXÍGENO SON DISPOSITIVOS PARA LA REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN LOS CUALES BAJAN LA PRESIÓN DEL OXÍGENO DEL CILINDRO A NIVELES QUE PUEDAN SER SEGUROS PARA EL USUARIO FINAL. USOS: EN PACIENTES CON ENFERMEDADES CARDIO RESPIRATORIAS QUE NECESITEN EL SUMINISTRO DE OXIGENO
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	UNIDAD
OBSERVACIONES:	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: MDC870 SERIES: MDC870-S, MDC870-UF, MDC870-L, MDC870UF-2CV, MDC-870-DG, MDC870-OPA, MDC540 SERIES: MDC540-S, MDC540-UN, MDC540 , BULLNOSE REGULATOR, MODEL MDC-BN OXYGEN FLOWMETER: FM4546, OXYGEN FLOWMETER: FM4000
VIDA UTIL:	10 AÑOS
EXPEDIENTE NO.:	20114221
RADICACIÓN NO.:	2016121002
FECHA DE RADICACIÓN:	31 08 2016

ARTICULO SEGUNDO.- CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

ARTICULO TERCERO.- LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

ARTICULO CUARTO.- LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 2005.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN BOGOTÁ D.C. A LOS 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016
ESTE ESPACIO, HASTA LA FIRMA SE CONSIDERA EN BLANCO.



Firma válida

Digitally signed by ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
Date: 2016.09.01 16:57:3
Reason: Firma
Location: Bogota, CO

ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
CTÓ: LEGAL: DCEPEDAR, TÉCNICO: MSANDOVALC, REVISÓ: CORDINA_VARIOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DIAN

Declaración de Importación

Privada | **500**

1. Año **2024**
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario **032024001521088-5**

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
830038639	1	FUTUMEDICA SAS

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CL 78 63 45	6300122	03	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
860514173	2	AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL 1	26	22

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
79443684	ROMERO DIAZ OSCAR MAURICIO

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9194415709	2024 - 10 - 31	No. CNLE240700693	2024 - 09 - 02

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
DANYANG MADICOM ELECTROMECHANICAL CO.,LTD	DANYANG, JIANGSU	215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
N.2 QIANDONG ROAD, SITU TOWN 212300	FAX. 008651186852677

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cts.
EEME240629	2024 - 07 - 24	215	1	169	11	MCT S.A.S	4,311.83

S

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
3926909090	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
08	01	215	2.37	2.15	CT	338	8	u	300.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
84.00	1.67
80. Valor Seguros USD	**81. Valor Otros Gastos USD**
0.06	0
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	**83. Ajuste valor USD**
1.73	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
85.73	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	10.00	369.653	37.000	0	0.00
I.V.A.	19.00	406.653	77.000	0	0.00
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0.00
Sanción	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	114.000		0.00

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 01244219. Declaracion(1-8). Producto: LLAVES PLASTICAS. Capacidad: NO APLICA. Uso: DOMICILIARIO PARA APERTURA DE CILINDROS DE OXIGENO PORTATILES. Marca: NO TIENE. Referencia: FISICA NO TIENE, CATALOGO: MDK-006. FABRICANTE: DANYANG MADICOM ELECTROMECHANICAL CO. LTD. PAIS: CHINA. Cant (300) NAR (Item 8) MERCANCIA NUEVA, POR SU USO Y APLICACION NO REQUIERE DE REGISTRO DE IMPORTCION NI VISTOS BUENOS, NOS ACOGEMOS AL DECRETO 925 DEL 2013 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Inspección física No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 032024001521088 133. Fecha: 202410 31

134. Levante No.	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.

Firma declarante

Servade S.A
AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL 1

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

91003042133461

Fecha de Impresión: 2024-10-31 10:41:20

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DIAN

Declaración de Importación

Privada | **500**

1. Año **2024**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario **032024001521092-5**

Importador
5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830038639 | 6. DV: 1 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: FUTUMEDICA SAS
13. Dirección: CL 78 63 45 | 15. Teléfono: 6300122 | 12. Cód. Admón.: 03 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante
24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860514173 | 25. DV: 2 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 22
29. Número documento de identificación: 79443684 | 30. Apellidos y nombres: ROMERO DIAZ OSCAR MAURICIO

31. Clase Importador: 02 | 32. Tipo declaración: Inicial | 33. Cod.: 1 | 34. No. Formulario Anterior: XXXXXXXXXXXXXX | 35. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX | 36. Cod. Admón.: XX | 37. Declaración de Exportación No.: XXXXXXXXXXXXXXX | 38. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX | 39. Cod. Admón.: XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías: BOG | 41. Cod. Depósito: 13907 | 42. Manifiesto de carga No.: 9194415709 | 43. Año - Mes - Día: 2024 - 10 - 31 | 44. Documento de transporte No.: CNLE240700693 | 45. Año - Mes - Día: 2024 - 09 - 02

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: DANYANG MADICOM ELECTROMECHANICAL CO.,LTD | 47. Ciudad: DANYANG, JIANGSU | 48. Cod.País Exportador: 215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: N.2 QIANDONG ROAD, SITU TOWN 212300 | 50. E-mail: FAX. 008651186852677

51. No. de factura: EEME240629 | 52. Año - Mes - Día: 2024 - 07 - 24 | 53. Cod. país procedencia: 215 | 54. Cod. Modo Transporte: 1 | 55. Código de Bandera: 169 | 56. Cod. Depto destino: 11 | 57. Empresa transportadora: MCT S.A.S | 58. Tasa de cambio $ cvs.: 4,311.83

S | 59. Subpartida arancelaria: 8484900000 | 60. Cod. Complementario: XX | 61. Cod. Suplementario: XX | 62. Cod. Modalidad: C200 | 63. No. cuotas o meses: XX | 64. Valor cuota USD: XXXX | 65. Periodicidad del pago de la cuota: XX | 66. Cod. país de origen: 215 | 67. Cod. Acuerdo: XXX

68. Forma de pago de la importación: 08 | 69. Tipo de importación: 01 | 70. Cod. país compra: 215 | 71. Peso bruto kgs. dcms.: 20.33 | 72. Peso neto kgs. dcms.: 18.42 | 73. Código embalaje: CT | 74. No. bultos: 338 | 75. Subpartidas: 8 | 76. Cod. unidad comercial: u | 77. Cantidad dcms.: 4,000.00

78. Valor FOB USD: 720.00 | 79. Valor fletes USD: 14.26
80. Valor Seguros USD: 0.50 | 81. Valor Otros Gastos USD: 0
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD: 14.76 | 83. Ajuste valor USD: 0.00
84. Valor aduana USD: 734.76 | 85. Código registro o licencia: X | 86. Número: XXXXXXXXXX
87. Cod. oficina: 99 | 88. Año: XXXX | 89. Programa No: XXXXXXXXXX | 90. Cód Interno del Producto: 0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	5.00	3,168,160	158,000	0	0.00
I.V.A.	19.00	3,326,160	632,000	0	0.00
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0.00
Sancion	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	790,000		0.00

91. Descripción de las mercancías (No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 01244219. Declaracion(2-8). Producto: JUNTA PARA YOKE, ARANDELA. Marca: NO TIENE, PROVEEDOR DANYANG. Modelo: NO TIENE. Referencia: NO TIENE. Serial: NO TIENE. Uso o destino: SELLA LAS CONEXIONES INTERNAS DE FUGAS DEL REGULADOR Cant (4000) NAR (Item 7) MERCANCIA NUEVA, POR SU USO Y APLICACION NO REQUIERE DE REGISTRO DE IMPORTCION NI VISTOS BUENOS, NOS ACOGEMOS AL DECRETO 925 DEL 2013 XXX

127. Valor pagos anteriores: **0** | 128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración: 032024001521092
133. Fecha: 202410 31

134. Levante No. 032024001428318 | 135. Fecha: 2024 - 10 - 31 | Firma funcionario responsable | 136. Nombre: OSCAR MAURICIO ROMERO DIAZ | 137. C.C. No.: 79.443.684 DE BOGOTA

Firma declarante

Servade S.A
AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL 1

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ **0**

996. Espacio para Número autoadhesivo
91003042133501

Fecha de Impresión: 2024-10-31 10:41:23

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2024**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario
032024001521093-2

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
830038639	1	FUTUMEDICA SAS

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CL 78 63 45	6300122	03	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
860514173	2	AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL 1	26	22

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
79443684	ROMERO DIAZ OSCAR MAURICIO

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9194415709	2024 - 10 - 31	No. CNLE240700693	2024 - 09 - 02

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
DANYANG MADICOM ELECTROMECHANICAL CO.,LTD	DANYANG, JIANGSU	215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
N.2 QIANDONG ROAD, SITU TOWN 212300	FAX. 008651186852677

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
EEME240629	2024 - 07 - 24	215	1	169	11	MCT S.A.S	4.311,83

S

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
8716801000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
08	01	215	2.138,78	1.938,00	CT	338	8	u	1.020,00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
8.690,00	1.500,63

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
6,08	0

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
1.506,71	0,00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
10.196,71	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	15,00	43.966.480	6.595.000	0	0,00
I.V.A.	19,00	50.561.480	9.607.000	0	0,00
Salvaguardia	0,00	0	0	0	0,00
Derechos Compensatorios	0,00	0	0	0	0,00
Derechos Antidumping	0,00	0	0	0	0,00
Sanción	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	16.202.000		0,00

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 01244219. Declaracion(3-8). Producto: CARROS PORTA CILINDROS. Uso: MANUAL PARA TRANSPORTE DE CILINDROS DE OXIGENO. Marca: NO TIENE. Referencia: TR-111C. CYLINDER CART FABRICANTE: DANYANG MADICOM ELECTROMECHANICAL CO. LTD. PAIS: CHINA. MATERIA CONSTITUTIVA : ACERO CUBIERTO DE CROMO Cant (1020) NAR (Item 19) MERCANCIA NUEVA, POR SU USO Y APLICACION NO REQUIERE DE REGISTRO DE IMPORTCION NI VISTOS BUENOS, NOS ACOGEMOS AL DECRETO 925 DEL 2013 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

127. Valor pagos anteriores:	128. Recibo oficial de pago anterior No.:	129. Fecha:
0	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración
Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior		032024001521093 133. Fecha: 202410 31

134. Levante No	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre / 137. C.C. No.
032024001428311	2024 - 10 - 31		OSCAR MAURICIO ROMERO DIAZ

Firma declarante

Servade S.A
AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL 1

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

91003042133531

Fecha de Impresión: 2024-10-31 10:40:23

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2024**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario **032024001521089-2**

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
830038639	1	FUTUMEDICA SAS

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CL 78 63 45	6300122	03	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
860514173	2	AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL 1	26	22

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
79443684	ROMERO DIAZ OSCAR MAURICIO

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9194415709	2024 - 10 - 31	No. CNLE240700693	2024 - 09 - 02

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
DANYANG MADICOM ELECTROMECHANICAL CO.,LTD	DANYANG, JIANGSU	215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
N.2 QIANDONG ROAD, SITU TOWN 212300	FAX. 008651186852677

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
EEME240629	2024 - 07 - 24	215	1	169	11	MCT S.A.S	4,311.83

S

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
8716900000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
08	01	215	0.28	0.26	CT	338	8	u	4.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
10.00	0.20

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
0.01	0

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
0.21	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
10.21	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	5.00	44.024	2.000	0	0.00
I.V.A.	19.00	46.024	9.000	0	0.00
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0.00
Sancion	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	11.000		0.00

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 01244219. Declaracion(4-8). Producto: MANGO DE CARROS PORTA CILINDROS. Uso: MANUAL PARA TRANSPORTE DE CILINDROS DE OXIGENO. Marca: NO TIENE. Referencia: NO TIENE. CART HANDLE. FABRICANTE: DANYANG MADICOM ELECTROMECHANICAL CO. LTD. PAIS: CHINA. MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO CUBIERTO DE CROMO Cant (4) NAR (Item 21) MERCANCIA NUEVA, POR SU USO Y APLICACION NO REQUIERE DE REGISTRO DE IMPORTCION NI VISTOS BUENOS, NOS ACOGEMOS AL DECRETO 925 DEL 2013 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

127. Valor pagos anteriores: **0**

128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX

129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático

No hay declaración posterior

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración 032024001521089

133. Fecha: 202410 31

134. Levante No. 032024001428312

135. Fecha 2024 - 10 - 31

Firma funcionario responsable

136. Nombre OSCAR MAURICIO ROMERO DIAZ

137. C.C. No. 79.443.684 DE BOGOTA

Firma declarante

Servade S.A
AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL 1

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ **0**

996. Espacio para Número autoadhesivo

91003042133484

Fecha de Impresión: 2024-10-31 10:40:28

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2024**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032024001521086-0

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
830038639	1	FUTUMEDICA SAS

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CL 78 63 45	6300122	03	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
860514173	2	AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL 1	26	22

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
79443684	ROMERO DIAZ OSCAR MAURICIO

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cód. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9194415709	2024 - 10 - 31	No. CNLE240700693	2024 - 09 - 02

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
DANYANG MADICOM ELECTROMECHANICAL CO.,LTD	DANYANG, JIANGSU	215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
N.2 QIANDONG ROAD, SITU TOWN 212300	FAX. 008651186852677

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Aduana	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
EEME240629	2024 - 07 - 24	215	1	169	11	MCT S.A.S	4.311.83

S

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Arancelario
4016930000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
08	01	215	3.36	3.05	CT	338	8	u	2.000.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
119.00	2.37	0.08	0	2.45	0.00	121.45	R	50166948

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
3	2024	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	15.00	523.672	79.000	0	0.00
I.V.A.	19.00	602.672	115.000	0	0.00
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0.00
Sanción	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	194.000		0.00

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 01244219. Declaracion(5-8). O-RING 18mm. Producto: ANILLO DE BUJE. Composicion: CAUCHO. Uso: SELLA LA CONEXIÓN DE OXÍGENO ENTR
E EL CUERPO DEL REGULADOR Y EL NIPLE DE ENTRADA CGA 540. Marca: NO TIENE, PROVEEDOR DANYANG. Referencia: NO TIENE. DESTINADO AL D
ISPOSITIVO MEDICO: REGULADOR DE OXIGENO MARCA MCARE, R/S: INVIMA 2016DM-0015134, EXP: 20114221, VIGENCIA 2026/09/01, FABRICANTE D
EL EQUIPO Y DE LA PARTE/ACCESORIO: DANYANG MADICOM ELECTROMECHANICAL CO. LTD P.O.: CHINA Cant (500) NAR (Item 9) O-RING 8mm. Prod
ucto: ANILLO 8 mm. Composicion: CAUCHO. Uso: SELLA LAS CONEXIONES INTERNAS DE FUGAS DEL REGULADOR. Marca: NO TIENE, PROVEEDOR DAN
YANG. Referencia: NO TIENE. DESTINADO AL DISPOSITIVO MEDICO: REGULADOR DE OXIGENO MARCA MCARE, R/S: INVIMA (continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 032024001521086 133. Feha: 202410 31

134. Levante No. 032024001428313	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
	2024 - 10 - 31		OSCAR MAURICIO ROMERO DIAZ 79443684 BOGOTÁ

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)	980. Pago Total $
Servade SA AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL 1	Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	0 996. Espacio para Número autoadhesivo 91003042133491

Fecha de Impresión: 2024-10-31 10:40:31

DIAN REPÚBLICA DE COLOMBIA	**Declaración de Importación**	Aceptación : **032024001521086-0** Subpartida : **4016930000** Página 1 de 1

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

2016DM-0015134, EXP: 20114221, VIGENCIA 2026/09/01, FABRICANTE DEL EQUIPO Y DE LA PARTE/ACCESORIO: DANYANG MADICOM ELECTROMECHANICAL CO. LTD P.O.: CHINA Cant (500) NAR (Item 10) ORING 4mm. Producto: ANILLO 4mm. Composicion: CAUCHO. Uso: SELLA LAS CONEXIONES INTERNAS DE FUGAS DEL REGULADOR. Marca: NO TIENE, PROVEEDOR DANYANG. Referencia: NO TIENE, DESTINADO AL DISPOSITIVO MEDICO: REGULADOR DE OXIGENO MARCA MCARE, R/S: INVIMA 2016DM-0015134, EXP: 20114221, VIGENCIA 2026/09/01, FABRICANTE DEL EQUIPO Y DE LA PARTE/ACCESORIO: DANYANG MADICOM ELECTROMECHANICAL CO. LTD P.O.: CHINA Cant (500) NAR (Item 11) ORING 4mm. Producto: ANILLO 4mm. Composicion: CAUCHO. Uso: SELLA LAS CONEXIONES INTERNAS DE FUGAS DEL REGULADOR. Marca: NO TIENE, PROVEEDOR DANYANG. Referencia: NO TIENE. DESTINADO AL DISPOSITIVO MEDICO: REGULADOR DE OXIGENO MARCA MCARE, R/S: INVIMA 2016DM-0015134, EXP: 20114221, VIGENCIA 2026/09/01, FABRICANTE DEL EQUIPO Y DE LA PARTE/ACCESORIO: DANYANG MADICOM ELECTROMECHANICAL CO. LTD P.O.: CHINA Cant (500) NAR (Item 12) MERCANCIA NUEVA, REGISTRO NO: REG-50166948-20240927N DEL 2024-09-27 FECHA DE VIGENCIA 2025-03-27, VISTO BUENO DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA: VMME-24-02920 DEL 2024-09-26 (NO REQUIERE), VISTO BUENO INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MED, ALIM: VINVIMA-24-0123646 DEL 2024-09-26XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

032024001521086-0	Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2024**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032024001521091-8

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830038639 | 6. DV.: 1 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: FUTUMEDICA SAS

13. Dirección: CL 78 63 45 | 15. Teléfono: 6300122 | 12. Cód. Admón.: 03 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860514173 | 25. DV.: 2 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 22

29. Número documento de identificación: 79443684 | 30. Apellidos y nombres: ROMERO DIAZ OSCAR MAURICIO

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Dependencia	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9194415709	2024 - 10 - 31	No. CNLE240700693	2024 - 09 - 02

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: DANYANG MADICOM ELECTROMECHANICAL CO.,LTD | 47. Ciudad: DANYANG, JIANGSU | 48. Cod.País Exportador: 215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: N.2 QIANDONG ROAD, SITU TOWN 212300 | 50. E-mail: FAX 008651186852677

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
EEME240629	2024 - 07 - 24	215	1	169	11	MCT S.A.S	4,311.83

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	9026900000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
08	01	215	66.51	60.26	CT	338	8	U	1,800.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código régimen o licencia	86. Número	87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód. Interno del Producto
2,355.00	46.65	1.65	0	48.30	0.00	2,403.30	R	50166948	3	2024	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	10.362.621	0	0	0.00
I.V.A.	19.00	10.362.621	1.969.000	0	0.00
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0.00
Sanción	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	1.969.000		0.00

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 01244219. Declaracion(7-8). BRASS, SPARE PARTS (0-15L). Producto: DIAFRAGMA. Uso o destino: REGULA EL FLUJO DE OXÍGENO ENTREGADO AL PACIENTE, DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA. Marca: NO TIENE, PROVEEDOR DANYANG. Referencia: NO TIENE, CATALOGO (DY06. DY12). DESTINADO AL DISPOSITIVO MEDICO: REGULADOR DE OXIGENO MARCA MCARE, R/S: INVIMA 2016DM-0015134, EXP: 20114221, VIGENCIA 2026/09/01, FABRICANTE DEL EQUIPO Y DE LA PARTE/ACCESORIO: DANYANG MADICOM ELECTROMECHANICAL CO. LTD P.O.: CHINA Cant (400) NAR (Item 14) BRASS, SPARE PARTS (0-6L). Producto: DIAFRAGMA. Uso o destino: REGULA EL FLUJO DE OXÍGENO ENTREGADO AL PACIENTE, DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA. Marca: NO TIENE, PROVEEDOR DANYANG. Referencia: NO TIENE, CATALOGO (DY06. DY12). DESTINADO AL DI(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0 | 128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración: 032024001521091
133. Fecha: 2024-10-31

134. Levante No. 032024001428310 | 135. Fecha: 2024 - 10 - 31 | Firma funcionario responsable | 136. Nombre | 137. C.C. No.

OSCAR MAURICIO ROMERO DIAZ

Firma declarante

Servade SA
AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL 1

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

91003042133524

Fecha de Impresión: 2024-10-31 10:40:19

DIAN REPÚBLICA DE COLOMBIA	**Declaración de Importación**	Aceptación : 032024001521091-8 Subpartida : 9026900000 Página 1 de 1

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

SPOSITIVO MEDICO: REGULADOR DE OXIGENO MARCA MCARE, R/S: INVIMA 2016DM-0015134, EXP: 20114221, VIGENCIA 2026/09/01, FABRICANTE DE
L EQUIPO Y DE LA PARTE/ACCESORIO: DANYANG MADICOM ELECTROMECHANICAL CO. LTD P.O.: CHINA Cant (200) NAR (Item 15) FLOW SELECTOR KN
OB (1/64-6L). Producto: PERILLA DEL REGULADOR. Uso o destino: REGULA EL FLUJO DE OXÍGENO ENTREGADO AL PACIENTE, DE ACUERDO A LA N
OMENCLATURA. Marca: NO TIENE, PROVEEDOR DANYANG. Referencia: NO TIENE, CATALOGO (FM-29). DESTINADO AL DISPOSITIVO MEDICO: REGULAD
OR DE OXIGENO MARCA MCARE, R/S: INVIMA 2016DM-0015134, EXP: 20114221, VIGENCIA 2026/09/01, FABRICANTE DEL EQUIPO Y DE LA PARTE/AC
CESORIO: DANYANG MADICOM ELECTROMECHANICAL CO. LTD P.O.: CHINA Cant (100) NAR (Item 16) FLOW SELECTOR KNOB (0-15L). Producto: PER
ILLA DEL REGULADOR. Uso o destino: REGULA EL FLUJO DE OXÍGENO ENTREGADO AL PACIENTE, DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA. Marca: NO TIEN
E, PROVEEDOR DANYANG. Referencia: NO TIENE, CATALOGO (FM-29). DESTINADO AL DISPOSITIVO MEDICO: REGULADOR DE OXIGENO MARCA MCARE,
R/S: INVIMA 2016DM-0015134, EXP: 20114221, VIGENCIA 2026/09/01, FABRICANTE DEL EQUIPO Y DE LA PARTE/ACCESORIO: DANYANG MADICOM EL
ECTROMECHANICAL CO. LTD P.O.: CHINA Cant (800) NAR (Item 17) Producto: LLAVE EN T DEL REGULADOR. Uso o destino: LLAVE DE PRESION
QUE REGULA EL FLUJO DE OXÍGENO ENTREGADO AL PACIENTE, DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA. Marca: NO TIENE, PROVEEDOR DANYANG. Referenci
a: NO TIENE, CATALOGO (FM-79). DESTINADO AL DISPOSITIVO MEDICO: REGULADOR DE OXIGENO MARCA MCARE, R/S: INVIMA 2016DM-0015134, EXP
: 20114221, VIGENCIA 2026/09/01, FABRICANTE DEL EQUIPO Y DE LA PARTE/ACCESORIO: DANYANG MADICOM ELECTROMECHANICAL CO. LTD P.O.: C
HINA Cant (300) NAR (Item 18) SE ANEXA CERTIFICACION DEL PROVEEDOR, QUE DECLARA QUE LOS PRODUCTOS OBJETO DE ESTA IMPORTACION, NO
SE FABRICAN CON MERCURIO Y TAMPOCO CONTIENEN MERCURIO. LOS PRODUCTOS NO CORRESPONDEN A PRODUCTOS CON MERCURIO AÑADIDO DE QUE TRAT
A EL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO 419 DEL 22 DE ABRIL DE 2021 Y DECRETO 1433 DE 2022. NO REQUIEREN NI UTILIZAN FUENTE RADIACTIVA DE POD
ER. MERCANCIA QUE NO SE ENCUENTRA SUJETA AL CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO TECNICO, DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 33883 DEL 2021 DE LA S
UPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), SEGÚN CONCEPTO 22-6498 Y 22-032018, 09/02/2022. LA NORMA SOLAMENTE APLICA A LOS IN
STRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO (BALANZAS); SURTIDORES, DISPENSADORES Y/O MEDIDORES DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
; ETILÓMETROS O ALCOHOSENSORES, ALCOHOLÍMETROS; Y TAXÍMETROS ELECTRÓNICOS. GRAVAMEN 0% SEGUN DECRETO 1881 DEL 2021. REGISTRO NO:
REG-50166948-20240927N DEL 2024-09-27 FECHA DE VIGENCIA 2025-03-27, VISTO BUENO DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA: VMME-24-02920
DEL 2024-09-26 (NO REQUIERE), VISTO BUENO INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MED, ALIM: VINVIMA-24-0123646 DEL 2024-09-26. MERCA
NCIA NUEVAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

032024001521091-8	Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2024**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032024001521090-0

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830038639 | 6. DV: 1 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: FUTUMEDICA SAS

13. Dirección: CL 78 63 45 | 15. Teléfono: 6300122 | 12. Cód. Admón.: 03 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860514173 | 25. DV: 2 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 22

29. Número documento de identificación: 79443684 | 30. Apellidos y nombres: ROMERO DIAZ OSCAR MAURICIO

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documentos de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9194415709	2024 - 10 - 31	No. CNLE240700693	2024 - 09 - 02

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: DANYANG MADICOM ELECTROMECHANICAL CO.,LTD | 47. Ciudad: DANYANG, JIANGSU | 48. Cod.País Exportador: 215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: N.2 QIANDONG ROAD, SITU TOWN 212300 | 50. E-mail: FAX. 008651186852677

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Aduana	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
EEME240629	2024 - 07 - 24	215	1	169	11	MCT S.A.S	4.311,83

S

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
9026200000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
08	01	215	561.37	495.86	CT	338	8	U	1.500,00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código régimen o licencia	86. Número	87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No.	90. Cód. interno del Producto
13.861,00	393,85	9,70	0	403,55	0,00	14.264,55	R	50166948	J	2024	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0,00	61.506.315	0	0	0,00
I.V.A.	19,00	61.506.315	11.686.000	0	0,00
Salvaguardia	0,00	0	0	0	0,00
Derechos Compensatorios	0,00	0	0	0	0,00
Derechos Antidumping	0,00	0	0	0	0,00
Sanción	0	0	0	0	
Reexame	0	0	0	0	
		Total	11.686.000		0,00

91. Descripción de las mercancías(No iniciar la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el espacio es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 01244219. Declaracion(8-8). . Producto: REGULADOR DE OXIGENO. Marca: MCARE. Modelo: NO TIENE. Referencia: MDC870-UF. Uso o destino: LOS REGULADOR DE OXIGENO SON DISPOSITIVOS PARA LA REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN LOS CUALES BAJAN LA PRESIÓN DEL OXÍGENO DEL CILINDRO A NIVELES QUE PUEDAN SER SEGUROS PARA EL USUARIO FINAL. USOS: EN PACIENTES CON ENFERMEDADES CARDIORESPIRATORIAS QUE NECESITEN EL SUMINISTRO DE OXIGENO. Principio de funcionamiento: MANUAL. REF: MDC870-UF, BRASS INTEGRAL 50 PSI 02 REGULATOR, CGA870 EXT FLOWS: 0-15L /MIN. Presentacion comercial: UNIDAD. VIDA UTIL: 10 AÑOS. FABRICANTE: DANYANG MADICOM ELECTROMECHANICAL CO. LTD. PAIS: CHINA, MERCANCIA NUEVA 2024 Cant (200) NAR; Serial: / (01)06977495730030(11)240810(21)00001 / (01)06977495(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración: 032024001521090 133. Fecha: 2024 10 31
134. Levante No. 032024001428325	135. Fecha: 2024 - 10 - 31	Firma funcionario responsable 136. Nombre 137. C.C. No.

Firma declarante

Servade SA

AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL 1

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

91003042133517

Fecha de Impresión: 2024-10-31 10:42:38

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Declaración de Importación

Aceptación : **032024001521090-0**
Subpartida : **9026200000**

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

730030(11)240810(21)00002 / (01)06977495730030(11)240810(21)00003 / (01)06977495730030(11)240810(21)00004 / (01)06977495730030(11
)240810(21)00005 / (01)06977495730030(11)240810(21)00006 / (01)06977495730030(11)240810(21)00007 / (01)06977495730030(11)240810(2
1)00008 / (01)06977495730030(11)240810(21)00009 / (01)06977495730030(11)240810(21)00010 / (01)06977495730030(11)240810(21)00011 /
(01)06977495730030(11)240810(21)00012 / (01)06977495730030(11)240810(21)00013 / (01)06977495730030(11)240810(21)00014 / (01)0697
7495730030(11)240810(21)00015 / (01)06977495730030(11)240810(21)00016 / (01)06977495730030(11)240810(21)00017 / (01)06977495730030
0(11)240810(21)00018 / (01)06977495730030(11)240810(21)00019 / (01)06977495730030(11)240810(21)00020 / (01)06977495730030(11)2408
10(21)00021 / (01)06977495730030(11)240810(21)00022 / (01)06977495730030(11)240810(21)00023 / (01)06977495730030(11)240810(21)000
Z4 ¥ (01)06977495730030(11)240810(21)00025 / (01)06977495730030(11)240810(21)00026 / (01)06977495730030(11)240810(21)00027 / (01)
06977495730030(11)240810(21)00028 / (01)06977495730030(11)240810(21)00029 / (01)06977495730030(11)240810(21)00030 / (01)069774957
30030(11)240810(21)00031 / (01)06977495730030(11)240810(21)00032 / (01)06977495730030(11)240810(21)00033 / (01)06977495730030(11)
240810(21)00034 / (01)06977495730030(11)240810(21)00035 / (01)06977495730030(11)240810(21)00036 / (01)06977495730030(11)240810(21
)00037 / (01)06977495730030(11)240810(21)00038 / (01)06977495730030(11)240810(21)00039 / (01)06977495730030(11)240810(21)00040 /
(01)06977495730030(11)240810(21)00041 / (01)06977495730030(11)240810(21)00042 / (01)06977495730030(11)240810(21)00043 / (01)06977
495730030(11)240810(21)00044 / (01)06977495730030(11)240810(21)00045 / (01)06977495730030(11)240810(21)00046 / (01)06977495730030
(11)240810(21)00047 / (01)06977495730030(11)240810(21)00048 / (01)06977495730030(11)240810(21)00049 / (01)06977495730030(11)24081
0(21)00050 / (01)06977495730030(11)240810(21)00051 / (01)06977495730030(11)240810(21)00052 / (01)06977495730030(11)240810(21)0005
3 / (01)06977495730030(11)240810(21)00054 / (01)06977495730030(11)240810(21)00055 / (01)06977495730030(11)240810(21)00056 / (01)0
6977495730030(11)240810(21)00057 / (01)06977495730030(11)240810(21)00058 / (01)06977495730030(11)240810(21)00059 / (01)0697749573
0030(11)240810(21)00060 / (01)06977495730030(11)240810(21)00061 / (01)06977495730030(11)240810(21)00062 / (01)06977495730030(11)2
40810(21)00063 / (01)06977495730030(11)240810(21)00064 / (01)06977495730030(11)240810(21)00065 / (01)06977495730030(11)240810(21)
00066 / (01)06977495730030(11)240810(21)00067 / (01)06977495730030(11)240810(21)00068 / (01)06977495730030(11)240810(21)00069 /
01)06977495730030(11)240810(21)00070 / (01)06977495730030(11)240810(21)00071 / (01)06977495730030(11)240810(21)00072 / (01)069774
95730030(11)240810(21)00073 / (01)06977495730030(11)240810(21)00074 / (01)06977495730030(11)240810(21)00075 / (01)06977495730030(
11)240810(21)00076 / (01)06977495730030(11)240810(21)00077 / (01)06977495730030(11)240810(21)00078 / (01)06977495730030(11)240810
(21)00079 / (01)06977495730030(11)240810(21)00080 / (01)06977495730030(11)240810(21)00081 / (01)06977495730030(11)240810(21)00082
/ (01)06977495730030(11)240810(21)00083 / (01)06977495730030(11)240810(21)00084 / (01)06977495730030(11)240810(21)00085 / (01)06
977495730030(11)240810(21)00086 / (01)06977495730030(11)240810(21)00087 / (01)06977495730030(11)240810(21)00088 / (01)06977495730
030(11)240810(21)00089 / (01)06977495730030(11)240810(21)00090 / (01)06977495730030(11)240810(21)00091 / (01)06977495730030(11)24
0810(21)00092 / (01)06977495730030(11)240810(21)00093 / (01)06977495730030(11)240810(21)00094 / (01)06977495730030(11)240810(21)0
0095 / (01)06977495730030(11)240810(21)00096 / (01)06977495730030(11)240810(21)00097 / (01)06977495730030(11)240810(21)00098 / (0
1)06977495730030(11)240810(21)00099 / (01)06977495730030(11)240810(21)00100 / (01)06977495730030(11)240810(21)00101 / (01)06977495
5730030(11)240810(21)00102 / (01)06977495730030(11)240810(21)00103 / (01)06977495730030(11)240810(21)00104 / (01)06977495730030(1
1)240810(21)00105 / (01)06977495730030(11)240810(21)00106 / (01)06977495730030(11)240810(21)00107 / (01)06977495730030(11)240810(
21)00108 / (01)06977495730030(11)240810(21)00109 / (01)06977495730030(11)240810(21)00110 / (01)06977495730030(11)240810(21)00111
/ (01)06977495730030(11)240810(21)00112 / (01)06977495730030(11)240810(21)00113 / (01)06977495730030(11)240810(21)00114 / (01)069
77495730030(11)240810(21)00115 / (01)06977495730030(11)240810(21)00116 / (01)06977495730030(11)240810(21)00117 / (01)06977495730030
30(11)240810(21)00118 / (01)06977495730030(11)240810(21)00119 / (01)06977495730030(11)240810(21)00120 / (01)06977495730030(11)240
810(21)00121 / (01)06977495730030(11)240810(21)00122 / (01)06977495730030(11)240810(21)00123 / (01)06977495730030(11)240810(21)00
124 / (01)06977495730030(11)240810(21)00125 / (01)06977495730030(11)240810(21)00126 / (01)06977495730030(11)240810(21)00127 / (01
)06977495730030(11)240810(21)00128 / (01)06977495730030(11)240810(21)00129 / (01)06977495730030(11)240810(21)00130 / (01)06977495
730030(11)240810(21)00131 / (01)06977495730030(11)240810(21)00132 / (01)06977495730030(11)240810(21)00133 / (01)06977495730030(11
)240810(21)00134 / (01)06977495730030(11)240810(21)00135 / (01)06977495730030(11)240810(21)00136 / (01)06977495730030(11)240810(2
1)00137 / (01)06977495730030(11)240810(21)00138 / (01)06977495730030(11)240810(21)00139 / (01)06977495730030(11)240810(21)00140 /
(01)06977495730030(11)240810(21)00141 / (01)06977495730030(11)240810(21)00142 / (01)06977495730030(11)240810(21)00143 / (01)0697
7495730030(11)240810(21)00144 / (01)06977495730030(11)240810(21)00145 / (01)06977495730030(11)240810(21)00146 / (01)06977495730030
0(11)240810(21)00147 / (01)06977495730030(11)240810(21)00148 / (01)06977495730030(11)240810(21)00149 / (01)06977495730030(11)2408
10(21)00150 / (01)06977495730030(11)240810(21)00151 / (01)06977495730030(11)240810(21)00152 / (01)06977495730030(11)240810(21)001
53 / (01)06977495730030(11)240810(21)00154 / (01)06977495730030(11)240810(21)00155 / (01)06977495730030(11)240810(21)00156 / (01)
06977495730030(11)240810(21)00157 / (01)06977495730030(11)240810(21)00158 / (01)06977495730030(11)240810(21)00159 / (01)069774957
30030(11)240810(21)00160 / (01)06977495730030(11)240810(21)00161 / (01)06977495730030(11)240810(21)00162 / (01)06977495730030(11)
240810(21)00163 / (01)06977495730030(11)240810(21)00164 / (01)06977495730030(11)240810(21)00165 / (01)06977495730030(11)240810(21
)00166 / (01)06977495730030(11)240810(21)00167 / (01)06977495730030(11)240810(21)00168 / (01)06977495730030(11)240810(21)00169 /
(01)06977495730030(11)240810(21)00170 / (01)06977495730030(11)240810(21)00171 / (01)06977495730030(11)240810(21)00172 / (01)06977
495730030(11)240810(21)00173 / (01)06977495730030(11)240810(21)00174 / (01)06977495730030(11)240810(21)00175 / (01)06977495730030
(11)240810(21)00176 / (01)06977495730030(11)240810(21)00177 / (01)06977495730030(11)240810(21)00178 / (01)06977495730030(11)24081
0(21)00179 / (01)06977495730030(11)240810(21)00180 / (01)06977495730030(11)240810(21)00181 / (01)06977495730030(11)240810(21)0018
2 / (01)06977495730030(11)240810(21)00183 / (01)06977495730030(11)240810(21)00184 / (01)06977495730030(11)240810(21)00185 / (01)0
6977495730030(11)240810(21)00186 / (01)06977495730030(11)240810(21)00187 / (01)06977495730030(11)240810(21)00188 / (01)06977495730
0030(11)240810(21)00189 / (01)06977495730030(11)240810(21)00190 / (01)06977495730030(11)240810(21)00191 / (01)06977495730030(11)2
40810(21)00192 / (01)06977495730030(11)240810(21)00193 / (01)06977495730030(11)240810(21)00194 / (01)06977495730030(11)240810(21)
00195 / (01)06977495730030(11)240810(21)00196 / (01)06977495730030(11)240810(21)00197 / (01)06977495730030(11)240810(21)00198 /
01)06977495730030(11)240810(21)00199 / (01)06977495730030(11)240810(21)00200 (Item 1) . Producto: REGULADOR DE OXIGENO. Marca: MC
ARE. Modelo: NO TIENE. Referencia: MDC870-UF. Uso o destino: LOS REGULADOR DE OXIGENO SON DISPOSITIVOS PARA LA REDUCCIÓN DE LA PR
ESIÓN LOS CUALES BAJAN LA PRESIÓN DEL OXÍGENO DEL CILINDRO A NIVELES QUE PUEDAN SER SEGUROS PARA EL USUARIO FINAL. USOS: EN PACIE
NTES CON ENFERMEDADES CARDIORESPIRATORIAS QUE NECESITEN EL SUMINISTRO DE OXIGENO. Principio de funcionamiento: MANUAL. REF: MDC87
0-UF, BRASS INTEGRAL 50 PSI 02 REGULATOR, CGA870 FLOWS: 0-6L/MIN. 1/64-6 LPM. Presentacion comercial: UNIDAD. VIDA UTIL: 10 AÑOS.
FABRICANTE: DANYANG MADICOM ELECTROMECHANICAL CO. LTD. PAIS: CHINA, MERCANCIA NUEVA, AÑO DE FABRICACION 2024. Cant (600) NAR: Se
rial: / (01)06977495730047(11) 240810(21)00201 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00202 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00203
/ (01)06977495730047(11) 240810(21)00204 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00205 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00206 / (01)
06977495730047(11) 240810(21)00207 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00208 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00209 / (01)069774
95730047(11) 240810(21)00210 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00211 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00212 / (01)06977495730047(11)
47(11) 240810(21)00213 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00214 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00215 / (01)06977495730047(11) 24081
240810(21)00216 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00217 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00218 / (01)06977495730047(11) 24081
0(21)00219 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00220 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00221 / (01)06977495730047(11) 240810(21)0
0222 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00223 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00224 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00225 /

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

032024001521090-0

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Declaración de Importación

Aceptación : **032024001521090-0**
Subpartida : **9026200000**

105. Continuación descripción mercancía (Incluya marcas, seriales y otros)

(01)06977495730047(11) 240810(21)00226 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00227 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00228 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00229 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00230 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00231 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00232 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00233 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00234 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00235 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00236 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00237 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00238 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00239 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00240 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00241 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00242 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00243 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00244 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00245 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00246 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00247 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00248 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00249 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00250 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00251 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00252 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00253 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00254 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00255 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00256 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00257 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00258 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00259 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00260 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00261 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00262 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00263 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00264 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00265 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00266 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00267 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00268 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00269 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00270 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00271 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00272 /(01)06977495730047(11) 240810(21)00273 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00274 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00275 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00276 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00277 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00278 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00279 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00280 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00281 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00282 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00283 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00284 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00285 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00286 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00287 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00288 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00289 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00290 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00291 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00292 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00293 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00294 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00295 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00296 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00297 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00298 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00299 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00300 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00301 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00302 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00303 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00304 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00305 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00306 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00307 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00308 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00309 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00310 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00311 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00312 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00313 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00314 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00315 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00316 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00317 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00318 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00319 /(01)06977495730047(11) 240810(21)00320 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00321 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00322 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00323 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00324 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00325 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00326 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00327 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00328 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00329 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00330 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00331 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00332 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00333 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00334 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00335 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00336 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00337 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00338 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00339 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00340 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00341 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00342 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00343 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00344 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00345 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00346 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00347 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00348 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00349 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00350 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00351 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00352 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00353 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00354 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00355 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00356 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00357 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00358 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00359 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00360 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00361 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00362 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00363 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00364 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00365 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00366 /(01)06977495730047(11) 240810(21)00367 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00368 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00369 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00370 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00371 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00372 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00373 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00374 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00375 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00376 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00377 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00378 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00379 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00380 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00381 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00382 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00383 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00384 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00385 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00386 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00387 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00388 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00389 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00390 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00391 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00392 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00393 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00394 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00395 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00396 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00397 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00398 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00399 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00400 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00401 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00402 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00403 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00404 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00405 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00406 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00407 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00408 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00409 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00410 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00411 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00412 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00413 /(01)06977495730047(11) 240810(21)00414 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00415 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00416 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00417 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00418 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00419 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00420 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00421 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00422 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00423 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00424 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00425 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00426 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00427 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00428 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00429 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00430 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00431 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00432 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00433 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00434 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00435 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00436 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00437 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00438 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00439 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00440 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00441 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00442 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00443 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00444 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00445 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00446 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00447 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00448 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00449 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00450 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00451 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00452 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00453 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00454 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00455 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00456 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00457 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00458 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00459 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00460 /(01)06977495730047(11) 240810(21)00461 / (01)

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

032024001521090-0

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Declaración de Importación

Aceptación : **032024001521090-0**
Subpartida : **9026200000**

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

(01)06977495730047(11) 240810(21)00462 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00463 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00464 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00465 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00466 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00467 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00468 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00469 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00470 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00471 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00472 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00473 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00474 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00475 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00476 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00477 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00478 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00479 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00480 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00481 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00482 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00483 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00484 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00485 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00486 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00487 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00488 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00489 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00490 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00491 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00492 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00493 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00494 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00495 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00496 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00497 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00498 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00499 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00500 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00501 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00502 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00503 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00504 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00505 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00506 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00507 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00508 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00509 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00510 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00511 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00512 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00513 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00514 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00515 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00516 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00517 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00518 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00519 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00520 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00521 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00522 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00523 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00524 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00525 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00526 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00527 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00528 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00529 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00530 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00531 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00532 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00533 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00534 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00535 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00536 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00537 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00538 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00539 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00540 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00541 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00542 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00543 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00544 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00545 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00546 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00547 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00548 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00549 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00550 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00551 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00552 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00553 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00554 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00555 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00556 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00557 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00558 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00559 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00560 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00561 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00562 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00563 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00564 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00565 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00566 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00567 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00568 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00569 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00570 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00571 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00572 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00573 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00574 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00575 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00576 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00577 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00578 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00579 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00580 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00581 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00582 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00583 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00584 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00585 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00586 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00587 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00588 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00589 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00590 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00591 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00592 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00593 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00594 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00595 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00596 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00597 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00598 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00599 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00600 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00601 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00602 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00603 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00604 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00605 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00606 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00607 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00608 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00609 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00610 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00611 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00612 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00613 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00614 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00615 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00616 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00617 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00618 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00619 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00620 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00621 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00622 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00623 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00624 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00625 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00626 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00627 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00628 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00629 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00630 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00631 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00632 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00633 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00634 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00635 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00636 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00637 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00638 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00639 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00640 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00641 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00642 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00643 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00644 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00645 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00646 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00647 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00648 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00649 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00650 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00651 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00652 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00653 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00654 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00655 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00656 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00657 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00658 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00659 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00660 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00661 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00662 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00663 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00664 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00665 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00666 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00667 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00668 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00669 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00670 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00671 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00672 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00673 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00674 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00675 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00676 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00677 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00678 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00679 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00680 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00681 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00682 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00683 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00684 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00685 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00686 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00687 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00688 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00689 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00690 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00691 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00692 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00693 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00694 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00695 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00696 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00697 / (01)06977

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

032024001521090-0

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

7495730047(11) 240810(21)00698 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00699 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00700 / (01)0697749573
0047(11) 240810(21)00701 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00702 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00703 / (01)06977495730047(1
1) 240810(21)00704 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00705 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00706 / (01)06977495730047(11) 240
810(21)00707 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00708 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00709 / (01)06977495730047(11) 240810(21
)00710 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00711 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00712 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00713
/ (01)06977495730047(11) 240810(21)00714 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00715 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00716 / (01
)06977495730047(11) 240810(21)00717 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00718 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00719 / (01)06977
495730047(11) 240810(21)00720 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00721 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00722 / (01)06977495730
047(11) 240810(21)00723 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00724 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00725 / (01)06977495730047(11
) 240810(21)00726 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00727 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00728 / (01)06977495730047(11) 2408
10(21)00729 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00730 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00731 / (01)06977495730047(11) 240810(21)
00732 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00733 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00734 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00735
/ (01)06977495730047(11) 240810(21)00736 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00737 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00738 / (01)
06977495730047(11) 240810(21)00739 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00740 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00741 / (01)069774
95730047(11) 240810(21)00742 /(01)06977495730047(11) 240810(21)00743 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00744 / (01)06977495730047
7(11) 240810(21)00745 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00746 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00747 / (01)06977495730047(11)
240810(21)00748 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00749 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00750 / (01)06977495730047(11) 240810
(21)00751 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00752 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00753 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00
754 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00755 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00756 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00757 /
(01)06977495730047(11) 240810(21)00758 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00759 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00760 / (01)06
977495730047(11) 240810(21)00761 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00762 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00763 / (01)06977495
730047(11) 240810(21)00764 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00765 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00766 / (01)06977495730047
(11) 240810(21)00767 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00768 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00769 / (01)06977495730047(11) 2
40810(21)00770 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00771 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00772 / (01)06977495730047(11) 240810(
21)00773 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00774 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00775 / (01)06977495730047(11) 240810(21)007
76 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00777 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00778 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00779 / (
01)06977495730047(11) 240810(21)00780 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00781 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00782 / (01)069
77495730047(11) 240810(21)00783 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00784 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00785 / (01)069774957
30047(11) 240810(21)00786 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00787 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00788 / (01)06977495730047(
11) 240810(21)00789 /(01)06977495730047(11) 240810(21)00790 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00791 / (01)06977495730047(11) 240
810(21)00792 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00793 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00794 / (01)06977495730047(11) 240810(21
)00795 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00796 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00797 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00798
/ (01)06977495730047(11) 240810(21)00799 / (01)06977495730047(11) 240810(21)00800 (Item 2) Producto: REGULADOR DE OXIGENO. Marca
: MCARE. Modelo: NO TIENE. Referencia: MDC870-L. Uso o destino: LOS REGULADOR DE OXIGENO SON DISPOSITIVOS PARA LA REDUCCIÓN DE LA
PRESIÓN LOS CUALES BAJAN LA PRESIÓN DEL OXÍGENO DEL CILINDRO ANIVELES QUE PUEDAN SER SEGUROS PARA EL USUARIO FINAL. USOS: EN PAC
IENTES CON ENFERMEDADES CARDIORESPIRATORIAS QUE NECESITEN EL SUMINISTRO DE OXIGENO. Principio de funcionamiento: MANUAL. REF: MDC
870-L, BRASS INTEGRAL 50 PSI 02 REGULATOR, CGA870 EXT FLOWS: 0-15L /MIN. PRESENTACION COMERCIAL: UNIDAD FABRICANTE: DANYANG MADIC
OM ELECTROMECHANICAL CO. LTD PAIS: CHINA VIDA UTIL 10 AÑOS REGISTRO SANITARIO INVIMA 2016DM-0015134, VIGENTE: 2026-09-01, EXPEDIE
NTE: 20114221, AÑO DE FABRICACION: 2024. MERCANCIA NUEVA Cant (300) NAR; Serial: / (01)06977495730016(11)240810(21)00801 / (01)06
977495730016(11)240810(21)00802 / (01)06977495730016(11)240810(21)00803 / (01)06977495730016(11)240810(21)00804 / (01)06977495730
016(11)240810(21)00805 / (01)06977495730016(11)240810(21)00806 / (01)06977495730016(11)240810(21)00807 / (01)06977495730016(11)24
0810(21)00808 / (01)06977495730016(11)240810(21)00809 / (01)06977495730016(11)240810(21)00810 / (01)06977495730016(11)240810(21)0
0811 / (01)06977495730016(11)240810(21)00812 / (01)06977495730016(11)240810(21)00813 / (01)06977495730016(11)240810(21)00814 / (0
1)06977495730016(11)240810(21)00815 / (01)06977495730016(11)240810(21)00816 / (01)06977495730016(11)240810(21)00817 / (01)0697749
5730016(11)240810(21)00818 / (01)06977495730016(11)240810(21)00819 / (01)06977495730016(11)240810(21)00820 / (01)06977495730016(1
1)240810(21)00821 / (01)06977495730016(11)240810(21)00822 / (01)06977495730016(11)240810(21)00823 / (01)06977495730016(11)240810(
21)00824 / (01)06977495730016(11)240810(21)00825 / (01)06977495730016(11)240810(21)00826 / (01)06977495730016(11)240810(21)00827
/ (01)06977495730016(11)240810(21)00828 / (01)06977495730016(11)240810(21)00829 / (01)06977495730016(11)240810(21)00830 / (01)069
77495730016(11)240810(21)00831 / (01)06977495730016(11)240810(21)00832 / (01)06977495730016(11)240810(21)00833 / (01)069774957300
16(11)240810(21)00834 / (01)06977495730016(11)240810(21)00835 / (01)06977495730016(11)240810(21)00836 / (01)06977495730016(11)240
810(21)00837 / (01)06977495730016(11)240810(21)00838 / (01)06977495730016(11)240810(21)00839 / (01)06977495730016(11)240810(21)00
840 / (01)06977495730016(11)240810(21)00841 / (01)06977495730016(11)240810(21)00842 / (01)06977495730016(11)240810(21)00843 / (01
)06977495730016(11)240810(21)00844 / (01)06977495730016(11)240810(21)00845 / (01)06977495730016(11)240810(21)00846 / (01)06977495
730016(11)240810(21)00847 / (01)06977495730016(11)240810(21)00848 / (01)06977495730016(11)240810(21)00849 / (01)06977495730016(11
)240810(21)00850 / (01)06977495730016(11)240810(21)00851 / (01)06977495730016(11)240810(21)00852 / (01)06977495730016(11)240810(2
1)00853 / (01)06977495730016(11)240810(21)00854 / (01)06977495730016(11)240810(21)00855 / (01)06977495730016(11)240810(21)00856 /
(01)06977495730016(11)240810(21)00857 / (01)06977495730016(11)240810(21)00858 / (01)06977495730016(11)240810(21)00859 / (01)0697
7495730016(11)240810(21)00860 / (01)06977495730016(11)240810(21)00861 / (01)06977495730016(11)240810(21)00862 / (01)06977495730016
6(11)240810(21)00863 / (01)06977495730016(11)240810(21)00864 / (01)06977495730016(11)240810(21)00865 / (01)06977495730016(11)2408
10(21)00866 / (01)06977495730016(11)240810(21)00867 / (01)06977495730016(11)240810(21)00868 / (01)06977495730016(11)240810(21)008
69 / (01)06977495730016(11)240810(21)00870 / (01)06977495730016(11)240810(21)00871 / (01)06977495730016(11)240810(21)00872 / (01)
06977495730016(11)240810(21)00873 / (01)06977495730016(11)240810(21)00874 / (01)06977495730016(11)240810(21)00875 / (01)069774957
30016(11)240810(21)00876 / (01)06977495730016(11)240810(21)00877 / (01)06977495730016(11)240810(21)00878 / (01)06977495730016(11)
240810(21)00879 / (01)06977495730016(11)240810(21)00880 / (01)06977495730016(11)240810(21)00881 / (01)06977495730016(11)240810(21
)00882 / (01)06977495730016(11)240810(21)00883 / (01)06977495730016(11)240810(21)00884 / (01)06977495730016(11)240810(21)00885 /
(01)06977495730016(11)240810(21)00886 / (01)06977495730016(11)240810(21)00887 / (01)06977495730016(11)240810(21)00888 / (01)06977
495730016(11)240810(21)00889 / (01)06977495730016(11)240810(21)00890 / (01)06977495730016(11)240810(21)00891 / (01)06977495730016
(11)240810(21)00892 / (01)06977495730016(11)240810(21)00893 / (01)06977495730016(11)240810(21)00894 / (01)06977495730016(11)24081
0(21)00895 / (01)06977495730016(11)240810(21)00896 / (01)06977495730016(11)240810(21)00897 / (01)06977495730016(11)240810(21)0089
8 / (01)06977495730016(11)240810(21)00899 / (01)06977495730016(11)240810(21)00900 / (01)06977495730016(11)240810(21)00901 / (01)0
6977495730016(11)240810(21)00902 / (01)06977495730016(11)240810(21)00903 / (01)06977495730016(11)240810(21)00904 / (01)06977495730
0016(11)240810(21)00905 / (01)06977495730016(11)240810(21)00906 / (01)06977495730016(11)240810(21)00907 / (01)06977495730016(11)2
40810(21)00908 / (01)06977495730016(11)240810(21)00909 / (01)06977495730016(11)240810(21)00910 / (01)06977495730016(11)240810(21)
00911 / (01)06977495730016(11)240810(21)00912 / (01)06977495730016(11)240810(21)00913 / (01)06977495730016(11)240810(21)00914 / (
01)06977495730016(11)240810(21)00915 / (01)06977495730016(11)240810(21)00916 / (01)06977495730016(11)240810(21)00917 / (01)069774

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

032024001521090-0

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, serieles y otros)

95730016(11)240810(21)00918 / (01)06977495730016(11)240810(21)00919 / (01)06977495730016(11)240810(21)00920 / (01)06977495730016(11)240810(21)00921 / (01)06977495730016(11)240810(21)00922 / (01)06977495730016(11)240810(21)00923 / (01)06977495730016(11)240810(21)00924 / (01)06977495730016(11)240810(21)00925 / (01)06977495730016(11)240810(21)00926 / (01)06977495730016(11)240810(21)00927 / (01)06977495730016(11)240810(21)00928 / (01)06977495730016(11)240810(21)00929 / (01)06977495730016(11)240810(21)00930 / (01)06977495730016(11)240810(21)00931 / (01)06977495730016(11)240810(21)00932 / (01)06977495730016(11)240810(21)00933 / (01)06977495730016(11)240810(21)00934 / (01)06977495730016(11)240810(21)00935 / (01)06977495730016(11)240810(21)00936 / (01)06977495730016(11)240810(21)00937 / (01)06977495730016(11)240810(21)00938 / (01)06977495730016(11)240810(21)00939 / (01)06977495730016(11)240810(21)00940 / (01)06977495730016(11)240810(21)00941 / (01)06977495730016(11)240810(21)00942 / (01)06977495730016(11)240810(21)00943 / (01)06977495730016(11)240810(21)00944 / (01)06977495730016(11)240810(21)00945 / (01)06977495730016(11)240810(21)00946 / (01)06977495730016(11)240810(21)00947 / (01)06977495730016(11)240810(21)00948 / (01)06977495730016(11)240810(21)00949 / (01)06977495730016(11)240810(21)00950 / (01)06977495730016(11)240810(21)00951 / (01)06977495730016(11)240810(21)00952 / (01)06977495730016(11)240810(21)00953 / (01)06977495730016(11)240810(21)00954 / (01)06977495730016(11)240810(21)00955 / (01)06977495730016(11)240810(21)00956 / (01)06977495730016(11)240810(21)00957 / (01)06977495730016(11)240810(21)00958 / (01)06977495730016(11)240810(21)00959 / (01)06977495730016(11)240810(21)00960 / (01)06977495730016(11)240810(21)00961 / (01)06977495730016(11)240810(21)00962 / (01)06977495730016(11)240810(21)00963 / (01)06977495730016(11)240810(21)00964 / (01)06977495730016(11)240810(21)00965 / (01)06977495730016(11)240810(21)00966 / (01)06977495730016(11)240810(21)00967 / (01)06977495730016(11)240810(21)00968 / (01)06977495730016(11)240810(21)00969 / (01)06977495730016(11)240810(21)00970 / (01)06977495730016(11)240810(21)00971 / (01)06977495730016(11)240810(21)00972 / (01)06977495730016(11)240810(21)00973 / (01)06977495730016(11)240810(21)00974 / (01)06977495730016(11)240810(21)00975 / (01)06977495730016(11)240810(21)00976 / (01)06977495730016(11)240810(21)00977 / (01)06977495730016(11)240810(21)00978 / (01)06977495730016(11)240810(21)00979 / (01)06977495730016(11)240810(21)00980 / (01)06977495730016(11)240810(21)00981 / (01)06977495730016(11)240810(21)00982 / (01)06977495730016(11)240810(21)00983 / (01)06977495730016(11)240810(21)00984 / (01)06977495730016(11)240810(21)00985 / (01)06977495730016(11)240810(21)00986 / (01)06977495730016(11)240810(21)00987 / (01)06977495730016(11)240810(21)00988 / (01)06977495730016(11)240810(21)00989 / (01)06977495730016(11)240810(21)00990 / (01)06977495730016(11)240810(21)00991 / (01)06977495730016(11)240810(21)00992 / (01)06977495730016(11)240810(21)00993 / (01)06977495730016(11)240810(21)00994 / (01)06977495730016(11)240810(21)00995 / (01)06977495730016(11)240810(21)00996 / (01)06977495730016(11)240810(21)00997 / (01)06977495730016(11)240810(21)00998 / (01)06977495730016(11)240810(21)00999 / (01)06977495730016(11)240810(21)01000 / (01)06977495730016(11)240810(21)01001 / (01)06977495730016(11)240810(21)01002 / (01)06977495730016(11)240810(21)01003 / (01)06977495730016(11)240810(21)01004 / (01)06977495730016(11)240810(21)01005 / (01)06977495730016(11)240810(21)01006 / (01)06977495730016(11)240810(21)01007 / (01)06977495730016(11)240810(21)01008 / (01)06977495730016(11)240810(21)01009 / (01)06977495730016(11)240810(21)01010 / (01)06977495730016(11)240810(21)01011 / (01)06977495730016(11)240810(21)01012 / (01)06977495730016(11)240810(21)01013 / (01)06977495730016(11)240810(21)01014 / (01)06977495730016(11)240810(21)01015 / (01)06977495730016(11)240810(21)01016 / (01)06977495730016(11)240810(21)01017 / (01)06977495730016(11)240810(21)01018 / (01)06977495730016(11)240810(21)01019 / (01)06977495730016(11)240810(21)01020 / (01)06977495730016(11)240810(21)01021 / (01)06977495730016(11)240810(21)01022 / (01)06977495730016(11)240810(21)01023 / (01)06977495730016(11)240810(21)01024 / (01)06977495730016(11)240810(21)01025 / (01)06977495730016(11)240810(21)01026 / (01)06977495730016(11)240810(21)01027 / (01)06977495730016(11)240810(21)01028 / (01)06977495730016(11)240810(21)01029 / (01)06977495730016(11)240810(21)01030 / (01)06977495730016(11)240810(21)01031 / (01)06977495730016(11)240810(21)01032 / (01)06977495730016(11)240810(21)01033 / (01)06977495730016(11)240810(21)01034 / (01)06977495730016(11)240810(21)01035 / (01)06977495730016(11)240810(21)01036 / (01)06977495730016(11)240810(21)01037 / (01)06977495730016(11)240810(21)01038 / (01)06977495730016(11)240810(21)01039 / (01)06977495730016(11)240810(21)01040 / (01)06977495730016(11)240810(21)01041 / (01)06977495730016(11)240810(21)01042 / (01)06977495730016(11)240810(21)01043 / (01)06977495730016(11)240810(21)01044 / (01)06977495730016(11)240810(21)01045 / (01)06977495730016(11)240810(21)01046 / (01)06977495730016(11)240810(21)01047 / (01)06977495730016(11)240810(21)01048 / (01)06977495730016(11)240810(21)01049 / (01)06977495730016(11)240810(21)01050 / (01)06977495730016(11)240810(21)01051 / (01)06977495730016(11)240810(21)01052 / (01)06977495730016(11)240810(21)01053 / (01)06977495730016(11)240810(21)01054 / (01)06977495730016(11)240810(21)01055 / (01)06977495730016(11)240810(21)01056 / (01)06977495730016(11)240810(21)01057 / (01)06977495730016(11)240810(21)01058 / (01)06977495730016(11)240810(21)01059 / (01)06977495730016(11)240810(21)01060 / (01)06977495730016(11)240810(21)01061 / (01)06977495730016(11)240810(21)01062 / (01)06977495730016(11)240810(21)01063 / (01)06977495730016(11)240810(21)01064 / (01)06977495730016(11)240810(21)01065 / (01)06977495730016(11)240810(21)01066 / (01)06977495730016(11)240810(21)01067 / (01)06977495730016(11)240810(21)01068 / (01)06977495730016(11)240810(21)01069 / (01)06977495730016(11)240810(21)01070 / (01)06977495730016(11)240810(21)01071 / (01)06977495730016(11)240810(21)01072 / (01)06977495730016(11)240810(21)01073 / (01)06977495730016(11)240810(21)01074 / (01)06977495730016(11)240810(21)01075 / (01)06977495730016(11)240810(21)01076 / (01)06977495730016(11)240810(21)01077 / (01)06977495730016(11)240810(21)01078 / (01)06977495730016(11)240810(21)01079 / (01)06977495730016(11)240810(21)01080 / (01)06977495730016(11)240810(21)01081 / (01)06977495730016(11)240810(21)01082 / (01)06977495730016(11)240810(21)01083 / (01)06977495730016(11)240810(21)01084 / (01)06977495730016(11)240810(21)01085 / (01)06977495730016(11)240810(21)01086 / (01)06977495730016(11)240810(21)01087 / (01)06977495730016(11)240810(21)01088 / (01)06977495730016(11)240810(21)01089 / (01)06977495730016(11)240810(21)01090 / (01)06977495730016(11)240810(21)01091 / (01)06977495730016(11)240810(21)01092 / (01)06977495730016(11)240810(21)01093 / (01)06977495730016(11)240810(21)01094 / (01)06977495730016(11)240810(21)01095 / (01)06977495730016(11)240810(21)01096 / (01)06977495730016(11)240810(21)01097 / (01)06977495730016(11)240810(21)01098 / (01)06977495730016(11)240810(21)01099 / (01)06977495730016(11)240810(21)01100 (Item 3) . Producto: REGULADOR DE OXIGENO. Marca: MCARE. Modelo: NO TIENE. Referencia: MDC540-UN. Uso o destino: LOS REGULADOR DE OXIGENO SON DISPOSITIVOS PARA LA REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN LOS CUALES BAJAN LA PRESIÓN DEL OXÍGENO DEL CILINDRO A NIVELES QUE PUEDAN SER SEGUROS PARA EL USUARIO FINAL. USOS: EN PACIENTES CON ENFERMEDADES CARDIORESPIRATORIAS QUE NECESITEN EL SUMINISTRO DE OXIGENO. Principio de funcionamiento: MANUAL. REF: MDC540-UN, BRASS INTEGRAL 50 PSI 02 REGULATOR, CGA540 FLOWS: 0-15L/MIN. PRESENTACION COMERCIAL: UNIDAD FABRICANTE: DANYANG MADICOM ELECTROMECHANICAL CO. LTD PAÍS: CHINA VIDA UTIL: 10 AÑOS, REGISTRO SANITARIO INVIMA 2016DM-0015134, VIGENTE: 2026-09-01 EXPEDIENTE: 20114221, AÑO DE FABRICACION 2024. MERCANCIA NUEVA Cant (200) NAR; Serial: / (01)06977495730054(11)240810(21)01101 / (01)06977495730054(11)240810(21)01102 / (01)06977495730054(11)240810(21)01103 / (01)06977495730054(11)240810(21)01104 / (01)06977495730054(11)240810(21)01105 / (01)06977495730054(11)240810(21)01106 / (01)06977495730054(11)240810(21)01107 / (01)06977495730054(11)240810(21)01108 / (01)06977495730054(11)240810(21)01109 / (01)06977495730054(11)240810(21)01110 / (01)06977495730054(11)240810(21)01111 / (01)06977495730054(11)240810(21)01112 / (01)06977495730054(11)240810(21)01113 / (01)06977495730054(11)240810(21)01114 / (01)06977495730054(11)240810(21)01115 / (01)06977495730054(11)240810(21)01116 / (01)06977495730054(11)240810(21)01117 / (01)06977495730054(11)240810(21)01118 / (01)06977495730054(11)240810(21)01119 / (01)06977495730054(11)240810(21)01120 / (01)06977495730054(11)240810(21)01121 / (01)06977495730054(11)240810(21)01122 / (01)06977495730054(11)240810(21)01123 / (01)06977495730054(11)240810(21)01124 / (01)06977495730054(11)240810(21)01125 / (01)06977495730054(11)240810(21)01126 / (01)06977495730054(11)240810(21)01127 / (01)06977495730054(11)240810(21)01128 / (01)06977495730054(11)240810(21)01129 / (01)06977495730054(11)240810(21)01130 / (01)06977495730054(11)240810(21)01131 / (01)06977495730054(11)240810(21)01132 / (01)06977495730054(11)240810(21)01133 / (01)06977495730054(11)240810(21)01134 / (01)06977495730054(11)240810(21)01135 / (01)06977495730054(11)240810(21)01136 / (01)06977495730054(11)240810(21)01137 / (01)06977495730054(11)240810(21)01138 / (01)06977495730054(11)240810(21)01139 / (01)06977495730054(11)240810(21)0

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

032024001521090-0

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Declaración de Importación

Aceptación : **032024001521090-0**
Subpartida : **9026200000**

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

1140 / (01)06977495730054(11)240810(21)01141 / (01)06977495730054(11)240810(21)01142 / (01)06977495730054(11)240810(21)01143 / (0
1)06977495730054(11)240810(21)01144 / (01)06977495730054(11)240810(21)01145 / (01)06977495730054(11)240810(21)01146 / (01)0697749
5730054(11)240810(21)01147 / (01)06977495730054(11)240810(21)01148 / (01)06977495730054(11)240810(21)01149 / (01)06977495730054(1
1)240810(21)01150 / (01)06977495730054(11)240810(21)01151 / (01)06977495730054(11)240810(21)01152 / (01)06977495730054(11)240810(
21)01153 / (01)06977495730054(11)240810(21)01154 / (01)06977495730054(11)240810(21)01155 / (01)06977495730054(11)240810(21)01156
/ (01)06977495730054(11)240810(21)01157 / (01)06977495730054(11)240810(21)01158 / (01)06977495730054(11)240810(21)01159 / (01)069
77495730054(11)240810(21)01160 / (01)06977495730054(11)240810(21)01161 / (01)06977495730054(11)240810(21)01162 / (01)069774957300
54(11)240810(21)01163 / (01)06977495730054(11)240810(21)01164 / (01)06977495730054(11)240810(21)01165 / (01)06977495730054(11)240
810(21)01166 / (01)06977495730054(11)240810(21)01167 / (01)06977495730054(11)240810(21)01168 / (01)06977495730054(11)240810(21)01
169 / (01)06977495730054(11)240810(21)01170 / (01)06977495730054(11)240810(21)01171 / (01)06977495730054(11)240810(21)01172 / (01
)06977495730054(11)240810(21)01173 / (01)06977495730054(11)240810(21)01174 / (01)06977495730054(11)240810(21)01175 / (01)06977495
730054(11)240810(21)01176 / (01)06977495730054(11)240810(21)01177 / (01)06977495730054(11)240810(21)01178 / (01)06977495730054(11
)240810(21)01179 / (01)06977495730054(11)240810(21)01180 / (01)06977495730054(11)240810(21)01181 / (01)06977495730054(11)240810(2
1)01182 / (01)06977495730054(11)240810(21)01183 / (01)06977495730054(11)240810(21)01184 / (01)06977495730054(11)240810(21)01185 /
(01)06977495730054(11)240810(21)01186 / (01)06977495730054(11)240810(21)01187 / (01)06977495730054(11)240810(21)01188 / (01)0697
7495730054(11)240810(21)01189 / (01)06977495730054(11)240810(21)01190 / (01)06977495730054(11)240810(21)01191 / (01)0697749573005
4(11)240810(21)01192 / (01)06977495730054(11)240810(21)01193 / (01)06977495730054(11)240810(21)01194 / (01)06977495730054(11)2408
10(21)01195 / (01)06977495730054(11)240810(21)01196 / (01)06977495730054(11)240810(21)01197 / (01)06977495730054(11)240810(21)011
98 / (01)06977495730054(11)240810(21)01199 / (01)06977495730054(11)240810(21)01200 / (01)06977495730054(11)240810(21)01201 / (01)
06977495730054(11)240810(21)01202 / (01)06977495730054(11)240810(21)01203 / (01)06977495730054(11)240810(21)01204 / (01)069774957
30054(11)240810(21)01205 / (01)06977495730054(11)240810(21)01206 / (01)06977495730054(11)240810(21)01207 / (01)06977495730054(11)
240810(21)01208 / (01)06977495730054(11)240810(21)01209 / (01)06977495730054(11)240810(21)01210 / (01)06977495730054(11)240810(21
)01211 / (01)06977495730054(11)240810(21)01212 / (01)06977495730054(11)240810(21)01213 / (01)06977495730054(11)240810(21)01214 /
(01)06977495730054(11)240810(21)01215 / (01)06977495730054(11)240810(21)01216 / (01)06977495730054(11)240810(21)01217 / (01)06977
495730054(11)240810(21)01218 / (01)06977495730054(11)240810(21)01219 / (01)06977495730054(11)240810(21)01220 / (01)06977495730054
(11)240810(21)01221 / (01)06977495730054(11)240810(21)01222 / (01)06977495730054(11)240810(21)01223 / (01)06977495730054(11)24081
0(21)01224 / (01)06977495730054(11)240810(21)01225 / (01)06977495730054(11)240810(21)01226 / (01)06977495730054(11)240810(21)0122
7 / (01)06977495730054(11)240810(21)01228 / (01)06977495730054(11)240810(21)01229 / (01)06977495730054(11)240810(21)01230 / (01)0
6977495730054(11)240810(21)01231 / (01)06977495730054(11)240810(21)01232 / (01)06977495730054(11)240810(21)01233 / (01)0697749573
0054(11)240810(21)01234 / (01)06977495730054(11)240810(21)01235 / (01)06977495730054(11)240810(21)01236 / (01)06977495730054(11)2
40810(21)01237 / (01)06977495730054(11)240810(21)01238 / (01)06977495730054(11)240810(21)01239 / (01)06977495730054(11)240810(21)
01240 / (01)06977495730054(11)240810(21)01241 / (01)06977495730054(11)240810(21)01242 / (01)06977495730054(11)240810(21)01243 / (
01)06977495730054(11)240810(21)01244 / (01)06977495730054(11)240810(21)01245 / (01)06977495730054(11)240810(21)01246 / (01)069774
95730054(11)240810(21)01247 / (01)06977495730054(11)240810(21)01248 / (01)06977495730054(11)240810(21)01249 / (01)06977495730054(
11)240810(21)01250 / (01)06977495730054(11)240810(21)01251 / (01)06977495730054(11)240810(21)01252 / (01)06977495730054(11)240810
(21)01253 / (01)06977495730054(11)240810(21)01254 / (01)06977495730054(11)240810(21)01255 / (01)06977495730054(11)240810(21)01256
/ (01)06977495730054(11)240810(21)01257 / (01)06977495730054(11)240810(21)01258 / (01)06977495730054(11)240810(21)01259 / (01)06
977495730054(11)240810(21)01260 / (01)06977495730054(11)240810(21)01261 / (01)06977495730054(11)240810(21)01262 / (01)06977495730
054(11)240810(21)01263 / (01)06977495730054(11)240810(21)01264 / (01)06977495730054(11)240810(21)01265 / (01)06977495730054(11)24
0810(21)01266 / (01)06977495730054(11)240810(21)01267 / (01)06977495730054(11)240810(21)01268 / (01)06977495730054(11)240810(21)0
1269 / (01)06977495730054(11)240810(21)01270 / (01)06977495730054(11)240810(21)01271 / (01)06977495730054(11)240810(21)01272 / (0
1)06977495730054(11)240810(21)01273 / (01)06977495730054(11)240810(21)01274 / (01)06977495730054(11)240810(21)01275 / (01)0697749
5730054(11)240810(21)01276 / (01)06977495730054(11)240810(21)01277 / (01)06977495730054(11)240810(21)01278 / (01)06977495730054(1
1)240810(21)01279 / (01)06977495730054(11)240810(21)01280 / (01)06977495730054(11)240810(21)01281 / (01)06977495730054(11)240810(
21)01282 / (01)06977495730054(11)240810(21)01283 / (01)06977495730054(11)240810(21)01284 / (01)06977495730054(11)240810(21)01285
/ (01)06977495730054(11)240810(21)01286 / (01)06977495730054(11)240810(21)01287 / (01)06977495730054(11)240810(21)01288 / (01)069
77495730054(11)240810(21)01289 / (01)06977495730054(11)240810(21)01290 / (01)06977495730054(11)240810(21)01291 / (01)069774957300
54(11)240810(21)01292 / (01)06977495730054(11)240810(21)01293 / (01)06977495730054(11)240810(21)01294 / (01)06977495730054(11)240
810(21)01295 / (01)06977495730054(11)240810(21)01296 / (01)06977495730054(11)240810(21)01297 / (01)06977495730054(11)240810(21)01
298 / (01)06977495730054(11)240810(21)01299 / (01)06977495730054(11)240810(21)01300 (Item 4) Producto: MANOMETRO DE PRESION 0-300
0PSI. Marca: UL ®, PROVEEDOR DANYANG. Modelo: NO TIENE. Referencia: NO TIENE, CATALOGO FM-30. Serial: NO TIENE. Uso o destino: IN
DICADOR ANALOGICO UTILIZADO PARA MEDIR LA PRESION DE UN GAS. Principio de funcionamiento: MECANICO. DESTINADO A REGULADOR DE OXIG
ENO MARCA MCARE, R/S: INVIMA 2016DM-0015134, EXP: 20114221, VIGENCIA 2026/09/01, FABRICANTE DEL EQUIPO Y DE LA PARTE/ACCESORIO: D
ANYANG MADICOM ELECTROMECHANICAL CO. LTD P.O.: CHINA Cant (200) NAR (Item 13) SE ANEXA CERTIFICACION DEL PROVEEDOR, QUE DECLARA Q
UE LOS PRODUCTOS OBJETO DE ESTA IMPORTACION, NO SE FABRICAN CON MERCURIO Y TAMPOCO CONTIENEN MERCURIO. LOS PRODUCTOS NO CORRESPON
DEN A PRODUCTOS CON MERCURIO AÑADIDO DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO 419 DEL 22 DE ABRIL DE 2021 Y DECRETO 1433 DE 2022. N
O REQUIEREN NI UTILIZAN FUENTE RADIACTIVA DE PODER. MERCANCIA QUE NO SE ENCUENTRA SUJETA AL CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO TECNICO, D
E ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 33883 DEL 2021 DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), SEGÚN CONCEPTO 22-6498 Y 22-032018
, 09/02/2022. LA NORMA SOLAMENTE APLICA ALOS INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO (BALANZAS); SURTIDORES, DISPE
NSADORES Y/O MEDIDORES DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS; ETILÓMETROS O ALCOHOSENSORES, ALCOHOLÍMETROS; Y TAXÍMETROS ELECTRÓNICOS. GRAVAME
N 0% SEGUN DECRETO 1881 DEL 2021. REGISTRO NO: REG-50166948-20240927N DEL 2024-09-27 FECHA DE VIGENCIA 2025-03-27, VISTO BUENO DE
L MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA: VMME-24-02920 DEL 2024-09-26 (NO REQUIERE), VISTO BUENO INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MED,
ALIM: VINVIMA-24-0123646 DEL 2024-09-26. MERCANCIA NUEVAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

032024001521090-0

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

Código	F-BIO-001
Versión	1
Fecha	Febrero 2017
Página	1 de 1

1. INFORMACION DE EQUIPO

EQUIPO	SUCCIONADOR		REGISTRO INVIMA	-			
MARCA	KONSUNG		SERVICIO	TAB			
MODELO	9E-A		UBICACIÓN	AMB. NXY747			
SERIE	MA23100260169		CALIBRACIÓN	ANUAL			
N.° INVENTARIO			TIPO DE EQUIPO	FIJO		MOVIL	X
FECHA DE COMPRA	13/12/2024	FECHA INSTALACION	13/12/2024	GARANTIA			
EQUIPO PROPIO		EQUIPO COMODATO		DONACION			

2. FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO

MENSUAL		BIMENSUAL		TRIMESTRAL		CUATRIMESTRAL	X	SEMESTRAL		ANUAL	

REGISTRO FOTOGRAFICO	ACCESORIOS	
	CANTIDAD	ACCESORIO
		

3. CARACTERISTICAS TECNICAS

VOLTAJE	120 VAC	CORRIENTE	0,65 A	POTENCIA	72 W	FRECUENCIA	60 Hz	TEMP. DE TRABAJO	

CLASIFICACION RIESGO SEGUN 4725 DE 2005		CLASIFICACION DE USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		TECNOLOGIA PREDOMINANTE			
				DIAGNOSTICO					
				MTTO DE LA VIDA		ELECTRICO		NEUMATICO	
RIESGO I		MEDICO		PREVENCION		ELECTRONICO		ACUSTICO	
RIESGO IIA	X	BASICO		REHABILITACIÓN	X	ELECTROMECANICO	X	SOLAR	
RIESGO IIB		APOYO	X	EQ. LABORATORIO		MECANICO		VAPOR	
RIESGO III		OTRO		EQ. ODONTOLOGIA		HIDRAULICO		OTRO	

4. RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

EVITAR GOLPES Y SALPICADURAS.
NO SUMERGIR EL EQUIPO EN LÍQUIDOS.
EL EQUIPO SE DEBE LIMPIAR CON PAÑO SUAVE Y HÚMEDO.
EL USO DEL EQUIPO ESTÁ RESERVADO A PERSONAL CALIFICADO.

HOSPITAL SAN VICENTE
HSV
ROVIRA TOLIMA



HOJA DE VIDA DE EQUIPO

EQUIPO: SUCCIONADOR	MARCA: KONSUNG	MODELO: 9 EA
SERIE: Ma23100260169	CLASIFICACION DE DISPOSITIVO MEDICO: Riesgo Medio (IIA) TRATAMIENTO	
FECHA DE COMPRA: 13-12-2024	FECHA DE INSTALACION 13-12-2024	VENCIMIENTO DE GARANTIA: 1 AÑO
DATOS DEL PROVEEDOR: OSMEC AMBULANCIA		TELEFONO: 3153083450
PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO:	ANUAL	UBICACIÓN: AMBULANCIA PLACA NXY 747 / EQUIPO MOVIL
REGISTRO INVIMA :	2016DM-0015359	

FUNCION: Aspiracion de alto vacio a bajo flujo para succión de secreciones de fluidos corporales

RECOMENDACIONES DE FABRICANTE:

- Asegurarse de que el interruptor de alimentación este en la posición de apagado (O). Enchufe el dispositivo y ponga el interruptor en la posición de encendido (on).
- Bloquee el tubo del paciente procedente del recipiente de recogida y deje que el manómetro alcance un nivel de vacío estable.
- Ajuste el nivel de vacío girando la perilla de regulador.

REGISTRO TECNICO DE INSTALACION

VOLTAJE: AC 120 V	POTENCIA ENTRADA: 90 VA	FRECUENCIA: 60 Hz	DIMENCIONES: 35 X 26,5 X 28,5 cm
PESO NETO: 5 KG	PESO BRUTO: 4.5 KG	TECNOLOGIA PREDOMINANTE: ELECTRICA	

REGISTRO TECNICO DE FUNCIONAMIENTO

MAXIMO VACIO: 760 mmHg (0,075Mpa)	RANGO DE VACIO: 0,02 Mpa	VELOCIDAD DE FLUJO: 15 Lt/min (760 mmHg)
NIVEL DE RUIDO: ≤ 60 Db	CAPACIDAD DEL RECIPIENTE: 800 ml	CONTROL DE FLUJO: REGULABLE PARA EL AJUSTE DE DIFERENTES REQUERIMIENTOS MEDICOS.

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PLANIFICADO SEGÚN PARAMETROS DE FABRICANTE

EQUIPO	SUCCIONADOR
MARCA	KONSUNG
MODELO	9 EA
SERIE	Ma23100260169
N° INVENTARIO	

- Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo
- Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo
- Inspeccionar sistema eléctrico y accesorios (cordón de alimentación, devanados del motor, carbones, etc.)
- Inspeccionar válvulas unidireccionales
- Revisar filtro bacteriológico y filtro silenciador, cambiar si es necesario.
- Revisar sellado de nivel de liquido
- Inspeccionar fugas en el sistema de vacío (mangueras, frascos, empaques de hule y acoples)
- Verificar flujo máximo [lts./min]
- Verificar rango de vacio
- Realizar prueba de seguridad eléctrica
- Verificar el funcionamiento del equipo.

PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION

- La limpieza se debe hacer con el equipo apagado.
- Utilizar un paño suave, humedecido con una solución desinfectante.
- El liquido no debe derramarse hacia el interior del equipo.
- No utilizar esponjas metálicas ni líquidos corrosivos como soluciones cloradas.
- Realizar limpieza profunda del equipo se recomienda, luego de ello, proteger la superficie con algún producto siliconado que dará brillo y aumentará la vida útil de la pintura.
- Cuando limpie o desinfecte el interior, utilice solo guantes de limpieza. No utilice desinfectantes alcalinos o liberadores de cloro porque son corrosivos.

BIOMEDICAL SOLUTIONS
INGENIERIA

NIT. 53116519-2
REGIMEN COMUN

REPORTE DE SERVICIO

FECHA:	12/12/2024	**REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO**		HORA INICIO:	9:50
INSTITUCION:	HOSPITAL SAN VICENTE	PROCESO:	AMBULANCIA	AREA:	MOVIL NXY 747

DATOS DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	SUCCIONADOR			MARCA:	KONSUNG
SERIE:	Ma23100260169	MODELO:	9EA	INV. N°.:	

ACCESORIOS DEL EQUIPO

GUERAS DE INTERCONEXION, FILTRO HIDROFOBICO, VACUOMETRO, PERILLA DE CONTROL DE PRESION N

DIAGNOSTICO INICIAL

	ESTADO		CONDICIONES AMBIENTALES DE USO SEGÚN LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE			
1	FISICO	BUENO	HUMEDAD:	46%	T°:	24,2 °C
2	FUNCIONAMIENTO	BUENO	SEGURIDAD DE LA INSTALACION:			
3	BATERIAS	N/A	EQUIPO NUEVO, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO			
4	ACCESORIOS	BUENO				

DESCRIPCION DEL SERVICIO

LIMPIEZA INTERNA		LIMPIEZA EXTERNA		DESINFECCION		DESMANCHADO	
LIMPIEZA CONTACTOS		LUBRICACION		ENGRASE		REEMPLAZO DE PARTES	

Se realiza hoja de vida

ELEMENTOS UTILIZADOS:

PRUEBAS FUNCIONALES

VERIFICACION DE:

SISTEMA ELECTRICO	X	ENCENDIDO	X	CONFIGURACION A TRAVES DEL MENU	
SISTEMA MECANICO	X	ACCESORIOS	X	FUNCIONAMIENTO DEL DISPLAY, PANTALLA	
SISTEMA HIDRAULICO		ALARMAS VISUAL		FUNCIONAMIENTO DEL MANOMETRO	X
SISTEMA NEUMATICO	X	ALARMAS AUDIBLES		FUNCIONAMIENTO DEL TECLADO, PERILLAS, CONTROLES	
VIDA DE LA BATERIA		FUGAS	X	TARJETAS ELECTRONICAS Y CONECTORES	
SEGURIDAD ELECTRICA		FILTROS		EMPAQUES	
PRUEBAS DE FABRICA		BOMBILLOS		NIVELES DE FLUJO	
		ALMACENAMIENTO DE DATOS Y MEMORIA		NIVELES DE PRESION	

REPUESTOS UTILIZADOS

OBSERVACIONES

EQUIPO NUEVO LISTO PARA USAR

EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE SI [X] NO [ ] HORA FINAL: 10:00

FECHA DEL PROXIMO MANTENIMIENTO: dic-25

ING. BIOMEDICO

FUNCIONARIO ENCARGADO

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2016043580 DE 21 de Octubre de 2016
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora de responsabilidad sanitaria encargada de las funciones del Director General del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA , en ejercicio de las facultades legales, decreto 2078 de 2012, decreto 4725 de 2005 y ley 1437 de 2011.

CONSIDERANDO

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMATICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.
EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARA EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS A

PRODUCTO:	SUCCIONADOR DE FLEMAS - UNIDAD DE SUCCION
MARCA:	KONSUNG
REGISTRO SANITARIO NO.:	INVIMA 2016DM-0015359
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	FUTUMEDICA S.A.S. CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
FABRICANTE(S):	JIANGSU KONSUNG MEDICAL EQUIPMENT CO. LTD CON DOMICILIO EN CHINA
IMPORTADOR(ES):	FUTUMEDICA S.A.S CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
ACONDICIONADOR(ES):	FUTUMEDICA S.A.S CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
EQUIPO BIOMEDICO:	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO
RIESGO:	IIA
SISTEMAS:	ELÉCTRICOS
SUBSISTEMAS:	DISPOSITIVO DE SUCCIÓN 2. INSTRUCCIONES PARA EL USO 3. BOTELLA DE 1000ML (INCLUYE UNA BOTELLA DE 1000ML, TUBO DE LA BOMBA AL RECIPIENTE, PROTECCIÓN CONTRA EL DESBORDAMIENTO) 4. BOTELLA 1000M 5. FILTRO DE AIRE 6.CABLE DE ENERGÍA 7. FUSIBLE (RF1Φ5*20/F1.6AL, AC250V) 2PCS 8. CONECTORES 9. MANGUERA (TUBO) DE CONEXIÓN (2M LARGO) ACCESORIOS: BOTELLA DE SUCCIÓN (1000ML): KS3-47, TUBOS DE CONEXIÓN:A-18, FILTRO: A-16, CUBIERTA DE SECRECIÓN: A-9, PROTECTOR DE SOBRELLENADO: A-15, MANGUERA (TUBO) DE ASPIRACIÓN: 38FR, PUNTA DE DEDO: A-27, - TUBO DE VACÍO, TUBO INTERMEDIO
USOS:	INDICACIONES: EL DISPOSITIVO ESTÁ DESTINADO PARA LA APLICACIÓN DE UN FLUJO BAJO DE SUCCIÓN CON UNA CAPACIDAD DE SUCCIÓN DE 18 LITROS POR MINUTO Y UN VACÍO MÁXIMO DE HASTA -75KPA (-563 MMHG). LA BOMBA ESTÁ MARCADA COMO "BAJO FLUJO- ALTO VACÍO". USOS: EL DISPOSITIVO USA LA SUCCIÓN COMO MEDIO PARA RETIRAR LA FLEMA DEL PACIENTE. LA INDICACIÓN DE USO PRIMARIO ES COMO UN ASPIRADOR UTILIZADO PARA AYUDAR A EVACUAR SALIVA, MOCOS, VOMITO, U OTRO ASPIRANTE DE LA BOCA O DE LAS VÍAS AÉREAS PARA PERMITIR UNA RESPIRACIÓN ADECUADA O VENTILACIÓN DEL PACIENTE.
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	EQUIPO: UNIDAD
OBSERVACIONES:	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LOS SIGUIENTES MODELOS: ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS DEL EQUIPO: 9A-26D, 9A-26B, 9E-A, 9E-B.
VIDA ÚTIL:	5 AÑOS
EXPEDIENTE NO.:	20117500
RADICACIÓN NO.:	2016147096
FECHA DE RADICACIÓN:	18 10 2016

ARTICULO SEGUNDO.- CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE LA DIRECCION DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

ARTICULO TERCERO.- LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2016043580 DE 21 de Octubre de 2016
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora de responsabilidad sanitaria encargada de las funciones del Director General del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA , en ejercicio de las facultades legales, decreto 2078 de 2012, decreto 4725 de 2005 y ley 1437 de 2011.

ARTICULO CUARTO.- LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 2005.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN BOGOTÁ D.C. A LOS 21 DE OCTUBRE DE 2016
ESTE ESPACIO, HASTA LA FIRMA SE CONSIDERA EN BLANCO.



MERCY YASMIN PARRA RODRIGUEZ
DIRECTORA DE RESPONSABILIDAD SANITARIA ENCARGADA DE LAS FUNCIONES
DEL DIRECTOR GENERAL DEL INVIMA
Proyectó: Legal: dcepedar, Técnico: msandovalc, Revisó: cordina_varios

Firma válida

Digitally signed by
MERCY YASMIN PARRA RODRIGUEZ
Date: 2016.10.21 14:01:57 EST
Reason: Invima
Location: Bogota, CO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2024**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032024000032321-5

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830038639 | 6. DV.: 1 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: FUTUMEDICA SAS

13. Dirección: CL 78 63 45 | 14. Teléfono: 6300122 | 12. Cód. Admón.: 03 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860514173 | 25. DV.: 2 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 22

29. Número documento de identificación: 79443684 | 30. Apellidos y nombres: ROMERO DIAZ OSCAR MAURICIO

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9194235139	2024 - 01 - 09	No. ESL23110328	2023 - 10 - 03

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: JIANGSU KONSUNG BIO-MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD | 47. Ciudad: DANYANG CITY, JIANGSU | 48. Cod.País Exportador: 215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: N.8 WEST SHENGCHANG RD DANYANG ECONOMIC ECONOMIC Z | 50. E-mail: FAX 86051186371668

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ x/x.
KSWA3230906002	2023 - 11 - 10	215	1	169	11	LOGISTICA TOTAL SAS	3.927,64

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	3926909090	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. / dcms.	72. Peso neto kgs. / dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
10	01	215	31.34	30.01	CT	783	13	11	90.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor Aduana USD	85. Código régimen o licencia	86. Número
85.00	4.21	0.06	0	4.27	0.00	89.27	R	50195130

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No.	90. Cód. Interno del Producto
3	2023	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	10.000	350.620	35.000	0	0.00
I.V.A.	19.00	385.620	73.000	0	0.00
Salvaguardia	0.000	0	0	0	0.00
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0.00
Sanción	0	0	0	0	
Reexte	0	0	0	0	
		Total	108.000		0.00

91. Descripción de las mercancías (Si marca la descripción de las mercancías a importar con la señalada en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, serial(es) y otros) (Si el espacio es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 01235352.. Declaracion(1-14). Producto: PERILLA DE CONTROL DE PRESIÓN. Capacidad: NO APLICA. Uso: REALIZAR CAMBIOS Y CONTROL D E PRESIÓN NEGATIVA SEGÚN NECESIDAD. Marca: PROVEEDOR KONSUNG. Referencia: N/A. COMPOSICIÓN: INSTRUMENTO DE MONTAJE TERMOPLÁSTICO. PARTE Y/O ACCESORIO EXCLUSIVO PARA EL EQUIPO DENOMINADO SUCCIONADOR DE FLEMAS. UNIDAD DE SUCCION MARCA KONSUNG, FABRICANTE: JIAN GSU KONSUNG MEDICAL EQUIPMENT CO. LTD, P.O: CHINA, REGISTRO SANITARIO INVIMA 2016DM-0015359, VIG: 2026-10-21, EXPEDIENTE: 2011759 0, MERCANCIA NUEVA 2023 / Cant (10) UNIDADES (Item 6) Producto: ANILLOS COMPRESORES. Capacidad: NO APLICA. Uso: EL ANILLO DE PIST ÓN DE LA BOMBA DE AIRE ADOPTA UNA RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS, LO QUE TAMBIÉN MANTIENE LA RESISTENCIA (continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera. Estado de levante: Levante automático. No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración: 032024000032321. 133. Fecha: 2024/01/10
134. Levante No. 032024000034657	135. Fecha: 2024 - 01 - 10	136. Nombre: OSCAR MAURICIO ROMERO DIAZ. 137. C.C. No.: 79.443.684 DE BOGOTA

Firma declarante

Servade SA

AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL 1

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

910030038034022

Fecha de Impresión: 2024-01-10 09:12:40

DIAN REPÚBLICA DE COLOMBIA	**Declaración de Importación**	Aceptación : **032024000032321-5** Subpartida : **3926909090** Página 1 de 1

103. Continuación descripción mercancías (Incluye marcas, seriales y otros)

A LA FATIGA. CON UNA LARGA VIDA ÚTIL Y UNA GRAN PRACTICIDAD. Marca: PROVEEDOR KONSUNG. Referencia: N/A. COMPOSICIÓN: MATERIAL DE GOMA, LA CALIDAD DEL ANILLO DE GOMA DE LA CAMISA DEL CILINDRO. PARTE Y/O ACCESORIO EXCLUSIVO PARA EL EQUIPO DENOMINADO SUCCIONADOR DE FLEMAS. UNIDAD DE SUCCION MARCA KONSUNG, FABRICANTE: JIANGSU KONSUNG MEDICAL EQUIPMENT CO. LTD, P.O: CHINA, REGISTRO SANITARIO INVIMA 2016DM-0015359, VIG: 2026-10-21, EXPEDIENTE: 20117500 MERCANCIA NUEVA 2023 Cant (80) UNIDADES (Item 7) MERCANCIA NUEVA. VISTO BUENO INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS Nº VINVIMA-23-0146257 DE FECHA 2023-12-07. REGISTRO DE IMPORTACION Nº RBG-50195130-20231211N DE FECHA 2023-12-11 VIGENTE HASTA 2024-06-09.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (continued for the remainder of the field)

032024000032321-5	Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DIAN

Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2024**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario **032024000032263-6**

Campo	Valor
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	830038639
6. DV.	1
11. Apellidos y nombres o Razón Social	FUTUMEDICA SAS
13. Dirección	CL 78 63 45
15. Teléfono	6300122
12. Cód. Admón.	03
16. Cód. Dpto	11
17. Cód. Ciudad Municipio	001
24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	860514173
25. DV.	2
26. Razón social del declarante autorizado	AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL 1
27. Tipo usuario	26
28. Cód. usuario	22
29. Número documento de identificación	79443684
30. Apellidos y nombres	ROMERO DIAZ OSCAR MAURICIO
31. Clase importador	02
32. Tipo declaración	Inicial
33. Cód.	1
34. No.Formulario Anterior	XXXXXXXXXXXXXXX
35. Año - Mes - Día	XXXX - XX - XX
36. Cód. Admón.	XX
37. Declaración de Exportación	No. XXXXXXXXXXXXXXX
38. Año - Mes - Día	XXXX - XX - XX
39. Cód. Admón.	XX
40. Cód. lugar ingreso de las mercancías	BOG
41. Cod. Depósito	13907
42. Manifiesto de carga	No. 9194235139
43. Año - Mes - Día	2024 - 01 - 09
44. Documento de transporte	No. ESL23110328
45. Año - Mes - Día	2023 - 10 - 03
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	JIANGSU KONSUNG BIO-MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD
47. Ciudad	DANYANG CITY, JIANGSU
48. Cod.País Exportador	215
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	N.8 WEST SHENGCHANG RD DANYANG ECONOMIC ECONOMIC Z
50. E-mail	FAX.86051186371668
51. No. de factura	KSWA3230906002
52. Año - Mes - Día	2023 - 11 - 10
53. Cod. país procedencia	215
54. Cod. Modo Transporte	1
55. Código de Bandera	169
56. Cod. Depto destino	11
57. Empresa transportadora	LOGISTICA TOTAL SAS
58. Tasa de cambio $ cvs.	3.927,64
S — 59. Subpartida arancelaria	4016999000
60. Cod. Complementario	XX
61. Cod. Suplementario	XX
62. Cod. Modalidad	C200
63. No. cuotas o meses	XX
64. Valor cuota USD	XXXX
65. Periodicidad del pago de la cuota	XX
66. Cod. país de origen	215
67. Cod. Acuerdo	XXX
68. Forma de pago de la importación	10
69. Tipo de importación	01
70. Cod. país compra	215
71. Peso bruto kgs. dcms.	0.37
72. Peso neto kgs. dcms.	0.35
73. Código embalaje	CT
74. No. bultos	783
75. Subpartidas	13
76. Cod. unidad comercial	U
77. Cantidad dcms.	100.00
78. Valor FOB USD	1.00
79. Valor fletes USD	0.05
80. Valor Seguros USD	0.01
81. Valor Otros Gastos USD	0
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	0.06
83. Ajuste valor USD	0.00
84. Valor aduana USD	1.06
85. Código registro o licencia	R
86. Número	50195130
87. Cod. oficina	3
88. Año	2023
89. Programa No	XXXXXXXXXXX
90. Cód. Interno del Producto	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	15.00	4.163	1.000	0	0.00
I.V.A.	19.00	5.163	1.000	0	0.00
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0.00
Sanción	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	2.000		0.00

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

```
DO 01235352.. Declaracion(2-14). PARTE Y/O ACCESORIO EXCLUSIVO PARA EL EQUIPO DENOMINADO SUCCIONADOR DE FLEMAS. UNIDAD DE SUCCION
 MARCA KONSUNG, REGISTRO SANITARIO INVIMA 2016DM-0015359, VIG: 2026-10-21, EXPEDIENTE: 20117500. Producto: GOMAS PARA BASE. Compo
sicion: GOMA CAUCHO. Uso: REALIZA EL SOPORTE DEL PESO DEL EQUIPO O DESCANSO DE ESTE. Marca: PROVEEDOR KONSUNG. Referencia: NO TIE
NE. MERCANCIA NUEVA 2023 / Cant (100) UNIDADES (Item 8) MERCANCIA NUEVA. VISTO BUENO INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAME
NTOS Y ALIMENTOS N° VINVIMA-23-0146257 DE FECHA 2023-12-07. REGISTRO DE IMPORTACION N° REG-50195130-20231211N DE FECHA 2023-12-11
 VIGENTE HASTA 2024-06-09. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

127. Valor pagos anteriores: 0

128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX

129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración 032024000032263

133. Fecha: 202401 10

134. Levante No. 032024000034656

135. Fecha 2024 - 01 - 10

Firma funcionario responsable

136. Nombre OSCAR MAURICIO ROMERO DIAZ

137. C.C. No. 79.443.684 DE BOGOTA

Firma declarante

Servade S.A
AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL 1

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

91003038033959

Fecha de Impresión: 2024-01-10 09:12:29

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2024**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032024000032255-7

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830038639 | 6. DV.: 1 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: FUTUMEDICA SAS

13. Dirección: CL 78 63 45 | 35. Teléfono: 6300122 | 12. Cód. Admón.: 03 | 36. Cód. Dpto: 11 | 37. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860514173 | 25. DV.: 2 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL I | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 22

29. Número documento de identificación: 79443684 | 30. Apellidos y nombres: ROMERO DIAZ OSCAR MAURICIO

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9194235139	2024 - 01 - 09	No. ESL23110328	2023 - 10 - 03

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: JIANGSU KONSUNG BIO-MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD | 47. Ciudad: DANYANG CITY, JIANGSU | 48. Cod.País Exportador: 215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: N.8 WEST SHENGCHANG RD DANYANG ECONOMIC ECONOMIC Z | 50. E-mail: FAX.86051186371668

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto. destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ vra.
KSWA3230906002	2023 - 11 - 10	215	1	160	11	LOGISTICA TOTAL SAS	3.927,64

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	9018909090	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartida	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
10	01	215	3.134,33		3.000,00		CT	783	13	U	500,00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código régimen o fórmula	86. Número	87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
21.000,00	421,19	14,70	0	435,89	0,00	21.435,89	R	50195130	3	2023	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	5,00	84.192,459	4.210,000	0	0,00
I.V.A.	19,00	88.402,459	16.796,000	0	0,00
Salvaguardia	0,00	0	0	0	0,00
Derechos Compensatorios	0,00	0	0	0	0,00
Derechos Antidumping	0,00	0	0	0	0,00
Sanción	0	0	0	0	
Rezago	0	0	0	0	
		Total	21.006,000		0,00

91. Descripción de las mercancías(Diligencie de conformidad con la factura comercial o documento soporte de la operación de importación. Indique marcas, seriales y otros) (Si el espacio es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 01235352.. Declaracion(4-14). Producto: SUCCIONADOR DE FLEMAS, UNIDAD DE SUCCION. Marca: KONSUNG. Modelo: 9E-A. Referencia: NO TIENE. Uso o destino: INDICACIONES: EL DISPOSITIVO ESTÁ DESTINADO PARA LA APLICACIÓN DE UN FLUJO BAJO DE SUCCIÓN CON UNA CAPACID AD DE SUCCIÓN DE 18 LITROS POR MINUTO Y UN VACÍO MÁXIMO DE HASTA -75KPA (-563 MMHG). LA BOMBA ESTÁ MARCADA COMO (BAJO FLUJO- ALTO VACÍO). USOS: EL DISPOSITIVO USA LA SUCCIÓN COMO MEDIO PARA RETIRAR LA FLEMA DEL PACIENTE. LA INDICACIÓN DE USO PRIMARIO ES COMO UN ASPIRADOR UTILIZADO PARA AYUDAR A EVACUAR SALIVA, MOCOS, VOMITO, U OTRO ASPIRANTE DE LA BOCA O DE LAS VÍAS AÉREAS PARA PERMIT IR UNA RESPIRACIÓN ADECUADA O VENTILACIÓN DEL PACIENTE. Tecnica de diagnostico: NO APLICA. / LOTE: MA231002(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0 | 128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración: 032024000032255
132. Fecha: 202401 10

134. Levante No. 032024000034662 | 135. Fecha: 2024 - 01 - 10 | Firma funcionario responsable | 136. Nombre: OSCAR MAURICIO ROMERO DIAZ | 137. C.C. No.: 79.443.684 DE BOGOTA

Firma declarante

Servade S.A. AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL I

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

9100303033887

Fecha de Impresión: 2024-01-10 09:13:21

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Declaración de Importación

Aceptación : **032024000032255-7**
Subpartida : **9018909090**

III. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

5 / ASPIRADOR DE FLEMAS PORTABLE PHLEGM SUCTION UNIT, 110V 60HZ 90VA, CON SUS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO
. FABRICANTE: JIANGSU KONSUNG MEDICAL EQUIPMENT CO. LTD, PAIS DE ORIGEN: CHINA; VIDA UTIL: 5 AÑOS, REGISTRO SANITARIO INVIMA 2016
DM-0015359 VIGENCIA: 2026-10-21, EXPEDIENTE: 20117500; MERCANCIA NUEVA 2023 / Cant (500) UNIDADES; Serial: Ma23100260001, Ma23100
260002, Ma23100260003, Ma23100260004, Ma23100260005, Ma23100260006, Ma23100260007, Ma23100260008, Ma23100260009, Ma23100260010, M
a23100260011, Ma23100260012, Ma23100260013, Ma23100260014, Ma23100260015, Ma23100260016, Ma23100260017, Ma23100260018, Ma23100260
019, Ma23100260020, Ma23100260021, Ma23100260022, Ma23100260023, Ma23100260024, Ma23100260025, Ma23100260026, Ma23100260027, Ma23
100260028, Ma23100260029, Ma23100260030, Ma23100260031, Ma23100260032, Ma23100260033, Ma23100260034, Ma23100260035, Ma23100260036
, Ma23100260037, Ma23100260038, Ma23100260039, Ma23100260040, Ma23100260041, Ma23100260042, Ma23100260043, Ma23100260044, Ma23100
260045, Ma23100260046, Ma23100260047, Ma23100260048, Ma23100260049, Ma23100260050, Ma23100260051, Ma23100260052, Ma23100260053, M
a23100260054, Ma23100260055, Ma23100260056, Ma23100260057, Ma23100260058, Ma23100260059, Ma23100260060, Ma23100260061, Ma23100260
062, Ma23100260063, Ma23100260064, Ma23100260065, Ma23100260066, Ma23100260067, Ma23100260068, Ma23100260069, Ma23100260070, Ma23
100260071, Ma23100260072, Ma23100260073, Ma23100260074, Ma23100260075, Ma23100260076, Ma23100260077, Ma23100260078, Ma23100260079
, Ma23100260080, Ma23100260081, Ma23100260082, Ma23100260083, Ma23100260084, Ma23100260085, Ma23100260086, Ma23100260087, Ma23100
260088, Ma23100260089, Ma23100260090, Ma23100260091, Ma23100260092, Ma23100260093, Ma23100260094, Ma23100260095, Ma23100260096, M
a23100260097, Ma23100260098, Ma23100260099, Ma23100260100, Ma23100260101, Ma23100260102, Ma23100260103, Ma23100260104, Ma23100260
105, Ma23100260106, Ma23100260107, Ma23100260108, Ma23100260109, Ma23100260110, Ma23100260111, Ma23100260112, Ma23100260113, Ma23
100260114, Ma23100260115, Ma23100260116, Ma23100260117, Ma23100260118, Ma23100260119, Ma23100260120, Ma23100260121, Ma23100260122
, Ma23100260123, Ma23100260124, Ma23100260125, Ma23100260126, Ma23100260127, Ma23100260128, Ma23100260129, Ma23100260130, Ma23100
260131, Ma23100260132, Ma23100260133, Ma23100260134, Ma23100260135, Ma23100260136, Ma23100260137, Ma23100260138, Ma23100260139, M
a23100260140, Ma23100260141, Ma23100260142, Ma23100260143, Ma23100260144, Ma23100260145, Ma23100260146, Ma23100260147, Ma23100260
148, Ma23100260149, Ma23100260150, Ma23100260151, Ma23100260152, Ma23100260153, Ma23100260154, Ma23100260155, Ma23100260156, Ma23
100260157, Ma23100260158, Ma23100260159, Ma23100260160, Ma23100260161, Ma23100260162, Ma23100260163, Ma23100260164, Ma23100260165
, Ma23100260166, Ma23100260167, Ma23100260168, Ma23100260169, Ma23100260170, Ma23100260171, Ma23100260172, Ma23100260173, Ma23100
260174, Ma23100260175, Ma23100260176, Ma23100260177, Ma23100260178, Ma23100260179, Ma23100260180, Ma23100260181, Ma23100260182, M
a23100260183, Ma23100260184, Ma23100260185, Ma23100260186, Ma23100260187, Ma23100260188, Ma23100260189, Ma23100260190, Ma23100260
191, Ma23100260192, Ma23100260193, Ma23100260194, Ma23100260195, Ma23100260196, Ma23100260197, Ma23100260198, Ma23100260199, Ma23
100260200, Ma23100260201, Ma23100260202, Ma23100260203, Ma23100260204, Ma23100260205, Ma23100260206, Ma23100260207, Ma23100260208
, Ma23100260209, Ma23100260210, Ma23100260211, Ma23100260212, Ma23100260213, Ma23100260214, Ma23100260215, Ma23100260216, Ma23100
260217, Ma23100260218, Ma23100260219, Ma23100260220, Ma23100260221, Ma23100260222, Ma23100260223, Ma23100260224, Ma23100260225, M
a23100260226, Ma23100260227, Ma23100260228, Ma23100260229, Ma23100260230, Ma23100260231, Ma23100260232, Ma23100260233, Ma23100260
234, Ma23100260235, Ma23100260236, Ma23100260237, Ma23100260238, Ma23100260239, Ma23100260240, Ma23100260241, Ma23100260242, Ma23
100260243, Ma23100260244, Ma23100260245, Ma23100260246, Ma23100260247, Ma23100260248, Ma23100260249, Ma23100260250, Ma23100260251
, Ma23100260252, Ma23100260253, Ma23100260254, Ma23100260255, Ma23100260256, Ma23100260257, Ma23100260258, Ma23100260259, Ma23100
260260, Ma23100260261, Ma23100260262, Ma23100260263, Ma23100260264, Ma23100260265, Ma23100260266, Ma23100260267, Ma23100260268, M
a23100260269, Ma23100260270, Ma23100260271, Ma23100260272, Ma23100260273, Ma23100260274, Ma23100260275, Ma23100260276, Ma23100260
277, Ma23100260278, Ma23100260279, Ma23100260280, Ma23100260281, Ma23100260282, Ma23100260283, Ma23100260284, Ma23100260285, Ma23
100260286, Ma23100260287, Ma23100260288, Ma23100260289, Ma23100260290, Ma23100260291, Ma23100260292, Ma23100260293, Ma23100260294
, Ma23100260295, Ma23100260296, Ma23100260297, Ma23100260298, Ma23100260299, Ma23100260300, Ma23100260301, Ma23100260302, Ma23100
260303, Ma23100260304, Ma23100260305, Ma23100260306, Ma23100260307, Ma23100260308, Ma23100260309, Ma23100260310, Ma23100260311, M
a23100260312, Ma23100260313, Ma23100260314, Ma23100260315, Ma23100260316, Ma23100260317, Ma23100260318, Ma23100260319, Ma23100260
320, Ma23100260321, Ma23100260322, Ma23100260323, Ma23100260324, Ma23100260325, Ma23100260326, Ma23100260327, Ma23100260328, Ma23
100260329, Ma23100260330, Ma23100260331, Ma23100260332, Ma23100260333, Ma23100260334, Ma23100260335, Ma23100260336, Ma23100260337
, Ma23100260338, Ma23100260339, Ma23100260340, Ma23100260341, Ma23100260342, Ma23100260343, Ma23100260344, Ma23100260345, Ma23100
260346, Ma23100260347, Ma23100260348, Ma23100260349, Ma23100260350, Ma23100260351, Ma23100260352, Ma23100260353, Ma23100260354, M
a23100260355, Ma23100260356, Ma23100260357, Ma23100260358, Ma23100260359, Ma23100260360, Ma23100260361, Ma23100260362, Ma23100260
363, Ma23100260364, Ma23100260365, Ma23100260366, Ma23100260367, Ma23100260368, Ma23100260369, Ma23100260370, Ma23100260371, Ma23
100260372, Ma23100260373, Ma23100260374, Ma23100260375, Ma23100260376, Ma23100260377, Ma23100260378, Ma23100260379, Ma23100260380
, Ma23100260381, Ma23100260382, Ma23100260383, Ma23100260384, Ma23100260385, Ma23100260386, Ma23100260387, Ma23100260388, Ma23100
260389, Ma23100260390, Ma23100260391, Ma23100260392, Ma23100260393, Ma23100260394, Ma23100260395, Ma23100260396, Ma23100260397, M
a23100260398, Ma23100260399, Ma23100260400, Ma23100260401, Ma23100260402, Ma23100260403, Ma23100260404, Ma23100260405, Ma23100260
406, Ma23100260407, Ma23100260408, Ma23100260409, Ma23100260410, Ma23100260411, Ma23100260412, Ma23100260413, Ma23100260414, Ma23
100260415, Ma23100260416, Ma23100260417, Ma23100260418, Ma23100260419, Ma23100260420, Ma23100260421, Ma23100260422, Ma23100260423
, Ma23100260424, Ma23100260425, Ma23100260426, Ma23100260427, Ma23100260428, Ma23100260429, Ma23100260430, Ma23100260431, Ma23100
260432, Ma23100260433, Ma23100260434, Ma23100260435, Ma23100260436, Ma23100260437, Ma23100260438, Ma23100260439, Ma23100260440, M
a23100260441, Ma23100260442, Ma23100260443, Ma23100260444, Ma23100260445, Ma23100260446, Ma23100260447, Ma23100260448, Ma23100260
449, Ma23100260450, Ma23100260451, Ma23100260452, Ma23100260453, Ma23100260454, Ma23100260455, Ma23100260456, Ma23100260457, Ma23
100260458, Ma23100260459, Ma23100260460, Ma23100260461, Ma23100260462, Ma23100260463, Ma23100260464, Ma23100260465, Ma23100260466
, Ma23100260467, Ma23100260468, Ma23100260469, Ma23100260470, Ma23100260471, Ma23100260472, Ma23100260473, Ma23100260474, Ma23100
260475, Ma23100260476, Ma23100260477, Ma23100260478, Ma23100260479, Ma23100260480, Ma23100260481, Ma23100260482, Ma23100260483, M
a23100260484, Ma23100260485, Ma23100260486, Ma23100260487, Ma23100260488, Ma23100260489, Ma23100260490, Ma23100260491, Ma23100260
492, Ma23100260493, Ma23100260494, Ma23100260495, Ma23100260496, Ma23100260497, Ma23100260498, Ma23100260499, Ma23100260500, (Ite
m 1) MERCANCIA NUEVA. VISTO BUENO INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS N° VINVIMA-23-0146257 DE FECHA 202
3-12-07. REGISTRO DE IMPORTACION N° REG-50195130-20231211N DE FECHA 2023-12-11 VIGENTE HASTA 2024-06-09.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

032024000032255-7

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2024**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032024000032264-3

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830038639 | 6. DV: 1 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: FUTUMEDICA SAS

13. Dirección: CL 78 63 45 | 14. Teléfono: 6300122 | 12. Cód. Admón.: 03 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860514173 | 25. DV: 2 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 22

29. Número documento de identificación: 79443684 | 30. Apellidos y nombres: ROMERO DIAZ OSCAR MAURICIO

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cód.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9194235139	2024 - 01 - 09	No. ESL23110328	2023 - 10 - 03

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: JIANGSU KONSUNG BIO-MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD | 47. Ciudad: DANYANG CITY, JIANGSU | 48. Cod.País Exportador: 215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: N.8 WEST SHENGCHANG RD DANYANG ECONOMIC ECONOMIC Z | 50. E-mail: FAX.86051186371668

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Aduana	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cop.
KSWA3230906002	2023 - 11 - 10	215	1	169	11	LOGISTICA TOTAL SAS	3.927.64

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. contrato o renovo	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	9019200010	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
10	01	215	9,741.51		9,324.00		CT	783	13	U	518.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor Aduana USD	85. Código régimen o Servicio	86. Número	87. Cod. aplicación	88. Año	89. Programa No.	90. Cód. Usuario del Productor
116.550.00	1.309.05	81.59	0	1.390.64	0.00	117.940.64	R	50195130	3	2023	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	463.228.375	0	0	0.00
I.V.A.	19.00	463.228.375	88.013.000	0	0.00
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0.00
Sanción	0	0	0	0	
Reintegro	0	0	0	0	
		Total	88.013.000		0.00

91. Descripción de las mercancías(Cite marca, referencia, modelo, serial, calidad, capacidad, tamaño, peso, etc.)

DO 01235352.. Declaracion(5-14). Producto: CONCENTRADOR DE OXIGENO, CONCENTRADOR DE OXIGENO. ACCESORIOS Y REPUESTOS. Marca: KONSUNG. Modelo: KSW-5. Referencia: N/A, PN: 301070220. Uso oDestino: MEDICO, EL CONCENTRADOR DE OXIGENO UTILIZA UN MICRO-COMPRESOR ELECTRICO LIBRE DE ACIETE DE ALTA FRECUENCIA Y AHORRO DE ENERGIA PARA COMPRIMIR EL AIRE A UNA CIERTA PRESION, EL AIRE PASA A TRAVES DE TAMICES DE ALTA CALIDAD, ES ABSORBIDO Y DE-SORBIDO A TEMPERATURA AMBIENTE, CREANDO OXIGENO CALIFICADO PARA EL PACIENTE. LOT: Ma2311002. 120V, 60HZ, RATED FLOW: 5L/min. FABRICANTE: JIANGSU KONSUNG BIO-MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO. LTD, PAIS DE ORIGEN : CHINA, VIDA UTIL: 5 AÑOS, MERCANCIA NUEVA 2023. REGISTRO SANITARIO INVIMA 2017DM-0015866 VIGENCIA: 2027-0(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0 | 128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera: Estado de levante: Levante automático. No hay declaración posterior | 131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores | 132. No. Aceptación declaración: 032024000032264 | 133. Fecha: 202401 10

134. Levante No. 032024000034664 | 135. Fecha: 2024 - 01 - 10 | Firma funcionario responsable | 136. Nombre: OSCAR MAURICIO ROMERO DIAZ | 137. C.C. No.: 79.443.684 DE BOGOTA

Firma declarante

Servade S.A.

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

$1003038033966

Fecha de Impresión: 2024-01-10 09:13:25

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Declaración de Importación

Aceptación : **032024000032264-3**
Subpartida : **9019200010**

105. Continuación descripción mercancías (Incluye marcas, seriales y otros)

2-07. EXPEDIENTE: 20122834. Cant (518) UNIDADES; Serial: Ma23110020001, Ma23110020002, Ma23110020003, Ma23110020004, Ma2311002000
5, Ma23110020006, Ma23110020007, Ma23110020008, Ma23110020009, Ma23110020010, Ma23110020011, Ma23110020012, Ma23110020013, Ma2311
0020014, Ma23110020015, Ma23110020016, Ma23110020017, Ma23110020018, Ma23110020019, Ma23110020020, Ma23110020021, Ma23110020022,
Ma23110020023, Ma23110020024, Ma23110020025, Ma23110020026, Ma23110020027, Ma23110020028, Ma23110020029, Ma23110020030, Ma2311002
0031, Ma23110020032, Ma23110020033, Ma23110020034, Ma23110020035, Ma23110020036, Ma23110020037, Ma23110020038, Ma23110020039, Ma2
3110020040, Ma23110020041, Ma23110020042, Ma23110020043, Ma23110020044, Ma23110020045, Ma23110020046, Ma23110020047, Ma2311002004
8, Ma23110020049, Ma23110020050, Ma23110020051, Ma23110020052, Ma23110020053, Ma23110020054, Ma23110020055, Ma23110020056, Ma2311
0020057, Ma23110020058, Ma23110020059, Ma23110020060, Ma23110020061, Ma23110020062, Ma23110020063, Ma23110020064, Ma23110020065,
Ma23110020066, Ma23110020067, Ma23110020068, Ma23110020069, Ma23110020070, Ma23110020071, Ma23110020072, Ma23110020073, Ma2311002
0074, Ma23110020075, Ma23110020076, Ma23110020077, Ma23110020078, Ma23110020079, Ma23110020080, Ma23110020081, Ma23110020082, Ma2
3110020083, Ma23110020084, Ma23110020085, Ma23110020086, Ma23110020087, Ma23110020088, Ma23110020089, Ma23110020090, Ma2311002009
1, Ma23110020092, Ma23110020093, Ma23110020094, Ma23110020095, Ma23110020096, Ma23110020097, Ma23110020098, Ma23110020099, Ma2311
0020100, Ma23110020101, Ma23110020102, Ma23110020103, Ma23110020104, Ma23110020105, Ma23110020106, Ma23110020107, Ma23110020108,
Ma23110020109, Ma23110020110, Ma23110020111, Ma23110020112, Ma23110020113, Ma23110020114, Ma23110020115, Ma23110020116, Ma2311002
0117, Ma23110020118, Ma23110020119, Ma23110020120, Ma23110020121, Ma23110020122, Ma23110020123, Ma23110020124, Ma23110020125, Ma2
3110020126, Ma23110020127, Ma23110020128, Ma23110020129, Ma23110020130, Ma23110020131, Ma23110020132, Ma23110020133, Ma2311002013
4, Ma23110020135, Ma23110020136, Ma23110020137, Ma23110020138, Ma23110020139, Ma23110020140, Ma23110020141, Ma23110020142, Ma2311
0020143, Ma23110020144, Ma23110020145, Ma23110020146, Ma23110020147, Ma23110020148, Ma23110020149, Ma23110020150, Ma23110020151,
Ma23110020152, Ma23110020153, Ma23110020154, Ma23110020155, Ma23110020156, Ma23110020157, Ma23110020158, Ma23110020159, Ma2311002
0160, Ma23110020161, Ma23110020162, Ma23110020163, Ma23110020164, Ma23110020165, Ma23110020166, Ma23110020167, Ma23110020168, Ma2
3110020169, Ma23110020170, Ma23110020171, Ma23110020172, Ma23110020173, Ma23110020174, Ma23110020175, Ma23110020176, Ma2311002017
7, Ma23110020178, Ma23110020179, Ma23110020180, Ma23110020181, Ma23110020182, Ma23110020183, Ma23110020184, Ma23110020185, Ma2311
0020186, Ma23110020187, Ma23110020188, Ma23110020189, Ma23110020190, Ma23110020191, Ma23110020192, Ma23110020193, Ma23110020194,
Ma23110020195, Ma23110020196, Ma23110020197, Ma23110020198, Ma23110020199, Ma23110020200, Ma23110020201, Ma23110020202, Ma2311002
0203, Ma23110020204, Ma23110020205, Ma23110020206, Ma23110020207, Ma23110020208, Ma23110020209, Ma23110020210, Ma23110020211, Ma2
3110020212, Ma23110020213, Ma23110020214, Ma23110020215, Ma23110020216, Ma23110020217, Ma23110020218, Ma23110020219, Ma2311002022
0, Ma23110020221, Ma23110020222, Ma23110020223, Ma23110020224, Ma23110020225, Ma23110020226, Ma23110020227, Ma23110020228, Ma2311
0020229, Ma23110020230, Ma23110020231, Ma23110020232, Ma23110020233, Ma23110020234, Ma23110020235, Ma23110020236, Ma23110020237,
Ma23110020238, Ma23110020239, Ma23110020240, Ma23110020241, Ma23110020242, Ma23110020243, Ma23110020244, Ma23110020245, Ma2311002
0246, Ma23110020247, Ma23110020248, Ma23110020249, Ma23110020250, Ma23110020251, Ma23110020252, Ma23110020253, Ma23110020254, Ma2
3110020255, Ma23110020256, Ma23110020257, Ma23110020258, Ma23110020259, Ma23110020260, Ma23110020261, Ma23110020262, Ma2311002026
3, Ma23110020264, Ma23110020265, Ma23110020266, Ma23110020267, Ma23110020268, Ma23110020269, Ma23110020270, Ma23110020271, Ma2311
0020272, Ma23110020273, Ma23110020274, Ma23110020275, Ma23110020276, Ma23110020277, Ma23110020278, Ma23110020279, Ma23110020280,
Ma23110020281, Ma23110020282, Ma23110020283, Ma23110020284, Ma23110020285, Ma23110020286, Ma23110020287, Ma23110020288, Ma2311002
0289, Ma23110020290, Ma23110020291, Ma23110020292, Ma23110020293, Ma23110020294, Ma23110020295, Ma23110020296, Ma23110020297, Ma2
3110020298, Ma23110020299, Ma23110020300, Ma23110020301, Ma23110020302, Ma23110020303, Ma23110020304, Ma23110020305, Ma2311002030
6, Ma23110020307, Ma23110020308, Ma23110020309, Ma23110020310, Ma23110020311, Ma23110020312, Ma23110020313, Ma23110020314, Ma2311
0020315, Ma23110020316, Ma23110020317, Ma23110020318, Ma23110020319, Ma23110020320, Ma23110020321, Ma23110020322, Ma23110020323,
Ma23110020324, Ma23110020325, Ma23110020326, Ma23110020327, Ma23110020328, Ma23110020329, Ma23110020330, Ma23110020331, Ma2311002
0332, Ma23110020333, Ma23110020334, Ma23110020335, Ma23110020336, Ma23110020337, Ma23110020338, Ma23110020339, Ma23110020340, Ma2
3110020341, Ma23110020342, Ma23110020343, Ma23110020344, Ma23110020345, Ma23110020346, Ma23110020347, Ma23110020348, Ma2311002034
9, Ma23110020350, Ma23110020351, Ma23110020352, Ma23110020353, Ma23110020354, Ma23110020355, Ma23110020356, Ma23110020357, Ma2311
0020358, Ma23110020359, Ma23110020360, Ma23110020361, Ma23110020362, Ma23110020363, Ma23110020364, Ma23110020365, Ma23110020366,
Ma23110020367, Ma23110020368, Ma23110020369, Ma23110020370, Ma23110020371, Ma23110020372, Ma23110020373, Ma23110020374, Ma2311002
0375, Ma23110020376, Ma23110020377, Ma23110020378, Ma23110020379, Ma23110020380, Ma23110020381, Ma23110020382, Ma23110020383, Ma2
3110020384, Ma23110020385, Ma23110020386, Ma23110020387, Ma23110020388, Ma23110020389, Ma23110020390, Ma23110020391, Ma2311002039
2, Ma23110020393, Ma23110020394, Ma23110020395, Ma23110020396, Ma23110020397, Ma23110020398, Ma23110020399, Ma23110020400, Ma2311
0020401, Ma23110020402, Ma23110020403, Ma23110020404, Ma23110020405, Ma23110020406, Ma23110020407, Ma23110020408, Ma23110020409,
Ma23110020410, Ma23110020411, Ma23110020412, Ma23110020413, Ma23110020414, Ma23110020415, Ma23110020416, Ma23110020417, Ma2311002
0418, Ma23110020419, Ma23110020420, Ma23110020421, Ma23110020422, Ma23110020423, Ma23110020424, Ma23110020425, Ma23110020426, Ma2
3110020427, Ma23110020428, Ma23110020429, Ma23110020430, Ma23110020431, Ma23110020432, Ma23110020433, Ma23110020434, Ma2311002043
5, Ma23110020436, Ma23110020437, Ma23110020438, Ma23110020439, Ma23110020440, Ma23110020441, Ma23110020442, Ma23110020443, Ma2311
0020444, Ma23110020445, Ma23110020446, Ma23110020447, Ma23110020448, Ma23110020449, Ma23110020450, Ma23110020451, Ma23110020452,
Ma23110020453, Ma23110020454, Ma23110020455, Ma23110020456, Ma23110020457, Ma23110020458, Ma23110020459, Ma23110020460, Ma2311002
0461, Ma23110020462, Ma23110020463, Ma23110020464, Ma23110020465, Ma23110020466, Ma23110020467, Ma23110020468, Ma23110020469, Ma2
3110020470, Ma23110020471, Ma23110020472, Ma23110020473, Ma23110020474, Ma23110020475, Ma23110020476, Ma23110020477, Ma2311002047
8, Ma23110020479, Ma23110020480, Ma23110020481, Ma23110020482, Ma23110020483, Ma23110020484, Ma23110020485, Ma23110020486, Ma2311
0020487, Ma23110020488, Ma23110020489, Ma23110020490, Ma23110020491, Ma23110020492, Ma23110020493, Ma23110020494, Ma23110020495,
Ma23110020496, Ma23110020497, Ma23110020498, Ma23110020499, Ma23110020500, Ma23110020501, Ma23110020502, Ma23110020503, Ma2311002
0504, Ma23110020505, Ma23110020506, Ma23110020507, Ma23110020508, Ma23110020509, Ma23110020510, Ma23110020511, Ma23110020512, Ma2
3110020513, Ma23110020514, Ma23110020515, Ma23110020516, Ma23110020517, Ma23110020518, (Item 2) MERCANCIA NUEVA, GRAVAMEN 0%, DEC
RETO 2065 DE 28-NOV-2023. VISTO BUENO INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS N° VINVIMA-23-0146257 DE FECHA
2023-12-07. REGISTRO DE IMPORTACION N° REG-50195130-20231211N DE FECHA 2023-12-11 VIGENTE HASTA 2024-06-09.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

032024000032264-3

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privado

500

1. Año **2024**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de Formulario

032024000032254-1

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830038639 | 6. DV: 1 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: FUTUMEDICA SAS

13. Dirección: CL 78 63 45 | 15. Teléfono: 6300122 | 12. Cód. Admón.: 03 | 14. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860514173 | 25. DV: 2 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL 1 | 22. Tipo usuario: 26 | 23. Cód. usuario: 22

29. Número documento de identificación: 79443684 | 30. Apellidos y nombres: ROMERO DIAZ OSCAR MAURICIO

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9194235139	2024 - 01 - 09	No. ESL23110328	2023 - 10 - 03

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: JIANGSU KONSUNG BIO-MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD | 47. Ciudad: DANYANG CITY, JIANGSU | 48. Cod.País Exportador: 215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: N.8 WEST SHENGCHANG RD DANYANG ECONOMIC ECONOMIC Z | 50. E-mail: FAX.86051186371668

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Aduana	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs
KSWA3230906002	2023 - 11 - 10	215	1	169	11	LOGISTICA TOTAL SAS	3.927,64

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
S 9026200000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	72. Peso neto kgs.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad comc.
10	01	215	55.31	52.94	CT	783	13	u	50.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código régimen o licencia	86. Número
150.00	7.43	0.11	0	7.54	0.00	157.54	R	50195130

87. Cod. tributo	88. Año	89. Programa No	90. Cód. interno del Producto
3	2023	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	618.760	0	0	0.00
I.V.A.	19.00	618.760	118.000	0	0.00
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0.00
Sanción	0	0	0	0	
Rezago	0	0	0	0	
		Total	118.000		0.00

91. Descripción de las mercancías/Si hacia la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria / Indique marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 01235352.. Declaracion(6-14). Producto: MANÓMETRO O MEDIDOR DE PRESIÓN NEGATIVA. Marca: PROVEEDOR KONSUNG. Modelo: NO TIENE. Referencia: N/A. Serial: SIN SERIAL. Uso o destino: COMUNICA EL MANÓMETRO CON LA TUBERÍA A MEDIR LA PRESIÓN NEGATIVA. Principio de funcionamiento: MECANICO. COMPOSICIÓN: ES UN MANÓMETRO O TUBO DE BOURDON, CONSISTENTE EN UN TUBO METÁLICO, APLANADO, HERMÉTICO, CERRADO POR UN EXTREMO Y ENROLLADO EN ESPIRAL. PARTE Y/O ACCESORIO EXCLUSIVO PARA EL EQUIPO DENOMINADO SUCCIONADOR DE FLEMAS. UNIDAD DE SUCCION MARCA KONSUNG, FABRICANTE: JIANGSU KONSUNG MEDICAL EQUIPMENT CO. LTD, P.O: CHINA, REGISTRO SANITARIO INVIMA 2016DM-0015359, VIG: 2026-10-21, EXPEDIENTE: 20117500 MERCANCIA NUEVA 2023 Cant (50) UNIDADES (Item 4) MERCANCIA (continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera: Estado de levante: Levante automático. No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración: 032024000032254 / 133. Fecha: 202401 10
134. Levante No. 032024000034653	135. Fecha: 2024 - 01 - 10	Firma funcionario responsable: 136. Nombre: OSCAR MAURICIO ROMERO DIAZ / 137. C.C. No.: 79.443.684 DE BOGOTA

Firma declarante

Servade S.A. AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL 1

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

01003038033841

Fecha de Impresión: 2024-01-10 09:12:05

DIAN REPÚBLICA DE COLOMBIA	**Declaración de Importación**	Aceptación : **032024000032254-1** Subpartida : **9026200000** Página 1 de 1

105. Continuación descripción mercancías (incluye marcas, seriales y otros)

```
NUEVA. MERCANCIA QUE NO SE ENCUENTRA SUJETA AL CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO TECNICO, DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 33683 DEL 2021 DE L
A SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), SEGÚN CONCEPTO 22-6498 Y 22-032018, 09/02/2022. LA NORMA SOLAMENTE APLICA A LOS
 INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO (BALANZAS); SURTIDORES, DISPENSADORES Y/O MEDIDORES DE COMBUSTIBLES LÍQUI
DOS; ETILÓMETROS O ALCOHOSENSORES, ALCOHOLÍMETROS; Y TAXÍMETROS ELECTRÓNICOS. SE ANEXA CERTIFICACION DEL PROVEEDOR, QUE DECLARA Q
UE LOS PRODUCTOS OBJETO DE ESTA IMPORTACION, NO SE FABRICAN CON MERCURIO Y TAMPOCO CONTIENEN MERCURIO. LOS PRODUCTOS NO CORRESPON
DEN A PRODUCTOS CON MERCURIO AÑADIDO DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO 419 DEL 22 DE ABRIL DE 2021 Y DECRETO 1433 DE 2022. G
RAVAMEN 0% SEGÚN DECRETO 1881 DE DICIEMBRE 30 DE 2021 / VISTO BUENO INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
N° VINVIMA-21-0146257 DE FECHA 2023-12-07. REGISTRO DE IMPORTACION N° REG-50195130-20231211N DE FECHA 2023-12-11 VIGENTE HASTA 20
24-06-09.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

032024000032254-1	Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2024**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032024000032301-8

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830038639 | 6. DV: 1 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: FUTUMEDICA SAS

13. Dirección: CL 78 63 45 | 14. Teléfono: 6300122 | 12. Cód. Admón.: 03 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860514173 | 25. DV: 2 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL I | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 22

29. Número documento de identificación: 79443684 | 30. Apellidos y nombres: ROMERO DIAZ OSCAR MAURICIO

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cód. Admón.	37. Declaración de Importación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9194235139	2024 - 01 - 09	No. BSL23110328	2023 - 10 - 03

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: JIANGSU KONSUNG BIO-MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD | 47. Ciudad: DANYANG CITY, JIANGSU | 48. Cod.País Exportador: 215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: N.8 WEST SHENGCHANG RD DANYANG ECONOMIC ECONOMIC Z | 50. E-mail: FAX.86051186371668

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Ciudad	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ vrs.
KSWA3230906002	2023 - 11 - 10	215	1	169	11	LOGISTICA TOTAL SAS	3.927,64

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cód. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas si existe	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8414901000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	72. Peso neto kgs.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad declar.
10	01	215	27.66	26.47	CT	783	13	U	5.00

78. Valor FOB USD	79. Valor flete USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor Aduana USD	85. Código régimen y modalidad	86. Número
75.00	3.72	0.05	0	3.72	0.00	78.77	R	50202967

87. Cod. tributo	88. Año	89. Programa No.	90. Cód. Interno del Producto
3	2023	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	309.380	0	0	0.00
I.V.A.	19.00	309.380	59.000	0	0.00
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0.00
Sanción	0	0	0	0	
Recargo	0	0	0	0	
		Total	59.000		0.00

91. Descripción de las mercancías(Para iniciar la descripción de las mercancías a importar con la señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria , incluya marcas, seriales y otros) (Si el espacio es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 01235352., Declaracion(7-14). PARTES DE USO EXCLUSIVO EN COMPRESOR DE SUCCIONADOR DE FLEMAS. UNIDAD DE SUCCION . Producto: CARCASA O CUERPO DE COMPRESOR. Destino: PARTES DE USO EXCLUSIVO EN COMPRESOR DE SUCCIONADOR DE FLEMAS. UNIDAD DE SUCCION. Marca: CHANGHUA / PROVEEDOR KONSUNG. Referencia: NO TIENE. /YY80-32-4A / NRO. CH23100800287, CH23100800267, CH23100800285, CH23100800263, CH23100800264 / 110V 60HZ 30W 0.95A 8uf/450V. FABRICANTE: JIANGSU KONSUNG MEDICAL EQUIPMENT CO. LTD, PAIS DE ORIGEN: CHINA, REGISTRO SANITARIO INVIMA 2016DM-0015359 VIGENCIA: 2026-10-21, EXPEDIENTE: 20117500; MERCANCIA NUEVA 2023. Cant (5) UNIDADES (Item 5) MERCANCIA NUEVA. GRAVAMEN 0% SEGÚN DECRETO 272 DEL 13 DE FEBRERO DE 2018 / VISTO BUENO INSTITUTO NACIONAL DE(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera: Estado de levante: Levante automático. No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración: 032024000032301. 133. Fecha: 2024 01 10
134. Levante No. 032024000034661	135. Fecha: 2024 - 01 - 10	Firma funcionario responsable

136. Nombre: OSCAR MAURICIO ROMERO DIAZ

137. C.C. No.: 79.443.684 DE BOGOTA

Firma declarante

Servade S.A. AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL I

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

91003038034015

Fecha de Impresión: 2024-01-10 09:13:17

DIAN REPÚBLICA DE COLOMBIA	Declaración de Importación	Aceptación : **032024000032301-8** Subpartida : **8414901000** Página 1 de 1

105. Continuación descripción mercancías (incluya marcas, seriales y otros)

VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS Nº VINVIMA-23-0151696 DE FECHA 2023-12-20. REGISTRO DE IMPORTACION Nº REG-50202967-202312
22N DE FECHA 2023-12-22 VIGENTE HASTA 2024-06-20.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

032024000032301-8	Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2024**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032024000032257-1

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830038639 | 6. DV.: 1 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: FUTUMEDICA SAS

13. Dirección: CL 78 63 45 | 14. Teléfono: 6300122 | 12. Cód. Admón.: 03 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860514173 | 25. DV.: 2 | 26. Razón social del declarante acreditado: AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 22

29. Número documento de identificación: 79443684 | 30. Apellidos y nombres: ROMERO DIAZ OSCAR MAURICIO

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9194235139	2024 - 01 - 09	No. ESL23110328	2023 - 10 - 03

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
JIANGSU KONSUNG BIO-MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD	DANYANG CITY, JIANGSU	215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
N.8 WEST SHENGCHANG RD DANYANG ECONOMIC ECONOMIC Z	FAX 86051186371668

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Medio Transporte	55. Código de Aduana	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
KSWA3230906002A	2023 - 11 - 10	215	1	169	11	LOGISTICA TOTAL SAS	3,927.64

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8414802100	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
99	99	215	7.37		7.06		CT	783	13	N	5.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código seguro o licencia	86. Número
20.00	0.99	0.01	0	1.00	0.00	21.00	R	50192527

87. Cod. adicional	88. Año	89. Programa No	90. Cód. interno del Producto
3	2023	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	82.480	0	0	0.00
I.V.A.	19.00	82.480	16.000	0	0.00
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0.00
Sanción	0	0	0	0	
Reexte	0	0	0	0	
		Total	16.000		0.00

91. Descripción de las mercancías(Cite marca la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Indique marcas, serriales y clase) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 01235352., Declaracion(9-14). Producto: COMPRESOR. Marca: SINC MED. Modelo: NO TIENE. Referencia: N/A. Serial: 1030202379000502, 1030202379000435, 1030202379000437, 1030202379000439, 1111202379000001 /. Uso o destino: ABSORBER EL AIRE AMBIENTE Y LLEVARLO A LOS TAMICES MOLECULARES CON AYUDA DE LAS VÁLVULAS A PRESIÓN 7 PSI. Potencia: 120 VAC, 60HZ, 3.2 AMP. COMPOSICIÓN: CARCASA O CUERPO DEL COMPRESOR. CABEZAL. CILINDRO Y PISTÓN. BIELA Y MANIVELA. PARTE Y/O ACCESORIO EXCLUSIVO PARA EL EQUIPO DENOMINADO CONCENTRADOR DE OXIGENO. ACCESORIOS Y REPUESTOS, FABRICANTE: JIANGSU KONSUNG BIO-MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO. LTD, CON DOMICILIO EN CHINA, P.O: CHINA, REGISTRO SANITARIO INVIMA 2017DM-0015866, VIG: 2027-02-07, EXPEDIENTE: 20122834, MERCAN(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado con exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración: 032024000032257 133. Fecha: 202401 10
134. Levante No. 032024000034654	135. Fecha: 2024 - 01 - 10	Firma funcionario responsable	136. Nombre: OSCAR MAURICIO ROMERO DIAZ 137. C.C. No.: 79.443.684 DE BOGOTA

Firma declarante

Servade S.A.

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

91003038033927

Fecha de Impresión: 2024-01-10 09:12:10

DIAN REPÚBLICA DE COLOMBIA	**Declaración de Importación**	Aceptación : **032024000032257-1** Subpartida : **8414802100** Página 1 de 1

101. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

CIA NUEVA 2023. Cant (5) UNIDADES (Item 11) MERCANCIA NUEVA. GRAVAMEN 0% SEGÚN DECRETO 272 DEL 13 DE FEBRERO DE 2018 / NO REEMBOLSABLE POR TRATARSE DE MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL (MSVC) / VISTO BUENO INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS Nº VINVIMA-23-0144236 DE FECHA 2023-12-04. REGISTRO DE IMPORTACION Nº REG-50192527-20231205N DE FECHA 2023-12-05 VIGENTE HASTA 2024-06-03.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

032024000032257-1	Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2024**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032024000032300-0

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830038639 | 6. DV.: 1 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: FUTUMEDICA SAS

13. Dirección: CL 78 63 45 | 14. Teléfono: 6300122 | 12. Cód. Admón.: 03 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860514173 | 25. DV.: 2 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 22

29. Número documento de identificación: 79443684 | 30. Apellidos y nombres: ROMERO DIAZ OSCAR MAURICIO

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Importación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9194235139	2024 - 01 - 09	No. ESL23110328	2023 - 10 - 03

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: JIANGSU KONSUNG BIO-MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD | 47. Ciudad: DANYANG CITY, JIANGSU | 48. Cod.País Exportador: 215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: N.8 WEST SHENGCHANG RD DANYANG ECONOMIC ECONOMIC Z | 50. E-mail: FAX.86051186371668

51. No. de flotera	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Medio Transporte	55. Código de Aduana	56. Cod. Depto Destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cve.
KSWA3230906002A	2023 - 11 - 10	215	1	169	11	LOGISTICA TOTAL SAS	3.927,64

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Arancel
	8421399000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
99	99	215	7.37		7.06		CT	783	13	U	40.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código régimen o licencia	86. Número	87. Cod. vrfletes	88. Año	89. Programa No	90. Cód Sistema del Producto
20.00	0.99	0.01	0	1.00	0.00	21.00	R	50192527	3	2023	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	10.00	82.480	8.000	0	0.00
I.V.A.	19.00	90.480	17.000	0	0.00
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0.00
Tasa cve	0	0	0	0	
Rezago	0	0	0	0	
		Total	25.000		0.00

91. Descripción de las mercancías(Dar inicio la descripción de las mercancías a importar con la señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Indique marcas, modelos y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 01235352.. Declaracion(10-14). Producto: FILTRO DE AIRE PARA KONSUNG. Marca: PROVEEDOR KONSUNG. Modelo: NO TIENE. Referencia: N/A. Serial: SIN SERIAL. Uso o destino: PARA CONCENTRADOR DE OXÍGENO, MARCA: KONSUNG, RETENCIÓN DE AIRE DE PARTÍCULAS GRUESAS. DESTINO: CONCENTRADOR. MARCA: KONSUNG. Tipo de filtro: BACTERIANO. Elemento filtrante: ESPONJA DE POLIURETANO DE CELDA CERRADA. Materia a filtrar: AIRE. FABRICANTE: JIANGSU KONSUNG BIO-MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO. LTD, PAIS DE ORIGEN: CHINA. PARTE Y/O ACCESORIO EXCLUSIVO PARA EL EQUIPO DENOMINADO CONCENTRADOR DE OXIGENO. ACCESORIOS Y REPUESTOS, REGISTRO SANITARIO INVIMA 2017DM-001 5866, VIG: 2027-02-07, EXPEDIENTE: 20122834 MERCANCIA NUEVA 2023. Cant (40) UNIDADES (Item 16) MERCANCIA NU(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0 | 128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Autoridad aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración: 032024000032300
133. Fecha: 202401 10

134. Levante No. 032024000034660 | 135. Fecha: 2024 - 01 - 10 | Firma funcionario responsable | 136. Nombre: OSCAR MAURICIO ROMERO DIAZ | 137. C.C. No.: 79.443.684 DE BOGOTA

Firma declarante

Servade S.A. AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL 1

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

9100303834008

Fecha de Impresión: 2024-01-10 09:13:17

DIAN REPÚBLICA DE COLOMBIA	**Declaración de Importación**	Aceptación : **032024000032261-1** Subpartida : **8481400090** Página 1 de 1

105. Continuación descripción mercancías (incluye marcas, seriales y otros)

DOMICILIO EN CHINA, P.O: CHINA, REGISTRO SANITARIO INVIMA 2017DM-0015866, VIG: 2027-02-07, EXPEDIENTE: 20122834, MERCANCIA NUEVA 2023. Cant (10) UNIDADES (Item 10) MERCANCIA NUEVA. GRAVAMEN 0% SEGÚN DECRETO 272 DEL 13 DE FEBRERO DE 2018 / NO REEMBOLSABLE POR TRATARSE DE MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL (MSVC) / VISTO BUENO INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS N° VI NVIMA-23-0144236 DE FECHA 2023-12-04. REGISTRO DE IMPORTACION N° REG-50192527-20231205N DE FECHA 2023-12-05 VIGENTE HASTA 2024-06-03.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora
032024000032261-1	

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2024**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032024000032262-9

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830038639 | 6. DV.: 1 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: FUTUMEDICA SAS

13. Dirección: CL 78 63 45 | 15. Teléfono: 6300122 | 12. Cód. Admón.: 03 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860514173 | 25. DV.: 2 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 22

29. Número documento de identificación: 79443684 | 30. Apellidos y nombres: ROMERO DIAZ OSCAR MAURICIO

21. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Importación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9194235139	2024 - 01 - 09	No. ESL2310328	2023 - 10 - 03

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: JIANGSU KONSUNG BIO-MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD | 47. Ciudad: DANYANG CITY, JIANGSU | 48. Cod.País Exportador: 215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: N.8 WEST SHENGCHANG RD DANYANG ECONOMIC ECONOMIC Z | 50. E-mail: FAX.86051186371668

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Aduana	56. Cod. Depto Destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ x/x.
KSWA1230906002A	2023 - 11 - 10	215	1	169	11	LOGISTICA TOTAL SAS	3.927,64

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8542390000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
99	99	215	3.69		3.53		CT	783	13	u	20.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código régimen o forma/a	86. Número	87. Cod. deficien	88. Año	89. Programa No.	90. Cód. Sector del Producto
10.00	0.50	0.01	0	0.51	0.00	10.51	R	50192527	3	2023	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	41.279	0	0	0.00
I.V.A.	19.00	41.279	8.000	0	0.00
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0.00
Sanción	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	8.000		0.00

91. Descripción de las mercancías(Use punto la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el manual de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 01235352.. Declaracion(12-14). Producto: TARJETA DE PODER. Marca: PROVEEDOR KONSUNG. Modelo: NO TIENE. Referencia: NO TIENE. Serial: 20502012923110340, 20502012923110341, 20502012923110342, 20502012923110343, 20502012923110344, 20502012923110345, 20502012923110346, 20502012923110347, 20502012923110348, 20502012923110349 /. Uso o destino: PARA CONCENTRADOR DE OXÍGENO MARCA: KONSUNG, TRANSFORMAR LA CORRIENTE ALTERNA (120V) A CORRIENTE DIRECTA (24V) Y ALIMENTAR LA TARJETA PCBA.. / NRO. 205020129, LOTE: 2311034 / POTENCIA: 0.36 KVA. TIPO DE DIELÉCTRICO: SECO (NDB-8ESS) 110V 50HZ RED, 15V (0.2A) YEL 15V GRY.DENOMINADOS: TRANSFORMER 110V(3300MM), PARTE Y/O ACCESORIO EXCLUSIVO PARA EL EQUIPO DENOMINADO CONCENTRADOR DE OXIGENO. ACCESORIOS Y REPUEST(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera. Retiro de levante: Levante autorizado. No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración: 032024000032262. 133. Fecha: 2024 01 10
134. Levante No. 032024000034665	135. Fecha: 2024 - 01 - 10	Firma funcionario responsable	136. Nombre: OSCAR MAURICIO ROMERO DIAZ. 137. C.C. No. 79.443.684 DE BOGOTA

Firma declarante

Servade S.A.

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

9100308033998

Fecha de Impresión: 2024-01-10 09:13:29

DIAN REPÚBLICA DE COLOMBIA	**Declaración de Importación**	Aceptación : **032024000032262-9** Subpartida : **8542390000** Página 1 de 1

(33. Continuación descripción mercancías (Incluye marcas, seriales y otros)

OS, FABRICANTE: JIANGSU KONSUNG BIO-MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO. LTD, P.O. CHINA . REGISTRO SANITARIO INVIMA 2017DM-0015866 , VIG: 2027-02-07, EXPEDIENTE: 20122834 MERCANCIA NUEVA 2023 Cant (10) UNIDADES (Item 9) Producto: PLACA DE CIRCUITO DEL TABLERO DE CONTROL-SOLDADURA (5B), ACCESORIOS DE GARANTÍA. Marca: MEGMEET / PROVEEDOR KONSUNG. Modelo: MKP24-12-KSN. Referencia: NO TIENE . Serial: 20702001923100447, 20702001923100453, 20702001923100468, 20702001923100452, 20702001923100456, 20702001923100430, 20702001923100454, 20702001923100438, 20702001923100451, 20702001923100437 /. Uso o destino: PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MANEJO DEL TABLERO DE CONTROL YDEL EQUIPO COMPLETO. / NRO. 207020019, LOTE NRO. 2310022, COMPOSICIÓN: LA PLACA DE CIRCUITO IMPRESO. ESTA ESTÁ COMPUESTA NORMALMENTE POR UN MATERIAL LLAMADO FIBRA DE VIDRIO QUE SE REFUERZA CON RESINAS EPOXI, UN POLÍMERO TERMOESTABLE QUE SE VUELVE DURO AL CONTACTO CON UN AGENTE CATALIZADOR, COMPUESTOS POR DIODOS, RESISTENCIAS, CONDENSADORES, TRANSISTORES ETC. PARTE Y/O ACCESORIO EXCLUSIVO PARA EL EQUIPO DENOMINADO CONCENTRADOR DE OXIGENO. ACCESORIOS Y REPUESTOS, MARCA KONSUNG, FABRICANTE: JIANGSU KONSUNG BIO-MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO. LTD ., P.O: CHINA, REGISTRO SANITARIO INVIMA 2017DM-0015866, VIG: 2027-02-07, EXPEDIENTE: 20122834, MERCANCIA NUEVA 2023. Cant (10) UNIDADES (Item 15) MERCANCIA NUEVA. GRAVAMEN 0% SEGÚN DECRETO 1881 DE DICIEMBRE 30 DE 2021 / NO REEMBOLSABLE POR TRATARSE DE MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL (MSVC) / VISTO BUENO INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS N° VINVIMA-23-0144236 DE FECHA 2023-12-04. REGISTRO DE IMPORTACION N° REG-50192527-20231205N DE FECHA 2023-12-05 VIGENTE HASTA 2024-06-03.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

032024000032262-9	Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2024**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032024000032260-4

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830038639 | 6. DV.: 1 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: FUTUMEDICA SAS

13. Dirección: CL 78 63 45 | 15. Teléfono: 6300122 | 12. Cód. Admón.: 03 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860514173 | 25. DV.: 2 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 22

29. Número documento de identificación: 79443684 | 30. Apellidos y nombres: ROMERO DIAZ OSCAR MAURICIO

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9194235139	2024 - 01 - 09	No. ESL23110328	2023 - 10 - 03

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: JIANGSU KONSUNG BIO-MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD | 47. Ciudad: DANYANG CITY, JIANGSU | 48. Cod.País Exportador: 215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: N.8 WEST SHENGCHANG RD DANYANG ECONOMIC ECONOMIC Z | 50. E-mail: FAX.86051186371668

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Aduana	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
KSWA3230906002A	2023 - 11 - 10	215	1	169	11	LOGISTICA TOTAL SAS	3.927,64

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Consignatario	61. Cod. Representante	62. Cod. Modalidad	63. No. cuentas a pagar	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	9018190000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
99	99	215	1.84	1.76	CT	783	13	U	10.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor moneda USD	85. Código registro de licencia	86. Número	87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód. Interno del Producto
5.00	0.25	0.01	0	0.26	0.00	5.26	R	50192527	3	2023	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	20.659	0	0	0.00
I.V.A.	19.00	20.659	4.000	0	0.00
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0.00
Sanción	0	0	0	0	
Retazo	0	0	0	0	
		Total	4.000		0.00

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, seriales y otros) (Si el espacio es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 01235352.. Declaracion(13-14). Producto: SENSOR DE PUREZA. Marca: PROVEEDOR KONSUNG. Modelo: NO TIENE. Referencia: N/A. Serial : SIN SERIAL. Uso o destino: CONCENTRADOR DE OXÍGENO MARCA: KONSUNG, PERMITE SENSAR LA PUREZA DE OXIGENO Y PERMITIR EL BUEN FUNCI ONAMIENTO DEL DISPOSITIVO. Tecnica de diagnostico: NO APLICA. NRO. 110050011, 23-01 V2.0, MATERIAL: UNA LÁMINA METÁLICA DE SILICI O Y UNA PELÍCULA GRURSA DE SILICIO SOBRE ZAFIRO. PARTE Y/O ACCESORIO EXCLUSIVO PARA EL EQUIPO DENOMINADO CONCENTRADOR DE OXIGENO. ACCESORIOS Y REPUESTOS. FABRICANTE: JIANGSU KONSUNG BIO-MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO. LTD, CON DOMICILIO EN CHINA, P.O: CHI NA, REGISTRO SAMITARIO INVIMA 2017DM-0015866, VIG: 2027-02-07, EXPEDIENTE: 20122834, MERCANCIA NUEVA 2023 C(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0 | 128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera: Estado de levante: Levante automático. No hay declaración posterior | 131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores | 132. No. Aceptación declaración: 032024000032260 | 133. Fecha: 202401 10

134. Levante No. 032024000034666 | 135. Fecha: 2024 - 01 - 10 | Firma funcionario responsable | 136. Nombre: OSCAR MAURICIO ROMERO DIAZ | 137. C.C. No.: 79.443.684 DE BOGOTA

Firma declarante

Servade S.A. EMPRESA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL 1

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

91003038033902

Fecha de Impresión: 2024-01-10 09:13:40

DIAN

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Declaración de Importación

Aceptación : **032024000032260-4**
Subpartida : **9018190000**

[illegible]. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

ant (10) UNIDADES (Item 14) MERCANCIA NUEVA. MERCANCIA QUE NO SE ENCUENTRA SUJETA AL CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO TECNICO, DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 33883 DEL 2021 DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), SEGÚN CONCEPTO 22-6498 Y 22-032018, 09/02/2022. LA NORMA SOLAMENTE APLICA A LOS INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO (BALANZAS); SURTIDORES, DISPENSADORES Y/O MEDIDORES DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS; ETILÓMETROS O ALCOHOSENSORES, ALCOHOLÍMETROS; Y TAXÍMETROS ELECTRÓNICOS. GRAVAMEN 0% SEGÚN DECRETO 1881 DE DICIEMBRE 30 DE 2021 / NO REEMBOLSABLE POR TRATARSE DE MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL (MSVC) / VISTO BUENO INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS Nº VINVIMA-23-0144236 DE FECHA 2023-12-04. REGISTRO DE IMPORTACION Nº REG-50192527-20231205N DE FECHA 2023-12-05 VIGENTE HASTA 2024-06-03.

032024000032260-4

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2024**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de Formulario

032024000032253-2

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830038639 | 6. DV.: 1 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: FUTUMEDICA SAS

13. Dirección: CL 78 63 45 | 14. Teléfono: 6300122 | 42. Cód. Admón.: 03 | 36. Cód. Dpto: 11 | 37. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860514173 | 25. DV.: 2 | 28. Razón social del declarante suministrado: AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 29. Cód. usuario: 22

29. Número documento de identificación: 79443684 | 30. Apellidos y nombres: ROMERO DIAZ OSCAR MAURICIO

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9194235139	2024 - 01 - 09	No. ESL23110328	2023 - 10 - 03

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
JIANGSU KONSUNG BIO-MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD	DANYANG CITY, JIANGSU	215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
N.8 WEST SHENGCHANG RD DANYANG ECONOMIC ECONOMIC Z	FAX.86051186371668

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Aduana	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
KSWA3230906002A	2023 - 11 - 10	215	1	169	11	LOGISTICA TOTAL SAS	3.927,64

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8414590000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código contenedor	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
99	99	215	1.84	1.76	CT	783	13	U	10.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código régimen y forma	86. Número	87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód. Interno del Producto
5.00	0.25	0.01	0	0.26	0.00	5.26	R	50204178	3	2023	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	5.00	20.659	1.000	0	0.00
I.V.A.	19.00	21.659	4.000	0	0.00
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0.00
Recargo	0	0	0	0	
Rezago	0	0	0	0	
		Total	5.000		0.00

91. Descripción de las mercancías(No iniciar la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el acápite de subpartida arancelaria - Indicar marcas, modelos y atributos (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 01235352.. Declaracion(14-14). Producto: SOPLADOR (FAN). Marca: BRUSHLESS DC BLOWER / FB, PROVEEDOR KONSUNG. Modelo: NO TIENE. Referencia: NO TIENE. Serial: SIN SERIAL. Uso o destino: PARTE Y/O ACCESORIO EXCLUSIVO PARA EL EQUIPO DENOMINADO CONCENTRADOR DE OXIGENO. ACCESORIOS Y REPUESTOS, FABRICANTE: JIANGSU KONSUNG BIO-MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO. LTD, P.O. CHINA . REGISTRO SANITARIO INVIMA 2017DM-0015866, VIG: 2027-02-07, EXPEDIENTE: 20122834. Potencia: DESDE 3.9 HP HASTA 19.6 HP. / INCLUYE ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO: CABLE MARCA: TB / BRUSHLESS DC BLOWER / ABD9733BH12, DC 12V, 0.55A / FABRICANTE: JIANGSU KONSUNG MEDICAL EQUIPMENT CO. LTD, PAIS DE ORIGEN: CHINA, MERCANCIA NUEVA Cant (10) UNIDADES (Item 13) MERCANCIA NU(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Autoridad aduanera. Estado de levante: Levante automático. No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Autoadhesivo declaración: 032024000032253. 133. Fecha: 202401 10
134. Levante No. 032024000034658	135. Fecha: 2024 - 01 - 10	Firma funcionario responsable / 136. Nombre: OSCAR MAURICIO ROMERO DIAZ / 137. C.C. No.: 79.443.684 DE BOGOTA

Firma declarante

Servade S.A. AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL 1

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $

0

996. Espacio para Número autoadhesivo

81003038033871

Fecha de Impresión: 2024-01-10 09:12:52

DIAN REPÚBLICA DE COLOMBIA	**Declaración de Importación**	Aceptación : **032024000032253-2** Subpartida : **8414590000** Página 1 de 1

105. Continuación descripción mercancías (Incluye marcas, seriales y otros)

```
EVA. NO REEMBOLSABLE POR TRATARSE DE MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL (MSVC) / VISTO BUENO INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICA
MENTOS Y ALIMENTOS N° VINVIMA-23-0152055 DE FECHA 2023-12-21. REGISTRO DE IMPORTACION N° REG-50204178-20231226N DE FECHA 2023-12-
26 VIGENTE HASTA 2024-06-25.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

032024000032253-2	Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

Año **2024**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de Formulario: **032024000032259-6**

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830038610 | 6. DV: 1 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: FUTUMEDICA SAS

13. Dirección: KL 75 63 45 | 15. Teléfono: 6300122 | 42. Cód. Admón.: 03 | 44. Cód. Dpto: 11 | 47. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860514173 | 25. DV: 2 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 22

29. Número documento de identificación: 79443684 | 30. Apellidos y nombres: ROMERO DIAZ OSCAR MAURICIO

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cód.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cód. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cód. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cód. lugar ingreso de las mercancías	41. Cód. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9194235139	2024 - 01 - 09	No. ESL23110328	2023 - 10 - 03

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: JIANGSU KONSUNG BIO-MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO. LTD | 47. Ciudad: DANYANG CITY, JIANGSU | 48. Cod.País Exportador: 215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: N.8 WEST SHENGCHANG RD DANYANG ECONOMIC ECONOMIC Z | 50. E-mail: FAX 86051186371668

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto. destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ a/v
KSWA3230906002	2023 - 11 - 10	215	1	169	11	LOGISTICA TOTAL SAS	3.927,64

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas a pagar	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Autorido
	8421399000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código fronterizo	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
10	01	215	210.00	200.00	CT	783	13	U	5.000,00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código régimen o licencia	86. Número	87. Cod. adicional	88. Año	89. Programa No	90. Cód interno del producto
2.500,00	28,22	1,75	0	29,97	0,00	2.529,97	R	50195130	3	2023	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	10.00	9.936.811	994.000	0	0,00
I.V.A.	19.00	10.930.811	2.077.000	0	0,00
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0,00
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0,00
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0,00
Sanción	0	0	0	0	
Rascate	0	0	0	0	
		Total	3.071.000		0,00

91. Descripción de las mercancías: No repetir la descripción de las mercancías a importar que ha señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, serie(s) y otro(s) (Si el espacio es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 01235352.. Declaracion(3-14). PARTE Y/O ACCESORIO EXCLUSIVO PARA EL EQUIPO DENOMINADO SUCCIONADOR DE FLEMAS. UNIDAD DE SUCCION MARCA KONSUNG. REGISTRO SANITARIO INVIMA 2016DM-0015359, VIG: 2026-10-21, EXPEDIENTE: 20117500. Producto: FILTRO BACTERIANO. Marca: PROVEEDOR KONSUNG. Modelo: NO TIENE. Referencia: NO TIENE. Serial: SIN SERIAL. Uso o destino: FILTRO BACTERIAL PARA EL ASPIRADOR, FILTRA LAS BACTERIAS Y LOS VIRUS CON UNA ALTA EFICIENCIA. Tipo de filtro: FILTRO BACTERIAL. Elemento filtrante: PLÁSTICO ASS DE GRADO MÉDICO DE ALTA CALIDAD. Materia a filtrar: BACTERIAS Y VIRUS. NRO. EN STICKER: 106230006 / FILTER / FABRICANTE: JIANGSU KONSUNG BIO-MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO. LTD, PAIS DE ORIGEN: CHINA. MERCANCIA NUEVA 2023. Cant (500(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0

128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera: Estado de levante: Inspección física

No hay declaración posterior

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración: 032024000032259

133. Fecha: 202401 10

134. Levante No.: 032024000092655 | 135. Fecha: 11-01-2024

136. Nombre: JULIAN GARCIA HOYOS | 137. C.C. No: 1075251225

Firma declarante

Servade S.A. AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL 1

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

Fecha de Impresión: 2024-01-10 09:13:37

980. Pago Total $: 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

910030038033911

Powered by CamScanner

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

Código	F-BIO-001
Versión	1
Fecha	Febrero 2017
Página	1 de 1

1. INFORMACION DE EQUIPO

EQUIPO	TENSIÓMETRO		REGISTRO INVIMA	2021DM-0024553			
MARCA	LENZ		SERVICIO	TAB			
MODELO	XB11300		UBICACIÓN	AMB. NXY747			
SERIE	2023061773		CALIBRACIÓN	ANUAL			
N.° INVENTARIO			TIPO DE EQUIPO	FIJO		MOVIL	X
FECHA DE COMPRA	13/12/2024	FECHA INSTALACION	13/12/2024	GARANTIA			
EQUIPO PROPIO		EQUIPO COMODATO		DONACION			

2. FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO

MENSUAL		BIMENSUAL		TRIMESTRAL		CUATRIMESTRAL	X	SEMESTRAL		ANUAL	

REGISTRO FOTOGRAFICO	ACCESORIOS	
	CANTIDAD	ACCESORIO
		

3. CARACTERISTICAS TECNICAS

VOLTAJE	N/A	CORRIENTE	N/A	POTENCIA	N/A	FRECUENCIA	N/A	TEMP. DE TRABAJO	

CLASIFICACION RIESGO SEGUN 4725 DE 2005		CLASIFICACION DE USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		TECNOLOGIA PREDOMINANTE			
				DIAGNOSTICO	X				
				MTTO DE LA VIDA		ELECTRICO		NEUMATICO	X
RIESGO I	X	MEDICO		PREVENCION		ELECTRONICO		ACUSTICO	
RIESGO IIA		BASICO	X	REHABILITACIÓN		ELECTROMECANICO		SOLAR	
RIESGO IIB		APOYO		EQ. LABORATORIO		MECANICO		VAPOR	
RIESGO III		OTRO		EQ. ODONTOLOGIA		HIDRAULICO		OTRO	

4. RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

DEJE QUE EL USUARIO REPOSE UN MOMENTO ANTES DE TOMAR LA TENSIÓN.
NO DEJAR CAER EL MANÓMETRO Y EVITAR GOLPEARLO.
NUNCA INFLAR MÁS ALLÁ DE LOS 300 MMHG.
NO EXPONER EL BRAZALETE A LA RADIACIÓN SOLAR INTENSA.
SIEMPRE DESINFLE EL BRAZALETE COMPLETAMENTE ANTES DE GUARDARLO.
EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA DESARME O DESMANTELE EL MANÓMETRO.
LIMPIE EL MANÓMETRO Y LA PERA CON UN PAÑO HÚMEDO, NO ES NECESARIA LA ESTERILIZACIÓN, DADO QUE LAS PARTES NO ENTRAN EN CONTACTO DIRECTO CON EL CUERPO DEL PACIENTE.
EL BRAZALETE PUEDE SER LAVADO CON JABÓN Y AGUA FRÍA. DEJARLO SECAR AL AIRE.

HOSPITAL SAN VICENTE
ROVIRA TOLIMA



HOJA DE VIDA DE EQUIPO

EQUIPO: TENSIOMETRO ADULTO	MARCA: LENZ	MODELO: XB 11300
SERIE: 2023061773	CLASIFICACION DE DISPOSITIVO MEDICO: Riesgo Bajo (IIA) DIAGNOSTICO	
FECHA DE COMPRA: 13-12-2024	FECHA DE INSTALACION: 13-12-2024	VENCIMIENTO DE GARANTIA: UN AÑO
DATOS DEL PROVEEDOR: OSMEC AMBULANCIA		TELEFONO: 3153083450

PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO: ANUAL	UBICACIÓN: AMBULANCIA PLACA NXY 747	EQUIPO:	MOVIL X	FIJO	

REGISTRO INVIMA :	2021DM-0024553

FUNCIONES: Este equipo ejerce una fuerza mecanica alrededor del brazo de un paciente con el fin de medir su tension arterial. Utiliza un manometro de aguja, semejante a un reloj

RECOMENDACIONES DE FABRICANTE:

- Verificar fugas antes de su uso.
- Verificarcion de prueba de cero.

REGISTRO TECNICO DE INSTALACION

VOLTAJE: no	CORRIENTE: no	FRECUENCIA: no
PESO: 500 grm	TECNOLOGIA PREDOMINANTE: Manual	

REGISTRO TECNICO DE FUNCIONAMIENTO

PACIENTE: ADULTO	CAPACIDAD MAXIMA: 300 mmHg

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PLANIFICADO SEGÚN PARAMETROS DE FABRICANTE

EQUIPO	TENSIOMETRO
MARCA	LENZ
MODELO	XB11300
SERIE	2023061773
N° INVENTARIO	

- Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo
- Efectuar limpieza integral externa del equipo
- Efectuar limpieza integral interna del equipo
- Verificación del manómetro
- Chequeo de la pera
- Verificación del brazalete (sin aberturas)
- Chequeo de mangueras
- Enjuague continuamente con agua destilada durante cinco minutos
- A presión cero, asegúrese que el puntero esta dentro del ovalo que rodea la gradación de presión cero en el dial.

Material Gastable	Repuestos Minimos	Herramientas y Equipos
• Franela • Limpiador de superficies liquido		• Manometro diferencial

BIOMEDICAL SOLUTIONS
INGENIERIA

NIT. 53116519-2
REGIMEN COMUN

REPORTE DE SERVICIO

FECHA:	12/12/2024	**REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO**		HORA INICIO:	9:30
INSTITUCION:	HOSPITAL SAN VICENTE	PROCESO:	AMBULANCIA	AREA:	MOVIL NXY 747

DATOS DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	TENSIOMETRO ADULTO			MARCA:	LENZ
SERIE:	2.023.061.773	MODELO:	XB 11300	INV. N°.:	

ACCESORIOS DEL EQUIPO

BRAZALETE DE DOS VIAS, MANOMETRO, VALVULA REGULADORA Y PERILLA INSUFLADORA

DIAGNOSTICO INICIAL

	ESTADO		CONDICIONES AMBIENTALES DE USO SEGÚN LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE			
1	FISICO	BUENO	HUMEDAD:	46%	T°:	24,2 °C
2	FUNCIONAMIENTO	BUENO	SEGURIDAD DE LA INSTALACION:			
3	BATERIAS	N/A	EQUIPO NUEVO, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO			
4	ACCESORIOS	BUENO				

DESCRIPCION DEL SERVICIO

LIMPIEZA INTERNA	☐	LIMPIEZA EXTERNA	☐	DESINFECCION	☐	DESMANCHADO	☐
LIMPIEZA CONTACTOS	☐	LUBRICACION	☐	ENGRASE	☐	REEMPLAZO DE PARTES	☐

Se realiza hoja de vida

ELEMENTOS UTILIZADOS:

PRUEBAS FUNCIONALES

VERIFICACION DE:

SISTEMA ELECTRICO	☐	ENCENDIDO	☐	CONFIGURACION A TRAVES DEL MENU	☐
SISTEMA MECANICO	X	ACCESORIOS	X	FUNCIONAMIENTO DEL DISPLAY, PANTALLA	☐
SISTEMA HIDRAULICO	☐	ALARMAS VISUAL	☐	FUNCIONAMIENTO DEL MANOMETRO	X
SISTEMA NEUMATICO	X	ALARMAS AUDIBLES	☐	FUNCIONAMIENTO DEL TECLADO, PERILLAS, CONTROLES	☐
VIDA DE LA BATERIA	☐	FUGAS	X	TARJETAS ELECTRONICAS Y CONECTORES	☐
SEGURIDAD ELECTRICA	☐	FILTROS	☐	EMPAQUES	☐
PRUEBAS DE FABRICA	☐	BOMBILLOS	☐	NIVELES DE FLUJO	☐
		ALMACENAMIENTO DE DATOS Y MEMORIA	☐	NIVELES DE PRESION	X

REPUESTOS UTILIZADOS

OBSERVACIONES

EQUIPO NUEVO LISTO PARA USAR

EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE	SI	X	NO	☐	HORA FINAL: 9:40
FECHA DEL PROXIMO MANTENIMIENTO:	dic-25				

ING. BIOMEDICO

FUNCIONARIO ENCARGADO

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2021050475 DE 12 de Noviembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005.

CONSIDERANDO

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMATICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.
EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARA EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS A

PRODUCTO:	ANEROID SPHYGMOMANOMETER - MEDIDOR DE PRESIÓN ARTERIAL-MEDIDOR DE PRESIÓN ARTERIAL
MARCA:	LENZ DIAGNOSTIC, LIFEN DIAGNOSTIC, ROSH DIAGNOSTIC, LORD.
REGISTRO SANITARIO NO.:	**INVIMA 2021DM-0024553**
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	G4 MEDICAL S.A.S CON DOMICILIO EN CALI - VALLE
FABRICANTE(S):	WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD CON DOMICILIO EN CHINA
IMPORTADOR(ES):	G4 MEDICAL S.A.S CON DOMICILIO EN CALI - VALLE
ACONDICIONADOR(ES):	G4 MEDICAL S.A.S CON DOMICILIO EN CALI - VALLE
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO:	NO INVASIVO I

COMPOSICIÓN:

PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO	COMPOSICIÓN CUALITATIVA
PERA	CON O SIN LÁTEX.
CÁMARA	CON O SIN LÁTEX.
BRAZALETE	
AURICULAR DEL MEDIDOR DE PRESIÓN ARTERIAL	
TUBO DEL MEDIDOR DE PRESIÓN ARTERIAL	
CABEZAL DEL MEDIDOR DE PRESIÓN ARTERIAL	

USOS:	SE UTILIZA PARA MEDIR LA PRESIÓN ARTERIAL DEL CUERPO HUMANO.
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	EMPAQUE INDIVIDUAL
OBSERVACIONES:	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS

FAMILIA	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA
MEDIDOR DE PRESIÓN ARTERIAL	SS-20C, SS-20A, SS-50D, SS-50B.

EXPEDIENTE NO.:	20215002
RADICACIÓN NO.:	20211232867
FECHA DE RADICACION.:	04 11 2021

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2021050475 DE 12 de Noviembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005.

ARTICULO SEGUNDO.- CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE LA DIRECCION DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

ARTICULO TERCERO.- LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

ARTICULO CUARTO.- LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 2005.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN BOGOTÁ D.C. A LOS 12 DE NOVIEMBRE DE 2021
ESTE ESPACIO, HASTA LA FIRMA SE CONSIDERA EN BLANCO.

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTOR(A) TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
PROYECTO: LEGAL: FMOSCOSOM, TÉCNICO: JGILV , REVISÓ:CORDINA_VARIOSJPACHECO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2023**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario
8820230000772l5-4

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 901148750 | 6. DV: 0 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: G 4 MEDICAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

13. Dirección: CL 13 65 B 16 BRR EL LIMONAR | 15. Teléfono: 3104891979 | 82. Cód. Admón.: 88 | 16. Cód. Dpto: 76 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 800254610 | 25. DV: 5 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS AGECOLDEX S.A NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 28 | 28. Cód. usuario: 0001

29. Número documento de identificación: 1113646176 | 30. Apellidos y nombres: HUERTAS GUACA MONICA ANDREA

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BUN	4803	No. 116575013694115	2023 - 08 - 31	No. KYBUEH2300438	2023 - 07 - 28

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior | 47. Ciudad | 48. Cod.País Exportador: 215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior | 50. E-mail: 86 21 57753176

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Sanders	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
23S035	2023 - 07 - 28	215	1	434	76		4,099.20

S

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Medidas	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Aduana
9018909090	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	215	XXX

69. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	215			YY	95	1	U	.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
000.00	

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
	0.00

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código régimen o licencia	86. Número
	R	50161933

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód interno del Producto
3	2022	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 .00	93	94	95 0	96 0
I.V.A.	97 .00	98	99	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Recaie	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125		126 0

91. Descripción de las mercancías: No marque la descripción de las mercancías a importar con la no validez en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluye marcas, serie/s y otros) (Si el espacio es insuficiente continúe en hoja anexa)

DO_ 01231786 PEDIDOS_ SST-2307_2308 DI_ 1 DE 2 PRODUCTO: KIT DE FONENDOSCOPIO Y TENSIÓMETRO. MARCA: LENI. MODELO: GZ-50. REFERENC
IA: GZ-50. SERIAL: 2023060001 2023060002 2023060003 2023060004 2023060005 2023060006 2023060007
2023060008 2023060009 2023060010 2023060011 2023060012 2023060013 2023060014 2023060015
2023060016 2023060017 2023060018 2023060019 2023060020 2023060021 2023060022 2023060023
2023060024 2023060025 2023060026 2023060027 2023060028 2023060029 2023060030 2023060031
2023060032 2023060033 2023060034 2023060035 2023060036 2023060037 20230600 (continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración: 8820230000772l5 133. Fecha: 2023 09 08
134. Levante No. 8820230000675l66	135. Fecha: 2023 - 09 - 11	Firma funcionario diligenciador / 136. Nombre / 137. C.C. No.

Firma declarante

Agencia de Aduanas Agecoldex S.A. Nivel 1

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

9108012008837

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 882023000077215-4
Subpartida : 9018909090

108. Continuación descripción mercancías (incluye marcas, seriales y otros)

38	2023060039	2023060040	2023060041	2023060042	2023060043	2023060044	2023060045	20230600
46	2023060047	2023060048	2023060049	2023060050	2023060051	2023060052	2023060053	20230600
54	2023060055	2023060056	2023060057	2023060058	2023060059	2023060060	2023060061	20230600
62	2023060063	2023060064	2023060065	2023060066	2023060067	2023060068	2023060069	20230600
70	2023060071	2023060072	2023060073	2023060074	2023060075	2023060076	2023060077	20230600
78	2023060079	2023060080	2023060081	2023060082	2023060083	2023060084	2023060085	20230600
86	2023060087	2023060088	2023060089	2023060090	2023060091	2023060092	2023060093	20230600
94	2023060095	2023060096	2023060097	2023060098	2023060099	2023060100	2023060101	20230601
02	2023060103	2023060104	2023060105	2023060106	2023060107	2023060108	2023060109	20230601
10	2023060111	2023060112	2023060113	2023060114	2023060115	2023060116	2023060117	20230601
18	2023060119	2023060120	2023060121	2023060122	2023060123	2023060124	2023060125	20230601
26	2023060127	2023060128	2023060129	2023060130	2023060131	2023060132	2023060133	20230601
34	2023060135	2023060136	2023060137	2023060138	2023060139	2023060140	2023060141	20230601
42	2023060143	2023060144	2023060145	2023060146	2023060147	2023060148	2023060149	20230601
50	2023060151	2023060152	2023060153	2023060154	2023060155	2023060156	2023060157	20230601
58	2023060159	2023060160	2023060161	2023060162	2023060163	2023060164	2023060165	20230601
66	2023060167	2023060168	2023060169	2023060170	2023060171	2023060172	2023060173	20230601
74	2023060175	2023060176	2023060177	2023060178	2023060179	2023060180	2023060181	20230601
82	2023060183	2023060184	2023060185	2023060186	2023060187	2023060188	2023060189	20230601
90	2023060191	2023060192	2023060193	2023060194	2023060195	2023060196	2023060197	20230601
98	2023060199	2023060200	2023060201	2023060202	2023060203	2023060204	2023060205	20230602
06	2023060207	2023060208	2023060209	2023060210	2023060211	2023060212	2023060213	20230602
14	2023060215	2023060216	2023060217	2023060218	2023060219	2023060220	2023060221	20230602
22	2023060223	2023060224	2023060225	2023060226	2023060227	2023060228	2023060229	20230602
30	2023060231	2023060232	2023060233	2023060234	2023060235	2023060236	2023060237	20230602
38	2023060239	2023060240	2023060241	2023060242	2023060243	2023060244	2023060245	20230602
46	2023060247	2023060248	2023060249	2023060250	2023060251	2023060252	2023060253	20230602
54	2023060255	2023060256	2023060257	2023060258	2023060259	2023060260	2023060261	20230602
62	2023060263	2023060264	2023060265	2023060266	2023060267	2023060268	2023060269	20230602
70	2023060271	2023060272	2023060273	2023060274	2023060275	2023060276	2023060277	20230602
78	2023060279	2023060280	2023060281	2023060282	2023060283	2023060284	2023060285	20230602
86	2023060287	2023060288	2023060289	2023060290	2023060291	2023060292	2023060293	20230602
94	2023060295	2023060296	2023060297	2023060298	2023060299	2023060300	2023060301	20230603
02	2023060303	2023060304	2023060305	2023060306	2023060307	2023060308	2023060309	20230603
10	2023060311	2023060312	2023060313	2023060314	2023060315	2023060316	2023060317	20230603
18	2023060319	2023060320	2023060321	2023060322	2023060323	2023060324	2023060325	20230603
26	2023060327	2023060328	2023060329	2023060330	2023060331	2023060332	2023060333	20230603
34	2023060335	2023060336	2023060337	2023060338	2023060339	2023060340	2023060341	20230603
42	2023060343	2023060344	2023060345	2023060346	2023060347	2023060348	2023060349	20230603
50	2023060351	2023060352	2023060353	2023060354	2023060355	2023060356	2023060357	20230603
58	2023060359	2023060360	2023060361	2023060362	2023060363	2023060364	2023060365	20230603
66	2023060367	2023060368	2023060369	2023060370	2023060371	2023060372	2023060373	20230603
74	2023060375	2023060376	2023060377	2023060378	2023060379	2023060380	2023060381	20230603
82	2023060383	2023060384	2023060385	2023060386	2023060387	2023060388	2023060389	20230603
90	2023060391	2023060392	2023060393	2023060394	2023060395	2023060396	2023060397	20230603
98	2023060399	2023060400	2023060401	2023060402	2023060403	2023060404	2023060405	20230604
06	2023060407	2023060408	2023060409	2023060410	2023060411	2023060412	2023060413	20230604
14	2023060415	2023060416	2023060417	2023060418	2023060419	2023060420	2023060421	20230604
22	2023060423	2023060424	2023060425	2023060426	2023060427	2023060428	2023060429	20230604
30	2023060431	2023060432	2023060433	2023060434	2023060435	2023060436	2023060437	20230604
38	2023060439	2023060440	2023060441	2023060442	2023060443	2023060444	2023060445	20230604
46	2023060447	2023060448	2023060449	2023060450	2023060451	2023060452	2023060453	20230604
54	2023060455	2023060456	2023060457	2023060458	2023060459	2023060460	2023060461	20230604
62	2023060463	2023060464	2023060465	2023060466	2023060467	2023060468	2023060469	20230604
70	2023060471	2023060472	2023060473	2023060474	2023060475	2023060476	2023060477	20230604
78	2023060479	2023060480	2023060481	2023060482	2023060483	2023060484	2023060485	20230604
86	2023060487	2023060488	2023060489	2023060490	2023060491	2023060492	2023060493	20230604
94	2023060495	2023060496	2023060497	2023060498	2023060499	2023060500	2023060501	20230605
02	2023060503	2023060504	2023060505	2023060506	2023060507	2023060508	2023060509	20230605
10	2023060511	2023060512	2023060513	2023060514	2023060515	2023060516	2023060517	20230605
18	2023060519	2023060520	2023060521	2023060522	2023060523	2023060524	2023060525	20230605
26	2023060527	2023060528	2023060529	2023060530	2023060531	2023060532	2023060533	20230605
34	2023060535	2023060536	2023060537	2023060538	2023060539	2023060540	2023060541	20230605
42	2023060543	2023060544	2023060545	2023060546	2023060547	2023060548	2023060549	20230605
50	2023060551	2023060552	2023060553	2023060554	2023060555	2023060556	2023060557	20230605
58	2023060559	2023060560	2023060561	2023060562	2023060563	2023060564	2023060565	20230605
66	2023060567	2023060568	2023060569	2023060570	2023060571	2023060572	2023060573	20230605
74	2023060575	2023060576	2023060577	2023060578	2023060579	2023060580	2023060581	20230605
82	2023060583	2023060584	2023060585	2023060586	2023060587	2023060588	2023060589	20230605
90	2023060591	2023060592	2023060593	2023060594	2023060595	2023060596	2023060597	20230605
98	2023060599	2023060600	2023060601	2023060602	2023060603	2023060604	2023060605	20230606
06	2023060607	2023060608	2023060609	2023060610	2023060611	2023060612	2023060613	20230606
14	2023060615	2023060616	2023060617	2023060618	2023060619	2023060620	2023060621	20230606
22	2023060623	2023060624	2023060625	2023060626	2023060627	2023060628	2023060629	20230606
30	2023060631	2023060632	2023060633	2023060634	2023060635	2023060636	2023060637	20230606

882023000077215-4

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

105. Continuación descripción mercancías (incluye marcas, serales y otros)

38	2023060639	2023060640	2023060641	2023060642	2023060643	2023060644	2023060645	20230606
46	2023060647	2023060648	2023060649	2023060650	2023060651	2023060652	2023060653	20230606
54	2023060655	2023060656	2023060657	2023060658	2023060659	2023060660	2023060661	20230606
62	2023060663	2023060664	2023060665	2023060666	2023060667	2023060668	2023060669	20230606
70	2023060671	2023060672	2023060673	2023060674	2023060675	2023060676	2023060677	20230606
78	2023060679	2023060680	2023060681	2023060682	2023060683	2023060684	2023060685	20230606
86	2023060687	2023060688	2023060689	2023060690	2023060691	2023060692	2023060693	20230606
94	2023060695	2023060696	2023060697	2023060698	2023060699	2023060700	2023060701	20230607
02	2023060703	2023060704	2023060705	2023060706	2023060707	2023060708	2023060709	20230607
10	2023060711	2023060712	2023060713	2023060714	2023060715	2023060716	2023060717	20230607
18	2023060719	2023060720	2023060721	2023060722	2023060723	2023060724	2023060725	20230607
26	2023060727	2023060728	2023060729	2023060730	2023060731	2023060732	2023060733	20230607
34	2023060735	2023060736	2023060737	2023060738	2023060739	2023060740	2023060741	20230607
42	2023060743	2023060744	2023060745	2023060746	2023060747	2023060748	2023060749	20230607
50	2023060751	2023060752	2023060753	2023060754	2023060755	2023060756	2023060757	20230607
58	2023060759	2023060760	2023060761	2023060762	2023060763	2023060764	2023060765	20230607
66	2023060767	2023060768	2023060769	2023060770	2023060771	2023060772	2023060773	20230607
74	2023060775	2023060776	2023060777	2023060778	2023060779	2023060780	2023060781	20230607
82	2023060783	2023060784	2023060785	2023060786	2023060787	2023060788	2023060789	20230607
90	2023060791	2023060792	2023060793	2023060794	2023060795	2023060796	2023060797	20230607
98	2023060799	2023060800	2023060801	2023060802	2023060803	2023060804	2023060805	20230608
06	2023060807	2023060808	2023060809	2023060810	2023060811	2023060812	2023060813	20230608
14	2023060815	2023060816	2023060817	2023060818	2023060819	2023060820	2023060821	20230608
22	2023060823	2023060824	2023060825	2023060826	2023060827	2023060828	2023060829	20230608
30	2023060831	2023060832	2023060833	2023060834	2023060835	2023060836	2023060837	20230608
38	2023060839	2023060840	2023060841	2023060842	2023060843	2023060844	2023060845	20230608
46	2023060847	2023060848	2023060849	2023060850	2023060851	2023060852	2023060853	20230608
54	2023060855	2023060856	2023060857	2023060858	2023060859	2023060860	2023060861	20230608
62	2023060863	2023060864	2023060865	2023060866	2023060867	2023060868	2023060869	20230608
70	2023060871	2023060872	2023060873	2023060874	2023060875	2023060876	2023060877	20230608
78	2023060879	2023060880	2023060881	2023060882	2023060883	2023060884	2023060885	20230608
86	2023060887	2023060888	2023060889	2023060890	2023060891	2023060892	2023060893	20230608
94	2023060895	2023060896	2023060897	2023060898	2023060899	2023060900	2023060901	20230609
02	2023060903	2023060904	2023060905	2023060906	2023060907	2023060908	2023060909	20230609
10	2023060911	2023060912	2023060913	2023060914	2023060915	2023060916	2023060917	20230609
18	2023060919	2023060920	2023060921	2023060922	2023060923	2023060924	2023060925	20230609
26	2023060927	2023060928	2023060929	2023060930	2023060931	2023060932	2023060933	20230609
34	2023060935	2023060936	2023060937	2023060938	2023060939	2023060940	2023060941	20230609
42	2023060943	2023060944	2023060945	2023060946	2023060947	2023060948	2023060949	20230609
50	2023060951	2023060952	2023060953	2023060954	2023060955	2023060956	2023060957	20230609
58	2023060959	2023060960	2023060961	2023060962	2023060963	2023060964	2023060965	20230609
66	2023060967	2023060968	2023060969	2023060970	2023060971	2023060972	2023060973	20230609
74	2023060975	2023060976	2023060977	2023060978	2023060979	2023060980	2023060981	20230609
82	2023060983	2023060984	2023060985	2023060986	2023060987	2023060988	2023060989	20230609
90	2023060991	2023060992	2023060993	2023060994	2023060995	2023060996	2023060997	20230609
98	2023060999	2023061000	2023061001	2023061002	2023061003	2023061004	2023061005	20230610
06	2023061007	2023061008	2023061009	2023061010	2023061011	2023061012	2023061013	20230610
14	2023061015	2023061016	2023061017	2023061018	2023061019	2023061020	2023061021	20230610
22	2023061023	2023061024	2023061025	2023061026	2023061027	2023061028	2023061029	20230610
30	2023061031	2023061032	2023061033	2023061034	2023061035	2023061036	2023061037	20230610
38	2023061039	2023061040	2023061041	2023061042	2023061043	2023061044	2023061045	20230610
46	2023061047	2023061048	2023061049	2023061050	2023061051	2023061052	2023061053	20230610
54	2023061055	2023061056	2023061057	2023061058	2023061059	2023061060	2023061061	20230610
62	2023061063	2023061064	2023061065	2023061066	2023061067	2023061068	2023061069	20230610
70	2023061071	2023061072	2023061073	2023061074	2023061075	2023061076	2023061077	20230610
78	2023061079	2023061080	2023061081	2023061082	2023061083	2023061084	2023061085	20230610
86	2023061087	2023061088	2023061089	2023061090	2023061091	2023061092	2023061093	20230610
94	2023061095	2023061096	2023061097	2023061098	2023061099	2023061100	2023061101	20230611
02	2023061103	2023061104	2023061105	2023061106	2023061107	2023061108	2023061109	20230611
10	2023061111	2023061112	2023061113	2023061114	2023061115	2023061116	2023061117	20230611
18	2023061119	2023061120	2023061121	2023061122	2023061123	2023061124	2023061125	20230611
26	2023061127	2023061128	2023061129	2023061130	2023061131	2023061132	2023061133	20230611
34	2023061135	2023061136	2023061137	2023061138	2023061139	2023061140	2023061141	20230611
42	2023061143	2023061144	2023061145	2023061146	2023061147	2023061148	2023061149	20230611
50	2023061151	2023061152	2023061153	2023061154	2023061155	2023061156	2023061157	20230611
58	2023061159	2023061160	2023061161	2023061162	2023061163	2023061164	2023061165	20230611
66	2023061167	2023061168	2023061169	2023061170	2023061171	2023061172	2023061173	20230611
74	2023061175	2023061176	2023061177	2023061178	2023061179	2023061180	2023061181	20230611
82	2023061183	2023061184	2023061185	2023061186	2023061187	2023061188	2023061189	20230611
90	2023061191	2023061192	2023061193	2023061194	2023061195	2023061196	2023061197	20230611
98	2023061199	2023061200	2023061201	2023061202	2023061203	2023061204	2023061205	20230612
06	2023061207	2023061208	2023061209	2023061210	2023061211	2023061212	2023061213	20230612
14	2023061215	2023061216	2023061217	2023061218	2023061219	2023061220	2023061221	20230612
22	2023061223	2023061224	2023061225	2023061226	2023061227	2023061228	2023061229	20230612
30	2023061231	2023061232	2023061233	2023061234	2023061235	2023061236	2023061237	20230612

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

108. Continuación descripción mercancías (incluye marcas, serialas y otros)

38	2023062439	2023062440	2023062441	2023062442	2023062443	2023062444	2023062445	20230624
46	2023062447	2023062448	2023062449	2023062450	2023062451	2023062452	2023062453	20230624
54	2023062455	2023062456	2023062457	2023062458	2023062459	2023062460	2023062461	20230624
62	2023062463	2023062464	2023062465	2023062466	2023062467	2023062468	2023062469	20230624
70	2023062471	2023062472	2023062473	2023062474	2023062475	2023062476	2023062477	20230624
78	2023062479	2023062480	2023062481	2023062482	2023062483	2023062484	2023062485	20230624
86	2023062487	2023062488	2023062489	2023062490	2023062491	2023062492	2023062493	20230624
94	2023062495	2023062496	2023062497	2023062498	2023062499	2023062500	2023062501	20230625
02	2023062503	2023062504	2023062505	2023062506	2023062507	2023062508	2023062509	20230625
10	2023062511	2023062512	2023062513	2023062514	2023062515	2023062516	2023062517	20230625
18	2023062519	2023062520	2023062521	2023062522	2023062523	2023062524	2023062525 . USD O DESTI	

NO: KIT COMPUESTO DE DOS DISPOSITIVOS UTILIZADOS EN CONJUNTO PARA DETERMINAR LA TENSIÓN ARTERIAL SISTÓLICA Y DIASTÓLICA EN HUMANO S (EL TENSIÓMETRO, QUE ES EL QUE INTERPRETA O ARROJA PROPIAMENTE LA INFORMACIÓN SOBRE LA PRESIÓN Y UN FONENDOSCOPIO QUE SE EMPLEA PARA ESCUCHAR LOS SONIDOS PROCEDENTES PRINCIPALMENTE DEL CORAZÓN Y DE LOS PULMONES).. TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO: NO TIENE. KIT DE E SFIGMOMANÓMETRO CON ESTETOSCOPIO. (KIT FORMADO POR ESTETOSCOPIO CVL NO. 20190443 Y ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE MODELO XB.11.300 CVL NO. 20200989).REGISTRO SANITARIO. NÚMERO DEL REGISTRO SANITARIO_ INVIMA 2021DM-0024553. VIGENTE HASTA_ 12-11-2031.EXPEDIENTE_ 20 215002. NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAIS DE ORIGEN_ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD CON DOMICILIO EN CHINA. NOMBRE COMERCI AL: KIT DE FONENDOSCOPIO Y TENSIÓMETRO. SPHYGMOMANOMETER KIT WITHRAPPAPORT STETHOSCOPE. , CANTIDAD: 2525 PIEZA, 2525 UNIDADES/XXX

BIOMEDICAL SOLUTIONS

NIT. 53116519-2
REGIMEN COMUN
DIAG. 5ª No. 37B 60 BLOQUE 15ª APTO. 503
BOGOTA – COLOMBIA

Certificado N° MP-700-24

INFORMACION DEL SOLICITANTE
Customer information

CLIENTE: HOSPITAL SAN VICENTE
Client

CIUDAD: ROVIRA **(TOLIMA)**
City

INFORMACION DEL EQUIPO BAJO PRUEBA.
Device under test information.

EQUIPO: TENSIOMETRO
Equipment
MARCA: LENZ
Brand
MODELO: XB 11300
Model
SERIE: 2023061773
Serial
ID. Institución:
ID. Institution

LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRUEBA
Place and conditions of test

Lugar de la Calibración: Laboratorio de metrología
Place of Calibration
Fecha de Calibración: 2024-12-12
Date of Calibration
Fecha de Recepción: 2024-12-06
Date of Receipt
TEMPERATURA: 19 °C
Temperature
HUMEDAD R: 61 %
Humidity

NOTAS:
Notes:

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso escrito de BIOMEDICAL SOLUTIONS.
Los resultados contenidos en el presente documento se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos probados.
El usuario es responsable del seguimiento de sus instrumentos a intervalos apropiados.

FIRMA:

FABIAN ALFONSO ARCE RAMIREZ
INGENIERO DE CALIBRACION

BIOMEDICAL SOLUTIONS

Certificado N° MP-700-24

Trabajo realizado:
Calibración del equipo

Método utilizado:
Comparación directa según procedimiento me003 del CEM. La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura K=2

Información de Trazabilidad
Nuestros instrumentos son trazables a estándares internacionales

Información de los instrumentos utilizados

PATRON	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA CALIBRACION	CERTIFICADO
MANOMETRO DE PRESION DIGITAL	NO REGISTRA	LK-168ª	01713093	2024-10-12	C5425-24

RESULTADOS DE CALIBRACION

Posición del item y el patrón durante la calibración: HORIZONTAL
Estado de la caratula y aguja indicadora/display: En buen estado
Comprobación de fugas: sistema neumático sin fugas
Escala del item: 2mmHg

COMPROBACION INICIAL EN TRES PUNTOS		
PRESION INDICADA EN EL ITEM (mmHg)		PRESION INDICADA EN EL PATRON (mmHg)
PUNTO BAJO	100	100,1
PUNTO MEDIO	150	150,1
PUNTO ALTO	300	300,1

MEDICIONES DE PRESION (mmHg)				
PROMEDIO DE PRESION INDICADA EN EL ITEM (mmHg)	PRESION INDICADA EN EL PATRON (mmHg)	ERROR (mmHg)	INCERTIDUMBRE (mmHg)	
0	0,0	0,0	±	0,70
50	50,1	0,1	±	0,71
100	100,1	0,1	±	0,71
150	150,1	0,1	±	0,71
200	200,2	0,2	±	0,72
250	250,2	0,2	±	0,72
300	300,2	0,2	±	0,72

ERROR MAXIMO: 0,2 mmHg
INCERTIDUMBRE MAXIMA: +/- 0,72 mmHg

La unidad de presión en el Sistema Internacional de Unidades es el Pascal: 1 mmHg = 133,322 Pa

Anomalías detectadas antes y durante la calibración: NINGUNA

FIN DEL CERTIFICADO

SET GAD Metrología

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-004

NVLAP CALIBRATION
NVLAP LAB CODE 201065-0

ilac-MRA

Certificado de Calibración

Certificado #
C5425-24

Laboratorio de Metrología Set y Gad S.A.S. — Bogotá

Descripción del equipo:	Manómetro de Presión digital	Condición como se recibió:	Operable
Fabricante:	LK-168A	Fecha de calibración:	2024-10-12
Serie No.:	01713093	Método de Calibración:	LAB-SIMSV-060
Nombre del cliente:	Biomedical Solutions	Temperatura:	21,6 °C
Dirección:	Diag. 5A N°37b60	Humedad:	51%
Ciudad:	BOGOTA		
Fecha de recepción	2024-10-02		

Patrones de calibración

Instrumento	Número de Serie	Due Date	ID Certificado
PATRON DE PRESION	34794	02/03/2023	FP021-23

Descripción de la calibración

La calibración del equipo bajo prueba se hace con un instrumento patrón trazable al sistema internacional de unidades... Los resultados emitidos en este certificado de calibración, describe al equipo bajo prueba en el momento que está siendo calibrado.
Este certificado de calibración no puede ser reproducido ni parcial ni de forma completa, sin la aprobación escrita del laboratorio SET & GAT.
Calibración: Datos de calibración obtenidos sin haber realizado ninguna clase de ajustes y/o reparación.
Set & Gad mantiene los patrones de referencia en condiciones físicas adecuadas para su conservación, estos patrones han sido calibrados con trazabilidad internacional o nacional, bajo estándares definidos por casa matriz, dependiendo de sus especificaciones.
El usuario es responsable de la caliración de sus instrumentos a intervalos adecuados.

S-G Metrología

Digitally signed by Felipe Uribe
DN: cn=Felipe Uribe, o=Set y Gad SAS, email=felipe.urib@esetgad.com, c=CO

Revisó y autorizó calibración
Ing. Luis Felipe Uribe Agudelo

Carrera 48 # 101 A - 69, Bogotá, Colombia
www.setgad.com

DIOS AYUDA A QUIEN CONFÍA EN ÉL

SET∝GAD Metrología

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-004

NVLAP CALIBRATION
NVLAP LAB CODE 201065-0

ilac-MRA

Certificado de Calibración

Certificado #
C5425-24

RESULTADOS DE LA MEDICION

Calibración de Presión

Precarga	IBC mmHg	Patrón mmHg	Corrección mmHg	Incertidumbre mmHg	k
300,0 mmHg	300	296,7	-3,3	0,72	2
Nominal	IBC mmHg	Patrón mmHg	Corrección mmHg	Incertidumbre mmHg	k
0,0 mmHg	0	0	0	0,58	2
50,0 mmHg	50	50,8	0,8	0,58	2
100,0 mmHg	100	100,7	0,7	0,58	2
150,0 mmHg	150	149,4	-0,6	0,58	2
200,0 mmHg	200	199,4	-0,6	0,58	2
250,0 mmHg	250	247,6	-2,4	0,58	2
300,0 mmHg	300	297,6	-2,4	0,72	2

Medición 1 mmHg	Medición 2 mmHg	Medición 3 mmHg	Medición 4 mmHg	Medición 5 mmHg
0	0	0	0	N/A
50,8	50,2	50,1	50,3	N/A
100,7	100,2	100,1	100,4	N/A
149,4	149,1	149,2	149,2	N/A
199,4	199,6	199,7	199,4	N/A
247,6	247,7	247,2	247,5	N/A
297,6	297,2	296,5	296,9	N/A

FIN DEL CERTIFICADO

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

Código	F-BIO-001
Versión	1
Fecha	Febrero 2017
Página	1 de 1

1. INFORMACION DE EQUIPO

EQUIPO	TENSIÓMETRO DIGITAL			REGISTRO INVIMA	-		
MARCA	DB LIFE			SERVICIO	TAB		
MODELO	BP369A			UBICACIÓN	AMB. NXY747		
SERIE	WZ 4040 9023 01			CALIBRACIÓN	NO REQUIERE		
N.° INVENTARIO				TIPO DE EQUIPO	FIJO		MOVIL X
FECHA DE COMPRA	13/12/2024	FECHA INSTALACION	13/12/2024	GARANTIA			
EQUIPO PROPIO		EQUIPO COMODATO		DONACION			

2. FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO

MENSUAL		BIMENSUAL		TRIMESTRAL		CUATRIMESTRAL	X	SEMESTRAL		ANUAL	

REGISTRO FOTOGRAFICO	ACCESORIOS	
	CANTIDAD	ACCESORIO
		

3. CARACTERISTICAS TECNICAS

VOLTAJE	4XAA	CORRIENTE	N/A	POTENCIA	N/A	FRECUENCIA	N/A	TEMP. DE TRABAJO	

CLASIFICACION RIESGO SEGUN 4725 DE 2005		CLASIFICACION DE USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		TECNOLOGIA PREDOMINANTE			
				DIAGNOSTICO	X				
				MTTO DE LA VIDA		ELECTRICO		NEUMATICO	
RIESGO I	X	MEDICO		PREVENCION		ELECTRONICO	X	ACUSTICO	
RIESGO IIA		BASICO	X	REHABILITACIÓN		ELECTROMECANICO		SOLAR	
RIESGO IIB		APOYO		EQ. LABORATORIO		MECANICO		VAPOR	
RIESGO III		OTRO		EQ. ODONTOLOGIA		HIDRAULICO		OTRO	

4. RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

DEJE QUE EL USUARIO REPOSE UN MOMENTO ANTES DE TOMAR LA TENSIÓN-
SI NO SE VA A USAR EL EQUIPO RETIRE LAS BATERIAS PARA EVITAR QUE SE SULFATEN EN EL EQUIPO.

HOSPITAL SAN VICENTE
ROVIRA TOLIMA



HOJA DE VIDA DE EQUIPO

EQUIPO: TENSIOMETRO DIGITAL	MARCA: DB LIFE	MODELO: BP369A
SERIE: WZ 4040 9023 01	CLASIFICACION DE DISPOSITIVO MEDICO: Riesgo Bajo (IIA) DIAGNOSTICO	
FECHA DE COMPRA: 13-12-2024	FECHA DE INSTALACION: 13-12-2024	VENCIMIENTO DE GARANTIA: DOS AÑOS
DATOS DEL PROVEEDOR: OSMEC AMBULANCIA		TELEFONO: 3153083450

PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO: ANUAL	UBICACIÓN: AMBULANCIA PLACA NXY 747	EQUIPO:	MOVIL X	FIJO	

REGISTRO INVIMA :

FUNCIONES: Este equipo ejerce una fuerza mecanica alrededor del brazo de un paciente con el fin de medir su tension arterial. Utiliza electrovalvulas para insuflar el brazalete de manera automatica

RECOMENDACIONES DE FABRICANTE:

- Verificar fugas antes de su uso.
- Verificarcion del nivel de carga.

REGISTRO TECNICO DE INSTALACION

VOLTAJE: 6 V	CORRIENTE: 0,4 A	FRECUENCIA: N/A
PESO: 500 grm	TECNOLOGIA PREDOMINANTE: Digital	

REGISTRO TECNICO DE FUNCIONAMIENTO

PACIENTE: ADULTO	CAPACIDAD MAXIMA: 270 mmHg

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PLANIFICADO SEGÚN PARAMETROS DE FABRICANTE

EQUIPO	TENSIOMETRO
MARCA	DB LIFE
MODELO	BP369A
SERIE	WZ4040 9023 01
N° INVENTARIO	

- Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo
- Efectuar limpieza integral externa del equipo
- Efectuar limpieza integral interna del equipo
- Verificación del nivel de la batería
- Verificación del brazalete (sin aberturas)
- Chequeo de manguera

Material Gastable	Repuestos Minimos	Herramientas y Equipos
• Franela • Limpiador de superficies liquido	Brazalete pilas AA (4)	• Manometro diferencial

BIOMEDICAL SOLUTIONS
INGENIERIA

NIT. 53116519-2
REGIMEN COMUN

REPORTE DE SERVICIO

FECHA:	12/12/2024	**REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO**		HORA INICIO:	8:30
INSTITUCION:	HOSPITAL SAN VICENTE	PROCESO:	AMBULANCIA	AREA:	MOVIL NXY 747

DATOS DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	TENSIOMETRO ADULTO DIGITAL			MARCA:	DB LIFE
SERIE:	WZ 4040 9023 01	MODELO:	BP369A	INV. N°.:	

ACCESORIOS DEL EQUIPO

BRAZALETE PILAS AA

DIAGNOSTICO INICIAL

	ESTADO		CONDICIONES AMBIENTALES DE USO SEGÚN LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE			
1	FISICO	BUENO	HUMEDAD:	46%	T°:	24,2 °C
2	FUNCIONAMIENTO	BUENO	SEGURIDAD DE LA INSTALACION:			
3	BATERIAS	N/A	EQUIPO NUEVO, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO			
4	ACCESORIOS	BUENO				

DESCRIPCION DEL SERVICIO

LIMPIEZA INTERNA		LIMPIEZA EXTERNA		DESINFECCION		DESMANCHADO	
LIMPIEZA CONTACTOS		LUBRICACION		ENGRASE		REEMPLAZO DE PARTES	

Se realiza hoja de vida

ELEMENTOS UTILIZADOS:

PRUEBAS FUNCIONALES

VERIFICACION DE:

SISTEMA ELECTRICO		ENCENDIDO		CONFIGURACION A TRAVES DEL MENU	
SISTEMA MECANICO	X	ACCESORIOS	X	FUNCIONAMIENTO DEL DISPLAY, PANTALLA	
SISTEMA HIDRAULICO		ALARMAS VISUAL		FUNCIONAMIENTO DEL MANOMETRO	X
SISTEMA NEUMATICO	X	ALARMAS AUDIBLES		FUNCIONAMIENTO DEL TECLADO, PERILLAS, CONTROLES	
VIDA DE LA BATERIA	X	FUGAS	X	TARJETAS ELECTRONICAS Y CONECTORES	
SEGURIDAD ELECTRICA		FILTROS		EMPAQUES	
PRUEBAS DE FABRICA		BOMBILLOS		NIVELES DE FLUJO	
		ALMACENAMIENTO DE DATOS Y MEMORIA		NIVELES DE PRESION	X

REPUESTOS UTILIZADOS

OBSERVACIONES

EQUIPO NUEVO LISTO PARA USAR

EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE	SI	X	NO		HORA FINAL: 8:40
FECHA DEL PROXIMO MANTENIMIENTO:	dic-25				

ING. BIOMEDICO

FUNCIONARIO ENCARGADO

BIOMEDICAL SOLUTIONS
INGENIERIA

NIT. 53116519-2
REGIMEN COMUN
DIAG. 5ª No. 37B 60 BLOQUE 15ª APTO. 503
BOGOTA – COLOMBIA

Certificado N° MP-702-24

INFORMACION DEL SOLICITANTE
Customer information

CLIENTE: **HOSPITAL SAN VICENTE**
Client

CIUDAD: ROVIRA **(TOLIMA)**
City

INFORMACION DEL EQUIPO BAJO PRUEBA.
Device under test information.

EQUIPO: TENSIOMETRO DIGITAL
Equipment
MARCA: DB LIFE
Brand
MODELO: BP369A
Model
SERIE: WZ 4040 9023 01
Serial
ID. Institución:
ID. Institution

LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRUEBA
Place and conditions of test

Lugar de la Calibración: Laboratorio de metrología
Place of Calibration
Fecha de Calibración: 2024-12-12
Date of Calibration
Fecha de Recepción: 2024-12-06
Date of Receipt
TEMPERATURA: 19 °C
Temperature
HUMEDAD R: 61 %
Humidity

NOTAS:
Notes:

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso escrito de BIOMEDICAL SOLUTIONS.
Los resultados contenidos en el presente documento se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos probados.
El usuario es responsable del seguimiento de sus instrumentos a intervalos apropiados.

FIRMA:

FABIAN ALFONSO ARCE RAMIREZ
INGENIERO DE CALIBRACION

BIOMEDICAL SOLUTIONS
INGENIERIA

Certificado N° MP-702-24

Trabajo realizado:

- Calibración del equipo

Método utilizado:

Comparación directa según procedimiento me003 del CEM. La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura K=2

Información de Trazabilidad

Nuestros instrumentos son trazables a estándares internacionales

Información de los instrumentos utilizados

PATRON	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA CALIBRACION	CERTIFICADO
MANOMETRO DE PRESION DIGITAL	NO REGISTRA	LK-168ª	01713093	2024-10-12	C5425-24

RESULTADOS DE CALIBRACION

Posición del item y el patrón durante la calibración: HORIZONTAL
Estado de la caratula y aguja indicadora/display: En buen estado
Comprobación de fugas: sistema neumático sin fugas
Escala del item: 2mmHg

COMPROBACION INICIAL EN TRES PUNTOS		
PRESION INDICADA EN EL ITEM (mmHg)		PRESION INDICADA EN EL PATRON (mmHg)
PUNTO BAJO	100	100,1
PUNTO MEDIO	150	150,2
PUNTO ALTO	270	270,2

MEDICIONES DE PRESION (mmHg)				
PROMEDIO DE PRESION INDICADA EN EL ITEM (mmHg)	PRESION INDICADA EN EL PATRON (mmHg)	ERROR (mmHg)	INCERTIDUMBRE (mmHg)	
0	0,0	0,0	±	0,70
50	50,1	0,1	±	0,71
100	100,1	0,1	±	0,71
150	150,2	0,2	±	0,72
200	200,2	0,2	±	0,72
250	250,2	0,2	±	0,72
270	270,2	0,2	±	0,72

ERROR MAXIMO: 0,2 mmHg

INCERTIDUMBRE MAXIMA: +/- 0,72 mmHg

La unidad de presión en el Sistema Internacional de Unidades es el Pascal: 1 mmHg = 133,322 Pa

Anomalías detectadas antes y durante la calibración: NINGUNA

FIN DEL CERTIFICADO

SET GAD Metrología

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-004

NVLAP CALIBRATION
NVLAP LAB CODE 201065-0

ilac-MRA

Certificado de Calibración

Certificado #
C5425-24

Laboratorio de Metrología Set y Gad S.A.S. — Bogotá

Descripción del equipo:	Manómetro de Presión digital	Condición como se recibió:	Operable
Fabricante:	LK-168A	Fecha de calibración:	2024-10-12
Serie No.:	01713093	Método de Calibración:	LAB-SIMSV-060
Nombre del cliente:	Biomedical Solutions	Temperatura:	21,6 °C
Dirección:	Diag. 5A N°37b60	Humedad:	51%
Ciudad:	BOGOTA		
Fecha de recepción	2024-10-02		

Patrones de calibración

Instrumento	Número de Serie	Due Date	ID Certificado
PATRON DE PRESION	34794	02/03/2023	FP021-23

Descripción de la calibración

La calibración del equipo bajo prueba se hace con un instrumento patrón trazable al sistema internacional de unidades... Los resultados emitidos en este certificado de calibración, describe al equipo bajo prueba en el momento que está siendo calibrado.
Este certificado de calibración no puede ser reproducido ni parcial ni de forma completa, sin la aprobación escrita del laboratorio SET & GAT.
Calibración: Datos de calibración obtenidos sin haber realizado ninguna clase de ajustes y/o reparación.
Set & Gad mantiene los patrones de referencia en condiciones físicas adecuadas para su conservación, estos patrones han sido calibrados con trazabilidad internacional o nacional, bajo estándares definidos por casa matriz, dependiendo de sus especificaciones.
El usuario es responsable de la caliración de sus instrumentos a intervalos adecuados.

S-G Metrología

Digitally signed by Felipe Uribe
DN: cn=Felipe Uribe, o=Set y Gad SAS, email=felipe.urib@esetgad.com, c=CO

Revisó y autorizó calibración
Ing. Luis Felipe Uribe Agudelo

Carrera 48 # 101 A - 69, Bogotá, Colombia
www.setgad.com

DIOS AYUDA A QUIEN CONFÍA EN ÉL

SET∝GAD Metrología

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-004

NVLAP CALIBRATION
NVLAP LAB CODE 201065-0

ilac-MRA

Certificado de Calibración

Certificado #
C5425-24

RESULTADOS DE LA MEDICION

Calibración de Presión

Precarga	IBC mmHg	Patrón mmHg	Corrección mmHg	Incertidumbre mmHg	k
300,0 mmHg	300	296,7	-3,3	0,72	2
Nominal	IBC mmHg	Patrón mmHg	Corrección mmHg	Incertidumbre mmHg	k
0,0 mmHg	0	0	0	0,58	2
50,0 mmHg	50	50,8	0,8	0,58	2
100,0 mmHg	100	100,7	0,7	0,58	2
150,0 mmHg	150	149,4	-0,6	0,58	2
200,0 mmHg	200	199,4	-0,6	0,58	2
250,0 mmHg	250	247,6	-2,4	0,58	2
300,0 mmHg	300	297,6	-2,4	0,72	2

Medición 1 mmHg	Medición 2 mmHg	Medición 3 mmHg	Medición 4 mmHg	Medición 5 mmHg
0	0	0	0	N/A
50,8	50,2	50,1	50,3	N/A
100,7	100,2	100,1	100,4	N/A
149,4	149,1	149,2	149,2	N/A
199,4	199,6	199,7	199,4	N/A
247,6	247,7	247,2	247,5	N/A
297,6	297,2	296,5	296,9	N/A

FIN DEL CERTIFICADO

	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS	Código	F-BIO-001
		Versión	1
		Fecha	Febrero 2017
		Página	1 de 1

1. INFORMACION DE EQUIPO

EQUIPO	TENSIÓMETRO		REGISTRO INVIMA	-			
MARCA	HONSUN		SERVICIO	HOSPITALIZACION			
MODELO	PEDIATRICO		UBICACIÓN				
SERIE	112999		CALIBRACIÓN	ANUAL			
N.° INVENTARIO			TIPO DE EQUIPO	FIJO		MOVIL	X
FECHA DE COMPRA		FECHA INSTALACION		GARANTIA			
EQUIPO PROPIO		EQUIPO COMODATO		DONACION			

2. FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO

MENSUAL		BIMENSUAL		TRIMESTRAL		CUATRIMESTRAL	X	SEMESTRAL		ANUAL	

REGISTRO FOTOGRAFICO	ACCESORIOS	
	CANTIDAD	ACCESORIO
		

3. CARACTERISTICAS TECNICAS

VOLTAJE	N/A	CORRIENTE	N/A	POTENCIA	N/A	FRECUENCIA	N/A	TEMP. DE TRABAJO	

CLASIFICACION RIESGO SEGUN 4725 DE 2005		CLASIFICACION DE USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		TECNOLOGIA PREDOMINANTE			
				DIAGNOSTICO	X				
				MTTO DE LA VIDA		ELECTRICO		NEUMATICO	X
RIESGO I	X	MEDICO		PREVENCION		ELECTRONICO		ACUSTICO	
RIESGO IIA		BASICO	X	REHABILITACIÓN		ELECTROMECANICO		SOLAR	
RIESGO IIB		APOYO		EQ. LABORATORIO		MECANICO		VAPOR	
RIESGO III		OTRO		EQ. ODONTOLOGIA		HIDRAULICO		OTRO	

4. RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

DEJE QUE EL USUARIO REPOSE UN MOMENTO ANTES DE TOMAR LA TENSIÓN.
NO DEJAR CAER EL MANÓMETRO Y EVITAR GOLPEARLO.
NUNCA INFLAR MÁS ALLÁ DE LOS 300 MMHG.
NO EXPONER EL BRAZALETE A LA RADIACIÓN SOLAR INTENSA.
SIEMPRE DESINFLE EL BRAZALETE COMPLETAMENTE ANTES DE GUARDARLO.
EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA DESARME O DESMANTELE EL MANÓMETRO.
LIMPIE EL MANÓMETRO Y LA PERA CON UN PAÑO HÚMEDO, NO ES NECESARIA LA ESTERILIZACIÓN, DADO QUE LAS PARTES NO ENTRAN EN CONTACTO DIRECTO CON EL CUERPO DEL PACIENTE.
EL BRAZALETE PUEDE SER LAVADO CON JABÓN Y AGUA FRÍA. DEJARLO SECAR AL AIRE.

Elaboró: Diego Alejandro Osorio Campos Ingeniero Electrónico	Revisó:	Aprobó:

HOSPITAL SAN VICENTE
ROVIRA TOLIMA



HOJA DE VIDA DE EQUIPO

EQUIPO: TENSIOMETRO PEDIATRICO	MARCA: DM	MODELO: HS-20C
SERIE: 15964	CLASIFICACION DE DISPOSITIVO MEDICO: Riesgo Medio (IIA) DIAGNOSTICO	
FECHA DE COMPRA: 13-12-2024	FECHA DE INSTALACION: 13-12-2024	VENCIMIENTO DE GARANTIA: N/A
DATOS DEL PROVEEDOR: OSMEC AMBULANCIA	TELEFONO: 3153083450	

PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO: ANUAL	UBICACIÓN: AMBULANCIA PLACA NXY 747	EQUIPO:	MOVIL X	FIJO	

REGISTRO INVIMA :	2020DM-0022495

FUNCIONES: Este equipo ejerce una fuerza mecanica alrededor del brazo de un paciente con el fin de medir su tension arterial. Utiliza un manometro de aguja, semejante a un reloj

RECOMENDACIONES DE FABRICANTE:

- Verificar fugas antes de su uso.
- Verificarcion de prueba de cero.

REGISTRO TECNICO DE INSTALACION

VOLTAJE: no	CORRIENTE: no	FRECUENCIA: no
PESO: 500 gr	TECNOLOGIA PREDOMINANTE: Manual	

REGISTRO TECNICO DE FUNCIONAMIENTO

PACIENTE: PEDIATRICO	CAPACIDAD MAXIMA: 300 mmHg

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PLANIFICADO SEGÚN PARAMETROS DE FABRICANTE

EQUIPO	TENSIOMETRO
MARCA	DM
MODELO	HS-20C
SERIE	230700745
N° INVENTARIO	

- Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo
- Efectuar limpieza integral externa del equipo
- Efectuar limpieza integral interna del equipo
- Verificación del manómetro
- Chequeo de la pera
- Verificación del brazalete (sin aberturas)
- Chequeo de mangueras
- Enjuague continuamente con agua destilada durante cinco minutos
- A presión cero, asegúrese que el puntero esta dentro del ovalo que rodea la gradación de presión cero en el dial.

Material Gastable	Repuestos Minimos	Herramientas y Equipos
• Franela • Limpiador de superficies liquido		• Analizador de NIBP

BIOMEDICAL SOLUTIONS
INGENIERIA

NIT. 53116519-2
REGIMEN COMUN

REPORTE DE SERVICIO

FECHA:	12/12/2024	**REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO**		HORA INICIO:	9:40
INSTITUCION:	HOSPITAL SAN VICENTE	PROCESO:	AMBULANCIA	AREA:	MOVIL NXY 747

DATOS DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO:	TENSIOMETRO PEDIATRICO			MARCA:	DM
SERIE:	15.964	MODELO:	HS-20C	INV. N°.:	

ACCESORIOS DEL EQUIPO

BRAZALETE DE DOS VIAS, MANOMETRO, VALVULA REGULADORA Y PERILLA INSUFLADORA

DIAGNOSTICO INICIAL

	ESTADO		CONDICIONES AMBIENTALES DE USO SEGÚN LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE			
1	FISICO	BUENO	HUMEDAD:	46%	T°:	24,2 °C
2	FUNCIONAMIENTO	BUENO	SEGURIDAD DE LA INSTALACION:			
3	BATERIAS	N/A	EQUIPO NUEVO, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO			
4	ACCESORIOS	BUENO				

DESCRIPCION DEL SERVICIO

LIMPIEZA INTERNA	☐	LIMPIEZA EXTERNA	☐	DESINFECCION	☐	DESMANCHADO	☐
LIMPIEZA CONTACTOS	☐	LUBRICACION	☐	ENGRASE	☐	REEMPLAZO DE PARTES	☐

Se realiza hoja de vida

ELEMENTOS UTILIZADOS:

PRUEBAS FUNCIONALES

VERIFICACION DE:

SISTEMA ELECTRICO	☐	ENCENDIDO	☐	CONFIGURACION A TRAVES DEL MENU	☐
SISTEMA MECANICO	X	ACCESORIOS	X	FUNCIONAMIENTO DEL DISPLAY, PANTALLA	☐
SISTEMA HIDRAULICO	☐	ALARMAS VISUAL	☐	FUNCIONAMIENTO DEL MANOMETRO	X
SISTEMA NEUMATICO	X	ALARMAS AUDIBLES	☐	FUNCIONAMIENTO DEL TECLADO, PERILLAS, CONTROLES	☐
VIDA DE LA BATERIA	☐	FUGAS	X	TARJETAS ELECTRONICAS Y CONECTORES	☐
SEGURIDAD ELECTRICA	☐	FILTROS	☐	EMPAQUES	☐
PRUEBAS DE FABRICA	☐	BOMBILLOS	☐	NIVELES DE FLUJO	☐
		ALMACENAMIENTO DE DATOS Y MEMORIA	☐	NIVELES DE PRESION	X

REPUESTOS UTILIZADOS

OBSERVACIONES

EQUIPO NUEVO LISTO PARA USAR

EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE SI [X] NO [ ] HORA FINAL: 9:50

FECHA DEL PROXIMO MANTENIMIENTO: dic-25

ING. BIOMEDICO

FUNCIONARIO ENCARGADO

La salud es de todos | Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020041773 DE 1 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

CONSIDERANDO

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMATICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.
EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARA EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS A

PRODUCTO: TENSIOMETRO ANEROIDE PARTES ACCESORIOS Y REPUESTOS - ESFINGOMANÓMETRO / TENSIOMETRO
MARCA: HONSUN - DM
REGISTRO SANITARIO NO.: INVIMA 2020DM-0022495
TIPO DE REGISTRO: IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES): DATASAVE MEDICAL SAS CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
FABRICANTE(S): HONSUN (NANTONG) CO., LTD CON DOMICILIO EN CHINA
IMPORTADOR(ES): DATASAVE MEDICAL SAS CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
ACONDICIONADOR(ES): DATASAVE MEDICAL SAS CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO: NO INVASIVO
I
COMPOSICIÓN:

PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO	COMPOSICIÓN CUALITATIVA
BOLSO	
BRAZALETE	NYLON - ALGODÓN - PVC
MANGUERA	BOLSA INTERNA EN PVC / LATEX / POLIURETANO
PERA	CON VALVULA EN LATEX
MANOMETRO	ALEACION DE ZINC
LLAVE DE AJUSTE DE MANOMETRO	

USOS: UN TENSIOMETRO ANEROIDE ES UTILIZADO POR PROFESIONALES DE LA SALUD O PERSONAL ENTRENADO EN LA TÉCNICA DE PRESIÓN ATERIAL AUSCULTATORIA PARA DETERMINAR LA PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA Y DIASTÓLICA EN LOS SERES HUMANOS.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: CAJA X UNIDAD
OBSERVACIONES: EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LOS MODELOS, PARTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS DEL EQUIPO CODIGO, MODELO O REFERENCIA

FAMILIA	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA
	HS-20A
	HS-20B
	HS-20C

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020041773 DE 1 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

FAMILIA	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA
	HS-20J
	HS-20G
	HS-20F
	HS-20M
	HS-20K
	HS-201A1
	HS-201M1
	HS-201N1
	HS-201J1
	HS-201K1
	HS-201K2
	HS-201Q1
	HS-201Q2
	HS-201T
	HS-201U
	HS-201V
	HS-60A
	HS-60D
	HS-60B
	HS-60C
	HS-60E
	HS-70A
	HS-70B
	HS-70C
	HS-70D
ACCESORIOS	MANOMETRO
ACCESORIOS	ESTUCHE
ACCESORIOS	BOLSA EN LATEX
ACCESORIOS	BOLSA EN PVC
ACCESORIOS	BOLSA EN POLIURETANO
ACCESORIOS	BOLSA LIBRE DE DEHP
ACCESORIOS	BRAZALETE ESTÁNDAR
ACCESORIOS	BRAZALETE CLASICO
ACCESORIOS	PERA CON VALVULA
ACCESORIOS	BRAZALETE PEDIATRICO
ACCESORIOS	LLAVE DE AJUSTE DEL MANOMETRO

VIDA UTIL: 5 AÑOS
EXPEDIENTE NO.: 20192908

La salud es de todos | Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020041773 DE 1 de Diciembre de 2020
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

ARTICULO SEGUNDO.- CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE LA DIRECCION DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

ARTICULO TERCERO.- LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

ARTICULO CUARTO.- LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 2005.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN BOGOTÁ D.C. A LOS 1 DE DICIEMBRE DE 2020
ESTE ESPACIO, HASTA LA FIRMA SE CONSIDERA EN BLANCO.

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTOR(A) TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
PROYECTO: LEGAL: ELOPEZ, TÉCNICO: MSANDOVALC, REVISÓ:CORDINA_VARIOS

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2023**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario
032023001507258-1

Importador

5. Número de identificación Tributaria (NIT): 830138246 | 6. DV: 4 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: DATASAVE MEDICAL S.A.S

13. Dirección: CL 86 B 49 A 21 | 15. Teléfono: 6230040 | 12. Cód. Admón.: 03 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830049499 | 25. DV: 4 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS CONTINENTAL EXPRESS LTDA NIVEL 2 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 0384

29. Número documento de identificación: 52441998 | 30. Apellidos y nombres: LUZ STELLA SEGURA CASTIBLANCO

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9194179599	2023 - 10 - 11	No. CNLE230800121	2023 - 09 - 01

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
HONSUN (NANTONG) CO., LTD	NANTONG	215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
NO.8 TONGXING ROAD,ECONOMIC & TECHNOLOGICAL DEVEL	021-63056696

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ con.
23YF1B016	2023 - 08 - 10	215	1	215	11	MCT S.A.S	4,230.61

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	9018909090	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. / dcms.	72. Peso neto kgs. / dcms.	73. Código embalaje	74. No. Bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
08	01	215	569.00	547.00	CT	118	3	u	2,650.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
7,055.00	44.08

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
11.29	0.00

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
55.37	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código régimen o licencia	86. Número
7,110.37	R	50156537

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód.interno del Producto
3	2023	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	5.00	30,081,202	1,504,000	0	0
I.V.A.	19.00	31,585,202	6,001,000	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Sancion	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	7,505,000		0

91. Descripción de las mercancías(No incluir la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales o otros) (Si el espacio es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DIM 5/5 D.O. 17269/REGISTRO DE IMPORTACION REG-50156537-20231005N DE FECHA 05/10/2023, VB INVIMA 23-0118310 DE FECHA 05/10/2023// REF: HS-20C PRODUCTO:- ESFINGOMANOMETRO / TENSIOMETRO, CON ACCESORIOS MANOMETRO ,ESTUCHE ,BOLSA EN LATEX , BOLSA EN PVC ,BOLSA E NPOLIURETANO, BOLSA LIBRE DE DE HP, PERA CON VALVULA , BRAZALETE PEDIATRICO , LLAVE DE AJUSTE DEL MANOMETRO,MARCA: DM,MODELO: HS -20C , SERIAL: 230700001,230700002,230700003,230700004,230700005,230700006,230700007,230700008,230700009,230700010,230700011,2307 00012,230700013,230700014,230700015,230700016,230700017,230700018,230700019,230700020,230700021,230700022,230700023,230700024,230 700025,230700026,230700027,230700028,230700029,230700030,230700031,230700032,230700033,230700034,230700035,(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración: 032023001507258 133. Fecha: 2023 10 17
134. Levante No: 032023001291178	135. Fecha: 2023 - 10 - 17	Firma funcionario responsable 136. Nombre 137. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

910030368834 57

Fecha de Impresión: 2023-10-17 11:27:15

20231364924988

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **032023001507258-1**
Subpartida : **9018909090**

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

230700036,230700037,230700038,230700039,230700040,230700041,230700042,230700043,230700044,230700045,230700046,230700047,230700048
,230700049,230700050,230700051,230700052,230700053,230700054,230700055,230700056,230700057,230700058,230700059,230700060,230700061
1,230700062,230700063,230700064,230700065,230700066,230700067,230700068,230700069,230700070,230700071,230700072,230700073,230700074
74,230700075,230700076,230700077,230700078,230700079,230700080,230700081,230700082,230700083,230700084,230700085,230700086,230700
087,230700088,230700089,230700090,230700091,230700092,230700093,230700094,230700095,230700096,230700097,230700098,230700099,230700
0100,230700101,230700102,230700103,230700104,230700105,230700106,230700107,230700108,230700109,230700110,230700111,230700112,230700
00113,230700114,230700115,230700116,230700117,230700118,230700119,230700120,230700121,230700122,230700123,230700124,230700125,230
700126,230700127,230700128,230700129,230700130,230700131,230700132,230700133,230700134,230700135,230700136,230700137,230700138,23
0700139,230700140,230700141,230700142,230700143,230700144,230700145,230700146,230700147,230700148,230700149,230700150,230700151,2
30700152,230700153,230700154,230700155,230700156,230700157,230700158,230700159,230700160,230700161,230700162,230700163,230700164,
230700165,230700166,230700167,230700168,230700169,230700170,230700171,230700172,230700173,230700174,230700175,230700176,230700177
,230700178,230700179,230700180,230700181,230700182,230700183,230700184,230700185,230700186,230700187,230700188,230700189,230700190
0,230700191,230700192,230700193,230700194,230700195,230700196,230700197,230700198,230700199,230700200,230700201,230700202,230700203
03,230700204,230700205,230700206,230700207,230700208,230700209,230700210,230700211,230700212,230700213,230700214,230700215,230700
216,230700217,230700218,230700219,230700220,230700221,230700222,230700223,230700224,230700225,230700226,230700227,230700228,230700
0229,230700230,230700231,230700232,230700233,230700234,230700235,230700236,230700237,230700238,230700239,230700240,230700241,230700
00242,230700243,230700244,230700245,230700246,230700247,230700248,230700249,230700250,230700251,230700252,230700253,230700254,230
700255,230700256,230700257,230700258,230700259,230700260,230700261,230700262,230700263,230700264,230700265,230700266,230700267,23
0700268,230700269,230700270,230700271,230700272,230700273,230700274,230700275,230700276,230700277,230700278,230700279,230700280,2
30700281,230700282,230700283,230700284,230700285,230700286,230700287,230700288,230700289,230700290,230700291,230700292,230700293,
230700294,230700295,230700296,230700297,230700298,230700299,230700300,230700301,230700302,230700303,230700304,230700305,230700306
,230700307,230700308,230700309,230700310,230700311,230700312,230700313,230700314,230700315,230700316,230700317,230700318,230700319
9,230700320,230700321,230700322,230700323,230700324,230700325,230700326,230700327,230700328,230700329,230700330,230700331,230700332
32,230700333,230700334,230700335,230700336,230700337,230700338,230700339,230700340,230700341,230700342,230700343,230700344,230700
345,230700346,230700347,230700348,230700349,230700350,230700351,230700352,230700353,230700354,230700355,230700356,230700357,230700
0358,230700359,230700360,230700361,230700362,230700363,230700364,230700365,230700366,230700367,230700368,230700369,230700370,2307
00371,230700372,230700373,230700374,230700375,230700376,230700377,230700378,230700379,230700380,230700381,230700382,230700383,230
700384,230700385,230700386,230700387,230700388,230700389,230700390,230700391,230700392,230700393,230700394,230700395,230700396,23
0700397,230700398,230700399,230700400,230700401,230700402,230700403,230700404,230700405,230700406,230700407,230700408,230700409,2
30700410,230700411,230700412,230700413,230700414,230700415,230700416,230700417,230700418,230700419,230700420,230700421,230700422,
230700423,230700424,230700425,230700426,230700427,230700428,230700429,230700430,230700431,230700432,230700433,230700434,230700435
,230700436,230700437,230700438,230700439,230700440,230700441,230700442,230700443,230700444,230700445,230700446,230700447,230700448
8,230700449,230700450,230700451,230700452,230700453,230700454,230700455,230700456,230700457,230700458,230700459,230700460,2307004
61,230700462,230700463,230700464,230700465,230700466,230700467,230700468,230700469,230700470,230700471,230700472,230700473,230700
474,230700475,230700476,230700477,230700478,230700479,230700480,230700481,230700482,230700483,230700484,230700485,230700486,230700
0487,230700488,230700489,230700490,230700491,230700492,230700493,230700494,230700495,230700496,230700497,230700498,230700499,2307
00500,230700501,230700502,230700503,230700504,230700505,230700506,230700507,230700508,230700509,230700510,230700511,230700512,230
700513,230700514,230700515,230700516,230700517,230700518,230700519,230700520,230700521,230700522,230700523,230700524,230700525,23
0700526,230700527,230700528,230700529,230700530,230700531,230700532,230700533,230700534,230700535,230700536,230700537,230700538,2
30700539,230700540,230700541,230700542,230700543,230700544,230700545,230700546,230700547,230700548,230700549,230700550,230700551,
230700552,230700553,230700554,230700555,230700556,230700557,230700558,230700559,230700560,230700561,230700562,230700563,230700564
,230700565,230700566,230700567,230700568,230700569,230700570,230700571,230700572,230700573,230700574,230700575,230700576,230700577
7,230700578,230700579,230700580,230700581,230700582,230700583,230700584,230700585,230700586,230700587,230700588,230700589,230700590
90,230700591,230700592,230700593,230700594,230700595,230700596,230700597,230700598,230700599,230700600,230700601,230700602,230700
603,230700604,230700605,230700606,230700607,230700608,230700609,230700610,230700611,230700612,230700613,230700614,230700615,230700
0616,230700617,230700618,230700619,230700620,230700621,230700622,230700623,230700624,230700625,230700626,230700627,230700628,2307
00629,230700630,230700631,230700632,230700633,230700634,230700635,230700636,230700637,230700638,230700639,230700640,230700641,230
700642,230700643,230700644,230700645,230700646,230700647,230700648,230700649,230700650,230700651,230700652,230700653,230700654,23
0700655,230700656,230700657,230700658,230700659,230700660,230700661,230700662,230700663,230700664,230700665,230700666,230700667,2
30700668,230700669,230700670,230700671,230700672,230700673,230700674,230700675,230700676,230700677,230700678,230700679,230700680,
230700681,230700682,230700683,230700684,230700685,230700686,230700687,230700688,230700689,230700690,230700691,230700692,230700693
,230700694,230700695,230700696,230700697,230700698,230700699,230700700,230700701,230700702,230700703,230700704,230700705,230700706
6,230700707,230700708,230700709,230700710,230700711,230700712,230700713,230700714,230700715,230700716,230700717,230700718,230700719
19,230700720,230700721,230700722,230700723,230700724,230700725,230700726,230700727,230700728,230700729,230700730,230700731,230700
7132,230700733,230700734,230700735,230700736,230700737,230700738,230700739,230700740,230700741,230700742,230700743,230700744,230700
00745,230700746,230700747,230700748,230700749,230700750,230700751,230700752,230700753,230700754,230700755,230700756,230700757,230700
00758,230700759,230700760,230700761,230700762,230700763,230700764,230700765,230700766,230700767,230700768,230700769,230700770,230
700771,230700772,230700773,230700774,230700775,230700776,230700777,230700778,230700779,230700780,230700781,230700782,230700783,23
0700784,230700785,230700786,230700787,230700788,230700789,230700790,230700791,230700792,230700793,230700794,230700795,230700796,2
30700797,230700798,230700799,230700800,230700801,230700802,230700803,230700804,230700805,230700806,230700807,230700808,230700809,
230700810,230700811,230700812,230700813,230700814,230700815,230700816,230700817,230700818,230700819,230700820,230700821,230700822
,230700823,230700824,230700825,230700826,230700827,230700828,230700829,230700830,230700831,230700832,230700833,230700834,230700835
5,230700836,230700837,230700838,230700839,230700840,230700841,230700842,230700843,230700844,230700845,230700846,230700847,230700848
48,230700849,230700850,230700851,230700852,230700853,230700854,230700855,230700856,230700857,230700858,230700859,230700860,230700
861,230700862,230700863,230700864,230700865,230700866,230700867,230700868,230700869,230700870,230700871,230700872,230700873,230700
0874,230700875,230700876,230700877,230700878,230700879,230700880,230700881,230700882,230700883,230700884,230700885,230700886,2307
00887,230700888,230700889,230700890,230700891,230700892,230700893,230700894,230700895,230700896,230700897,230700898,230700899,230
700900,230700901,230700902,230700903,230700904,230700905,230700906,230700907,230700908,230700909,230700910,230700911,230700912,23
0700913,230700914,230700915,230700916,230700917,230700918,230700919,230700920,230700921,230700922,230700923,230700924,230700925,2
30700926,230700927,230700928,230700929,230700930,230700931,230700932,230700933,230700934,230700935,230700936,230700937,230700938,
230700939,230700940,230700941,230700942,230700943,230700944,230700945,230700946,230700947,230700948,230700949,230700950,230700951
,230700952,230700953,230700954,230700955,230700956,230700957,230700958,230700959,230700960,230700961,230700962,230700963,230700964
4,230700965,230700966,230700967,230700968,230700969,230700970,230700971,230700972,230700973,230700974,230700975,230700976,230700977
77,230700978,230700979,230700980,230700981,230700982,230700983,230700984,230700985,230700986,230700987,230700988,230700989,230700
990,230700991,230700992,230700993,230700994,230700995,230700996,230700997,230700998,230700999,230701000,USO: MEDICO UN TERMIOMETR

032023001507258-1

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **032023001507258-1**
Subpartida : **9018909090**

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

O ANEROI DE ES UTILIZADO POR PROFESIONALES DE LA SALUD O PERSONAL ENTRENADO EN LA TÉCNICA DE PRESIÓN ATERIAL AUSCULTATORIA PARA D ETERMINAR LA PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA Y DIASTÓLICA EN LOS SERES HUMANOS. PRESENTACION COMERCIAL: CAJA X UNIDAD,TECNICA DE DIAGN OSTICO:MANUAL MARCA: DM CANT. 1000 U//REF: MANOMETRO ,PRODUCTO: MANOMETRO, MARCA: DM, MODELO:SIN MODELO, REFERENCIA:SIN REFERENCI A, SERIAL:230702001,230702002,230702003,230702004,230702005,230702006,230702007,230702008,230702009,230702010,230702011,230702012 ,230702013,230702014,230702015,230702016,230702017,230702018,230702019,230702020,230702021,230702022,230702023,230702024,230702025 ,230702026,230702027,230702028,230702029,230702030,230702031,230702032,230702033,230702034,230702035,230702036,230702037,230702038 ,230702039,230702040,230702041,230702042,230702043,230702044,230702045,230702046,230702047,230702048,230702049,230702050,230702051 ,230702052,230702053,230702054,230702055,230702056,230702057,230702058,230702059,230702060,230702061,230702062,230702063,230702064 ,230702065,230702066,230702067,230702068,230702069,230702070,230702071,230702072,230702073,230702074,230702075,230702076,230702077 ,230702078,230702079,230702080,230702081,230702082,230702083,230702084,230702085,230702086,230702087,230702088,230702089,230702090 ,230702091,230702092,230702093,230702094,230702095,230702096,230702097,230702098,230702099,230702100,230702101,230702102,230702103 ,230702104,230702105,230702106,230702107,230702108,230702109,230702110,230702111,230702112,230702113,230702114,230702115,230702116 ,230702117,230702118,230702119,230702120,230702121,230702122,230702123,230702124,230702125,230702126,230702127,230702128,230702129 ,230702130,230702131,230702132,230702133,230702134,230702135,230702136,230702137,230702138,230702139,230702140,230702141,230702142 ,230702143,230702144,230702145,230702146,230702147,230702148,230702149,230702150,.USO O DESTINO:ACCESORIO DE TENSIOMETR O HS-20C, TECNICA DE DIAGNOSTICO: MANUAL, MARCA: DM CANT. 150 U //REF: BRAZALETTE PRODUCTO: BRAZALETE,MARCA: DM, MODELO:SIN MODEL O, REFERENCIA:SIN REFERENCIA, SERIAL:230702151,230702152,230702153,230702154,230702155,230702156,230702157,230702158,230703159,23 0702160,230702161,230702162,230702163,230702164,230702165,230702166,230702167,230702168,230702169,230702170,230702171,230702172,2 30702173,230702174,230702175,230702176,230702177,230702178,230702179,230702180,230702181,230702182,230702183,230702184,230702185, 230702186,230702187,230702188,230702189,230702190,230702191,230702192,230702193,230702194,230702195,230702196,230702197,230702198 ,230702199,230702200,230702201,230702202,230702203,230702204,230702205,230702206,230702207,230702208,230702209,230702210,230702211 ,230702212,230702213,230702214,230702215,230702216,230702217,230702218,230702219,230702220,230702221,230702222,230702223,230702224 ,230702225,230702226,230702227,230702228,230702229,230702230,230702231,230702232,230702233,230702234,230702235,230702236,230702 237,230702238,230702239,230702240,230702241,230702242,230702243,230702244,230702245,230702246,230702247,230702248,230702249,230702 2250,230702251,230702252,230702253,230702254,230702255,230702256,230702257,230702258,230702259,230702260,230702261,230702262,2307 02263,230702264,230702265,230702266,230702267,230702268,230702269,230702270,230702271,230702272,230702273,230702274,230702275,230 702276,230702277,230702278,230702279,230702280,230702281,230702282,230702283,230702284,230702285,230702286,230702287,230702288,23 0702289,230702290,230702291,230702292,230702293,230702294,230702295,230702296,230702297,230702298,230702299,230702300,230702301,2 30702302,230702303,230702304,230702305,230702306,230702307,230702308,230702309,230702310,230702311,230702312,230702313,230702314, 230702315,230702316,230702317,230702318,230702319,230702320,230702321,230702322,230702323,230702324,230702325,230702326,230702327 ,230702328,230702329,230702330,230702331,230702332,230702333,230702334,230702335,230702336,230702337,230702338,230702339,230702340 ,230702341,230702342,230702343,230702344,230702345,230702346,230702347,230702348,230702349,230702350,230702351,230702352,230702353 ,230702354,230702355,230702356,230702357,230702358,230702359,230702360,230702361,230702362,230702363,230702364,230702365,230702 366,230702367,230702368,230702369,230702370,230702371,230702372,230702373,230702374,230702375,230702376,230702377,230702378,23070 2379,230702380,230702381,230702382,230702383,230702384,230702385,230702386,230702387,230702388,230702389,230702390,230702391,2307 02392,230702393,230702394,230702395,230702396,230702397,230702398,230702399,230702400,230702401,230702402,230702403,230702404,230 202405,230702406,230702407,230702408,230702409,230702410,230702411,230702412,230702413,230702414,230702415,230702416,230702417,23 0702418,230702419,230702420,230702421,230702422,230702423,230702424,230702425,230702426,230702427,230702428,230702429,230702430,2 30702431,230702432,230702433,230702434,230702435,230702436,230702437,230702438,230702439,230702440,230702441,230702442,230702443, 230702444,230702445,230702446,230702447,230702448,230702449,230702450,230702451,230702452,230702453,230702454,230702455,230702456 ,230702457,230702458,230702459,230702460,230702461,230702462,230702463,230702464,230702465,230702466,230702467,230702468,230702469 ,230702470,230702471,230702472,230702473,230702474,230702475,230702476,230702477,230702478,230702479,230702480,230702481,230702482 ,230702483,230702484,230702485,230702486,230702487,230702488,230702489,230702490,230702491,230702492,230702493,230702494,230702 495,230702496,230702497,230702498,230702499,230702500,230702501,230702502,230702503,230702504,230702505,230702506,230702507,230702 508,230702509,230702510,230702511,230702512,230702513,230702514,230702515,230702516,230702517,230702518,230702519,230702520,230702 521,230702522,230702523,230702524,230702525,230702526,230702527,230702528,230702529,230702530,230702531,230702532,230702533,230 702534,230702535,230702536,230702537,230702538,230702539,230702540,230702541,230702542,230702543,230702544,230702545,230702546,23 0702547,230702548,230702549,230702550,230702551,230702552,230702553,230702554,230702555,230702556,230702557,230702558,230702559,2 30702560,230702561,230702562,230702563,230702564,230702565,230702566,230702567,230702568,230702569,230702570,230702571,230702572, 230702573,230702574,230702575,230702576,230702577,230702578,230702579,230702580,230702581,230702582,230702583,230702584,230702585 ,230702586,230702587,230702588,230702589,230702590,230702591,230702592,230702593,230702594,230702595,230702596,230702597,230702598 ,230702599,230702600,230702601,230702602,230702603,230702604,230702605,230702606,230702607,230702608,230702609,230702610,230702611 ,230702612,230702613,230702614,230702615,230702616,230702617,230702618,230702619,230702620,230702621,230702622,230702623,230702 624,230702625,230702626,230702627,230702628,230702629,230702630,230702631,230702632,230702633,230702634,230702635,230702636,230702 637,230702638,230702639,230702640,230702641,230702642,230702643,230702644,230702645,230702646,230702647,230702648,230702649,230702 650,.USO O DESTINO: ACCESORIO DE TENSIOMETRO HS-20C, TECNICA DE DIAGNOSTICO: MANUAL, MARCA: DM CANT. 500 U //REF: PERA CON VALV ULA PRODUCTO: PERA CON VALVULA, MARCA: DM, MODELO:SIN MODELO,REFERENCIA:SIN REFERENCIA, SERIAL:230701001,230701002,230701003,230701 001004,230701005,230701006,230701007,230701008,230701009,230701010,230701011,230701012,230701013,230701014,230701015,230701016,230 701017,230701018,230701019,230701020,230701021,230701022,230701023,230701024,230701025,230701026,230701027,230701028,230701029,23 0701030,230701031,230701032,230701033,230701034,230701035,230701036,230701037,230701038,230701039,230701040,230701041,230701042,2 30701043,230701044,230701045,230701046,230701047,230701048,230701049,230701050,230701051,230701052,230701053,230701054,230701055, 230701056,230701057,230701058,230701059,230701060,230701061,230701062,230701063,230701064,230701065,230701066,230701067,230701068 ,230701069,230701070,230701071,230701072,230701073,230701074,230701075,230701076,230701077,230701078,230701079,230701080,230701081 ,230701082,230701083,230701084,230701085,230701086,230701087,230701088,230701089,230701090,230701091,230701092,230701093,230701094 ,230701095,230701096,230701097,230701098,230701099,230701100,230701101,230701102,230701103,230701104,230701105,230701106,230701 107,230701108,230701109,230701110,230701111,230701112,230701113,230701114,230701115,230701116,230701117,230701118,230701119,230701 2120,230701121,230701122,230701123,230701124,230701125,230701126,230701127,230701128,230701129,230701130,230701131,230701132,2307 01133,230701134,230701135,230701136,230701137,230701138,230701139,230701140,230701141,230701142,230701143,230701144,230701145,230 701146,230701147,230701148,230701149,230701150,230701151,230701152,230701153,230701154,230701155,230701156,230701157,230701158,23 0701159,230701160,230701161,230701162,230701163,230701164,230701165,230701166,230701167,230701168,230701169,230701170,230701171,2 30701172,230701173,230701174,230701175,230701176,230701177,230701178,230701179,230701180,230701181,230701182,230701183,230701184, 230701185,230701186,230701187,230701188,230701189,230701190,230701191,230701192,230701193,230701194,230701195,230701196,230701197 ,230701198,230701199,230701200,230701201,230701202,230701203,230701204,230701205,230701206,230701207,230701208,230701209,230701210 ,230701211,230701212,230701213,230701214,230701215,230701216,230701217,230701218,230701219,230701220,230701221,230701222,230701223 ,230701224,230701225,230701226,230701227,230701228,230701229,230701230,230701231,230701232,230701233,230701234,230701235,230701

032023001507258-1

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, serialres y otros)

236,230701237,230701238,230701239,230701240,230701241,230701242,230701243,230701244,230701245,230701246,230701247,230701248,230701 249,230701250,230701251,230701252,230701253,230701254,230701255,230701256,230701257,230701258,230701259,230701260,230701261,230701 701262,230701263,230701264,230701265,230701266,230701267,230701268,230701269,230701270,230701271,230701272,230701273,230701274,230 701275,230701276,230701277,230701278,230701279,230701280,230701281,230701282,230701283,230701284,230701285,230701286,230701287,23 0701288,230701289,230701290,230701291,230701292,230701293,230701294,230701295,230701296,230701297,230701298,230701299,230701300,2 30701301,230701302,230701303,230701304,230701305,230701306,230701307,230701308,230701309,230701310,230701311,230701312,230701313, 230701314,230701315,230701316,230701317,230701318,230701319,230701320,230701321,230701322,230701323,230701324,230701325,230701326

,230701327,230701328,230701329,230701330,230701331,230701332,230701333,230701334,230701335,230701336,230701337,230701338,23070133
9,230701340,230701341,230701342,230701343,230701344,230701345,230701346,230701347,230701348,230701349,230701350,230701351,2307013
52,230701353,230701354,230701355,230701356,230701357,230701358,230701359,230701360,230701361,230701362,230701363,230701364,230701
365,230701366,230701367,230701368,230701369,230701370,230701371,230701372,230701373,230701374,230701375,230701376,230701377,23070
1378,230701379,230701380,230701381,230701382,230701383,230701384,230701385,230701386,230701387,230701388,230701389,230701390,2307
01391,230701392,230701393,230701394,230701395,230701396,230701397,230701398,230701399,230701400,230701401,230701402,230701403,230
701404,230701405,230701406,230701407,230701408,230701409,230701410,230701411,230701412,230701413,230701414,230701415,230701416,23
0701417,230701418,230701419,230701420,230701421,230701422,230701423,230701424,230701425,230701426,230701427,230701428,230701429,2
30701430,230701431,230701432,230701433,230701434,230701435,230701436,230701437,230701438,230701439,230701440,230701441,230701442,
230701443,230701444,230701445,230701446,230701447,230701448,230701449,230701450,230701451,230701452,230701453,230701454,230701455
,230701456,230701457,230701458,230701459,230701460,230701461,230701462,230701463,230701464,230701465,230701466,230701467,23070146
8,230701469,230701470,230701471,230701472,230701473,230701474,230701475,230701476,230701477,230701478,230701479,230701480,2307014
81,230701482,230701483,230701484,230701485,230701486,230701487,230701488,230701489,230701490,230701491,230701492,230701493,230701
494,230701495,230701496,230701497,230701498,230701499,230701500,230701501,230701502,230701503,230701504,230701505,230701506,23070
1507,230701508,230701509,230701510,230701511,230701512,230701513,230701514,230701515,230701516,230701517,230701518,230701519,2307
01520,230701521,230701522,230701523,230701524,230701525,230701526,230701527,230701528,230701529,230701530,230701531,230701532,230
701533,230701534,230701535,230701536,230701537,230701538,230701539,230701540,230701541,230701542,230701543,230701544,230701545,23
0701546,230701547,230701548,230701549,230701550,230701551,230701552,230701553,230701554,230701555,230701556,230701557,230701558,2
30701559,230701560,230701561,230701562,230701563,230701564,230701565,230701566,230701567,230701568,230701569,230701570,230701571,
230701572,230701573,230701574,230701575,230701576,230701577,230701578,230701579,230701580,230701581,230701582,230701583,230701584
,230701585,230701586,230701587,230701588,230701589,230701590,230701591,230701592,230701593,230701594,230701595,230701596,23070159
7,230701598,230701599,230701600,230701601,230701602,230701603,230701604,230701605,230701606,230701607,230701608,230701609,2307016
10,230701611,230701612,230701613,230701614,230701615,230701616,230701617,230701618,230701619,230701620,230701621,230701622,230701
623,230701624,230701625,230701626,230701627,230701628,230701629,230701630,230701631,230701632,230701633,230701634,230701635,23070
1636,230701637,230701638,230701639,230701640,230701641,230701642,230701643,230701644,230701645,230701646,230701647,230701648,2307
01649,230701650,230701651,230701652,230701653,230701654,230701655,230701656,230701657,230701658,230701659,230701660,230701661,230
701662,230701663,230701664,230701665,230701666,230701667,230701668,230701669,230701670,230701671,230701672,230701673,230701674,23
0701675,230701676,230701677,230701678,230701679,230701680,230701681,230701682,230701683,230701684,230701685,230701686,230701687,2
30701688,230701689,230701690,230701691,230701692,230701693,230701694,230701695,230701696,230701697,230701698,230701699,230701700,
230701701,230701702,230701703,230701704,230701705,230701706,230701707,230701708,230701709,230701710,230701711,230701712,230701713
,230701714,230701715,230701716,230701717,230701718,230701719,230701720,230701721,230701722,230701723,230701724,230701725,23070172
6,230701727,230701728,230701729,230701730,230701731,230701732,230701733,230701734,230701735,230701736,230701737,230701738,2307017
39,230701740,230701741,230701742,230701743,230701744,230701745,230701746,230701747,230701748,230701749,230701750,230701751,230701
752,230701753,230701754,230701755,230701756,230701757,230701758,230701759,230701760,230701761,230701762,230701763,230701764,23070
1765,230701766,230701767,230701768,230701769,230701770,230701771,230701772,230701773,230701774,230701775,230701776,230701777,2307
01778,230701779,230701780,230701781,230701782,230701783,230701784,230701785,230701786,230701787,230701788,230701789,230701790,230
701791,230701792,230701793,230701794,230701795,230701796,230701797,230701798,230701799,230701800,230701801,230701802,230701803,23
0701804,230701805,230701806,230701807,230701808,230701809,230701810,230701811,230701812,230701813,230701814,230701815,230701816,2
30701817,230701818,230701819,230701820,230701821,230701822,230701823,230701824,230701825,230701826,230701827,230701828,230701829,
230701830,230701831,230701832,230701833,230701834,230701835,230701836,230701837,230701838,230701839,230701840,230701841,230701842
,230701843,230701844,230701845,230701846,230701847,230701848,230701849,230701850,230701851,230701852,230701853,230701854,23070185
5,230701856,230701857,230701858,230701859,230701860,230701861,230701862,230701863,230701864,230701865,230701866,230701867,2307018
68,230701869,230701870,230701871,230701872,230701873,230701874,230701875,230701876,230701877,230701878,230701879,230701880,230701
881,230701882,230701883,230701884,230701885,230701886,230701887,230701888,230701889,230701890,230701891,230701892,230701893,23070
1894,230701895,230701896,230701897,230701898,230701899,230701900,230701901,230701902,230701903,230701904,230701905,230701906,2307
01907,230701908,230701909,230701910,230701911,230701912,230701913,230701914,230701915,230701916,230701917,230701918,230701919,230
701920,230701921,230701922,230701923,230701924,230701925,230701926,230701927,230701928,230701929,230701930,230701931,230701932,23
0701933,230701934,230701935,230701936,230701937,230701938,230701939,230701940,230701941,230701942,230701943,230701944,230701945,2
30701946,230701947,230701948,230701949,230701950,230701951,230701952,230701953,230701954,230701955,230701956,230701957,230701958,
230701959,230701960,230701961,230701962,230701963,230701964,230701965,230701966,230701967,230701968,230701969,230701970,230701971
,230701972,230701973,230701974,230701975,230701976,230701977,230701978,230701979,230701980,230701981,230701982,230701983,23070198
4,230701985,230701986,230701987,230701988,230701989,230701990,230701991,230701992,230701993,230701994,230701995,230701996,2307019
97,230701998,230701999,230702000,.USO O DESTINO: ACCESORIO DE TENSIOMETRO HS-20C, TECNICA DE DIAGNOSTICO: MANUAL,MARCA: DM CANT.
1000 U //XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

032023001507258-1	Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

BIOMEDICAL SOLUTIONS
INGENIERIA

NIT. 53116519-2
REGIMEN COMUN
DIAG. 5ª No. 37B 60 BLOQUE 15ª APTO. 503
BOGOTA – COLOMBIA

Certificado N° MP-701-24

INFORMACION DEL SOLICITANTE
Customer information

CLIENTE: **HOSPITAL SAN VICENTE**
Client

CIUDAD: ROVIRA **(TOLIMA)**
City

INFORMACION DEL EQUIPO BAJO PRUEBA.
Device under test information.

EQUIPO: TENSIOMETRO
Equipment
MARCA: DM
Brand
MODELO: HS20C
Model
SERIE: 15964
Serial
ID. Institución:
ID. Institution

LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRUEBA
Place and conditions of test

Lugar de la Calibración: Laboratorio de metrología
Place of Calibration
Fecha de Calibración: 2024-12-12
Date of Calibration
Fecha de Recepción: 2024-12-06
Date of Receipt
TEMPERATURA: 19 °C
Temperature
HUMEDAD R: 61 %
Humidity

NOTAS:
Notes:

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso escrito de BIOMEDICAL SOLUTIONS.
Los resultados contenidos en el presente documento se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos probados.
El usuario es responsable del seguimiento de sus instrumentos a intervalos apropiados.

FIRMA:

FABIAN ALFONSO ARCE RAMIREZ
INGENIERO DE CALIBRACION

BIOMEDICAL SOLUTIONS
INGENIERIA

Certificado N° MP-701-24

Trabajo realizado:
Calibración del equipo

Método utilizado:
Comparación directa según procedimiento me003 del CEM. La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura K=2

Información de Trazabilidad
Nuestros instrumentos son trazables a estándares internacionales

Información de los instrumentos utilizados

PATRON	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA CALIBRACION	CERTIFICADO
MANOMETRO DE PRESION DIGITAL	NO REGISTRA	LK-168ª	01713093	2024-10-12	C5425-24

RESULTADOS DE CALIBRACION

Posición del item y el patrón durante la calibración: HORIZONTAL
Estado de la caratula y aguja indicadora/display: En buen estado
Comprobación de fugas: sistema neumático sin fugas
Escala del item: 2mmHg

COMPROBACION INICIAL EN TRES PUNTOS		
PRESION INDICADA EN EL ITEM (mmHg)		PRESION INDICADA EN EL PATRON (mmHg)
PUNTO BAJO	100	100,1
PUNTO MEDIO	150	150,2
PUNTO ALTO	300	300,2

MEDICIONES DE PRESION (mmHg)				
PROMEDIO DE PRESION INDICADA EN EL ITEM (mmHg)	PRESION INDICADA EN EL PATRON (mmHg)	ERROR (mmHg)	INCERTIDUMBRE (mmHg)	
0	0,0	0,0	±	0,70
50	50,1	0,1	±	0,71
100	100,1	0,1	±	0,71
150	150,2	0,2	±	0,72
200	200,2	0,2	±	0,72
250	250,2	0,2	±	0,72
300	300,2	0,2	±	0,72

ERROR MAXIMO: 0,2 mmHg
INCERTIDUMBRE MAXIMA: +/- 0,72 mmHg

La unidad de presión en el Sistema Internacional de Unidades es el Pascal: 1 mmHg = 133,322 Pa

Anomalías detectadas antes y durante la calibración: NINGUNA

FIN DEL CERTIFICADO

SET GAD Metrología

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-004

NVLAP CALIBRATION
NVLAP LAB CODE 201065-0

ilac-MRA

Certificado de Calibración

Certificado #
C5425-24

Laboratorio de Metrología Set y Gad S.A.S. — Bogotá

Descripción del equipo:	Manómetro de Presión digital	Condición como se recibió:	Operable
Fabricante:	LK-168A	Fecha de calibración:	2024-10-12
Serie No.:	01713093	Método de Calibración:	LAB-SIMSV-060
Nombre del cliente:	Biomedical Solutions	Temperatura:	21,6 °C
Dirección:	Diag. 5A N°37b60	Humedad:	51%
Ciudad:	BOGOTA		
Fecha de recepción	2024-10-02		

Patrones de calibración

Instrumento	Número de Serie	Due Date	ID Certificado
PATRON DE PRESION	34794	02/03/2023	FP021-23

Descripción de la calibración

La calibración del equipo bajo prueba se hace con un instrumento patrón trazable al sistema internacional de unidades... Los resultados emitidos en este certificado de calibración, describe al equipo bajo prueba en el momento que está siendo calibrado.
Este certificado de calibración no puede ser reproducido ni parcial ni de forma completa, sin la aprobación escrita del laboratorio SET & GAT.
Calibración: Datos de calibración obtenidos sin haber realizado ninguna clase de ajustes y/o reparación.
Set & Gad mantiene los patrones de referencia en condiciones físicas adecuadas para su conservación, estos patrones han sido calibrados con trazabilidad internacional o nacional, bajo estándares definidos por casa matriz, dependiendo de sus especificaciones.
El usuario es responsable de la caliración de sus instrumentos a intervalos adecuados.

S-G Metrología

Digitally signed by Felipe Uribe
DN: cn=Felipe Uribe, o=Set y Gad SAS, email=felipe.urib@esetgad.com, c=CO

Revisó y autorizó calibración
Ing. Luis Felipe Uribe Agudelo

Carrera 48 # 101 A - 69, Bogotá, Colombia
www.setgad.com

DIOS AYUDA A QUIEN CONFÍA EN ÉL

SET∝GAD Metrología

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-004

NVLAP CALIBRATION
NVLAP LAB CODE 201065-0

ilac-MRA

Certificado de Calibración

Certificado #
C5425-24

RESULTADOS DE LA MEDICION

Calibración de Presión

Precarga	IBC mmHg	Patrón mmHg	Corrección mmHg	Incertidumbre mmHg	k
300,0 mmHg	300	296,7	-3,3	0,72	2
Nominal	IBC mmHg	Patrón mmHg	Corrección mmHg	Incertidumbre mmHg	k
0,0 mmHg	0	0	0	0,58	2
50,0 mmHg	50	50,8	0,8	0,58	2
100,0 mmHg	100	100,7	0,7	0,58	2
150,0 mmHg	150	149,4	-0,6	0,58	2
200,0 mmHg	200	199,4	-0,6	0,58	2
250,0 mmHg	250	247,6	-2,4	0,58	2
300,0 mmHg	300	297,6	-2,4	0,72	2

Medición 1 mmHg	Medición 2 mmHg	Medición 3 mmHg	Medición 4 mmHg	Medición 5 mmHg
0	0	0	0	N/A
50,8	50,2	50,1	50,3	N/A
100,7	100,2	100,1	100,4	N/A
149,4	149,1	149,2	149,2	N/A
199,4	199,6	199,7	199,4	N/A
247,6	247,7	247,2	247,5	N/A
297,6	297,2	296,5	296,9	N/A

FIN DEL CERTIFICADO

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

Código	F-BIO-001
Versión	1
Fecha	Febrero 2017
Página	1 de 1

1. INFORMACION DE EQUIPO

EQUIPO	TERMOHIGROMETRO		REGISTRO INVIMA	-			
MARCA	KNS		SERVICIO	TAB			
MODELO	SN094		UBICACIÓN	AMB. NXY747			
SERIE	044048040-3		CALIBRACIÓN	ANUAL			
N.° INVENTARIO			TIPO DE EQUIPO	FIJO		MOVIL	X
FECHA DE COMPRA	13/12/2024	FECHA INSTALACION	13/12/2024	GARANTIA			
EQUIPO PROPIO		EQUIPO COMODATO		DONACION			

2. FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO

MENSUAL		BIMENSUAL		TRIMESTRAL		CUATRIMESTRAL	X	SEMESTRAL		ANUAL	

REGISTRO FOTOGRAFICO	ACCESORIOS	
	CANTIDAD	ACCESORIO
		

3. CARACTERISTICAS TECNICAS


VOLTAJE	1XAAA	CORRIENTE	N/A	POTENCIA	N/A	FRECUENCIA	N/A	TEMP. DE TRABAJO	

CLASIFICACION RIESGO SEGUN 4725 DE 2005		CLASIFICACION DE USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		TECNOLOGIA PREDOMINANTE			
				DIAGNOSTICO					
				MTTO DE LA VIDA		ELECTRICO		NEUMATICO	
RIESGO I		MEDICO		PREVENCION		ELECTRONICO	X	ACUSTICO	
RIESGO IIA		BASICO		REHABILITACIÓN		ELECTROMECANICO		SOLAR	
RIESGO IIB		APOYO		EQ. LABORATORIO	X	MECANICO		VAPOR	
RIESGO III		OTRO	X	EQ. ODONTOLOGIA		HIDRAULICO		OTRO	

4. RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

EVITE GOLPEAR EL EQUIPO.
EVITE SUMERGIR EL EQUIPO EN LIQUIDOS.
REVISE LAS BATERÍAS PERIODICAMENTE.

HOSPITAL SAN VICENTE
ROVIRA TOLIMA

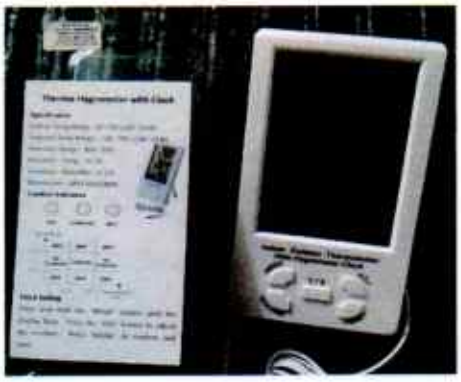

HOJA DE VIDA DE EQUIPO

EQUIPO: TERMOHIGROMETRO	MARCA: KNS	MODELO: SN094
SERIE: 04404804-03	CLASIFICACION DE DISPOSITIVO MEDICO: Riesgo Bajo (I) DIAGNOSTICO	
FECHA DE COMPRA: 13-12-2024	FECHA DE INSTALACION: 13-12-2024	VENCIMIENTO DE GARANTIA: UN AÑO
DATOS DEL PROVEEDOR: OSMEC AMBULANCIA	TELEFONO: 3153083450	

PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO: ANUAL	UBICACIÓN: AMBULANCIA PLACA NXY 747	EQUIPO:	MOVIL X	FIJO	

REGISTRO INVIMA :

FUNCIONES: Mide la temperatura y la humedad relativa de un ambiente determinado

RECOMENDACIONES DE FABRICANTE:

- No golpear el equipo,
- Verificar el funcionamiento antes de iniciar el turno.

REGISTRO TECNICO DE INSTALACION

VOLTAJE: 1,5V (1*AAA)	TAMAÑO: 10 X 4 X 8 cm	POTENCIA: N/A
TEMPERATURA: +10° C + 40° C	PESO: 130 gr	PRESION N/A

REGISTRO TECNICO DE FUNCIONAMIENTO

HUMEDAD: hasta 100% de humedad relativa	Condiciones de almacenamiento: Sin pila : -25°C a +70° C (-13° F a +158° F)	

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PLANIFICADO SEGÚN PARAMETROS DE FABRICANTE

EQUIPO	TERMOHIGROMETRO
MARCA	KNS
MODELO	SN094
SERIE	04404804-03
N° INVENTARIO	

- Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo
- Efectuar limpieza integral externa del equipo
- Efectuar limpieza integral interna del equipo
- Inspeccionar sistema de conexión de las pilas
- Verificar el funcionamiento de los empaques
- Verificar el manometro
- Verificar funcionamiento del equipo en conjunto.

Material Gastable	Repuestos Minimos	Herramientas y Equipos
• FRANELA • LIMPIADOR DE CONTACTOS • LIMPIADOR DE SUPERFICIES LIQUIDO		

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2022**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario **352022000477591-1**

Importador	5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 860070078	6. DV 3	11. Apellidos y nombres o Razón Social IMCOLMEDICA S.A			
	13. Dirección CL 36 15 42		15. Teléfono 2869858	Cód. Admón. 35	16. Cód. Dpto 11	17. Cód. Ciudad Municipio 001
Declarante	24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 860028026	25. DV 3	26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA GRANCOLOMBIANA S.A. NIVEL 1		27. Tipo usuario 26	28. Cód. usuario 0010
	29. Número documento de identificación 31585171		30. Apellidos y nombres KAREN LIZETH CHAVERRA MEJIA			

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BUN	25578	No. 116575012735213	2022 - 09 - 21	No. OLC22080109BUN	2022 - 08 - 13

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
9025804900	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	215	XXX

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 31223898 DECLARACION(1-4) PEDIDO IMP 220116 - F-6946 // MERCANCIA NUEVA // VISTO BUENO: VEIC-2244618 DEL 2022-10-06 // NOS ACOGEMOS AL DECRETO 272 DEL 2018, GRAVAMEN 0% //. PRODUCTO: TERMOMETRO HIGROMETRO DIGITAL, MARCA: SIN MARCA, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: SIN REFERENCIA / ITEM. SN094, USO O DESTINO: EN LABORATORIO, PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO: ELECTRONICO DIGITAL, SERIAL: NO TIENE, 0+50°C/ +32+122 FAHRENHEIT 20-99% AVEC SONDA VIENE SIN BATERIA, AÑO DE FABRICACION: 2022, KNS THERMO HYGROMETER SHINING ELECTRIC DIGITAL IN OUT THERMOMETER - HYGROMETER - CLOCK,. // INDOOR OUTDOOR THERMOMETER WITH HYGROMETER CLOCK CON MANUAL DE INSTRUCIONES, CANT (1000) PCS (ITEM 1). IMCOLMEDICA S.A // KNS MEDTECH CO., LIMITED. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Después de insp.: levante No hay declaración posterior Acta de inspección No.: 352022000050010 Inicio: 2022-10-12 17:50:16 Finalizó: 2022-10-14 22:31:00	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 352022000477591 133. Fecha 2022 10 11

134. Levante No. 352022000427343	135. Fecha 2022 - 10 - 14	Firma funcionario responsable	136. Nombre BERTHA EDDISA CARDENAS CANDELO 137. C.C.No. 1,111,747,797

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	**980. Pago Total $** 996. Espacio para Número autoadhesivo **91035020150689**

Fecha de Impresión: 2022-10-15 09:36:37

defi1757892521

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2022**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario **352022000477590-2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860070078	6. DV: 3	11. Apellidos y nombres o Razón Social: IMCOLMEDICA S.A

13. Dirección: CL 36 15 42	15. Teléfono: 2889858	12. Cód. Admón.: 35	16. Cód. Dpto: 11	17. Cód. Ciudad Municipio: 001

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860028026	25. DV: 3	26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA GRANCOLOMBIANA S.A. NIVEL 1	27. Tipo usuario: 26	28. Cód. usuario: 0010

29. Número documento de identificación: 31585171	30. Apellidos y nombres: KAREN LIZETH CHAVERRA MEJIA

31. Clase Importador: 02	32. Tipo declaración: Inicial	33. Cod.: 1	34. No. Formulario Anterior: XXXXXXXXXXXXXX	35. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX	36. Cod. Admón.: XX	37. Declaración de Exportación: No. XXXXXXXXXXXXXX	38. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX	39. Cod. Admón.: XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías: BUN	41. Cod. Depósito: 25578	42. Manifiesto de carga: No. 116575012735213	43. Año - Mes - Día: 2022 - 09 - 21	44. Documento de transporte: No. OLC22080109BUN	45. Año - Mes - Día: 2022 - 08 - 13

S	59. Subpartida arancelaria: 9107000000	60. Cod. Complementario: XX	61. Cod. Suplementario: XX	62. Cod. Modalidad: C100	63. No. cuotas o meses: XX	64. Valor cuota USD: XXXX	65. Periodicidad del pago de la cuota: XX	66. Cod. país de origen: 215	67. Cod. Acuerdo: XXX

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, señales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 31220898 DECLARACION(2-4) IMP 220116 - PEDIDO P-8946 // NOS ACOGEMOS AL DECRETO 1881 DEL 2021, GRAVAMEN 0% //. PRODUCTO: RELOJ CRONOMETRO PARA LABORATORIO, MECANISMO: ELECTRONICO, MARCA: SIN MARCA, REFERENCIA: SIN REFERENCIA / ITEM. SN360, SERIAL: NO TIENE, 4 CHANNELS TIMER DIGITAL AUDIO TIMERS MULTIFUNCTIONAL STAIRS TIMER // KNS TIMER, 4 GROUPS TIMER, CON MANUAL DE INSTRUCCIONES, VIENE SIN BATERIA. KNS TIMER. MERCANCIA NUEVA, AÑO DE FABRICACION 2022 CANT (500) PCS (ITEM 2). IMCOLMEDICA S.A// KNS MEDTECH CO., LIMITED. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No. XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración: 352022000477590 133. Fecha: 2022 10 11

134. Levante No. 352022000423441	135. Fecha: 2022 - 10 - 12	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	980. Pago Total $ 0 996. Espacio para Número autoadhesivo **91035020150736**

Fecha de Impresión: 2022-10-12 17:50:19

20223804066418

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2022**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

352022000477616-5

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	11. Apellidos y nombres o Razón Social
860070078	3	IMCOLMEDICA S.A

13. Dirección	15. Teléfono	Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CL 36 15 42	2889858	35	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
860028026	3	AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA GRANCOLOMBIANA S.A. NIVEL 1	26	0010

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
31585171	KAREN LIZETH CHAVERRA MEJIA

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BUN	25578	No. 116575012735213	2022 - 09 - 21	No. OLC22080109BUN	2022 - 08 - 13

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	9025804900	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	215	XXX

69. Descripción de las mercancías(No incluir la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, señales y serie) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 31220898 DECLARACION(3-4) PEDIDO IMP 220116 - P-8946 // MERCANCIA NUEVA // VISTO BUENO: VSIC-2244624 DEL 2022-10-06 // NOS ACO GEMOS AL DECRETO 272 DEL 2018, GRAVAMEN 0% // MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL, VALORES SOLO PARA EFECTOS ADUANEROS //. PRODUCTO: TER MOMETRO HIGROMETRO DIGITAL CON SONDA EXTERIOR, MARCA: INSTRUTHERM, MODELO: HT - 730, REFERENCIA: SIN REFERENCIA / ITEM. SN002, US O O DESTINO: EN LABORATORIO, PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO: ELECTRONICO DIGITAL, SERIAL: NO TIENE, 0+50°C/ +32+122 FAHRENHEIT 20-99 % AVEC SONDA, AÑO DE FABRICACION: 2022, THERMO-HYGROMETER WITH OUTDOOR SENSOR FREE SAMPLE // TERMO - HIGROMETRO DIGITAL, CON SU R ESPECTIVO CABLE, VIENE SIN BATERIA, CANT (2) PCS (ITEM 4), PRODUCTO: TERMOMETRO HIGROMETRO DIGITAL, MARCA: (continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No. XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 352022000477616 133. Fecha: 2022 10 11

134. Levante No. 352022000423443	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
	2022 - 10 - 12		

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	**980. Pago Total $** 996. Espacio para Número autoadhesivo **9103502015080 8**

Fecha de Impresión: 2022-10-12 17:50:52

20222561098286

BIOMEDICAL SOLUTIONS
INGENIERIA

NIT. 53116519-2
REGIMEN COMUN
DIAG. 5ª No. 37B 60 BLOQUE 15ª APTO. 503
BOGOTA – COLOMBIA

Certificado N° MP-703-24

INFORMACION DEL SOLICITANTE
Customer information

CLIENTE: **HOSPITAL SAN VICENTE**
Client

CIUDAD: **ROVIRA (TOLIMA)**
City

INFORMACION DEL EQUIPO BAJO PRUEBA.
Device under test information.

EQUIPO: TERMOHIGROMETRO
Equipment
MARCA: KNS
Brand
MODELO: SN094
Model
SERIE: 04404804-03
Serial
ID. Institución:
ID. Institution

LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRUEBA
Place and conditions of test

Lugar de la Calibración: LABORATORIO
Place of Calibration
Fecha de Calibración: 12/12/2024
Date of Calibration
Fecha de Recepción: 06/12/2024
Date of Receipt
TEMPERATURA: 21,2 °C
Temperature
HUMEDAD R: 56 %
Humidity

NOTAS:
Notes:

Este documento no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso escrito de BIOMEDICAL SOLUTIONS. Los resultados contenidos en el presente documento se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos probados. El usuario es responsable del seguimiento de sus instrumentos a intervalos apropiados.

FIRMAS
Signatures:

FABIAN ALFONSO ARCE RAMIREZ
INGENIERO DE CALIBRACION

BIOMEDICAL SOLUTIONS
INGENIERIA

Certificado N° MP-703-24

Trabajo realizado:
Calibración del equipo

Método utilizado:
Comparación directa en medios isotermos de temperatura y humedad relativa controlada. La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura K=2.
Procedimiento **TH007** del **CEM.**

Información de Trazabilidad
Los resultados de este certificado de calibración son trazables al SI a través de un instituto de medición reconocido nacionalmente y cumple con la norma ISO 17025:2017.

Información de los instrumentos utilizados

PATRON	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA CALIBRACION	CERTIFICADO
DATALOGGER	VTA	VTA-84663	NO TIENE	2024-11-28	CC295479

RESULTADOS DE CALIBRACION

MEDICIONES DE TEMPERATURA			
TEMPERATURA INDICADA EN EL PATRON °C	TEMPERATURA INDICADA EN EL ITEM °C	ERROR	INCERTIDUMBRE °C
20,5	20,7	0,2	0,24
25,5	25,6	0,1	0,23
30,5	30,6	0,1	0,23

ERROR MAXIMO: 0,2 °C
INCERTIDUMBRE MAXIMA: 0,24 °C

MEDICIONES DE HUMEDAD (%Hr)			
HUMEDAD INDICADA EN EL PATRON (%)	HUMEDAD INDICADA EN EL ITEM (%)	ERROR	INCERTIDUMBRE %
35	35	0	0,15
45	46	1	0,16
65	66	1	0,16

ERROR MAXIMO: 1%

INCERTIDUMBRE MAXIMA: 0,16 %

- FIN DEL CERTIFICADO