SUMINISTROS RADIOGRÁFICOS S.A.S

800099568-9

Orden de Trabajo

N°: OT-2661- 24

Fecha: **2024-10-24**

Calificación: 5

GENERÓ: MARIA ISABEL JIMENEZ GUERRA

RESPONSABLE: JHON ESTEBAN CANO MESA

DURACIÓN ESTIMADA: 03:00:00

NOTAS:

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: CR CARESTREAM POINT-OF-CARE 145 VITA CR SYSTEM 141014150 IIA N/D { SR00667 }

UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // ZONA 2/ HOSPITAL SAN RAFAEL (YOLOMBÓ)/

CLASIFICACIÓN 1: HABILITADO CARTERA

TIPO: HORARIO HÁBIL

CLASIFICACIÓN 2: CONTRATO SR

PRIORIDAD: Media

CENTRO DE COSTO:

CÓDIGO DE BARRAS: K8501-6330

TAREA NO PLANIFICADA

DESCRIPCIÓN: PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA: 2024-10-24

FECHA Y HORA DE INICIO: 2024-10-24 14:30

TIPO DE TRABAJO: PREVENTIVA

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2024-10-24 17:30

PRIORIDAD: Media

TIEMPO TOTAL DE TRABAJO: 03:00:00

ACTIVADOR: Tarea no Programada

TIEMPO FUERA DE SERVICIO: 00:00:00

CLASIFICACIÓN 1:

SOLICITADO POR: MARIA ISABEL JIMENEZ GUERRA

CLASIFICACIÓN 2:

NÚMERO DE SOLICITUD:

FECHA DEL EVENTO: 2024-10-24 07:00

NOTAS:

SUBTAREAS

Grupo/Parte	Procedimiento	Resultado
	REALIZAR LIMPIEZA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE COLECTOR/PMTS	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
	REALIZAR LIMPIEZA, VERIFICACIÓN DEL LENTE ÓPTICO	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
	REALIZAR LIMPIEZA Y AJUSTE FOLD MIRROR	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
	VERIFICAR ESTADO LAMPARAS DE BORRADO	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
	LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN RODILLOS DE TRANSPORTE	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló

Todos los derechos reservados

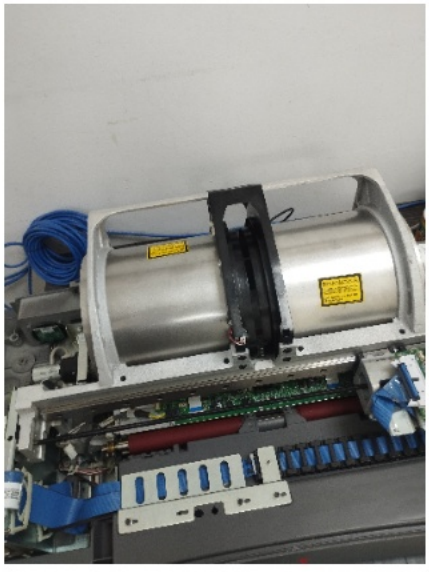
	REALIZAR LIMPIEZA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DEL SLOW SCAN	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
	REALIZAR LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE CPU/MONITOR	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
	REALIZAR LIMPIEZA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS INTERNO	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
	REALIZAR LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN SELLOS DE LUZ	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
	REALIZAR LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN FILTRO DE AIRE	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
	REALIZAR LIMPIEZA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DEL EXTRACCIÓN BAR	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
	REALIZAR LIMPIEZA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE PARTES MECÁNICAS	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
	REALIZAR CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CASSETTES Y PANTALLAS	☐ Aprobó ☑ Alerta ☐ Falló
	REALIZAR VERIFICACIÓN DE VOLTAJES DE ALIMENTACIÓN E INTERNOS	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
	QUEDA EL EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE?	☐ Si ☑ No ☐ N/A
	OBSERVACIONES. .	Se revisa estado y funcionamiento del equipo, se realiza rutina de mantenimiento preventivo, el equipo aparentemente se encuentra en buen estado, los chasis y las pantallas tienen desgaste natural por uso. El equipo no es utilizado por el cliente.

RECURSOS A UTILIZAR

Descripción	Cantidad	Costo	Cantidad Usada	Tipo	Fuente
FLUKE 179 TRUE RMS MULTIMETER 51170534 FLUKE CORPORATION FLUKE-179 EDSNF { SR.HER_0016 } ACTIVO N/D	1	N/A	0	Inventario	ALMACÉN DE HERRAMIENTAS

Todos los derechos reservados

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	
	

Todos los derechos reservados

María Isabel López	MARIA ISABEL JIMENEZ GUERRA	JHON ESTEBAN CANO MESA
Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por

Todos los derechos reservados