

	ESE CENTRO DE SALUD PÁRAMO		Código: AP-GJC-R-11
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión: 0.1
	Fecha de Actualización : Noviembre de 2019		Página : 1 de 10
	Elaboró: Profesional Universitario Asesor Externo Calidad	Revisó: Gerencia	Aprobó: Comité de Calidad

INFORME DE SUPERVISION UNICO

CONTRATO No.	051-2025 PROCESO CONVOCATORIA PUBLICA N° 001-2025
CLASE DE CONTRATO	DE COMPRA Y/O ADQUISICION
CONTRATANTE	ESE CENTRO DE SALUD MUNICIPIO DEL PARAMO NIT: 804.014.835-0 R/L: DAISY CAROLINA CORREDOR- Gerente C.C. 1.100.954.816 de San Gil
CONTRATISTA	RODA EXPRESS NIT: 37893838 de San Gil. ROCIO DEL PILAR DELGADO MENDOZA C.C. N° 37.893.838 San Gil Carrera 12 # 5 – 126 Apartamento 1203 Teléfono: 315 8234303 Email: rodaexpress2004@yahoo.com.
OBJETO	CONTRATO DE COMPRA Y/O ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ATENCIÓN DE USUARIOS CORRESPONDIENTE A LOS EQUIPOS BÁSICOS POR PARTE DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE PÁRAMO - SANTANDER SEGÚN RESOLUCIÓN No 1212 DE 2024 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.
PLAZO DE EJECUCION	CINCO (05) DIAS HABILES
VALOR	DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS (\$12.904.110)
FECHA DE INFORME	11 DE JULIO DE 2025

PERÍODO DE EJECUCIÓN

DESDE EL 28 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2025

SEGURIDAD SOCIAL

No. Planilla	33949200	
Salud	Salud Total	\$ 1.500.000
Pensión	Colpensiones	\$2.040.000
ARL	La Equidad	\$62700

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	\$12.904.110.00	
VALOR CANCELADO ACTA DE PAGO UNICA		\$12.904.110.00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		\$ 00
SUMAS IGUALES	\$12.904.110.00	\$12.904.110.00

	ESE CENTRO DE SALUD PÁRAMO		Código: AP-GJC-R-11
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión: 0.1
	Fecha de Actualización : Noviembre de 2019		Página : 2 de 10
	Elaboró: Profesional Universitario Asesor Externo Calidad	Revisó: Gerencia	Aprobó: Comité de Calidad

BIENES SOLICITADOS EN EL CONTRATO

No	DISPOSITIVO MEDICO.	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	BASCULA DIGITAL TIPO ADULTO - GRADO MÉDICO	BALANZA DIGITAL DE PISO: 180 KG PLATAFORMA SUPERAMPLIA DESCONEXION AUTOMATICA. BASCULA DIGITAL DE PISO PESA PERSONAS ELECTRONICA ADULTO, ADULTO + BEBE, QUE SOPORTE MAXIMO 180 KILOGRAMOS, DIVISION 50G (0.1 LB) PANTALLA LED DE 38 MM, CON INDICADORES Lo / Err, AUTO ENCENDIDO, FUENTE DE ALIMENTACION 4 PILAS AAA, DIMENSIONES 34 X 34 X 2,8 CM, COLOR NEGRO.	4	\$511.546,49	\$ 2.046.185,96
2	TENSIÓMETRO ADULTO	TENSIOMETRO ANEROIDE MANUAL ADULTO CON BRAZALETE NO.11 CON ESTUCHE. Tensiometro con diseño integrado montado en el manguito o brazalete, compacto y ligero para facilitar su uso, indicador del manometro rota 360° sobre el brazalete que permita su lectura desde cualquier ángulo, con protector de plástico blando alrededor de la esfera, Dispositivo que contenga tecnología Durashock libre de piñones, resistente a golpes de 76cm de altura, Brazalete con sistema flexiport que permita hacer rápidamente el cambio del tamaño del brazalete y la limpieza del mismo, Intervalos de funcionamiento y visualización de 0 a 300 mmHg, precisión de los esfigomanómetros es de +/- 3mmHg, Escala con graduación con incrementos de 2mmHg,	4	\$ 346.003,45	\$ 1.384.013,79



ESE CENTRO DE SALUD PÁRAMO		Código: AP-GJC-R-11
INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión: 0.1
Fecha de Actualización : Noviembre de 2019		Página : 3 de 10
Elaboró: Profesional Universitario Asesor Externo Calidad	Revisó: Gerencia	Aprobó: Comité de Calidad

		Válvula con sistema de desinflado y seguridad anti fuga de aire, que contenga garantía de calibración por uso de 5 años, que sea Libre de mercurio y de látex, que contenga los siguientes accesorios o componentes: Manguito o brazalete con tecnología Flexiport, Pera mediana estándar con válvula de liberación de aire, Estuche flexible para almacenamiento.			
3	FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS	FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS PROFESIONAL - COLOR NEGRO - USO: ADULTO. Estetoscopio de uso general, acústica que permita una auscultación precisa de sonidos cardíacos, pulmonares y vasculares. Pieza torácica de cabezal doble (campana y diafragma plano) de acero inoxidable con aros anti-enfriamiento Binaurales giratorios Olivas intercambiables de sellado cómodo tipo rosca. Libre de látex Adulto pediátrico Longitud Total: 710mm Material de pieza pectoral: Acero inoxidable Rango de frecuencia: 20 a 500 Hz Accesorios: Olivas duras y blandas	4	\$ 370.787,34	\$ 1.483.149,36
4	EQUIPO DE ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS PORTÁTIL	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS LED Y OTOSCOPIO. OFTALMOSCOPIO: Altura Total 17,5 cm, Ancho del Cabezal 3,3 cm, Profundidad del Cabezal 3,0 cm, Diámetro del Mango 2,1 cm, Peso Cabezal y Mango (Sin baterías) 2,56 oz. (72,6 gr.), Tipo de Batería (No incluida)	4	\$ 1.331.902,74	\$ 5.327.610,96



ESE CENTRO DE SALUD PÁRAMO		Código: AP-GJC-R-11
INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión: 0.1
Fecha de Actualización : Noviembre de 2019		Página : 4 de 10
Elaboró: Profesional Universitario Asesor Externo Calidad	Revisó: Gerencia	Aprobó: Comité de Calidad

		Alkalina AA x 2, Duración de la Batería 5 horas, Tipo de Bombillo LED SureColor, Duración del Bombillo Hasta 20.000 horas, Rango de Dioptrías -20 a 20, Escala de Dioptrías -20, -15, -10, -8, -6, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20, Tipos de Filtro Libre de Rojo, Azul Cobalto, Tamaños del Punto de Apertura 5 (Micropunto, Pequeño, Grande, Ranura, Fijación), Apertura Grande de Flujo Total (Lúmenes, Andor) 20 a 50 Lúmenes, Campo de Iluminación/Distribución, Apertura Grande 11,4 mm a una Distancia de 50 mm, Estándares IEC 60601-1, 60601-1-2, ISO 15004-1, 15004-2, 10942, 10993-1. OTOSCOPIO: Altura Total 16,8 cm, Ancho del Cabezal 3,0 cm, Profundidad del Cabezal 5,1 cm, Diámetro del Mango 2,1 cm, Peso Cabezal y Mango (sin baterías) 2,53 oz (71,7 g), Tipo de Batería (No incluida) Alkalina AA x 2, Duración de la Batería > 5 horas, Tipo de Bombillo LED SureColor, Duración del Bombillo Hasta 20.000 horas, Transmisión de Luz Fibra Óptica, Capacidad de Aumento 3,6X, Dioptría 10,4, Distancia de trabajo con Espéculos de 4.5mm (visual, mejor distancia de enfoque) 12.4			
5	PULSOXIMETRO	PULSOXIMETRO DE DEDO PARA PACIENTE ADULTO. Monitorización de SPO2 y frecuencia de pulso. • Visualización en pantalla de SPO2, frecuencia de pulso, onda de pletismografía y barra de perfusión. • Indicador de nivel de la batería. • Diferentes modos de pantalla. • Ajuste de brillo de pantalla.	4	\$ 227.482,78	\$ 909.931,12



ESE CENTRO DE SALUD PÁRAMO		Código: AP-GJC-R-11
INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión: 0.1
Fecha de Actualización : Noviembre de 2019		Página : 5 de 10
Elaboró: Profesional Universitario Asesor Externo Calidad	Revisó: Gerencia	Aprobó: Comité de Calidad

		• Bajo consumo de energía. • Tamaño pequeño (57mm x 31mm x 32mm), liviano y portable. • Pantalla doble color • Rango SPO2: 0-100% • Resolución de 1% Precisión: $\pm 2\%$ (70% - 100%) • Rango de frecuencia de pulso: 30-250 rpm • Resolución 1 rpm • Precisión: ± 2 rpm ó 2% • Batería: 2 baterías alcalinas AAA, autonomía de trabajo de 36 h continuas.			
6	TERMÓMETRO INFRARROJO (PISTOLA)	TERMOMETRO INFRARROJO MEDICO. Termómetro infrarrojo médico. Ø Tipo de seguridad eléctrica: Fuente de alimentación interna, partes aplicadas (Tipo BF). Ø Grado de protección: IPX0. Ø Clasificación de seguridad: Equipo no se puede usar en presencia de mezcla gas anestésico inflamable y aire o con oxígeno u óxido nitroso. Ø Modo de operación: Operación continua. Ø Unidades de temperatura: Celsius (°C) /Fahrenheit (°F). Ø Resolución: 0.1 °C. Ø Rango de visualización de temperatura: 32°C -42,9 °C Ø Error máximo permitido: Rango de 35.0 °C-42.0 °C, el error máximo permitido es ± 0.2 °C. Rango 35.0 °C y > 42.0 °C, el error máximo permitido es ± 0.3 °C. Ø Máxima repetitibilidad clínica permitida: menos de ± 0.3 °C. Ø Tiempo de medición: < 1 segundo. Ø Modo de visualización: pantalla LCD. Ø Datos de memoria: 30 datos. Ø Administración de energía: Control de consumo de energía (apagado	4	\$ 132.551,02	\$ 530.204,07



ESE CENTRO DE SALUD PÁRAMO		Código: AP-GJC-R-11
INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión: 0.1
Fecha de Actualización : Noviembre de 2019		Página : 6 de 10
Elaboró: Profesional Universitario Asesor Externo Calidad	Revisó: Gerencia	Aprobó: Comité de Calidad

		automático), indicador de nivel de batería baja. Ø Fuente de alimentación: DC 3V (2pilasAAA). Ø Duración de uso: 5 años. Ø Peso: Alrededor de 130 g. Ø Condiciones normales de trabajo y almacenamiento: Rango de temperatura: Trabajo normal: 16 °C 35 °C; Transporte y almacenamiento: 20 °C~+55 °C; Rango de humedad: Operación normal: ≤ 85% (sin condensación). Transporte y almacenaje: ≤ 95 (sin condensación). Presión atmosférica: Operación normal: 525 mmHg795 mmHg (700 hPa 1060 hPa). Transporte y almacenamiento: 375 mmHg ~ 795 mmHg (500 hPa 1060 hPa).			
7	CINTA MÉTRICA	CINTA METRICA ERGONOMICA PARA MEDIR CIRCUNFERENCIAS ALCANCE DE: 0-205 CM, DIV: 1 MM. CINTA METRICA ERGONOMICA PARA MEDIR CIRCUNFERENCIAS, Materiales de alta calidad para una funcionalidad precisa, Alcance de medición: 15-205 cm, División: 1mm, Diámetro: 70 mm, Altura: 22 mm, Peso: aprox. 55 g, la cinta metrica debe venir en caja de forma ergonomica agradable al tacto, en material robusto que soprte caídas sin sufrir deterioro o daño.	4	\$ 39.590,99	\$ 158.363,96
8	TALLÍMETRO.	CINTA METRICA PORTATIL ENROLLABLE DE PARED. CINTA METRICA (TALLIMETRO) PORTATIL ENROLLABLE DE PARED CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MECANISMO DE ENROLLADO PARA ESPACIOS REDUCIDOS, FACIL LECTURA DE	4	\$ 104.252,70	\$ 417.010,79



ESE CENTRO DE SALUD PÁRAMO		Código: AP-GJC-R-11
INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión: 0.1
Fecha de Actualización : Noviembre de 2019		Página : 7 de 10
Elaboró: Profesional Universitario Asesor Externo Calidad	Revisó: Gerencia	Aprobó: Comité de Calidad

		RESULTADOS DE MEDICION A TRAVES DE INDICADOR, CINTA METALICA DE ALTA DURABILIDAD, Alcance de medición: 0-220 cm 1087", División: 1 mm / 1/8", Dimensiones (AxAxP): 125 x 125 x 173 mm / 4,9 x 4,9 x 6,8", Peso: 202 g/0.4 lbs,			
9	INFANTOMETRO.	INFANTOMETRO PARA DETERMINAR TALLA DE NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS. INFANTOMETRO PARA DETERMINAR TALLA DE NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS, ELABORADO ELABORADO EN PLEXIGLAS (MATERIAL INOXIDABLE) CON DOBLE ESCALA EN CENTIMETROS Y PULGADAS CON LONGITUD DE 52 CMS (21 PULGADAS) A 100 CMS (39 PULGADAS), PLEGABLE, CON TOPE CEFALICO, LATERALES LEGROS CON TABLAS DE MEDIDA PARA LOS INFANTES, DIMENSIONES: LARGO 54 CMS, ANCHO 7.3 CM S Y ALTO 150 CMS.	4	\$ 161.910,00	\$ 647.639,98
				VALOR.	\$12.904.110




Se deja constancia del recibido por medio de acta de entrega e informe de entrega por parte del contratista, de los equipos biomédicos en las cantidades y calidad solicitada como se puede observar en las siguientes evidencias fotográficas.

	ESE CENTRO DE SALUD PÁRAMO		Código: AP-GJC-R-11
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión: 0.1
	Fecha de Actualización : Noviembre de 2019		Página : 8 de 10
	Elaboró: Profesional Universitario Asesor Externo Calidad	Revisó: Gerencia	Aprobó: Comité de Calidad

REGISTRO FOTOGRÁFICO



	ESE CENTRO DE SALUD PÁRAMO		Código: AP-GJC-R-11
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión: 0.1
	Fecha de Actualización : Noviembre de 2019		Página : 9 de 10
	Elaboró: Profesional Universitario Asesor Externo Calidad	Revisó: Gerencia	Aprobó: Comité de Calidad

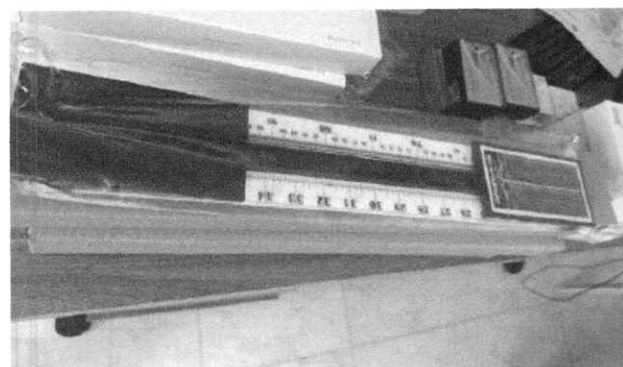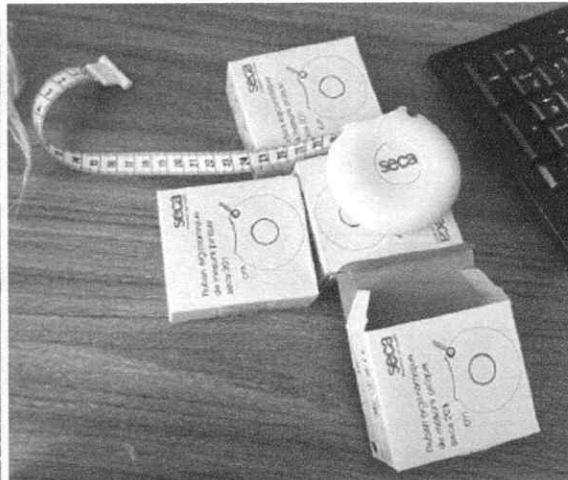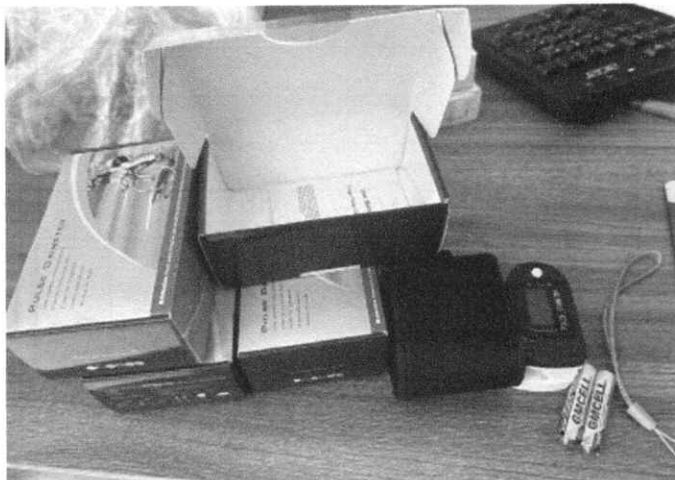

	ESE CENTRO DE SALUD PÁRAMO		Código: AP-GJC-R-11
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión: 0.1
	Fecha de Actualización : Noviembre de 2019		Página : 10 de 10
	Elaboró: Profesional Universitario Asesor Externo Calidad	Revisó: Gerencia	Aprobó: Comité de Calidad

De acuerdo con el cumplimiento de las actividades contratadas en el periodo de ejecución relacionado y de acuerdo con el informe de ejecución presentado por el contratista, se certifica el cumplimiento de las actividades y se procede a autorizar el pago según acta adjunta al presente informe.

CONTRATO No 051-2025 PROCESO CONVOCATORIA PUBLICA N° 001-2025
CONTRATISTA RODA EXPRESS
NIT: 37893838 de San Gil.
ROCIO DEL PILAR DELGADO MENDOZA
C.C. N° 37.893.838 San Gil

OBJETO CONTRATO DE COMPRA Y/O ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ATENCIÓN DE USUARIOS CORRESPONDIENTE A LOS EQUIPOS BÁSICOS POR PARTE DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE PÁRAMO - SANTANDER SEGÚN RESOLUCIÓN No 1212 DE 2024 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.

VALOR DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS (\$12.904.110)

Páramo, once (11) de julio de 2025.


BLANCA LILIA CASTILLO REMOLINA
Supervisor