
Premixslip®

Lubricante de instrumental e Inhibidor de óxido

El único inhibidor de óxido y lubricante para instrumental clínicamente probado para ser completamente penetrable y esterilizable con vapor



Artículo No. 34552-27

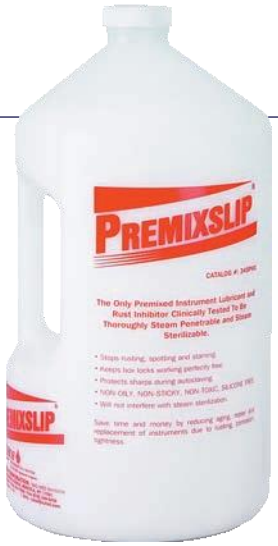

Artículo No. 34552-18

Premixslip® es un lubricante de aceite mineral no pegajoso, no tóxico, libre de silicona y soluble en agua que puede soportar las altas temperaturas del autoclave sin volverse gomoso. Al formar una barrera protectora en los instrumentos quirúrgicos, Premixslip® previene la oxidación, las manchas, y restaura la articulación de las cerraduras y las juntas pegajosas. Utilizado habitualmente como parte del sistema de cuidado de instrumentos Ruhof, Premixslip® reducirá en gran medida los costos de reparación y reemplazo.

Premixslip ® proporciona lubricación y protección permanente para todos los instrumentos quirúrgicos.

Funciones

- **Lubricante de aceite mineral de alta calidad e inhibidor de óxido.**
- **Previene el óxido y manchas prolongando así la vida útil del instrumental.**
- **Evita daños debidos al mal uso de instrumentos rígidos o de rectificación, lo que reduce los costos de reparación y reemplazo.**
- **Vapor penetrable, esterilizable al vapor y esterilizable ETO.**
- **No aceitoso, no pegajoso, no tóxico y libre de silicona.**

Instrucciones de uso

Listo para usar – **No diluir** – Agitar suavemente antes de usar.

Para aplicaciones de pulverización: Artículo No. 34552-18

1. Restrinja el uso del lubricante al área del instrumento que requiera lubricación usando el rociador o el gotero.
2. Deje que Premixslip® penetre en la junta durante unos 30 segundos. Pruebe la acción de la junta lubricada para asegurar la penetración.
3. Para instrumentos excepcionalmente rígidos, vuelva a aplicar y abra y cierre activamente el instrumento hasta que se afloje.
4. Si el lubricante desprende contaminantes secos de la junta, será necesario volver a limpiar el instrumento.
5. Los instrumentos rígidos pueden requerir tratamiento por inmersión en un baño de Premixslip

Para aplicaciones de inmersión: Artículo No. 34552-27

1. Sumerja los instrumentos previamente limpiados en la solución de ® Premixslip.
2. Retire los instrumentos y deje remover el exceso unos 30 segundos.
3. Para instrumentos excepcionalmente rígidos:
   - Coloque el instrumento abierto en solución durante 5 minutos.
   - Abra y cierre activamente la abrazadera o las tijeras en la solución durante 30 segundos.
   - Proceda según las instrucciones.
4. Los instrumentos están listos para la preparación y esterilización terminal. No enjuague, limpie ni seque.
5. Cubra siempre la solución de ® premixslip cuando no esté en uso.

Precauciones: Evite el contacto prolongado con la piel. No tragar. Manténgase alejado de los niños.

IFU/DFU

393 Sagamore Avenue, Mineola, Nueva York
11501 1-800-537-8463 • www.ruhof.com

CE