

	<p align="center">PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN</p> <p align="center">FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACIÓN DE BALANZAS</p>	F3.G8.PP	28/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ____ Balanza Pesa Personas ____ Balanza Pesa Bebés X

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
G02	Seca	334	1245	Gran Britania.	Coordinación

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
1	10-8-22	Cumple	NA	NA	NA	2027


DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	20 Kg	Juego de pesas clase	Paralelepípedo	14-03-25	14-06-25
Carga mínima (Min)	5 Kg	Número de Certificado	Rectangular	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	5g < 10 Kg > 10g		DE 371-30	Nutrición	
Repetibilidad (Indicación en manual)	15	INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)	0.01				

EXCENTRICIDAD			REPETIBILIDAD		
CARGA EN PRUEBA			CARGA EN PRUEBA		
Punto	Indicación	Diferencia	No. Medición	Indicación	Diferencia
1	10.000	0	1	9.995	0.005
2	10.000	0	2	9.990	0.010
3	10.000	0	3	9.990	0.010
4	9.995	0.005	4	9.985	0.015
5	9.990	0.010	5	9.990	0.010
Error máximo obtenido en la prueba		0.005	Error máximo obtenido en la prueba		0.015
Error mínimo obtenido en la prueba		0	Error mínimo obtenido en la prueba		0.005
RESULTADO		Cumple.	RESULTADO		Cumple.

EXACTITUD		
CARGA EN PRUEBA		
Punto	Indicación	Diferencia
1	10.9	0.1
2	9.950	0.04
3	9.96	0.04
4	9.975	0.025
5	9.995	0.005
Error máximo obtenido en la prueba		0.25
Error mínimo obtenido en la prueba		0.005
RESULTADO		Cumple.

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD

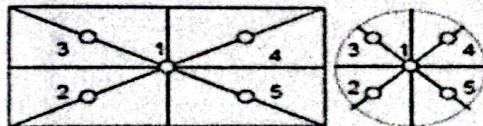

Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	Equipo en adecuadas condiciones.
Firma del responsable de realizar la Verificación intermedia:	Olivia Co. Nutricionista. APC.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considerará como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1801 DE 2012.