

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	28/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

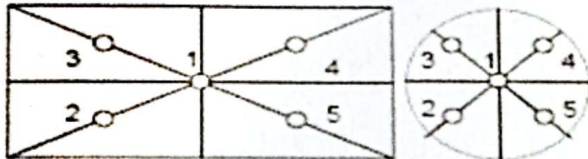
Balanza Pesa Alimentos ____ Balanza Pesa Personas ____ Balanza Pesa Bebés X Triunfadoras

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
NA	BBG	BB3	NA	APC-Triunfadoras	Coordinación

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
SH22-2012	10-8-23	Cumple.	NA	NA	NA	2027

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	20 kg.	Juego de pesas clase	Paralelepípedo rectangular	14-03-25	14-10-25
Carga mínima (Min)	5 kg.	Numero de Certificado	DE372-30	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	5g < 10kg > 10g	Nutrición			
Repetibilidad (indicación en manual)	15	INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)	0.01				

EXCENTRICIDAD			REPETIBILIDAD		
CARGA EN PRUEBA 10 kg			CARGA EN PRUEBA 10 kg		
Punto	Indicación	Diferencia	No Medición	Indicación	Diferencia
1	10.000	0	1	10.000	0
2	10.010	0.01	2	10.005	0.005
3	10.000	0	3	10.005	0.005
4	10.020	0.02	4	10.005	0.005
5	10.005	0.005	5	10.005	0.005
Error máximo obtenido en la prueba		0.02	Error máximo obtenido en la prueba		0.005
Error mínimo obtenido en la prueba		0.005	Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO		Cumple.	RESULTADO		Cumple.

EXACTITUD			GUÍA EXCENTRICIDAD	
CARGA EN PRUEBA 5, 10, 15				
Punto	Indicación	Diferencia	Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido	
1	5.000	0		
2	10.010	0.01		
3	15.005	0.005		
4	15.015	0.015		
5	10.010	0.01		
Error máximo obtenido en la prueba		0.015		
Error mínimo obtenido en la prueba		0.015		
RESULTADO		Cumple		
RESULTADO: Cumple o no cumple				

OBSERVACIONES:	Equipo es adecuadas. Condiciones. Auditoría por Nutricionista APC.
----------------	---