BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	45076
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ____ Balanza Pesa Personas ___ Balanza Pesa Bebés _ x

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección-Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
K7-02	Seca	334	2026	APC periodistas - Calle 41 B SUR # 78 I - 37 - Bogotá	Yolima Guzman

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
1	16/09/2021	cumple	NA	NA	NA	16/09/2025

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	20 KG	Juego de pesas clase	Paralelepipedo rectangular	28/05/2024	28/08/2024
Carga mínima (Min)	5G	Número de Certificado	DE3710-23	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	5g < 10 kg > 10g			Yolima Guzman / responsable	
Repetibilidad (indicación en manual)	SIN INFORMACIÓN	**JUEGO DE PESAS PATRON PARA VERIFICACION DE BALANZAS DE PLATAFORMA** **Fabricante: METRO GLOBAL** **Fecha de recepción: 2023/10/13** **Modelo M-PARALELEPIPEDO** **Fecha de calibración. 2023/10/19** **Serie: 201414905**			
Error Máximo Permitido (EMP)	2,8 KG				

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA 10 KG

Punto	Indicación	Diferencia
1	10.01	0.01
2	10.01	0.01
3	10.01	0.01
4	10.01	0.01
5	10.01	0.01
Error máximo obtenido en la prueba		0.01
Error mínimo obtenido en la prueba		0.01
RESULTADO	CUMPLE	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA 5 KG

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	5.01	0.01
2	5.01	0.01
3	5.01	0.01
4	5.01	0.01
5	5.01	0.01
Error máximo obtenido en la prueba		0.01
Error mínimo obtenido en la prueba		0.01
RESULTADO	CUMPLE	

EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA 5 KG-10 KG-15KG-20KG

Punto	Indicación	Diferencia
1	20.03	0.03
2	15.01	0.01
3	10	0
4	5.01	0.01
5	5.005	0.005
Error máximo obtenido en la prueba		0.03
Error mínimo obtenido en la prueba		0.005
RESULTADO	CUMPLE	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD

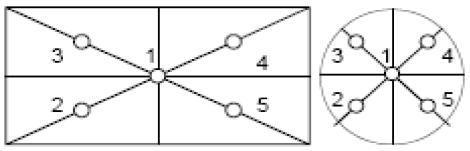

Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaria por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.