

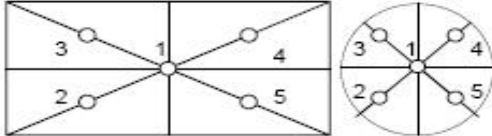
	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS				F3.G8.PP	5/30/2023
					Versión 4	Página 1 de 1
					Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ____		Balanza Pesa Personas _ x		Balanza Pesa Bebés ____	
-----------------------------	--	---------------------------	--	-------------------------	--

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
K7-01	Seca	813	22989	APC periodistas - Calle 41 B SUR # 78 I - 37 - Bogotá	Yolima Guzman

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
1	15/10/2019	cumple	1	8/10/2022	Cumple	8/10/2026

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	200 KG	Juego de pesas clase	No hay información	3/6/2024	6/6/2024
Carga mínima (Min)	10 g	Número de Certificado	No hay información	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	100 G	Yolima Guzman / responsable			
Repetibilidad (indicación en manual)	SIN INFORMACIÓN	INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)	0,1 KG				

PRUEBAS		
EXCENTRICIDAD		
CARGA EN PRUEBA 10KG		
Punto	Indicación	Diferencia
1	9,9	0,1
2	9,9	0,1
3	9,9	0,1
4	9,9	0,1
5	9,9	0,1
Error máximo obtenido en la prueba		0,1
Error mínimo obtenido en la prueba		0,1
RESULTADO	CUMPLE	
EXACTITUD		
CARGA EN PRUEBA 5KG-10KG-15KG-20KG		
Punto	Indicación	Diferencia
1	20,2	0,2
2	15,8	0,8
3	10,1	0,1
4	5,9	0,9
5	5,1	0,1
Error máximo obtenido en la prueba		0,1
Error mínimo obtenido en la prueba		0,9
RESULTADO	CUMPLE	
RESULTADO: Cumple o no cumple		
REPETIBILIDAD		
CARGA EN PRUEBA 10 KG		
No. Medición	Indicación	Diferencia
1	9,9	0,1
2	9,9	0,1
3	9,9	0,1
4	9,9	0,1
5	9,9	0,1
Error máximo obtenido en la prueba		0,1
Error mínimo obtenido en la prueba		0,1
RESULTADO	CUMPLE	
GUIA EXCENTRICIDAD		
		
Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido		

OBSERVACIONES:	
----------------	--

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.