VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE ASPIRADOR

Fecha de Revisión
8/16/2017
FO-MS-54
Versión 01

INSTRUMENTO: *Apparatus* **ASPIRADOR** **FABRICANTE:** *Manufacturer* **EVO**

MODELO: *Model* **606** **FECHA DE VERIFICACION:** *Date of Verification:* **Abril-2025**

NUMERO DE IDENT.: *Identification Number* **538** **SERIAL:** *Serial Number* **B401813**

EQUIPO PATRON *(Measurement Standard)* **:** Identificación: Manómetro de Presión (mmHg)


Certif. de Calib. No: **DE5309-24** Exactitud: 6,77 mmHg Fecha de Calib.: **25-Sep-2024**

CONDICIONES AMBIENTALES DEL LABORATORIO *(Enviroment Condition Of Laboratory)* **:**

Temperatura: **22,2** Humedad Relativa: **63,1 ± 1.7 % HR** Presión atmosférica: **683,0 ± 10 mbar**

LECTURA EQUIPO	LECTURA (Presión Manométrica)		CALCULO DE ERRORES EN UNIDADES DEL EQUIPO VERIFICADO			
mmHg	ASCENSO mmHg	DESCENSO mmHg	ERROR ASCENSO mmHg	ERROR DESCENSO mmHg	ERROR HISTERESIS mmHg	Incert. Exp. Med. mmHg
0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	± 7,7
150,0	147,9	145,7	-2,1	-4,3	-2,2	
200,0	199,7	197,5	-0,3	-2,5	-2,2	
300,0	298,5	296,3	-1,5	-3,7	-2,2	
400,0	401,8	399,6	1,8	-0,4	-2,2	
450,0	450,6	448,4	0,6	-1,6	-2,2	
Error max. Abs. Permitido:		± 19,0	Error max. + U:	12,0	Evaluación:	CUMPLE

##

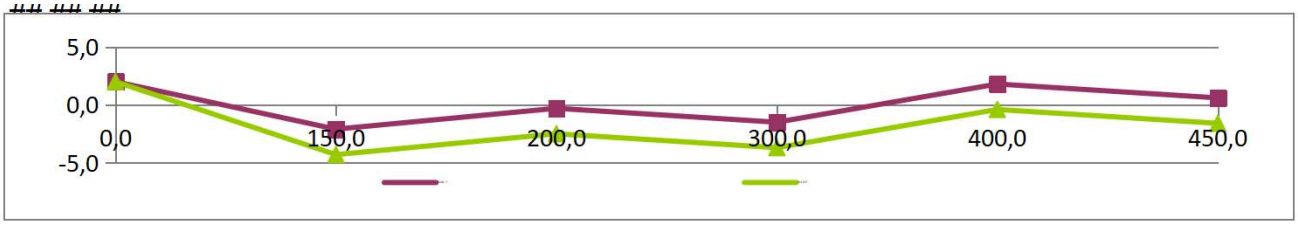

FIRMAS AUTORIZADAS

Authorized signatures

Asis. Bio. Oscar Murillo

Realizado Por - Realized by