AMANECER MEDICO HOME CARE su cuidado más efectivo	**VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BOMBA MEDIFUSION**	Fecha de Revisión 8/16/2017
		FO-MS-54
		Versión 01

INSTRUMENTO: *Apparatus* **BOMBA DE INFUSION MEDIFUSION**

FABRICANTE: *Manufacturer* **DAIWHA**

MODELO: *Model* **DI2000**

FECHA DE VERIFICACION: *Date of Verification* **Septiembre-2025**

NUMERO DE IDENT.: *Identification Number* 14 **SERIAL:** **D120EXP1112209**

VERSIÓN DEL SOFTWARE: **2,30**

EQUIPO PATRON *(Measurement Standard)* **:**

Identificación:	Certif. de Calib. No:	Exactitud:		Fecha de Calib.
Analizador Infusion IDA 1S	MG13809-24	60,0	ml/h	27-sep-24

INSPECCIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN	C	OBSERVACIONES
Limpieza externa del equipo	X	
Estado del cable de voltaje	X	
Estado de pantalla	X	
Estado de teclado	X	
Estado de leds indicadores de batería	X	
Estado de la puerta	X	

CHEQUEO DE MEDIDAS VOLUMEN

PRUEBA	FLUJO (ml/h)	VOLUMEN (ml)	MEDIDAS	C	N.C	ERROR %	OBSERVACIONES
1	100	10	50	X		± 5	
2	200	20	25,15	X		± 5	
3	300	30	31,21	X		± 5	
4	400	50	50,31	X		± 5	

CHEQUEO DE MEDIDAS FLUJO

PRUEBA	FLUJO (ml/h)	VOLUMEN (ml)	MEDIDAS	C	N.C	ERROR %	OBSERVACIONES
1	100	10	100,05	X		± 5	
2	200	20	100,11	X		± 5	
3	300	30	201,21	X		± 5	
4	400	50	299,31	X		± 5	


TIPO DE ALARMA	C	N.C	OBSERVACIONES
Prueba de carga y descarga de batería	X		
Alarma de puerta abierta	X		
Alarma de oclusión	X		12.26 PSI
Alarma de aire	X		

CONDICIONES AMBIENTALES DEL LABORATORIO *(Enviroment Condition Of Laboratory)* **:**

Temperatura: **26,7 ± 0,37 °C** Humedad Relativa: **59,8 ± 1,7 % HR** Presión atmosférica: **904,4 ± 10 mbar**

FIRMAS AUTORIZADAS

Authorized signatures

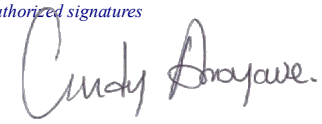

Coord. Bio. Cindy Arroyave

Realizado Por - Realized by