



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Versión: 002

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMÉDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS

Páginas: 2

SEDE:		CASA LA ESPERANZA		DATOS GENERALES		SEDE		CAJICA			
NOMBRE DEL EQUIPO:		Termómetro digital de punzon 1		MODELO:		TP3001					
MARCA:		Digital thermometer									
NÚMERO DE SERIE:				No INVENTARIO							
EQUIPO BIOMÉDICO:											
MÁQUINAS Y EQUIPOS:		X									
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO		CLASE I		ELECTRICO				ELECTRÓNICO			
		CLASE IIA		NEUMÁTICO				HIDRÁULICO			
		CLASE IIB		MECÁNICO				ÓPTICO			
		CLASE III		OTRO		X					
FORMA DE ADQUISICIÓN		COMPRA		TIPO		DIAGNÓSTICO		QUIRÚRGICO			
		DONACIÓN				TRATAMIENTO		REHABILITACIÓN			
FECHA DE ADQUISICIÓN:		ND				IMAGENOLÓGIA		OTRO		X	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS											
PARÁMETROS ELÉCTRICOS		VOLTAJE		CONSUMIBLES		BRAZALETE		ELECTRODOS		OBSERVACIONES	
		CORRIENTE				PERA		BATERÍAS			
		POTENCIA				MEMBRANA		PAPEL			
		FRECUENCIA				OTRO		X			
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO				SI		NO		X			
DATOS FABRICANTE											
Nombre del Proveedor:				Digital thermometer							
DIRECCIÓN:		ND		Nombre del Fabricante:				Digital thermometer			
TELÉFONO:		ND		E-MAIL:							
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA											
VIDA ÚTIL:				Amplio rango de temperatura -300°C a 300°C, con una exactitud de 0.4°C, fabricado en acero inoxidable (sin mercurio)							
INSTRUCCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE USO											
Inspeccione con frecuencia el termómetro para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.											
FUNCIÓN											
Funciona introduciendo el punzón en el alimento frío o caliente; se deben esperar unos segundos para obtener la temperatura.											
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN											
Debe guardarse en su respectivo estuche para evitar posibles daños.											
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN											

Nombre:	
Cargo:	
Firma y/o sello:	



Gobierno General

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Version: 002

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS

Páginas: 2

DATOS GENERALES

SEDE: CASA LA ESPERANZA

NOMBRE DEL EQUIPO: Termometro digital de punzon 2

MARCA: Digital thermometer

NÚMERO DE SERIE:

EQUIPO BIOMEDICO:

MÁQUINAS Y EQUIPOS: X

CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO

FORMA DE ADQUISICIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN:

CLASE I

CLASE IIA

CLASE IIB

CLASE IIB

CLASE III

COMPRA

DONACIÓN

ND

MODELO: TP3001

No INVENTARIO

TECNOLOGÍA PREDOMINANTE

TIPO

ELECTRICO

NEUMÁTICO

MECÁNICO

OTRO

DIAGNÓSTICO

TRATAMIENTO

IMAGENOLOGÍA

ELECTRÓNICO

HIDRÁULICO

ÓPTICO

QUIRÚRGICO

REHABILITACIÓN

OTRO

X

X

X

X

X

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

VOLTAJE

CORRIENTE

POTENCIA

FRECUENCIA

CUENTA CON MANUAL DE USUARIO

CONSUMIBLES

BRAZALETE

PERA

MEMBRANA

OTRO

SI

NO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DATOS FABRICANTE

Nombre del Proveedor:

DIRECCION: ND

TELEFONO: ND

E-MAIL:

Nombre del Fabricante:

ESPECIFICACION TECNICA

VIDA UTIL:

Amplio rango de temperatura -300°C a 300°C, con una exactitud de 0.4°C, fabricado en acero inoxidable (sin mercurio)

INSTRUCCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE USO

Inspeccione con frecuencia el termómetro para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.


FUNCION

Funciona introduciendo el punzón en el alimento frío o caliente, se deben esperar unos segundos para obtener la temperatura.

ELEMENTOS DE PROTECCION

Debe guardarse en su respectivo estuche para evitar posibles daños.

LIMPIEZA Y DESINFECCION



FOTOGRAFIA

TIPO DE SERVICIO	Garantía	
	Instalación	
	Mtto. Preventivo	☒
	Mtto. Correctivo	
	Seguimiento	

ING. JAVIER MAURICIO MOSQUERA BARRERA NIT: 1018446915-5 Mantenimiento, venta y reparación de equipos de medicina, cirugía, odontología, oftalmología, otorrinolaringología, terapia, laboratorio clínico, banco de sangre y veterinaria.
--

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO		
FECHA		
24	02	2021

Cliente: <u>Casa la Esperanza</u> Dependencia: <u>CORUNA</u>	Contacto: Ciudad: <u>Cajica</u>
---	------------------------------------

Equipo	Marca	Modelo	Serie	Inventario	Otro:
<u>Termómetro Digital</u>	<u>De Puntón</u>	<u>TP 3001</u>			

CONDICIONES INICIALES DEL EQUIPO	
☒ NORMAL	Irregularidad / Descripción de falla:
☐ IRREGULAR	
☐ FUERA DE SERVICIO	

LABORES REALIZADAS					
ITEM	NO APLICA	REALIZADO	ITEM	NO APLICA	REALIZADO
Inspección de carcasa.		☒	Inspección de sistema óptico.	☒	
Inspección de sistema eléctrico.	☒		Inspección de fugas.	☒	
Inspección de sistema electrónico.	☒		Inspección de bombillos.	☒	
Inspección de sistema mecánico.	☒		Inspección de alarmas.	☒	
Inspección de sistema hidráulico.	☒		Pruebas de funcionamiento.		☒
Inspección de sistema neumático.	☒		Configuración/actualización de software.	☒	
Inspección de sistema de refrigeración.	☒		Limpieza externa.	☒	☒
Inspección de escobillas.	☒		Limpieza Interna.	☒	
Inspección de conexiones.	☒		Lubricación.	☒	
Inspección de motores/bombas.	☒		reemplazo de repuestos/ insumos.	☒	

Verificación eléctrica (Si Aplica):	Fase 1 - Neutro	VAC	Fase 1 - Tierra	VAC	Fase 1 - Fase 2	VAC	Tierra - Neutro	VAC
	Fase 2 - Neutro	VAC	Fase 2 - Tierra	VAC	Fase 2 - Fase 3	VAC		
	Fase 3 - Neutro	VAC	Fase 3 - Tierra	VAC	Fase 1 - Fase 3	VAC	Resistencia Tierra	Ω

HERRAMIENTAS UTILIZADAS						
Osciloscopio	Multímetro	Termómetro	Manómetro	Pínza Amperimétrica	Pesos Patrón	
Analizador de RX	Tacómetro	Balanza Analítica	Datalogger	Herramienta de mano	Otra:	

Descripción de labores / Observaciones: <u>Equipo apto para su uso; Se realiza mantenimiento preventivo.</u> <u>Limpieza interna y externa;</u>
Anexos:

VERIFICACIÓN DE PARAMETROS					
Unidad de Medida 1:	Unidad de Medida 2:	Unidad de Medida 3:			
Valor Equipo	Valor Patrón	Valor Equipo	Valor Patrón	Valor Equipo	Valor Patrón

REPUESTOS UTILIZADOS			
Cantidad	Descripción	Cantidad	Descripción

Responsable del Servicio Técnico.  ING. BIOMÉDICO RH INVIMA 201304-242 MP 25244-417894-GND	Cliente: Nombre: Cargo:
---	-----------------------------------



Gobierno
General

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Versión: 002

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS

Páginas: 2

SEDE:		CASA LA ESPERANZA	SEDE		CAJICA
NOMBRE DEL EQUIPO:		Gramera			
MARCA:		ND	MODELO:		ND
NÚMERO DE SERIE:		ND	No INVENTARIO		
EQUIPO BIOMEDICO:			TECNOLOGÍA PREDOMINANTE		
MÁQUINAS Y EQUIPOS:		X	ELECTRICO		ELECTRÓNICO X
			NEUMÁTICO		HIDRÁULICO
			MECÁNICO		ÓPTICO
			OTRO		
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO			TIPO		QUIRÚRGICO
			TRATAMIENTO		REHABILITACIÓN
FORMA DE ADQUISICIÓN		X	IMAGENOLÓGIA		OTRO X
FECHA DE ADQUISICIÓN:		ND			
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS					
VOLTAJE		NA	BRAZALETE		ELECTRODOS
CORRIENTE		NA	PERA		BATERÍAS
POTENCIA		NA	MEMBRANA		PAPEL
FRECUENCIA		NA	OTRO		X
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO			SI		NO X
DATOS FABRICANTE					
Nombre del Proveedor:		ND	Nombre del Fabricante:		ND
DIRECCIÓN:		ND	E-MAIL:		ND
TELÉFONO:		ND			
ESPECIFICACION TECNICA					
VIDA UTIL:		ND			
INSTRUCCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE USO					
Inspeccione con frecuencia la gramera y sus componentes para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.					
FUNCION					
Gramera para pesaje de alimentos con capacidad de 5Kg, precision de 1g					
ELEMENTOS DE PROTECCION					
NA					
LIMPIEZA Y DESINFECCION					
Se debe realizar limpieza diaria en seco aplicando productos destinados y diseñados para la limpieza de equipos evitando el contacto directo de líquidos. Se debe evitar usar productos abrasivos o corrosivos					
MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
Actual					
CONTROL ESPECIAL DURANTE EL MANEJO					
En caso de que observe cualquiera de las siguientes condiciones, o si tiene alguna preocupación con respecto a su producto, deje de utilizarlo y retire la fuente de energía hasta que pueda hablar con el centro de atención al cliente para obtener un mejor asesoramiento.					
• Sonido de crujido, silbido o estallido u olor fuerte que proviene del producto					
• Se dejó caer el producto o se dañó de alguna manera					

TIPO DE SERVICIO	Garantía	
	Instalación	
	Mtto. Preventivo	☒
	Mtto. Correctivo	
	Seguimiento	

ING. JAVIER MAURICIO MOSQUERA BARRERA NIT: 1018446915-5
Mantenimiento, venta y reparación de equipos de medicina, cirugía, odontología, oftalmología, otorrinolaringología, terapia, laboratorio clínico, banco de sangre y veterinaria.

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO
FECHA
24 02 2022

Cliente: Casa la esperanza		Contacto:			
Dependencia: Fisioterapia. Nutricion.		Ciudad: Cullca.			
Equipo Gramera.	Marca Generica.	Modelo Digital.	Serie CE004	Inventario	Otro:

CONDICIONES INICIALES DEL EQUIPO	
☒ NORMAL	Irregularidad / Descripción de falla:
☐ IRREGULAR	
☐ FUERA DE SERVICIO	

LABORES REALIZADAS					
ITEM	NO APLICA	REALIZADO	ITEM	NO APLICA	REALIZADO
Inspección de carcasa.	☒	☒	Inspección de sistema óptico.	☒	☒
Inspección de sistema eléctrico.	☒	☒	Inspección de fugas.	☒	☒
Inspección de sistema electrónico.	☒	☒	Inspección de bombillos.	☒	☒
Inspección de sistema mecánico.	☒	☒	Inspección de alarmas.	☒	☒
Inspección de sistema hidráulico.	☒	☒	Pruebas de funcionamiento.	☒	☒
Inspección de sistema neumático.	☒	☒	Configuración/actualización de software.	☒	☒
Inspección de sistema de refrigeración.	☒	☒	Limpieza externa.	☒	☒
Inspección de escobillas.	☒	☒	Limpieza Interna.	☒	☒
Inspección de conexiones.	☒	☒	Lubricación.	☒	☒
Inspección de motores/bombas.	☒	☒	reemplazo de repuestos/ insumos.	☒	☒

Verificación eléctrica (Si Aplica):	Fase 1 - Neutro	VAC	Fase 1 - Tierra	VAC	Fase 1 - Fase 2	VAC	Tierra - Neutro	VAC
	Fase 2 - Neutro	VAC	Fase 2 - Tierra	VAC	Fase 2 - Fase 3	VAC		
	Fase 3 - Neutro	VAC	Fase 3 - Tierra	VAC	Fase 1 - Fase 3	VAC	Resistencia Tierra	Ω

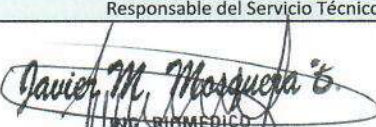
HERRAMIENTAS UTILIZADAS						
Osciloscopio	Multímetro	Termómetro	Manómetro	Pinza Amperimétrica	Pesas Patrón	
Analizador de RX	Tacómetro	Balanza Analítica	Datalogger	Herramienta de mano	Otra:	

Descripción de labores / Observaciones:
Se realiza mantenimiento preventivo. Limpieza interna y externa.
Se realizan pruebas de funcionamiento. Equipo apto para su uso.

Anexos:

VERIFICACIÓN DE PARAMETROS					
Unidad de Medida 1:		Unidad de Medida 2:		Unidad de Medida 3:	
Valor Equipo	Valor Patrón	Valor Equipo	Valor Patrón	Valor Equipo	Valor Patrón

REPUESTOS UTILIZADOS			
Cantidad	Descripción	Cantidad	Descripción

Responsable del Servicio Técnico.	Cliente:
 ING. BIOMÉDICO RN INVIMA 201304-242 MP 25244 417894 CND	
	Firma y/o sello:
	Nombre:
	Cargo:



Gobierno
General

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Versión: 002

Páginas: 2

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMÉDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS

DATOS GENERALES									
SEDE:	CASA LA ESPERANZA	SEDE	CAJICA	FOTOGRAFIA					
NOMBRE DEL EQUIPO:	Báscula electrónica digital para alimentos	MODELO:	TCS-K1						
MARCA:	Pesatronics								
NÚMERO DE SERIE:									
EQUIPO BIOMÉDICO:									
MAQUINAS Y EQUIPOS:									
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO	CLASE I	TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELÉCTRICO	ELECTRÓNICO					
	CLASE IIA		NEUMÁTICO	HIDRÁULICO					
	CLASE IIB		MECÁNICO	ÓPTICO					
	CLASE III		OTRO						
FORMA DE ADQUISICIÓN	COMPRA	TIPO	DIAGNÓSTICO	QUIRÚRGICO					
	DONACIÓN		TRATAMIENTO	REHABILITACIÓN					
FECHA DE ADQUISICIÓN:		IMAGENOLÓGIA		OTRO					
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS									
PARÁMETROS ELÉCTRICOS	VOLTAJE	ND	BRAZALETE	ELECTRODOS					
	CORRIENTE	ND	PERA	BATERÍAS					
	POTENCIA	ND	MEMBRANA	PAPEL					
	FRECUENCIA		OTRO						
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO			SI						
DATOS FABRICANTE									
Nombre del Proveedor:									
DIRECCIÓN:		Nombre del Fabricante:		Pesatronics SA.					
TELÉFONO:		E-MAIL:							
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA									
VIDA UTIL:	Báscula electrónica digital con capacidad de 100 Kg. rango de error 50g. batería recargable, con plataforma en aluminio.								
INSTRUCCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE USO									
Inspeccione con frecuencia la báscula y sus componentes para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.									
FUNCION									
Báscula electrónica digital para el pesaje de alimentos									
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN									
Se debe realizar protección eléctrica con reguladores de voltaje o UPS con el fin de evitar daños en el equipo y preservar su vida útil.									
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN									
Se debe realizar limpieza en seco aplicando productos destinados y diseñados para la limpieza de equipos electrónicos evitando el contacto directo de líquidos. Se debe evitar usar productos abrasivos o corrosivos									

Responsable del Servicio Técnico.	Cliente:
 Javier M. Mosquera S. ING BIOMÉDICA RH INVIMA 201304-232 MP 25244 417804 CND	
	Firma y/o sello:
Nombre:	
Cargo:	



Gobierno General

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Versión: 002

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMÉDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS

Página: 2

DATOS GENERALES

SEDE: CASA LA ESPERANZA

NOMBRE DEL EQUIPO: Balcón electrónica digital para personas mayores

MARCA: BGC Colombia SAS

NÚMERO DE SERIE: MODELO: INDUSTRIA INOX + B.P. INOX

EQUIPO BIOMÉDICO: X

MÁQUINAS Y EQUIPOS: No INVENTARIO

CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO

FORMA DE ADQUISICIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN:

CLASE I

CLASE II A

CLASE II B

CLASE III

COMPRA

DONACIÓN

TECNOLOGÍA PREDOMINANTE

TIPO

ELÉCTRICO

NEUMÁTICO

MECÁNICO

OTRO

DIAGNÓSTICO

TRATAMIENTO

IMAGENOLOGÍA

ELECTRÓNICO

HIDRÁULICO

ÓPTICO

QUIRÚRGICO

REHABILITACIÓN

OTRO

FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

VOLTAJE

CORRIENTE

POTENCIA

FRECUENCIA

CONSUMIBLES

BRAZALETE

PERA

MEMBRANA

OTRO

SI

NO

X

X

CUENTA CON MANUAL DE USUARIO

DATOS FABRICANTE

Nombre del Proveedor:

DIRECCIÓN: Calle 13 # 24 - 19 Bogotá

TELÉFONO: 7457700

Nombre del Fabricante:

E-MAIL:

BBG Colombia SAS.

ventas@basculasbbg.com

ESPECIFICACION TÉCNICA

VIDA ÚTIL:

Inspeccione con frecuencia la báscula y sus componentes para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.

FUNCION

Se debe realizar limpieza en seco aplicando productos destinados y diseñados para la limpieza de equipos electrónicos evitando el contacto directo de líquidos. Se debe evitar usar productos abrasivos o corrosivos

TIPO DE SERVICIO	Garantía	
	Instalación	
	Mtto. Preventivo	☒
	Mtto. Correctivo	
	Seguimiento	

ING. JAVIER MAURICIO MOSQUERA BARRERA NIT: 1018446915-5
Mantenimiento, venta y reparación de equipos de medicina, cirugía, odontología, oftalmología, otorrinolaringología, terapia, laboratorio clínico, banco de sangre y veterinaria.

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO
FECHA
24 02 2022

Cliente: casa la esperanza	Contacto:
Dependencia: nutrición - fisioterapia	Ciudad: Cajica

Equipo: Balanza Electrónica	Marca: BBG Colombia	Modelo: TBP-INOX industry 201NOX	Serie:	Inventario:	Otro:
-----------------------------	---------------------	----------------------------------	--------	-------------	-------

CONDICIONES INICIALES DEL EQUIPO	
☒ NORMAL	Irregularidad / Descripción de falla:
☐ IRREGULAR	
☐ FUERA DE SERVICIO	

LABORES REALIZADAS					
ITEM	NO APLICA	REALIZADO	ITEM	NO APLICA	REALIZADO
Inspección de carcasa.		☒	Inspección de sistema óptico.	☒	☒
Inspección de sistema eléctrico.		☒	Inspección de fugas.	☒	☒
Inspección de sistema electrónico.		☒	Inspección de bombillos.	☒	☒
Inspección de sistema mecánico.	☒		Inspección de alarmas.		☒
Inspección de sistema hidráulico.	☒		Pruebas de funcionamiento.		☒
Inspección de sistema neumático.	☒		Configuración/actualización de software.	☒	☒
Inspección de sistema de refrigeración.	☒		Limpieza externa.		☒
Inspección de escobillas.	☒	☒	Limpieza interna.		☒
Inspección de conexiones.		☒	Lubricación.	☒	☒
Inspección de motores/bombas.	☒		reemplazo de repuestos/ insumos.	☒	☒

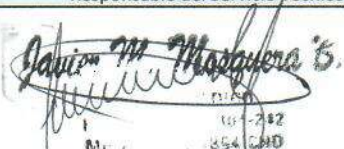
Verificación eléctrica (Si aplica):	Fase 1 - Neutro	VAC	Fase 1 - Tierra	VAC	Fase 1 - Fase 2	VAC	Tierra - Neutro	VAC
	Fase 2 - Neutro	VAC	Fase 2 - Tierra	VAC	Fase 2 - Fase 3	VAC		
	Fase 3 - Neutro	VAC	Fase 3 - Tierra	VAC	Fase 1 - Fase 3	VAC	Resistencia Tierra	Ω

HERRAMIENTAS UTILIZADAS							
Osciloscopio	Multímetro	Termómetro	Manómetro	Pinza Amperimétrica	Pesos Patrón		
Análizador de RX	Tacómetro	Balanza Analítica	Datalogger	Herramienta de mano	Otra:		

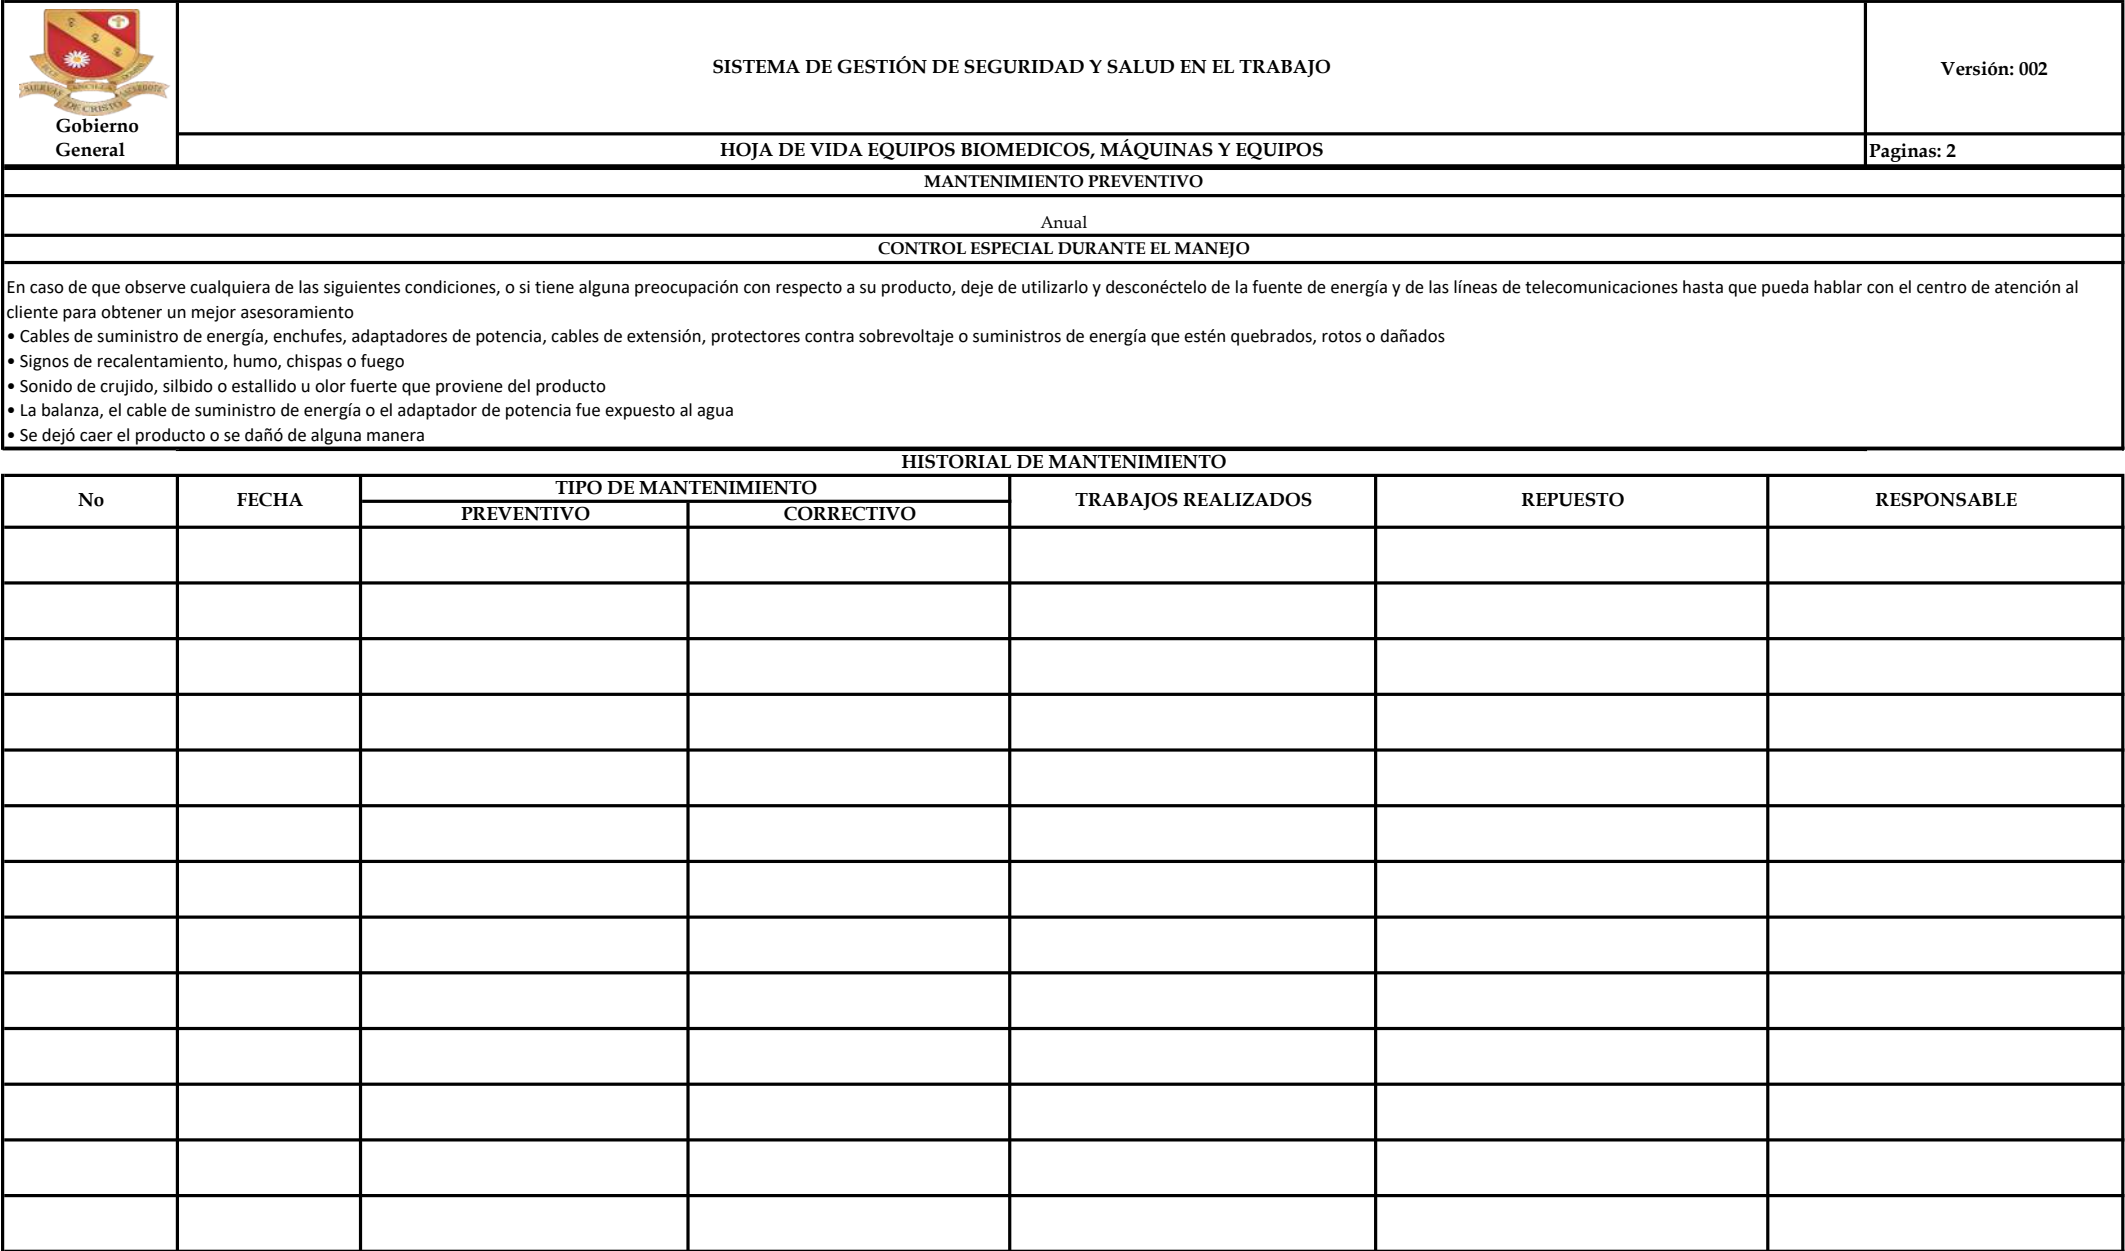
Descripción de labores / Observaciones:
Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza interna y externa. Se realizan pruebas de funcionamiento. Equipo apto para su uso.
Anexos:

VERIFICACIÓN DE PARAMETROS					
Unidad de Medida 1:	Unidad de Medida 2:	Unidad de Medida 3:			
Valor Equipo	Valor Patrón	Valor Equipo	Valor Patrón	Valor Equipo	Valor Patrón

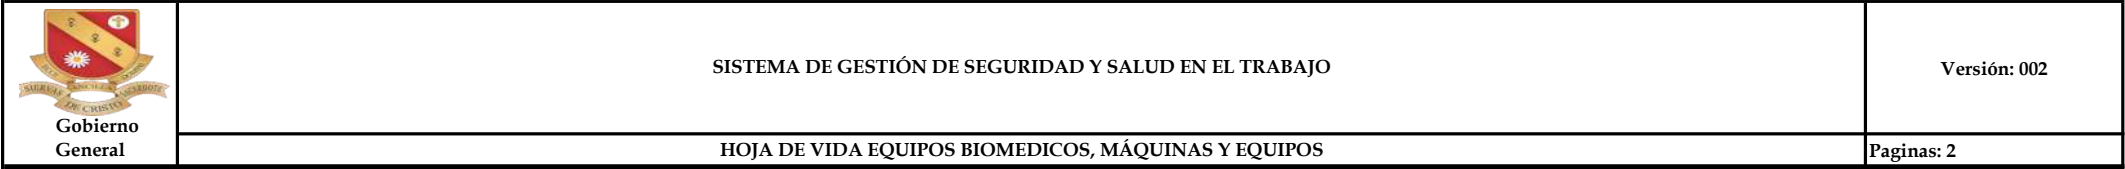
REPUESTOS UTILIZADOS			
Cantidad	Descripción	Cantidad	Descripción

Responsable del Servicio Técnico.	Cliente:
 Javier M. Mosquera B. NIT: 1018446915-5	
	Firma y/o sello:
	Nombre:
	Cargo:

 Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Versión: 002
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS										Paginas: 2
DATOS GENERALES											
SEDE:	CASA LA ESPERANZA				SEDE			CAJICA			
NOMBRE DEL EQUIPO:	Batidora eléctrica de pedestal										
MARCA:	Black and decker		MODELO:		MX900						
NÚMERO DE SERIE:			No INVENTARIO								
EQUIPO BIOMEDICO:											
MAQUINAS Y EQUIPOS:	X										
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO	CLASE I		TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELÉCTRICO	X	ELECTRÓNICO					
	CLASE IIA			NEUMÁTICO		HIDRÁULICO					
	CLASE IIB			MECÁNICO		ÓPTICO					
	CLASE III			OTRO							
FORMA DE ADQUISICIÓN	COMPRA	X	TIPO	DIAGNÓSTICO		QUIRÚRGICO					
	DONACIÓN			TRATAMIENTO		REHABILITACIÓN					
FECHA DE ADQUISICIÓN:				IMAGENOLÓGÍA		OTRO	X				
FOTOGRAFIA											
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS											
PARÁMETROS ELÉCTRICOS	VOLTAJE	120 V	CONSUMIBLES	BRAZALETE		ELECTRODOS		OBSERVACIONES			
	CORRIENTE			PERA		BATERÍAS					
	POTENCIA	250 W		MEMBRANA		PAPEL					
	FRECUENCIA	60 Hz		OTRO	X						
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO				SI	X	NO					
DATOS FABRICANTE											
Nombre del Proveedor:		ALMACEN Y TALLER DE LA LICUADORA									
DIRECCION:	Calle 7 # 8-08, ZIPAQUIRA			Nombre del Fabricante:		Black and decker					
TELEFONO:	8512934			E-MAIL:		memogonzalez03@hotmail.com					
ESPECIFICACION TECNICA											
VIDA UTIL:	Batidora eléctrica stand mixer de pedestal										
INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO											
Inspeccione con frecuencia la batidora y sus componentes para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.											
FUNCION											
Mezcla alimentos con facilidad, cuenta con 5 velocidades											
ELEMENTOS DE PROTECCION											
Se debe realizar protección eléctrica con reguladores de voltaje o UPS con el fin de evitar daños en el equipo y preservar su vida útil.											
LIMPIEZA Y DESINFECCION											
Se debe realizar limpieza después de cada uso y desinfección al final del día, no debe entrar el contacto directo con el agua para evitar daños. Se debe evitar usar productos abrasivos o corrosivos											



 Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Versión: 002
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS										Paginas: 2
DATOS GENERALES											
SEDE:	CASA LA ESPERANZA				SEDE			CAJICA			
NOMBRE DEL EQUIPO:	Congelador vertical en acero inoxidable										
MARCA:	Refriformax		MODELO:		TP1413YS						
NÚMERO DE SERIE:			No INVENTARIO								
EQUIPO BIOMEDICO:											
MAQUINAS Y EQUIPOS:	X										
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO	CLASE I		TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELÉCTRICO	X	ELECTRÓNICO		FOTOGRAFIA			
	CLASE IIA			NEUMÁTICO		HIDRÁULICO					
	CLASE IIB			MECÁNICO		ÓPTICO					
	CLASE III			OTRO							
FORMA DE ADQUISICIÓN	COMPRA	X	TIPO	DIAGNÓSTICO		QUIRÚRGICO					
	DONACIÓN			TRATAMIENTO		REHABILITACIÓN					
FECHA DE ADQUISICIÓN:				IMAGENOLOGÍA		OTRO	X				
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS											
PARÁMETROS ELÉCTRICOS	VOLTAJE	115 -127 V	CONSUMIBLES	BRAZALETE		ELECTRODOS		OBSERVACIONES			
	CORRIENTE			PERA		BATERÍAS					
	POTENCIA			MEMBRANA		PAPEL					
	FRECUENCIA	60 Hz		OTRO	X						
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO				SI		NO	X				
DATOS FABRICANTE											
Nombre del Proveedor:						Refriformax					
DIRECCION:	KR 18A 19-32, Bogotá D.C.			Nombre del Fabricante:		Refriforma					
TELEFONO:	5512923			E-MAIL:		induformax@hotmail.com					
ESPECIFICACION TECNICA											
VIDA UTIL:	Congelador vertical de una puerta										
INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO											
Inspeccione con frecuencia el congelador y sus componentes para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.											
FUNCION											
Congelador eléctrico vertical											
ELEMENTOS DE PROTECCION											
Se debe realizar protección eléctrica con reguladores de voltaje o UPS con el fin de evitar daños en el equipo y preservar su vida útil.											
LIMPIEZA Y DESINFECCION											
Se debe realizar limpieza y desinfección semanal, retirando totalmente el hielo, con la aplicación de un producto químico, posteriormente un desinfectante. De ser necesario realizar limpieza a diario de la puerta o superficies externas.											

**Versión: 002**

Paginas: 2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
--------------------------	--

CONTROL ESPECIAL DURANTE EL MANEJO	
------------------------------------	--

En caso de que observe cualquiera de las siguientes condiciones, o si tiene alguna preocupación con respecto a su producto, deje de utilizarlo y desconéctelo de la fuente de energía y de las líneas de telecomunicaciones hasta que pueda hablar con el centro de atención al cliente para obtener un mejor asesoramiento

- Cables de suministro de energía, enchufes, adaptadores de potencia, cables de extensión, protectores contra sobrevoltaje o suministros de energía que estén quebrados, rotos o dañados
- Signos de recalentamiento, humo, chispas o fuego
- Sonido de crujido, silbido o estallido u olor fuerte que proviene del producto
- La balanza, el cable de suministro de energía o el adaptador de potencia fue expuesto al agua
- Se dejó caer el producto o se dañó de alguna manera

- En caso de que observe cualquiera de las siguientes condiciones, o si tiene alguna preocupación con respecto a su producto, deje de utilizarlo y desconéctelo de la fuente de energía y de las líneas de telecomunicaciones hasta que pueda hablar con el centro de atención al cliente para obtener un mejor asesoramiento
- Cables de suministro de energía, enchufes, adaptadores de potencia, cables de extensión, protectores contra sobrevoltaje o suministros de energía que estén quebrados, rotos o dañados
 - Signos de recalentamiento, humo, chispas o fuego
 - Sonido de crujido, silbido o estallido u olor fuerte que proviene del producto
 - La balanza, el cable de suministro de energía o el adaptador de potencia fue expuesto al agua
 - Se dejó caer el producto o se dañó de alguna manera

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

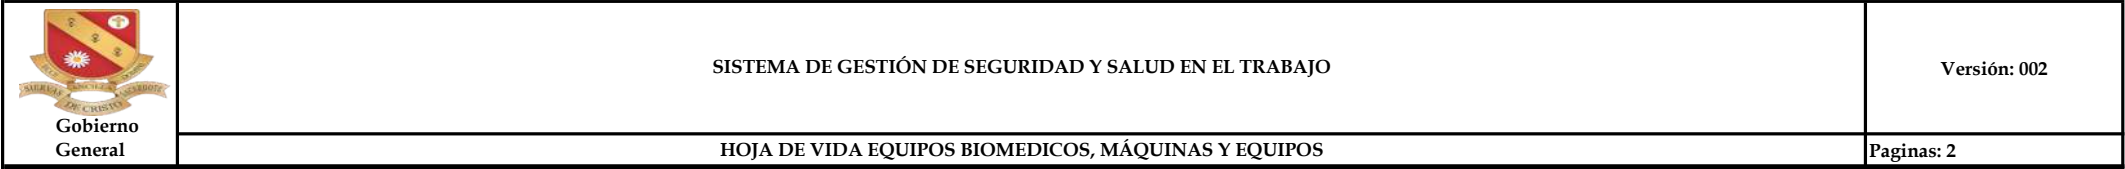
[illegible]

 <p>Gobierno General</p>	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Versión: 002
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS										Paginas: 2
DATOS GENERALES											
SEDE:	CASA LA ESPERANZA					SEDE	CAJICA				
NOMBRE DEL EQUIPO:	Refrigerador vertical en acero inoxidable										
MARCA:	Refriformax			MODELO:	TP1413YS						
NÚMERO DE SERIE:				No INVENTARIO							
EQUIPO BIOMEDICO:											
MAQUINAS Y EQUIPOS:	X										
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO	CLASE I		TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELÉCTRICO	X	ELECTRÓNICO		FOTOGRAFIA			
	CLASE IIA			NEUMÁTICO		HIDRÁULICO					
	CLASE IIB			MECÁNICO		ÓPTICO					
	CLASE III			OTRO							
FORMA DE ADQUISICIÓN	COMPRA	X	TIPO	DIAGNÓSTICO		QUIRÚRGICO					
	DONACIÓN			TRATAMIENTO		REHABILITACIÓN					
FECHA DE ADQUISICIÓN:				IMAGENOLÓGÍA		OTRO	X				
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS											
PARÁMETROS ELÉCTRICOS	VOLTAJE	115 -127 V	CONSUMIBLES	BRAZALETE		ELECTRODOS		OBSERVACIONES			
	CORRIENTE			PERA		BATERÍAS					
	POTENCIA			MEMBRANA		PAPEL					
	FRECUENCIA	60 Hz		OTRO	X						
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO				SI		NO	X				
DATOS FABRICANTE											
Nombre del Proveedor:		Refriformax									
DIRECCION:	KR 18A 19-32, Bogotá D.C.			Nombre del Fabricante:	Refriforma						
TELEFONO:	5512923			E-MAIL:	induformax@hotmail.com						
ESPECIFICACION TECNICA											
VIDA UTIL:	Congelador vertical de una puerta										
INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO											
Inspeccione con frecuencia el congelador y sus componentes para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.											
FUNCION											
Congelador eléctrico vertical											
ELEMENTOS DE PROTECCION											
Se debe realizar protección eléctrica con reguladores de voltaje o UPS con el fin de evitar daños en el equipo y preservar su vida útil.											
LIMPIEZA Y DESINFECCION											
Se debe realizar limpieza y desinfección semanal, retirando totalmente el hielo, con la aplicación de un producto químico, posteriormente un desinfectante. De ser necesario realizar limpieza a diario de la puerta o superficies externas.											
MANTENIMIENTO PREVENTIVO											
Semestral											
CONTROL ESPECIAL DURANTE EL MANEJO											
<p>En caso de que observe cualquiera de las siguientes condiciones, o si tiene alguna preocupación con respecto a su producto, deje de utilizarlo y desconéctelo de la fuente de energía y de las líneas de telecomunicaciones hasta que pueda hablar con el centro de atención al cliente para obtener un mejor asesoramiento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cables de suministro de energía, enchufes, adaptadores de potencia, cables de extensión, protectores contra sobrevoltaje o suministros de energía que estén quebrados, rotos o dañados • Signos de recalentamiento, humo, chispas o fuego • Sonido de crujido, silbido o estallido u olor fuerte que proviene del producto • La balanza, el cable de suministro de energía o el adaptador de potencia fue expuesto al agua • Se dejó caer el producto o se dañó de alguna manera 											

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

[illegible]

 Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Versión: 002
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS										Páginas: 2
DATOS GENERALES											
SEDE:	CASA LA ESPERANZA				SEDE			CAJICA			
NOMBRE DEL EQUIPO:	Estufa enana en acero inoxidable										
MARCA:	ND		MODELO:		ND						
NÚMERO DE SERIE:	ND		No INVENTARIO								
EQUIPO BIOMEDICO:											
MAQUINAS Y EQUIPOS:	X										
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO	CLASE I		TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELÉCTRICO		ELECTRÓNICO		FOTOGRAFIA			
	CLASE IIA			NEUMÁTICO		HIDRÁULICO					
	CLASE IIB			MECÁNICO		ÓPTICO					
	CLASE III			OTRO	X						
FORMA DE ADQUISICIÓN	COMPRA	X	TIPO	DIAGNÓSTICO		QUIRÚRGICO					
	DONACIÓN			TRATAMIENTO		REHABILITACIÓN					
FECHA DE ADQUISICIÓN:				IMAGENOLÓGIA		OTRO	X				
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS											
PARÁMETROS ELÉCTRICOS	VOLTAJE		CONSUMIBLES	BRAZALETE		ELECTRODOS		OBSERVACIONES			
	CORRIENTE			PERA		BATERÍAS					
	POTENCIA			MEMBRANA		PAPEL					
	FRECUENCIA			OTRO	X						
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO				SI		NO	X				
DATOS FABRICANTE											
Nombre del Proveedor:		Joserrago									
DIRECCION:	ND			Nombre del Fabricante:		ND					
TELEFONO:	ND			E-MAIL:		ND					
ESPECIFICACION TECNICA											
VIDA UTIL:	Estufa enana de 1 puesto										
INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO											
Inspeccione con frecuencia la estufa y sus componentes para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.											
FUNCION											
Estufa enana a gas											
ELEMENTOS DE PROTECCION											
Evite el contacto directo de la piel con las superficies de la estufa, al manipular utilice guantes resistentes al calor.											
LIMPIEZA Y DESINFECCION											



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Versión: 002

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS

Paginas: 2

Se debe realizar limpieza y desinfección diaria, retirando totalmente los restos de alimentos, con la aplicación de un producto químico, posteriormente un desinfectante.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Anual

CONTROL ESPECIAL DURANTE EL MANEJO

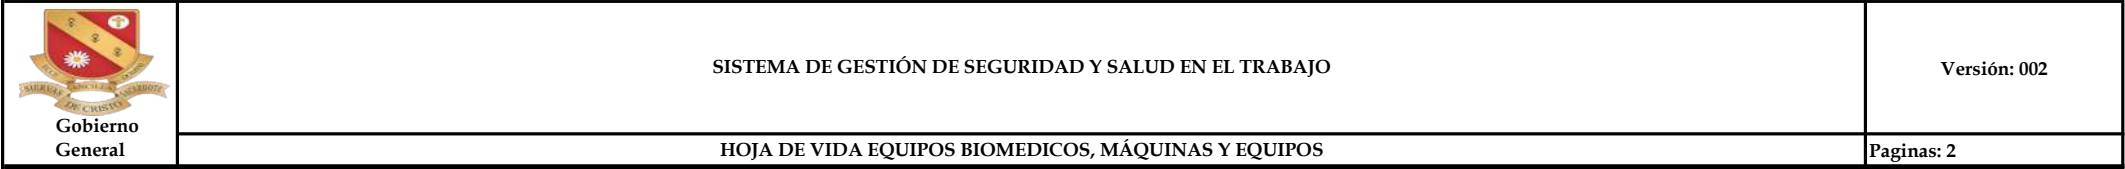
En caso de que observe cualquiera de las siguientes condiciones, o si tiene alguna preocupación con respecto a su producto, deje de utilizarlo y desconéctelo de la fuente de energía y de las líneas de telecomunicaciones hasta que pueda hablar con el centro de atención al cliente para obtener un mejor asesoramiento

- Sonido de crujido, silbido o estallido u olor a gas que proviene del producto
- Se dañó de alguna manera

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

[illegible]

 Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Versión: 002
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS										Páginas: 2
DATOS GENERALES											
SEDE:	CASA LA ESPERANZA					SEDE		CAJICA		 FOTOGRAFIA	
NOMBRE DEL EQUIPO:	Licuadora eléctrica										
MARCA:	Imusa		MODELO:		INFINYFORCE						
NÚMERO DE SERIE:	LM802556		No INVENTARIO								
EQUIPO BIOMEDICO:											
MAQUINAS Y EQUIPOS:	X										
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO	CLASE I		TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELÉCTRICO	X	ELECTRÓNICO					
	CLASE IIA			NEUMÁTICO		HIDRÁULICO					
	CLASE IIB			MECÁNICO		ÓPTICO					
	CLASE III			OTRO							
FORMA DE ADQUISICIÓN	COMPRA	X	TIPO	DIAGNÓSTICO		QUIRÚRGICO					
	DONACIÓN			TRATAMIENTO		REHABILITACIÓN					
FECHA DE ADQUISICIÓN:				IMAGENOLOGÍA		OTRO	X				
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS											
PARÁMETROS ELÉCTRICOS	VOLTAJE	120 V	CONSUMIBLES	BRAZALETE		ELECTRODOS		OBSERVACIONES			
	CORRIENTE			PERA		BATERÍAS					
	POTENCIA	600 W		MEMBRANA		PAPEL					
	FRECUENCIA	60 Hz		OTRO	X						
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO				SI		NO	X				
DATOS FABRICANTE											
Nombre del Proveedor:		Imusa									
DIRECCION:			Nombre del Fabricante:		Imusa						
TELEFONO:	18000520022		E-MAIL:		atencionalcliente@groupeseb.com						
ESPECIFICACION TECNICA											
VIDA UTIL:	Licuadora con vaso removible, acoples plásticos, capacidad de 4 litros										
INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO											
Inspeccione con frecuencia la licuadora y sus componentes para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.											
FUNCION											
Licuadora eléctrica de 12 velocidades, con vaso removible de vidrio.											
ELEMENTOS DE PROTECCION											
Se debe realizar protección eléctrica con reguladores de voltaje o UPS con el fin de evitar daños en el equipo y preservar su vida útil.											
LIMPIEZA Y DESINFECCION											
Se debe realizar limpieza del vaso después de cada uso y desinfección al final del día, así como de los demás componentes de la licuadora, el motor no debe entrar en contacto directo con el agua para evitar daños. Se debe evitar usar productos abrasivos o corrosivos											

**Versión: 002**

Paginas: 2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
--------------------------	--

CONTROL ESPECIAL DURANTE EL MANEJO	
------------------------------------	--

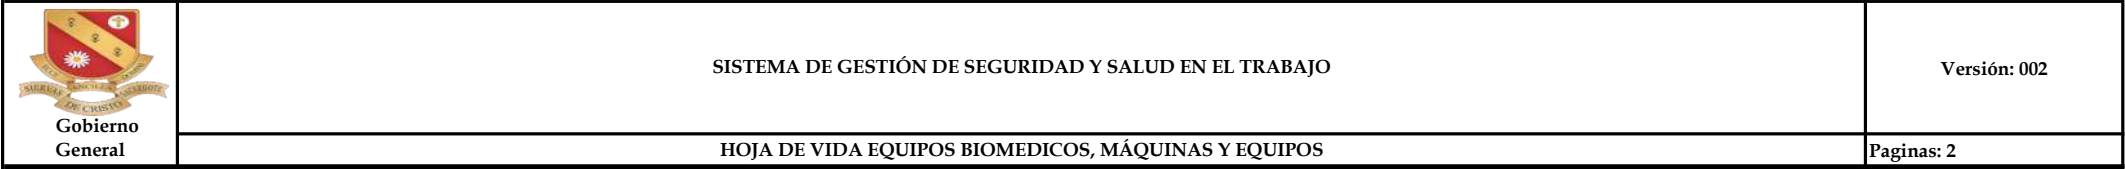
En caso de que observe cualquiera de las siguientes condiciones, o si tiene alguna preocupación con respecto a su producto, deje de utilizarlo y desconéctelo de la fuente de energía y de las líneas de telecomunicaciones hasta que pueda hablar con el centro de atención al cliente para obtener un mejor asesoramiento

- Cables de suministro de energía, enchufes, adaptadores de potencia, cables de extensión, protectores contra sobrevoltaje o suministros de energía que estén quebrados, rotos o dañados
- Signos de recalentamiento, humo, chispas o fuego
- Sonido de crujido, silbido o estallido u olor fuerte que proviene del producto
- La balanza, el cable de suministro de energía o el adaptador de potencia fue expuesto al agua
- Se dejó caer el producto o se dañó de alguna manera

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

[illegible]

 Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Versión: 002
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS										Paginas: 2
DATOS GENERALES											
SEDE:	CASA LA ESPERANZA				SEDE			CAJICA			 FOTOGRAFIA
NOMBRE DEL EQUIPO:	Licuadora eléctrica industrial										
MARCA:	Joserrago		MODELO:		LAS-04MB						
NÚMERO DE SERIE:	473901		No INVENTARIO								
EQUIPO BIOMEDICO:											
MAQUINAS Y EQUIPOS:	X										
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO	CLASE I		TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELÉCTRICO	X	ELECTRÓNICO					
	CLASE IIA			NEUMÁTICO		HIDRÁULICO					
	CLASE IIB			MECÁNICO		ÓPTICO					
	CLASE III			OTRO							
FORMA DE ADQUISICIÓN	COMPRA	X	TIPO	DIAGNÓSTICO		QUIRÚRGICO					
	DONACIÓN			TRATAMIENTO		REHABILITACIÓN					
FECHA DE ADQUISICIÓN:				IMAGENOLOGÍA		OTRO	X				
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS											
PARÁMETROS ELÉCTRICOS	VOLTAJE	110 V	CONSUMIBLES	BRAZALETE		ELECTRODOS		OBSERVACIONES			
	CORRIENTE			PERA		BATERÍAS					
	POTENCIA	368 W		MEMBRANA		PAPEL					
	FRECUENCIA	60 Hz		OTRO	X						
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO				SI		NO	X				
DATOS FABRICANTE											
Nombre del Proveedor:		Joserrago									
DIRECCION:	Av. Caracas # 17-40 Bogotá, Colombia.			Nombre del Fabricante:		Joserrago					
TELEFONO:	2436035			E-MAIL:		ventas@joserrago.com.co					
ESPECIFICACION TECNICA											
VIDA UTIL:	Fabricada en acero inoxidable, vaso removible, 1 velocidad, acoples metálicos, capacidad de 4 litros										
INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO											
Inspeccione con frecuencia la licuadora y sus componentes para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.											
FUNCION											
Licuadora eléctrica industrial de 1 velocidad, con vaso removible.											
ELEMENTOS DE PROTECCION											
Se debe realizar protección eléctrica con reguladores de voltaje o UPS con el fin de evitar daños en el equipo y preservar su vida útil.											
LIMPIEZA Y DESINFECCION											
Se debe realizar limpieza del vaso después de cada uso y desinfección al final del día, así como de los demás componentes de la licuadora, el motor no debe entrar en contacto directo con el agua para evitar daños. Se debe evitar usar productos abrasivos o corrosivos											

**Versión: 002**

Paginas: 2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
--------------------------	--

CONTROL ESPECIAL DURANTE EL MANEJO

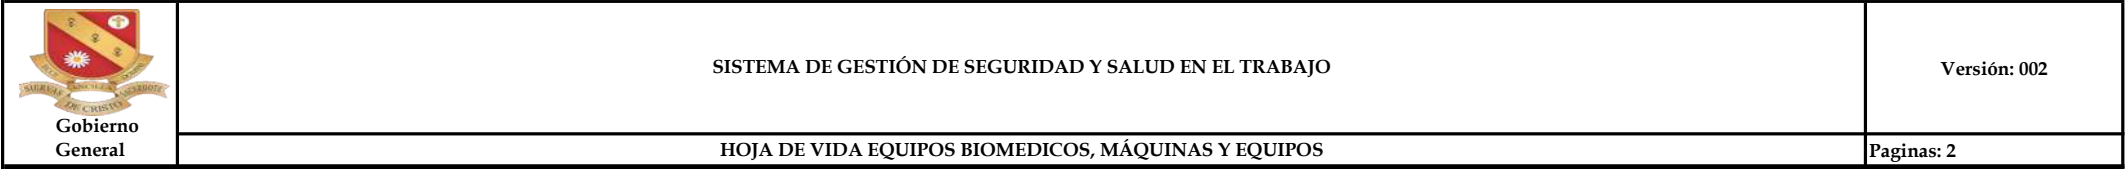
En caso de que observe cualquiera de las siguientes condiciones, o si tiene alguna preocupación con respecto a su producto, deje de utilizarlo y desconéctelo de la fuente de energía y de las líneas de telecomunicaciones hasta que pueda hablar con el centro de atención al cliente para obtener un mejor asesoramiento

- Cables de suministro de energía, enchufes, adaptadores de potencia, cables de extensión, protectores contra sobrevoltaje o suministros de energía que estén quebrados, rotos o dañados
- Signos de recalentamiento, humo, chispas o fuego
- Sonido de crujido, silbido o estallido u olor fuerte que proviene del producto
- La balanza, el cable de suministro de energía o el adaptador de potencia fue expuesto al agua
- Se dejó caer el producto o se dañó de alguna manera

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

[illegible]

 Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Versión: 002	
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS										Paginas: 2	
DATOS GENERALES												
SEDE:	CASA LA ESPERANZA				SEDE			CAJICA				
NOMBRE DEL EQUIPO:	Licuadora eléctrica industrial 2											
MARCA:	Joserrago		MODELO:		LAS-04MB							
NÚMERO DE SERIE:	473901		No INVENTARIO									
EQUIPO BIOMEDICO:												
MAQUINAS Y EQUIPOS:	X											
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO	CLASE I		TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELÉCTRICO	X	ELECTRÓNICO		FOTOGRAFIA				
	CLASE IIA			NEUMÁTICO		HIDRÁULICO						
	CLASE IIB			MECÁNICO		ÓPTICO						
	CLASE III			OTRO								
FORMA DE ADQUISICIÓN	COMPRA	X	TIPO	DIAGNÓSTICO		QUIRÚRGICO						
	DONACIÓN			TRATAMIENTO		REHABILITACIÓN						
FECHA DE ADQUISICIÓN:				IMAGENOLOGÍA		OTRO	X					
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS												
PARÁMETROS ELÉCTRICOS	VOLTAJE	110 V	CONSUMIBLES	BRAZALETE		ELECTRODOS			OBSERVACIONES			
	CORRIENTE			PERA		BATERÍAS						
	POTENCIA	368 W		MEMBRANA		PAPEL						
	FRECUENCIA	60 Hz		OTRO	X							
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO				SI		NO	X					
DATOS FABRICANTE												
Nombre del Proveedor:		Joserrago										
DIRECCION:	Av. Caracas # 17-40 Bogotá, Colombia.			Nombre del Fabricante:		Joserrago						
TELEFONO:	2436035			E-MAIL:		ventas@joserrago.com.co						
ESPECIFICACION TECNICA												
VIDA UTIL:	Fabricada en acero inoxidable, vaso removible, 1 velocidad, acoples metálicos, capacidad de 4 litros											
INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO												
Inspeccione con frecuencia la licuadora y sus componentes para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.												
FUNCION												
Licuadora eléctrica industrial de 1 velocidad, con vaso removible.												
ELEMENTOS DE PROTECCION												
Se debe realizar protección eléctrica con reguladores de voltaje o UPS con el fin de evitar daños en el equipo y preservar su vida útil.												
LIMPIEZA Y DESINFECCION												
Se debe realizar limpieza del vaso después de cada uso y desinfección al final del día, así como de los demás componentes de la licuadora, el motor no debe entrar en contacto directo con el agua para evitar daños. Se debe evitar usar productos abrasivos o corrosivos												

**Versión: 002**

Paginas: 2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
--------------------------	--

CONTROL ESPECIAL DURANTE EL MANEJO

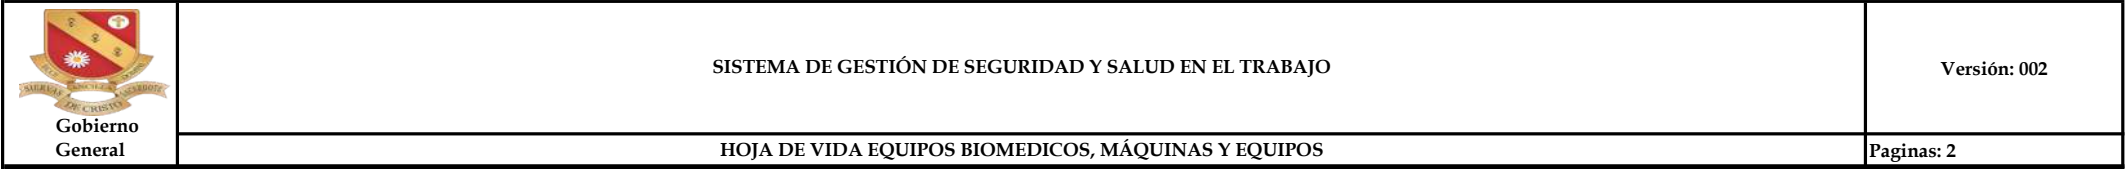
En caso de que observe cualquiera de las siguientes condiciones, o si tiene alguna preocupación con respecto a su producto, deje de utilizarlo y desconéctelo de la fuente de energía y de las líneas de telecomunicaciones hasta que pueda hablar con el centro de atención al cliente para obtener un mejor asesoramiento

- Cables de suministro de energía, enchufes, adaptadores de potencia, cables de extensión, protectores contra sobrevoltaje o suministros de energía que estén quebrados, rotos o dañados
- Signos de recalentamiento, humo, chispas o fuego
- Sonido de crujido, silbido o estallido u olor fuerte que proviene del producto
- La balanza, el cable de suministro de energía o el adaptador de potencia fue expuesto al agua
- Se dejó caer el producto o se dañó de alguna manera

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

[illegible]

 Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Versión: 002
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS										Paginas: 2
DATOS GENERALES											
SEDE:		CASA LA ESPERANZA				SEDE		CAJICA			
NOMBRE DEL EQUIPO:		Microondas									
MARCA:		Haceb		MODELO:		UCC128					
NÚMERO DE SERIE:		1601NFBL03837		No INVENTARIO							
EQUIPO BIOMEDICO:											
MAQUINAS Y EQUIPOS:		X									
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO		CLASE I		TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELÉCTRICO	X	ELECTRÓNICO				
		CLASE IIA			NEUMÁTICO		HIDRÁULICO				
		CLASE IIB			MECÁNICO		ÓPTICO				
		CLASE III			OTRO						
FORMA DE ADQUISICIÓN		COMPRA		TIPO	DIAGNÓSTICO		QUIRÚRGICO				
		DONACIÓN	X		TRATAMIENTO		REHABILITACIÓN				
FECHA DE ADQUISICIÓN:					IMAGENOLOGÍA		OTRO	X	FOTOGRAFIA		
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS											
PARÁMETROS ELÉCTRICOS	VOLTAJE	120 V	CONSUMIBLES	BRAZALETE		ELECTRODOS		OBSERVACIONES			
	CORRIENTE			PERA		BATERÍAS					
	POTENCIA	700 W		MEMBRANA		PAPEL					
	FRECUENCIA	60 Hz		OTRO	X						
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO				SI		NO	X				
DATOS FABRICANTE											
Nombre del Proveedor:		Haceb									
DIRECCION:	Calle 59 No. 55 – 80 Copacabana, Antioquia			Nombre del Fabricante:		Haceb					
TELEFONO:	4897979			E-MAIL:		asesor.servicio@haceb.com					
ESPECIFICACION TECNICA											
VIDA UTIL:	Microondas eléctrico										
INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO											
Inspeccione con frecuencia el microondas y sus componentes para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.											
FUNCION											
Calentar alimentos con ondas electromagnéticas											
ELEMENTOS DE PROTECCION											
Se debe realizar protección eléctrica con reguladores de voltaje o UPS con el fin de evitar daños en el equipo y preservar su vida útil.											
LIMPIEZA Y DESINFECCION											
Se debe realizar limpieza después de cada uso y desinfección al final del día, no debe entrar el contacto directo con el agua para evitar daños. Se debe evitar usar productos abrasivos o corrosivos											

**Versión: 002**

Paginas: 2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
--------------------------	--

CONTROL ESPECIAL DURANTE EL MANEJO	
------------------------------------	--

En caso de que observe cualquiera de las siguientes condiciones, o si tiene alguna preocupación con respecto a su producto, deje de utilizarlo y desconéctelo de la fuente de energía y de las líneas de telecomunicaciones hasta que pueda hablar con el centro de atención al cliente para obtener un mejor asesoramiento

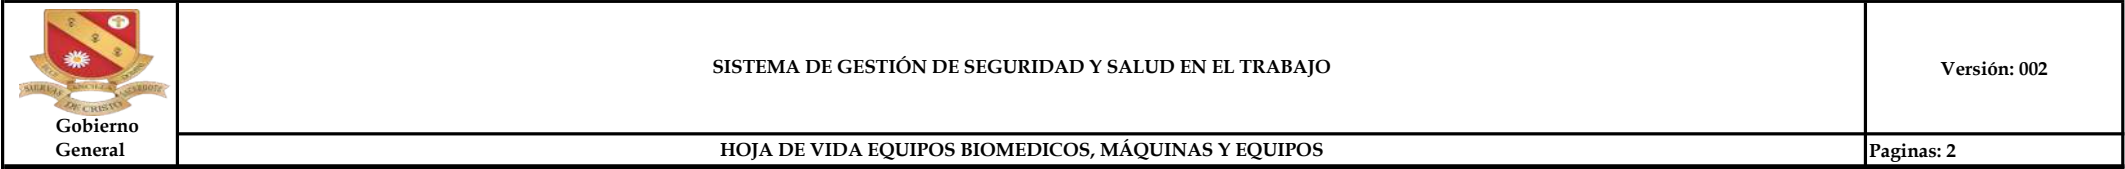
- Cables de suministro de energía, enchufes, adaptadores de potencia, cables de extensión, protectores contra sobrevoltaje o suministros de energía que estén quebrados, rotos o dañados
- Signos de recalentamiento, humo, chispas o fuego
- Sonido de crujido, silbido o estallido u olor fuerte que proviene del producto
- La balanza, el cable de suministro de energía o el adaptador de potencia fue expuesto al agua
- Se dejó caer el producto o se dañó de alguna manera

- En caso de que observe cualquiera de las siguientes condiciones, o si tiene alguna preocupación con respecto a su producto, deje de utilizarlo y desconéctelo de la fuente de energía y de las líneas de telecomunicaciones hasta que pueda hablar con el centro de atención al cliente para obtener un mejor asesoramiento
- Cables de suministro de energía, enchufes, adaptadores de potencia, cables de extensión, protectores contra sobrevoltaje o suministros de energía que estén quebrados, rotos o dañados
 - Signos de recalentamiento, humo, chispas o fuego
 - Sonido de crujido, silbido o estallido u olor fuerte que proviene del producto
 - La balanza, el cable de suministro de energía o el adaptador de potencia fue expuesto al agua
 - Se dejó caer el producto o se dañó de alguna manera

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

[illegible]

 Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Versión: 002
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS										Paginas: 2
DATOS GENERALES											
SEDE:	CASA LA ESPERANZA				SEDE			CAJICA			
NOMBRE DEL EQUIPO:	Nevera mixta										
MARCA:	Samsung		MODELO:		RT6CWNPP1/SCL						
NÚMERO DE SERIE:					No INVENTARIO						
EQUIPO BIOMEDICO:											
MAQUINAS Y EQUIPOS:	X										
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO	CLASE I			TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELÉCTRICO	X	ELECTRÓNICO				
	CLASE IIA				NEUMÁTICO		HIDRÁULICO				
	CLASE IIB				MECÁNICO		ÓPTICO				
	CLASE III				OTRO						
FORMA DE ADQUISICIÓN	COMPRA	X		TIPO	DIAGNÓSTICO		QUIRÚRGICO				
	DONACIÓN				TRATAMIENTO		REHABILITACIÓN				
FECHA DE ADQUISICIÓN:					IMAGENOLOGÍA		OTRO	X	FOTOGRAFIA		
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS											
PARÁMETROS ELÉCTRICOS	VOLTAJE	110 -120 V		CONSUMIBLES	BRAZALETE		ELECTRODOS		OBSERVACIONES		
	CORRIENTE	1,8A			PERA		BATERÍAS				
	POTENCIA				MEMBRANA		PAPEL				
	FRECUENCIA	60 Hz			OTRO	X					
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO					SI		NO	X			
DATOS FABRICANTE											
Nombre del Proveedor:		Samsung									
DIRECCION:	Carrera 7 # 113 - 43 Of 607 (Torre Samsung)			Nombre del Fabricante:		Samsung					
TELEFONO:	600 12 72			E-MAIL:							
ESPECIFICACION TECNICA											
VIDA UTIL:	Nevera mista, hecha en México, con volumen de 421 L, volumen de almacenamiento 408 L y una carga de refrigerante de 180g										
INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO											
Inspeccione con frecuencia la nevera y sus componentes para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo. Intrucir alimentos evitando tapar las salidad de aire y evitando sobrecargar puertas.											
FUNCION											
Nevera mixta, congelador y refrigerador											
ELEMENTOS DE PROTECCION											
Se debe realizar protección eléctrica con reguladores de voltaje o UPS con el fin de evitar daños en el equipo y preservar su vida útil.											
LIMPIEZA Y DESINFECCION											

**Versión: 002**

Paginas: 2

Se debe realizar limpieza y desinfección semanal, retirando totalmente el hielo, con la aplicación de un producto químico, posteriormente un desinfectante. De ser necesario realizar limpieza a diario de la puerta o superficies externas.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Semestral

CONTROL ESPECIAL DURANTE EL MANEJO

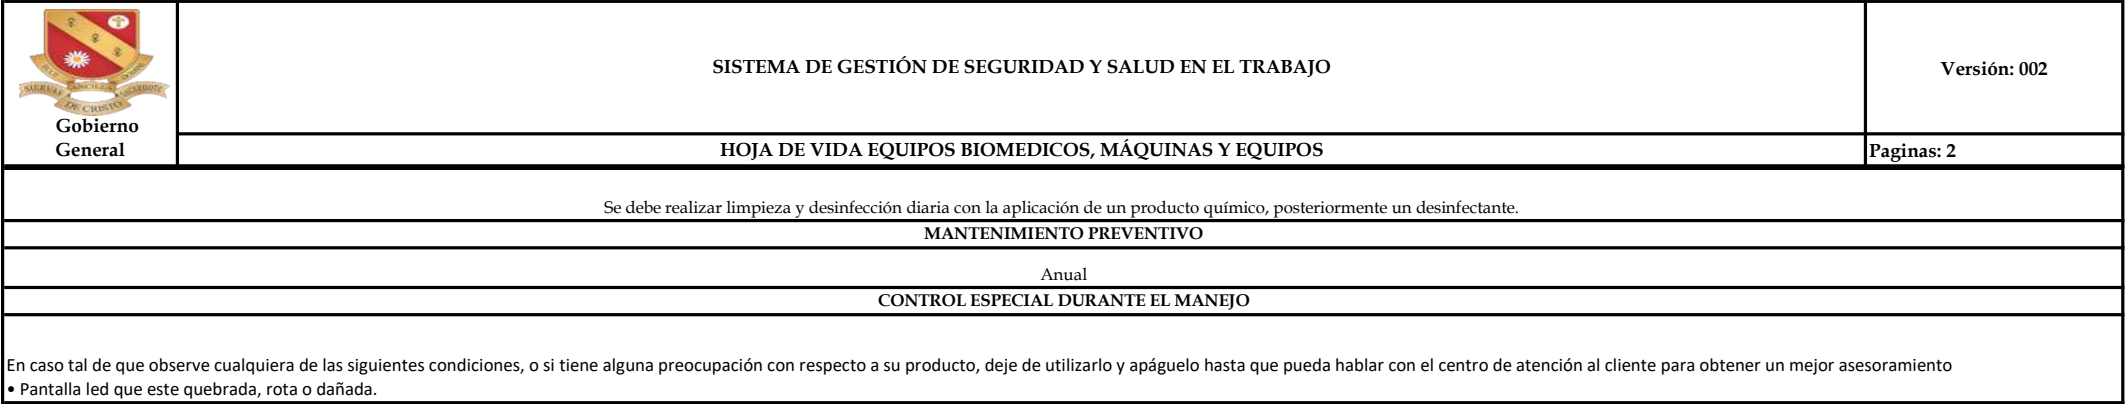
En caso de que observe cualquiera de las siguientes condiciones, o si tiene alguna preocupación con respecto a su producto, deje de utilizarlo y desconéctelo de la fuente de energía y de las líneas de telecomunicaciones hasta que pueda hablar con el centro de atención al cliente para obtener un mejor asesoramiento

- Cables de suministro de energía, enchufes, adaptadores de potencia, cables de extensión, protectores contra sobrevoltaje o suministros de energía que estén quebrados, rotos o dañados
- Signos de recalentamiento, humo, chispas o fuego
- Sonido de crujido, silbido o estallido u olor fuerte que proviene del producto
- La balanza, el cable de suministro de energía o el adaptador de potencia fue expuesto al agua
- Se dejó caer el producto o se dañó de alguna manera

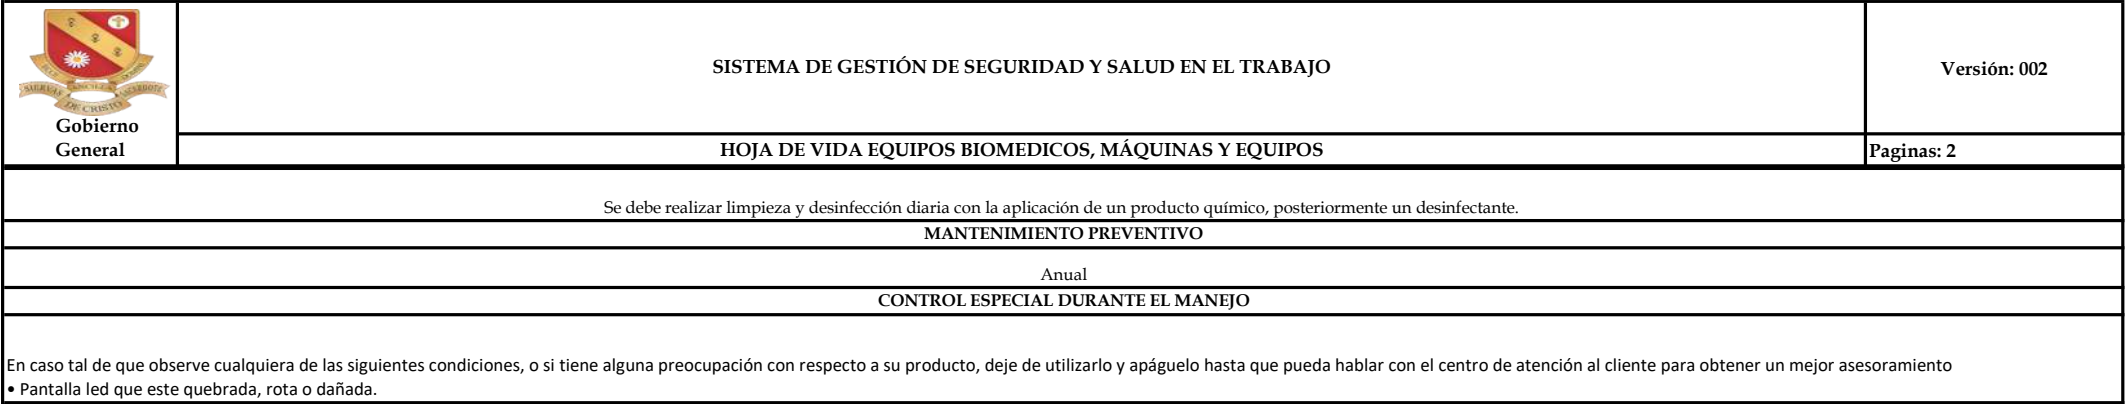
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

[illegible]

 Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Versión: 002	
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS										Páginas: 2	
DATOS GENERALES												
SEDE:	CASA LA ESPERANZA				SEDE			CAJICA				
NOMBRE DEL EQUIPO:	Termometro digital de punzon 4											
MARCA:	Digital thermometer		MODELO:	TP3001								
NÚMERO DE SERIE:			No INVENTARIO									
EQUIPO BIOMEDICO:												
MAQUINAS Y EQUIPOS:	X											
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO	CLASE I		TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELÉCTRICO		ELECTRÓNICO						
	CLASE IIA			NEUMÁTICO		HIDRÁULICO						
	CLASE IIB			MECÁNICO		ÓPTICO						
	CLASE III			OTRO	X							
FORMA DE ADQUISICIÓN	COMPRA	X	TIPO	DIAGNÓSTICO		QUIRÚRGICO						
	DONACIÓN			TRATAMIENTO		REHABILITACIÓN						
FECHA DE ADQUISICIÓN:	ND			IMAGENOLOGÍA		OTRO	X					
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS												
PARÁMETROS ELÉCTRICOS	VOLTAJE		CONSUMIBLES	BRAZALETE		ELECTRODOS		OBSERVACIONES				
	CORRIENTE			PERA		BATERÍAS						
	POTENCIA			MEMBRANA		PAPEL						
	FRECUENCIA			OTRO	X							
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO				SI		NO	X					
DATOS FABRICANTE												
Nombre del Proveedor:		Digital thermometer										
DIRECCION:	ND			Nombre del Fabricante:	Digital thermometer							
TELEFONO:	ND			E-MAIL:								
ESPECIFICACION TECNICA												
VIDA UTIL:	Amplio rango de temperatura -300°C a 300°C, con una exactitud de 0.4°C, fabricado en acero inoxidable (sin mercurio)											
INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO												
Inspeccione con frecuencia el termómetro para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.												
FUNCION												
Funciona introduciendo el punzón en el alimento frio o caliente, se deben esperar unos segundos para obtener la temperatura.												
ELEMENTOS DE PROTECCION												
Debe guardarse en su respectivo estuche para evitar posibles daños.												
LIMPIEZA Y DESINFECCION												

[illegible]

 Gobierno General	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Versión: 002	
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS										Páginas: 2	
DATOS GENERALES												
SEDE:	CASA LA ESPERANZA				SEDE			CAJICA				
NOMBRE DEL EQUIPO:	Termometro digital de punzon 4											
MARCA:	Digital thermometer		MODELO:	TP3001								
NÚMERO DE SERIE:			No INVENTARIO									
EQUIPO BIOMEDICO:												
MAQUINAS Y EQUIPOS:	X											
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO	CLASE I		TECNOLOGÍA PREDOMINANTE	ELÉCTRICO		ELECTRÓNICO						
	CLASE IIA			NEUMÁTICO		HIDRÁULICO						
	CLASE IIB			MECÁNICO		ÓPTICO						
	CLASE III			OTRO	X							
FORMA DE ADQUISICIÓN	COMPRA	X	TIPO	DIAGNÓSTICO		QUIRÚRGICO						
	DONACIÓN			TRATAMIENTO		REHABILITACIÓN						
FECHA DE ADQUISICIÓN:	ND			IMAGENOLOGÍA		OTRO	X					
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS												
PARÁMETROS ELÉCTRICOS	VOLTAJE		CONSUMIBLES	BRAZALETE		ELECTRODOS		OBSERVACIONES				
	CORRIENTE			PERA		BATERÍAS						
	POTENCIA			MEMBRANA		PAPEL						
	FRECUENCIA			OTRO	X							
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO				SI		NO	X					
DATOS FABRICANTE												
Nombre del Proveedor:		Digital thermometer										
DIRECCION:	ND			Nombre del Fabricante:	Digital thermometer							
TELEFONO:	ND			E-MAIL:								
ESPECIFICACION TECNICA												
VIDA UTIL:	Amplio rango de temperatura -300°C a 300°C, con una exactitud de 0.4°C, fabricado en acero inoxidable (sin mercurio)											
INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO												
Inspeccione con frecuencia el termómetro para detectar daños o signos de peligro. Si tiene alguna duda con respecto a la condición de un componente, no use el producto. De ser necesario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente o con el fabricante del producto para obtener instrucciones sobre cómo inspeccionarlo y repararlo.												
FUNCION												
Funciona introduciendo el punzón en el alimento frio o caliente, se deben esperar unos segundos para obtener la temperatura.												
ELEMENTOS DE PROTECCION												
Debe guardarse en su respectivo estuche para evitar posibles daños.												
LIMPIEZA Y DESINFECCION												

[illegible]