	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	28/01/2025
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ____ Balanza Pesa Personas _X__ Balanza Pesa Bebés ____

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
	SECA	803	88030701 151615	FUNDACIÓN SOLIDARIDAD POR COLOMBIA	Coordinadora - Nutricionista

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
SH20-39353	29/10/2020	CUMPLE	SH20-39353	29/10/2020	CUMPLE	SD
			SH22-47542	12/06/2022	CUMPLE	SD
			SH23-55159	10/05/2023	CUMPLE	may-27

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	150 Kg	Juego de pesas clase	Paralelepípedo Metroglobal	28/02/2025	28/05/2025
Carga mínima (Min)	2 Kg	Número de Certificado	D3710-23 19-10-23	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	0,1 Kg		Nutricionista Alejandra Vargas		
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON Masas patrón del Centro Zonal de Kennedy			
Error Máximo Permitido (EMP)	0,1				

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA 35 KG

Punto	Indicación	Diferencia
1	35	0
2	35	0
3	35	0
4	35	0
5	35	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	CUMPLE	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA 35 KG

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	35	0
2	35	0
3	35	0
4	35	0
5	35	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	CUMPLE	

EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA 35KG-20KG-15KG-10KG-5KG

Punto	Indicación	Diferencia
1	35	0
2	20	0
3	15	0
4	10	0
5	5	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	CUMPLE	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD

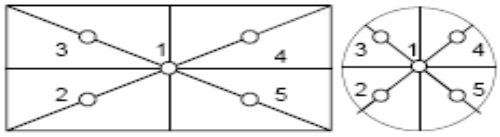

Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	EQUIPO CUMPLE
Firma del responsable de realizar la Verificación Intermedia:	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.