

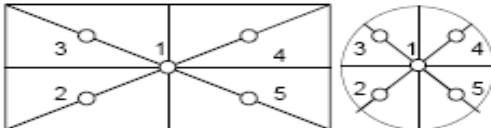
	<p align="center">PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN</p> <p align="center">FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS</p>	F3.G8.PP	28/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ____ Balanza Pesa Personas ____ Balanza Pesa Bebés X

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
	SECA	354	8354310 150796	FUNDACIÓN SOLIDARIDAD POR COLOMBIA	Coordinadora - Nutricionista

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
SH19-28991	19/06/2019	CUMPLE	SH22-47541	12/05/2022	CUMPLE	SD
			SH23-55157	10/05/2023	CUMPLE	may-27

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	20 KG	Juego de pesas clase	Paralelepípedo Metroglobal	28/02/2025	28/05/2025
Carga mínima (Min)	50 G	Número de Certificado	D3710-23 19-10-23	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	5 - 10 G		Nutricionista Alejandra Vargas		
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON Masas patrón del Centro Zonal de Kennedy			
Error Máximo Permitido (EMP)	0,01 A 0,02 LB				

PRUEBAS					
EXCENTRICIDAD			REPETIBILIDAD		
CARGA EN PRUEBA 10 KG			CARGA EN PRUEBA 10 KG		
Punto	Indicación	Diferencia	No. Medición	Indicación	Diferencia
1	9,99	-0,01	1	9,95	-0,05
2	9,99	-0,01	2	9,96	-0,04
3	9,99	-0,01	3	9,95	-0,05
4	9,95	-0,05	4	9,95	-0,05
5	9,99	-0,01	5	9,95	-0,05
Error máximo obtenido en la prueba		-0,01	Error máximo obtenido en la prueba		-0,04
Error mínimo obtenido en la prueba		-0,01	Error mínimo obtenido en la prueba		-0,05
RESULTADO	CUMPLE		RESULTADO	CUMPLE	
EXACTITUD			GUIA EXCENTRICIDAD		
CARGA EN PRUEBA 10KG-5KG					
Punto	Indicación	Diferencia	<p>Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido</p>		
1	9,99	-0,01			
2	4,95	-0,05			
3	4,95	-0,05			
4	9,99	-0,01			
5	4,95	-0,05			
Error máximo obtenido en la prueba		-0,05			
Error mínimo obtenido en la prueba		-0,01			
RESULTADO	CUMPLE				
RESULTADO: Cumple o no cumple					

OBSERVACIONES:	EQUIPO CUMPLE
Firma del responsable de realizar la Verificación Intermedia:	

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.