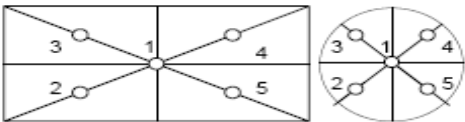


	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS				F3.G8.PP	28/01/2025
					Versión 5	Página 1 de 1
					Clasificación de la Información: Pública	
Balanza Pesa Alimentos ____ Balanza Pesa Personas ____ Balanza Pesa Bebés <u>X</u>						
No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO	
	SECA	354	8354310 150796	FUNDACIÓN SOLIDARIDAD POR COLOMBIA	Coordinadora - Nutricionista	
CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)				CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)		
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
SH19-28991	19/06/2019	CUMPLE	SH22-47541	12/05/2022	CUMPLE	SD
			SH23-55157	10/05/2023	CUMPLE	may-27
DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO			DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA 27/05/2025	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA 27/08/2025
Carga Máxima (Max)	20 KG	Juego de pesas clase	Paralelepípedo Metroglobal		RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	
Carga mínima (Min)	50 G	Número de Certificado	D3710-23 19-10-23		Nutricionista Alejandra Vargas	
División de escala (e / d)	5 - 10 G					
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON Masas patrón del Centro Zonal de Kennedy				
Error Máximo Permitido (EMP)	0,01 A 0,02 LB					
PRUEBAS						
EXCENTRICIDAD			REPETIBILIDAD			
CARGA EN PRUEBA 10 KG			CARGA EN PRUEBA 10 KG			
Punto	Indicación	Diferencia	No. Medición	Indicación	Diferencia	
1	9,99	-0,01	1	9,95	-0,05	
2	9,99	-0,01	2	9,95	-0,05	
3	9,95	-0,05	3	9,95	-0,05	
4	9,95	-0,05	4	9,95	-0,05	
5	9,99	-0,01	5	9,95	-0,05	
Error máximo obtenido en la prueba		-0,05	Error máximo obtenido en la prueba		-0,05	
Error mínimo obtenido en la prueba		-0,01	Error mínimo obtenido en la prueba		-0,05	
RESULTADO	CUMPLE		RESULTADO	CUMPLE		
EXACTITUD			GUIA EXCENTRICIDAD			
CARGA EN PRUEBA 10KG-5KG						
Punto	Indicación	Diferencia				
1	9,99	-0,01				
2	4,95	-0,05				
3	4,95	-0,05				
4	9,99	-0,01				
5	9,99	-0,01				
Error máximo obtenido en la prueba		-0,01				
Error mínimo obtenido en la prueba		-0,01				
RESULTADO	CUMPLE					
RESULTADO: Cumple o no cumple						
OBSERVACIONES: EQUIPO CUMPLE						
Firma del responsable de realizar la Verificación Intermedia: 						

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.