BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	30/05/2023
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ____ Balanza Pesa Personas ___ Balanza Pesa Bebés __X__

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
	SECA	354	8354310 150796	FUNDACIÓN SOLIDARIDAD POR COLOMBIA	Coordinadora - Nutricionista

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
SH20-39354	29/10/2020	CUMPLE	SH20-39354	29/10/2020	CUMPLE	SD
			SH22-47541	12/06/2022	CUMPLE	SD
			SH23-55157	10/05/2023	CUMPLE	may-27

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	20 KG	Juego de pesas clase	Paralelepípedo Metroglobal	6/03/2024	6/06/2024
Carga mínima (Min)	50 G	Número de Certificado	SD	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	
Division de escala (e / d)	5 - 10 G			Nutricionista Alejandra Vargas	
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON Masas patrón del Centro Zonal de Kennedy Central			
Error Máximo Permitido (EMP)	0,01 A 0,02 LB				

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA 10 KG

Punto	Indicación	Diferencia
1	9,98	0,02
2	9,95	0,05
3	9,96	0,04
4	9,98	0,02
5	9,96	0,04
Error máximo obtenido en la prueba		0,05
Error mínimo obtenido en la prueba		0,04
RESULTADO	CUMPLE	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA 10 KG

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	9,98	0,02
2	9,98	0,02
3	9,98	0,02
4	9,95	0,05
5	9,98	0,02
Error máximo obtenido en la prueba		0,05
Error mínimo obtenido en la prueba		0,02
RESULTADO	CUMPLE	

EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA10 KG

Punto	Indicación	Diferencia
1	9,98	0,02
2	9,95	0,05
3	9,95	0,05
4	9,95	0,05
5	9,95	0,05
Error máximo obtenido en la prueba		0,05
Error mínimo obtenido en la prueba		0,05
RESULTADO	CUMPLE	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD

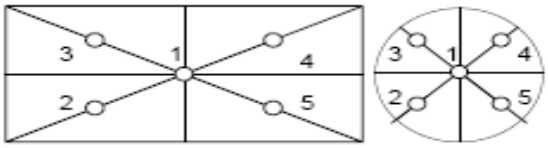

Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaria por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	EQUIPO CUMPLE

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.