Made with Xodo PDF Reader and Editor

Superintendencia de Industria y Comercio

INFORME DE VERIFICACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Metrología Legal

CVM Consorcio Verificación Metrológica

ONAC ACREDITADO

CEA-3.0-14:V3
CEA-3.0-15:V3
17-OVM-001

Código del Hito:	213342	**Tipo de Verificación:**	Periódica	**Estado del instrumento:**	EN SERVICIO	**Fecha:**	2025/11/20

ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

NIT OAVM:	900987141	**Razón Social OAVM:**	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM

INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Cámara de Comercio:	PASTO	**Razón Social o Nombre:**	SERVICENTRO PASTO
Matricula Mercantil:	0000056613	**Dirección:**	CALLE 9 NO.16A-20 PANAMERICANA

DATOS DEL INSTRUMENTO

NII:	S5984	**Productor / Importador / OAVM:**	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM		
No. de serie:	GSEN130752	**Marca:**	GILBARCO	**Modelo:**	NA1 ENCORE 500S-R
Temperatura máxima (°C):	40.0	**Temperatura mínima (°C):**	-20.0	**Conexión perifericos:**	SI
Caudal mínimo (gal/min):	0.5	**Caudal máximo (gal/min):**	10.0	**CMM (gal):**	0.5
Número de caras:	2	**Cantidad de Mangueras:**	4	**Ubicación Latitud**	1.203208
Ubicación Longitud	-77.282183	**Ubicación Descripción**	EDS SERVICENTRO PASTO, CALLE 9 # 16A-20 PANAMERICANA, PASTO, NARIÑO.		

PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN

Número de serie	Descripción	Capacidad	Error	Cert. Calibración	Temp. Calibración
V009-20	5-RECIPIENTE VOLUMETRICO 5 gal-S1-20	5.0	0.026	ILM25 - CC80626	20
V05G-010-20	5-RECIPIENTE VOLUMETRICO 05 gal-S1-20	0.5	0.003	ILM25 - CC81106	20
H160316583	5-TERMOHIGROMETRO-B1	100.0	-1.1	PSTH - 6205	25
07460064101-S34	D-TERMOMETRO DIGITAL	100.0	-2.4	PST - 1307	25

CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES

Temperatura inicial (°C):	22.6	**Temperatura intermedia (°C):**	19.1	**Temperatura final (°C):**	20.1
Temperatura mínima (°C):	19.1	**Temperatura máxima (°C):**	22.6	**Delta de T (°C):**	3.5

ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES

Requisito	Conforme	No Conforme	Observaciones
Placa de características	X		
Contenido TCM	X		
Marca de regularización	X		
Comprobación de precintos conformes	X		
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo	X		
RESULTADO ENSAYO			CONFORME

ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES

NII Manguera:	M22307	**Serie:**	GSEN130752-M1		**Cara:**	1	**Orden:**	1
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V009-20	18.5	5.0	0.3	5.015	-0.273	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-010-20	19.4	0.5	-0.1	0.4995	0.103	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	
NII Manguera:	M22314	**Serie:**	GSEN130752-M2		**Cara:**	1	**Orden:**	2
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V009-20	18.2	5.0	0.2	5.01	-0.174	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-010-20	19.0	0.5	-0.4	0.498	0.405	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	
NII Manguera:	M22331	**Serie:**	GSEN130752-M3		**Cara:**	2	**Orden:**	3
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V009-20	19.2	5.0	0.25	5.012499999999999	-0.223	+/- 0.5	CONFORME

Made with Xodo PDF Reader and Editor

Caudal mínimo	V05G-010-20	18.6	0.5	-0.3	0.4985	0.304	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	
NII Manguera:	M22334	**Serie:**	GSEN130752-M4		**Cara:**	2	**Orden:**	4
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V009-20	19.4	5.0	0.15	5.0075	-0.124	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-010-20	18.9	0.5	-0.3	0.4985	0.304	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	

ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL

CONTROL DE PRECIO UNITARIO

NII Manguera:	Precio galón ($)	Precio indicado por el instrumento ($)	Precio calculado ($)	Error ($)	EMP ($)	Resultado
M22307	$14150.0	$70750.0	$70750.0	0.0	707.5	CONFORME
M22314	$14150.0	$70750.0	$70750.0	0.0	707.5	CONFORME
M22331	$14150.0	$70750.0	$70750.0	0.0	707.5	CONFORME
M22334	$14150.0	$70750.0	$70750.0	0.0	707.5	CONFORME
					RESULTADO ENSAYO	CONFORME

CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO

NII Manguera:	Puesta a cero:	Observaciones:
M22307	CONFORME	
M22314	CONFORME	
M22331	CONFORME	
M22334	CONFORME	
	RESULTADO PUESTA A CERO	CONFORME

REPORTE DE PRECINTOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ANTES DE LA VERIFICACIÓN

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
20308	XAA2950000036865	Alambre - MEDIDOR VOLUEMTRICO	2023/11/23
16113	50810000000000833	Alambre - MEDIDOR VOLUEMTRICO	2023/05/16
19259	XAA2950000478865	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2022/09/13
19259	XAA2950000030057	Alambre - TARJETA ELECTRONICA MAIN BOARD	2022/09/13
16113	508100000605	Alambre - MEDIDOR VOLUEMTRICO	2022/08/16
19259	XAA2950000161217	Alambre - MEDIDOR VOLUEMTRICO	2020/07/17
19259	XAA2950000387552	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2020/07/17
19259	XAA2950000387551	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2020/07/17
19259	XAA2950000161220	Alambre - MEDIDOR VOLUEMTRICO	2020/07/17
19259	XAA2950000161219	Alambre - MEDIDOR VOLUEMTRICO	2020/07/17
19259	XAA2950000161218	Alambre - TARJETA ELECTRONICA MAIN BOARD	2020/07/17
19259	XAA2950000387555	ABRAZADERA PLASTICA - CABLES EMISOR DE IMPULSOS	2020/07/17
19259	XAA2950000387554	ABRAZADERA PLASTICA - CABLES EMISOR DE IMPULSOS	2020/07/17
19259	XAA2950000387553	ABRAZADERA PLASTICA - CABLES EMISOR DE IMPULSOS	2020/07/17
19259	XAA2950000387556	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2020/07/17
12489	508100000087	Alambre - VISUALIZADOR	2019/10/09
19259	2950000282896	ABRAZADERA PLASTICA - CABLES EMISOR DE IMPULSOS	2019/09/10
19259	2950000149658	Alambre - MEDIDOR VOLUEMTRICO	2019/09/10
18768	2950000282034	ABRAZADERA PLASTICA - CABLES EMISOR DE IMPULSOS	2019/07/16
18768	2950000282033	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2019/07/16
18768	2950000282032	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2019/07/16
18768	2950000282031	Alambre - VISUALIZADOR	2019/07/16
18768	2950000282030	Alambre - VISUALIZADOR	2019/07/16
18768	2950000176868	Alambre - MEDIDOR VOLUEMTRICO	2019/07/16

REPORTE DE PRECINTOS AUSENTES O VULNERADOS EN EL MOMENTO DE LA VERIFICACIÓN

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación

REPORTE DE PRECINTOS COLOCADOS POR EL VERIFICADOR

Made with Xodo PDF Reader and Editor

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
REPORTE DE PRECINTOS DETERIORADOS			
Código Usuario	**Número de serie**	**Tipo de precinto**	**Fecha de colocación**

RESUMEN DE LA VERIFICACIÓN	
ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M22307	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M22314	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M22331	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M22334	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE PRECIO UNITARIO	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO	CONFORME
RESULTADO GENERAL DE LA VERIFICACIÓN	CONFORME

OBSERVACIONES	
Observaciones del OAVM - Verificador	CONFORME. El equipo se ajusta al reglamento técnico, se instalan etiquetas amarillas.
Observaciones de quien atiende la visita:	Se recibe la información técnica y el equipo funcionando correctamente y a satisfacción.
Errores a favor del consumidor:	NO

Made with Xodo PDF Reader and Editor

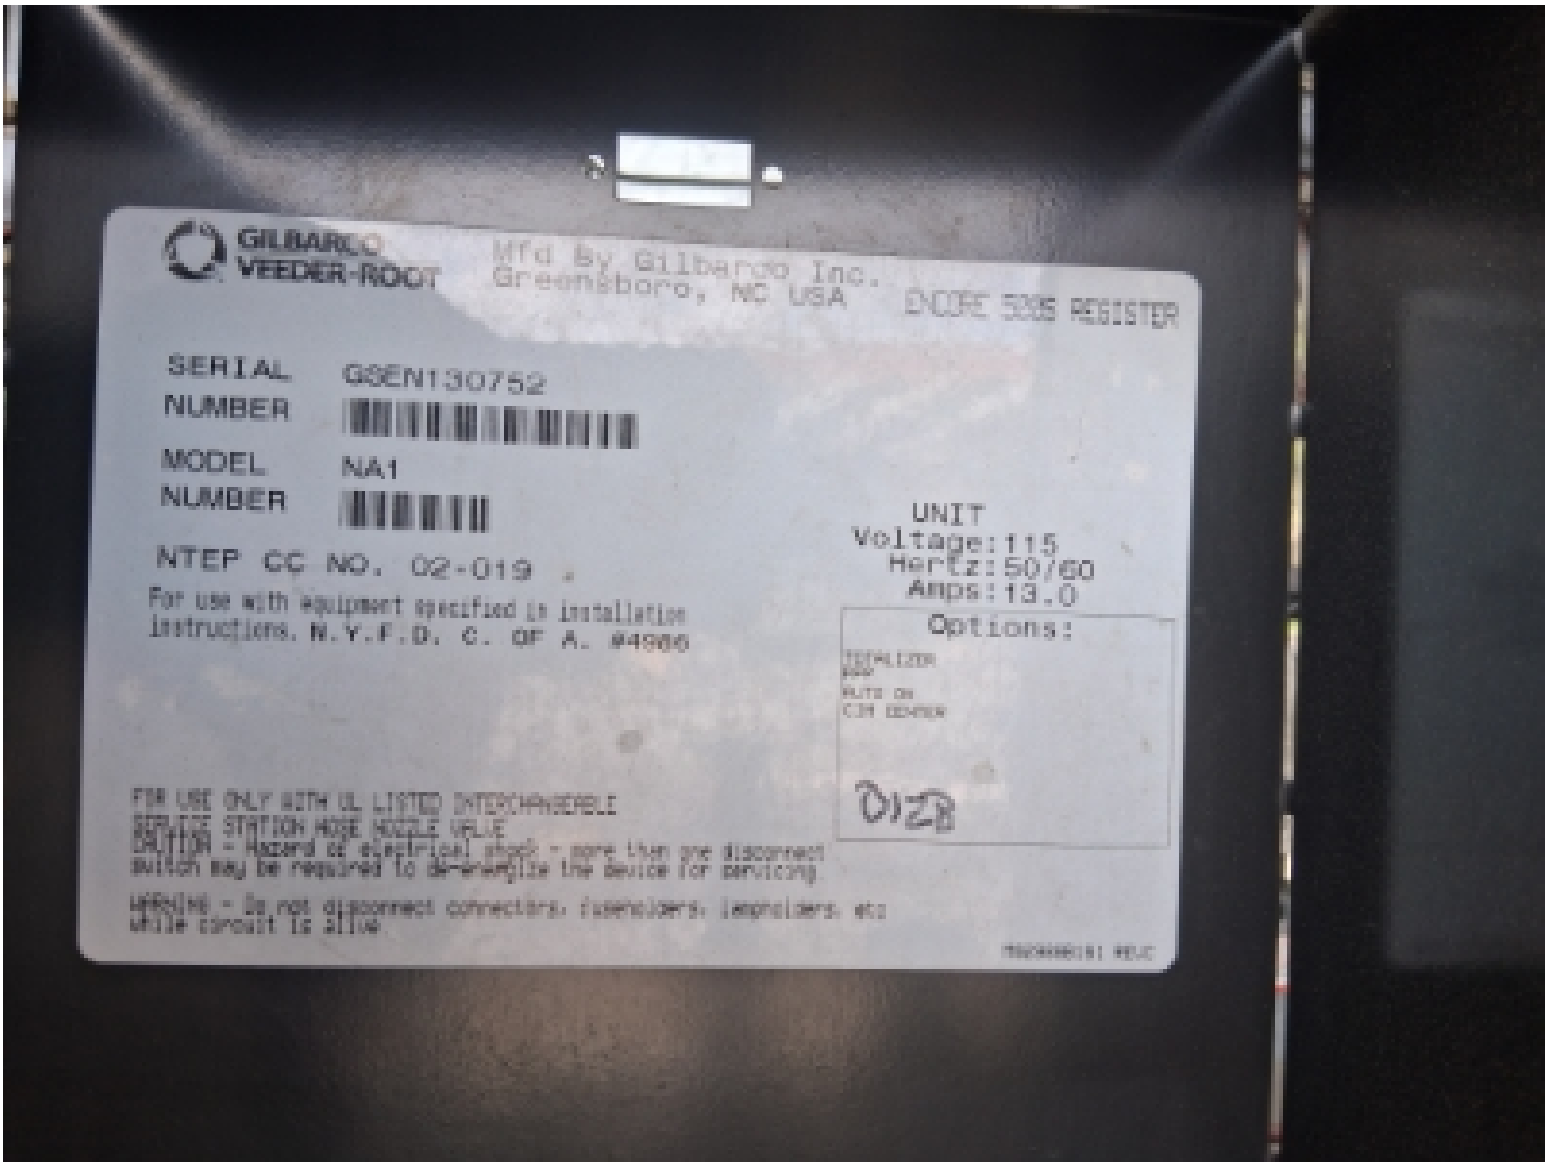
REGISTRO FOTOGRÁFICO



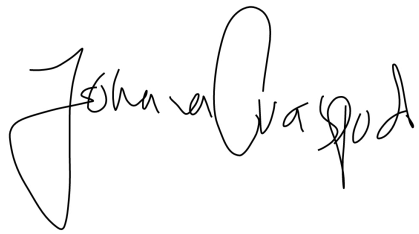
Made with Xodo PDF Reader and Editor



Made with Xodo PDF Reader and Editor



Made with Xodo PDF Reader and Editor

FIRMA DE QUIEN ATIENDE:		FIRMA DEL OAVM - VERIFICADOR:	
			
Nombre de quien atiende:	JOHANA ELIZABETH CUASPUD VILLA	**Nombre Profesional SIC:**	JEFFREY TORO BYLANDER
Cédula de ciudadania:	1193527466	**Cédula de ciudadania:**	1107045433

Made with Xodo PDF Reader and Editor

Superintendencia de Industria y Comercio

INFORME DE VERIFICACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Metrología Legal

CVM Consorcio Verificación Metrológica

ONAC ACREDITADO

CEA-3.0-14:V3
CEA-3.0-15:V3
17-OVM-001

Código del Hito:	213345	**Tipo de Verificación:**	Periódica	**Estado del instrumento:**	FUERA DE SERVICIO	**Fecha:**	2025/11/20

ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

NIT OAVM:	900987141	**Razón Social OAVM:**	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM

INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Cámara de Comercio:	PASTO	**Razón Social o Nombre:**	SERVICENTRO PASTO
Matricula Mercantil:	0000056613	**Dirección:**	CALLE 9 NO.16A-20 PANAMERICANA

DATOS DEL INSTRUMENTO

NII:	S5998	**Productor / Importador / OAVM:**	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM		
No. de serie:	GSEN130634	**Marca:**	GILBARCO	**Modelo:**	NA1 ENCORE 500S-R
Temperatura máxima (°C):	40.0	**Temperatura mínima (°C):**	-20.0	**Conexión perifericos:**	SI
Caudal mínimo (gal/min):	0.5	**Caudal máximo (gal/min):**	10.0	**CMM (gal):**	0.5
Número de caras:	2	**Cantidad de Mangueras:**	4	**Ubicación Latitud**	1.203165
Ubicación Longitud	-77.282065	**Ubicación Descripción**	EDS SERVICENTRO PASTO, CALLE 9 # 16A-20 PANAMERICANA, PASTO, NARIÑO.		

PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN

Número de serie	Descripción	Capacidad	Error	Cert. Calibración	Temp. Calibración
V009-20	5-RECIPIENTE VOLUMETRICO 5 gal-S1-20	5.0	0.026	ILM25 - CC80626	20
V05G-010-20	5-RECIPIENTE VOLUMETRICO 05 gal-S1-20	0.5	0.003	ILM25 - CC81106	20
07460064101-S34	D-TERMOMETRO DIGITAL	100.0	-2.4	PST - 1307	25
H160316583	5-TERMOHIGROMETRO-B1	100.0	-1.1	PSTH - 6205	25

CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES

Temperatura inicial (°C):	22.6	**Temperatura intermedia (°C):**	22.6	**Temperatura final (°C):**	22.6
Temperatura mínima (°C):	22.6	**Temperatura máxima (°C):**	22.6	**Delta de T (°C):**	0.0

ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES

Requisito	Conforme	No Conforme	Observaciones
Placa de características	X		
Contenido TCM	X		
Marca de regularización	X		
Comprobación de precintos conformes	X		
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo	X		
RESULTADO ENSAYO			CONFORME

ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES

NII Manguera:	M22278	**Serie:**	GSEN130634-M1		**Cara:**	1	**Orden:**	1
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V009-20	22.1	5.0	-0.3	4.985	0.327	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-010-20	22.5	0.5	-0.25	0.49875	0.254	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	
NII Manguera:	M22282	**Serie:**	GSEN130634-M2		**Cara:**	1	**Orden:**	2
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V009-20	21.9	5.0	-0.35	4.9825	0.377	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-010-20	21.5	0.5	-0.75	0.49625	0.759	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	
NII Manguera:	M22285	**Serie:**	GSEN130634-M3		**Cara:**	2	**Orden:**	3
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V009-20	19.7	5.0	-0.35	4.9825	0.377	+/- 0.5	CONFORME

Made with Xodo PDF Reader and Editor

Caudal mínimo	V05G-010-20	20.5	0.5	-0.8	0.496	0.809	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	
NII Manguera:	M22294	**Serie:**	GSEN130634-M4		**Cara:**	2	**Orden:**	4
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V009-20	22.5	5.0	-0.4	4.98	0.428	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-010-20	22.6	0.5	-1.5	0.4925	1.526	+/- 1	NO CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	NO CONFORME	

ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL

CONTROL DE PRECIO UNITARIO

NII Manguera:	Precio galón ($)	Precio indicado por el instrumento ($)	Precio calculado ($)	Error ($)	EMP ($)	Resultado
M22278	$14150.0	$70750.0	$70750.0	0.0	707.5	CONFORME
M22282	$14150.0	$70750.0	$70750.0	0.0	707.5	CONFORME
M22285	$14150.0	$70750.0	$70750.0	0.0	707.5	CONFORME
M22294	$14150.0	$70750.0	$70750.0	0.0	707.5	CONFORME
					RESULTADO ENSAYO	CONFORME

CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO

NII Manguera:	Puesta a cero:	Observaciones:
M22278	CONFORME	
M22282	CONFORME	
M22285	CONFORME	
M22294	CONFORME	
	RESULTADO PUESTA A CERO	CONFORME

REPORTE DE PRECINTOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ANTES DE LA VERIFICACIÓN

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
16113	50810000000000630	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2024/09/24
16113	50810000000000570	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2024/09/24
16113	50810000000000609	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2024/09/24
16113	50810000000000566	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2024/09/24
16113	50810000000001295	Alambre - TARJETA ELECTRONICA MAIN BOARD	2024/09/24
16113	50810000000000542	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2024/05/21
16113	50810000000001176	Alambre - TARJETA ELECTRONICA MAIN BOARD	2024/05/21
16113	50810000000001007	Alambre - MEDIDOR VOLUEMTRICO	2023/11/29
16113	50810000000000501	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2023/11/29
20308	XAA2950000036867	Alambre - MEDIDOR VOLUEMTRICO	2023/11/23
20308	XAA2950000036866	Alambre - MEDIDOR VOLUEMTRICO	2023/11/23
16113	50810000000000325	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2023/06/07
16113	50810000000000874	Alambre - MEDIDOR DE IMPULSOS	2023/06/07
16113	50810000000000839	Alambre - MEDIDOR VOLUEMTRICO	2023/04/26
16113	50810000000718	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2023/02/16
19259	XAA2950000478870	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2022/09/13
19259	XAA2950000030056	Alambre - TARJETA ELECTRONICA MAIN BOARD	2022/09/13
16113	508100000604	Alambre - MEDIDOR VOLUEMTRICO	2022/08/16
19259	XAA2950000161222	Alambre - MEDIDOR VOLUEMTRICO	2020/07/17
19259	XAA2950000387558	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2020/07/17
19259	XAA2950000387557	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2020/07/17
19259	XAA2950000161224	Alambre - MEDIDOR VOLUEMTRICO	2020/07/17
19259	XAA2950000161223	Alambre - MEDIDOR VOLUEMTRICO	2020/07/17
19259	XAA2950000387562	ABRAZADERA PLASTICA - CABLES EMISOR DE IMPULSOS	2020/07/17
19259	XAA2950000161221	Alambre - TARJETA ELECTRONICA MAIN BOARD	2020/07/17
19259	XAA2950000387561	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2020/07/17
19259	XAA2950000387560	ABRAZADERA PLASTICA - CABLES EMISOR DE IMPULSOS	2020/07/17
19259	XAA2950000387559	ABRAZADERA PLASTICA - CABLES EMISOR DE IMPULSOS	2020/07/17

Made with Xodo PDF Reader and Editor

12489	508100000088	Alambre - VISUALIZADOR	2019/10/09
19259	2950000282897	ABRAZADERA PLASTICA - CABLES EMISOR DE IMPULSOS	2019/09/10
19259	2950000149660	Alambre - MEDIDOR VOLUEMTRICO	2019/09/10
18768	2950000282045	ABRAZADERA PLASTICA - CABLES EMISOR DE IMPULSOS	2019/07/16
18768	2950000282044	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2019/07/16
18768	2950000282043	Alambre - TARJETA ELECTRONICA MAIN BOARD	2019/07/16
18768	2950000282042	Alambre - VISUALIZADOR	2019/07/16
18768	2950000282041	Alambre - VISUALIZADOR	2019/07/16
18768	2950000176873	Alambre - MEDIDOR VOLUEMTRICO	2019/07/16

REPORTE DE PRECINTOS AUSENTES O VULNERADOS EN EL MOMENTO DE LA VERIFICACIÓN

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación

REPORTE DE PRECINTOS COLOCADOS POR EL VERIFICADOR

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación

REPORTE DE PRECINTOS DETERIORADOS

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación

RESUMEN DE LA VERIFICACIÓN

ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M22278	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M22282	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M22285	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M22294	NO CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE PRECIO UNITARIO	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO	CONFORME
RESULTADO GENERAL DE LA VERIFICACIÓN	NO CONFORME

OBSERVACIONES

Observaciones del OAVM - Verificador	NO CONFORME. El equipo NO se ajusta al reglamento técnico, se coloca etiquetas rojas de NO CONFORME. Se indica al titular del instrumento que debe realizar la respectiva reparación. La(s) no conformidad(es) pueden generar un proceso administrativo sancionatorio por parte de la SIC hasta por 2000 SMLV.
Observaciones de quien atiende la visita:	Se recibe la información técnica y el equipo funcionando correctamente y a satisfacción.
Errores a favor del consumidor:	NO

Made with Xodo PDF Reader and Editor

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Made with Xodo PDF Reader and Editor



Made with Xodo PDF Reader and Editor



Made with Xodo PDF Reader and Editor

FIRMA DE QUIEN ATIENDE:	FIRMA DEL OAVM - VERIFICADOR:
	

Nombre de quien atiende:	JOHANA ELIZABETH CUASPUD VILLA	**Nombre Profesional SIC:**	JEFFREY TORO BYLANDER
Cédula de ciudadania:	1193527466	**Cédula de ciudadania:**	1107045433

Made with Xodo PDF Reader and Editor

Superintendencia de Industria y Comercio

INFORME DE VERIFICACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Metrología Legal

CVM Consorcio Verificación Metrológica

ONAC ACREDITADO

CEA-3.0-14:V3
CEA-3.0-15:V3
17-OVM-001

Código del Hito:	213346	**Tipo de Verificación:**	Periódica	**Estado del instrumento:**	EN SERVICIO	**Fecha:**	2025/11/20

ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

NIT OAVM:	900987141	**Razón Social OAVM:**	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM

INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Cámara de Comercio:	PASTO	**Razón Social o Nombre:**	SERVICENTRO PASTO
Matricula Mercantil:	0000056613	**Dirección:**	CALLE 9 NO.16A-20 PANAMERICANA

DATOS DEL INSTRUMENTO

NII:	S95233	**Productor / Importador / OAVM:**	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM		
No. de serie:	13060315	**Marca:**	HONGYANG	**Modelo:**	CMD1687SK-D-GAQ2PRL -R
Temperatura máxima (°C):	50.0	**Temperatura mínima (°C):**	-20.0	**Conexión perifericos:**	SI
Caudal mínimo (gal/min):	1.32	**Caudal máximo (gal/min):**	14.53	**CMM (gal):**	0.528
Número de caras:	2	**Cantidad de Mangueras:**	2	**Ubicación Latitud**	1.203256
Ubicación Longitud	-77.282159	**Ubicación Descripción**	EDS SERVICENTRO PASTO, CALLE 9 # 16A-20 PANAMERICANA, PASTO, NARIÑO.		

PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN

Número de serie	Descripción	Capacidad	Error	Cert. Calibración	Temp. Calibración
V009-20	5-RECIPIENTE VOLUMETRICO 5 gal-S1-20	5.0	0.026	ILM25 - CC80626	20
V05G-010-20	5-RECIPIENTE VOLUMETRICO 05 gal-S1-20	0.5	0.003	ILM25 - CC81106	20
07460064101-S34	D-TERMOMETRO DIGITAL	100.0	-2.4	PST - 1307	25
H160316583	5-TERMOHIGROMETRO-B1	100.0	-1.1	PSTH - 6205	25

CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES

Temperatura inicial (°C):	20.6	**Temperatura intermedia (°C):**	21.6	**Temperatura final (°C):**	22.3
Temperatura mínima (°C):	20.6	**Temperatura máxima (°C):**	22.3	**Delta de T (°C):**	1.7

ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES

Requisito	Conforme	No Conforme	Observaciones
Placa de características	X		
Contenido TCM	X		
Marca de regularización	X		
Comprobación de precintos conformes	X		
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo	X		
RESULTADO ENSAYO			CONFORME

ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES

NII Manguera:	M95218	**Serie:**	13060315-M1		**Cara:**	1	**Orden:**	1
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V009-20	23.1	5.0	-0.15	4.992500000000001	0.176	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-010-20	22.5	0.5	-0.3	0.4985	0.304	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO		CONFORME

NII Manguera:	M95237	**Serie:**	13060315-M2		**Cara:**	2	**Orden:**	2
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V009-20	24.2	5.0	-0.15	4.992500000000001	0.176	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-010-20	23.5	0.5	0.62	0.5031	-0.613	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO		CONFORME

ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL

CONTROL DE PRECIO UNITARIO

Made with Xodo PDF Reader and Editor

Superintendencia de Industria y Comercio

INFORME DE VERIFICACIÓN
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Metrología Legal

CVM Consorcio Verificación Metrológica
ONAC ACREDITADO
CEA-3.0-14:V3
CEA-3.0-15:V3
17-OVM-001

NII Manguera:	Precio galón ($)	Precio indicado por el instrumento ($)	Precio calculado ($)	Error ($)	EMP ($)	Resultado
M95218	$10130.0	$50650.0	$50650.0	0.0	506.5	CONFORME
M95237	$10130.0	$50650.0	$50650.0	0.0	506.5	CONFORME
					RESULTADO ENSAYO	CONFORME

CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO

NII Manguera:	Puesta a cero:	Observaciones:
M95218	CONFORME	
M95237	CONFORME	
	RESULTADO PUESTA A CERO	CONFORME

REPORTE DE PRECINTOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ANTES DE LA VERIFICACIÓN

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
42478	XAA2950000062751	Alambre con precinto - MEDIDOR TORNILLO DE REGULACION Y TAPAS	2024/11/29
19259	XAA2950000161229	Alambre con precinto - MEDIDOR TORNILLO DE REGULACION Y TAPAS	2020/07/17
19259	XAA2950000161230	Alambre con precinto - MEDIDOR TORNILLO DE REGULACION Y TAPAS	2020/07/17
19259	XAA2950000161228	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSOS AL CHASIS	2020/07/17
19259	XAA2950000161226	Alambre con precinto - MEDIDOR TORNILLO DE REGULACION Y TAPAS	2020/07/17
19259	XAA2950000161227	Alambre con precinto - MEDIDOR TORNILLO DE REGULACION Y TAPAS	2020/07/17
19259	XAA2950000161225	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSOS AL CHASIS	2020/07/17
18768	2950000282051	PEGATINA - INTERFASES	2019/07/16
18768	2950000282050	PEGATINA - INTERFASES	2019/07/16
18768	2950000282049	PEGATINA - PANTALLA DE DATOS MEDIDOS	2019/07/16
18768	2950000282048	PEGATINA - PANTALLA DE DATOS MEDIDOS	2019/07/16
18768	2950000282047	PEGATINA - PANTALLA DE DATOS MEDIDOS	2019/07/16
18768	2950000282046	PEGATINA - PANTALLA DE DATOS MEDIDOS	2019/07/16
18768	2950000176876	Alambre con precinto - MEDIDOR TORNILLO DE REGULACION Y TAPAS	2019/07/16
18768	2950000176875	Alambre con precinto - MEDIDOR TORNILLO DE REGULACION Y TAPAS	2019/07/16
18768	2950000176874	Alambre con precinto - MEMORIA EPROM O MEMORIA FLASH	2019/07/16

REPORTE DE PRECINTOS AUSENTES O VULNERADOS EN EL MOMENTO DE LA VERIFICACIÓN

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación

REPORTE DE PRECINTOS COLOCADOS POR EL VERIFICADOR

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación

REPORTE DE PRECINTOS DETERIORADOS

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación

RESUMEN DE LA VERIFICACIÓN

ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M95218	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M95237	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE PRECIO UNITARIO	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO	CONFORME
RESULTADO GENERAL DE LA VERIFICACIÓN	CONFORME

OBSERVACIONES

Observaciones del OAVM - Verificador	CONFORME. El equipo se ajusta al reglamento técnico, se instalan etiquetas amarillas.
Observaciones de quien atiende la visita:	Se recibe la información técnica y el equipo funcionando correctamente y a satisfacción.
Errores a favor del consumidor:	NO

Made with Xodo PDF Reader and Editor

REGISTRO FOTOGRÁFICO



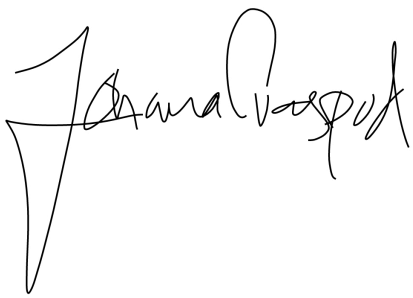
Made with Xodo PDF Reader and Editor



Made with Xodo PDF Reader and Editor



Made with Xodo PDF Reader and Editor

FIRMA DE QUIEN ATIENDE:	FIRMA DEL OAVM - VERIFICADOR:
	

Nombre de quien atiende:	JOHANA ELIZABETH CUASPUD VILLA	**Nombre Profesional SIC:**	JEFFREY TORO BYLANDER
Cédula de ciudadania:	1193527466	**Cédula de ciudadania:**	1107045433

Superintendencia de Industria y Comercio

INFORME DE VERIFICACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Metrología Legal

CVM Consorcio Verificación Metrológica

ONAC ACREDITADO

CEA-3.0-14
CEA-3.0-15
17-OVM-001

Código del Hito:	195226	Tipo de Verificación:	Periódica	Estado del instrumento:	EN SERVICIO	Fecha:	2025/04/11

ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

NIT OAVM:	900987141	Razón Social OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM

INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Cámara de Comercio:	PASTO	Razón Social o Nombre:	ESTACION DE SERVICIO AMERICAS PASTO
Matricula Mercantil:	0000120846	Dirección:	CARRERA 19 NO 14 - 58

DATOS DEL INSTRUMENTO

NII:	S98936	Productor / Importador / OAVM:	GOMEZ VELASQUEZ S.A.S.		
No. de serie:	637184	Marca:	WAYNE	Modelo:	H (N/LU) 22-22 MR
Temperatura máxima (°C):	55.0	Temperatura mínima (°C):	-20.0	Conexión perifericos:	SI
Caudal mínimo (gal/min):	1.057	Caudal máximo (gal/min):	10.0	CMM (gal):	0.264
Número de caras:	2	Cantidad de Mangueras:	4	Ubicación Latitud	1.207379
Ubicación Longitud	-77.278029	Ubicación Descripción	EDS LAS AMÉRICAS CARRERA 19 # 14 - 58 PASTO NARIÑO		

PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN

Número de serie	Descripción	Capacidad	Error	Cert. Calibración	Temp. Calibración
V008-20	5-RECIPIENTE VOLUMETRICO 5 gal-S2-20	5.0	0.004	ILM24 - CC76086	20
V05G-009-20	5-RECIPIENTE VOLUMETRICO 0,5 gal-S2-20	0.5	-0.002	ILM24 - CC76088	20
07460064101-S34	D-TERMOMETRO DIGITAL	100.0	-2.2	PS_THR_4308	25
H160316583	5-TERMOHIGROMETRO-B1	100.0	-1.1	PSTH - 6205	25

CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES

Temperatura inicial (°C):	19.0	Temperatura intermedia (°C):	17.3	Temperatura final (°C):	17.0
Temperatura mínima (°C):	17.0	Temperatura máxima (°C):	19.0	Delta de T (°C):	2.0

ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES

Requisito	Conforme	No Conforme	Observaciones
Placa de características	X		
Contenido TCM	X		
Marca de regularización	X		
Comprobación de precintos conformes	X		
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo	X		
RESULTADO ENSAYO			CONFORME

ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES

NII Manguera:	M98937	Serie:	637184-M1		Cara:	1	Orden:	1
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V008-20	17.5	5.0	0.2	5.01	-0.196	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-009-20	16.6	0.5	0.1	0.5005	-0.102	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO		CONFORME

NII Manguera:	M98938	Serie:	637184-M2		Cara:	1	Orden:	2
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V008-20	17.2	5.0	-0.15	4.992500000000001	0.154	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-009-20	17.5	0.5	-0.45	0.49775	0.45	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO		CONFORME

NII Manguera:	M98948	Serie:	637184-M3		Cara:	2	Orden:	3
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V008-20	15.5	5.0	-0.1	4.995	0.104	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-009-20	15.8	0.5	-0.95	0.49525	0.957	+/- 1	CONFORME

					RESULTADO ENSAYO		CONFORME	
NII Manguera:	M98949	**Serie:**	637184-M4		**Cara:**	2	**Orden:**	4
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V008-20	17.9	5.0	-0.05	4.9975000000000005	0.054	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-009-20	17.8	0.5	0.2	0.501	-0.202	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	

ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL

CONTROL DE PRECIO UNITARIO

NII Manguera:	Precio galón ($)	Precio indicado por el instrumento ($)	Precio calculado ($)	Error ($)	EMP ($)	Resultado
M98937	$13920.0	$69600.0	$69600.0	0.0	696.0	CONFORME
M98938	$9800.0	$49000.0	$49000.0	0.0	490.0	CONFORME
M98948	$13920.0	$69600.0	$69600.0	0.0	696.0	CONFORME
M98949	$9800.0	$49000.0	$49000.0	0.0	490.0	CONFORME
					RESULTADO ENSAYO	CONFORME

CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO

NII Manguera:	Puesta a cero:	Observaciones:
M98937	CONFORME	
M98938	CONFORME	
M98948	CONFORME	
M98949	CONFORME	
	RESULTADO PUESTA A CERO	CONFORME

REPORTE DE PRECINTOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ANTES DE LA VERIFICACIÓN

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
20308	XAA2950000457222	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2024/04/15
16113	50810000000000461	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2024/02/03
20308	XAA2950000036864	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2023/11/22
20308	XAA2950000036863	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2023/11/22
20308	XAA2950000036862	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2023/11/22
16113	50810000000000996	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2023/08/28
16113	50810000000000918	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2023/08/28
16113	50810000000000917	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2023/08/28
20308	XAA2950000465295	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2023/05/15
20308	XAA2950000465294	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2023/05/15
16113	50810000000000333	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2023/03/09
16113	508100000381	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2022/11/11
16113	508100000380	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2022/11/11
20308	XAA2950000428773	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2022/03/07
20308	XAA2950000428772	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2022/03/07
16113	508100000200	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2021/07/10
20308	XAA2950000373764	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2020/11/11
20308	XAA2950000373763	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2020/11/11
16096	508100000070	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2020/09/05
19259	2950000149633	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/09
19259	2950000149635	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/09
19259	2950000149640	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/09
19259	2950000149638	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2019/09/09
19259	2950000149639	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/09
19259	2950000149637	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2019/09/09
19259	2950000149634	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/09
19259	2950000149636	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/09
19259	2950000149632	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2019/09/09
19259	2950000149631	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2019/09/09

19259	2950000282881	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/09
19259	2950000282879	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/09
19259	2950000282880	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/09
19259	2950000282877	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/09
19259	2950000282878	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/09
19259	2950000282875	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/09
19259	2950000282876	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/09

REPORTE DE PRECINTOS AUSENTES O VULNERADOS EN EL MOMENTO DE LA VERIFICACIÓN

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación

REPORTE DE PRECINTOS COLOCADOS POR EL VERIFICADOR

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
42478	XAA2950000501622	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2025/04/11
42478	XAA2950000501623	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2025/04/11

REPORTE DE PRECINTOS DETERIORADOS

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
16113	50810000000000564	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2024/07/19

RESUMEN DE LA VERIFICACIÓN

ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M98937	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M98938	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M98948	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M98949	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE PRECIO UNITARIO	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO	CONFORME
RESULTADO GENERAL DE LA VERIFICACIÓN	CONFORME

OBSERVACIONES

Observaciones del OAVM - Verificador	CONFORME. El equipo se ajusta al reglamento técnico correspondiente, se instala etiquetas aplicables.
Observaciones de quien atiende la visita:	Se recibe la información técnica pertinente y el equipo funcionando correctamente y a satisfacción.
Errores a favor del consumidor:	NO

REGISTRO FOTOGRÁFICO







FIRMA DE QUIEN ATIENDE:		FIRMA DEL OAVM - VERIFICADOR:	
			
Nombre de quien atiende:	LINA FERNANDA TAPIA ORTEGA	**Nombre del verificador:**	PABLO ANDRES VARGAS VELEZ
Cédula de ciudadania:	1088798930	**Cédula de ciudadania:**	1143977863

Superintendencia de Industria y Comercio

INFORME DE VERIFICACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Metrología Legal

CVM Consorcio Verificación Metrológica

ONAC ACREDITADO

CEA-3.0-14
CEA-3.0-15
17-OVM-001

Código del Hito:	195225	Tipo de Verificación:	Periódica	Estado del instrumento:	EN SERVICIO	Fecha:	2025/04/11

ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

NIT OAVM:	900987141	Razón Social OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM

INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Cámara de Comercio:	PASTO	Razón Social o Nombre:	ESTACION DE SERVICIO AMERICAS PASTO
Matricula Mercantil:	0000120846	Dirección:	CARRERA 19 NO 14 - 58

DATOS DEL INSTRUMENTO

NII:	S98939	Productor / Importador / OAVM:	GOMEZ VELASQUEZ S.A.S.		
No. de serie:	637186	Marca:	WAYNE	Modelo:	H (N/LU) 22-22 MR
Temperatura máxima (°C):	55.0	Temperatura mínima (°C):	-20.0	Conexión perifericos:	SI
Caudal mínimo (gal/min):	1.057	Caudal máximo (gal/min):	10.0	CMM (gal):	0.264
Número de caras:	2	Cantidad de Mangueras:	4	Ubicación Latitud	1.20753
Ubicación Longitud	-77.277979	Ubicación Descripción	EDS LAS AMÉRICAS CARRERA 19 # 14 - 58 PASTO NARIÑO		

PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN

Número de serie	Descripción	Capacidad	Error	Cert. Calibración	Temp. Calibración
V008-20	5-RECIPIENTE VOLUMETRICO 5 gal-S2-20	5.0	0.004	ILM24 - CC76086	20
V05G-009-20	5-RECIPIENTE VOLUMETRICO 0,5 gal-S2-20	0.5	-0.002	ILM24 - CC76088	20
07460064101-S34	D-TERMOMETRO DIGITAL	100.0	-2.2	PS_THR_4308	25
H160316583	5-TERMOHIGROMETRO-B1	100.0	-1.1	PSTH - 6205	25

CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES

Temperatura inicial (°C):	17.1	Temperatura intermedia (°C):	16.3	Temperatura final (°C):	16.4
Temperatura mínima (°C):	16.3	Temperatura máxima (°C):	17.1	Delta de T (°C):	0.8

ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES

Requisito	Conforme	No Conforme	Observaciones
Placa de características	X		
Contenido TCM	X		
Marca de regularización	X		
Comprobación de precintos conformes	X		
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo	X		
RESULTADO ENSAYO			CONFORME

ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES

NII Manguera:	M98940	Serie:	637186-M1		Cara:	1	Orden:	1
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V008-20	16.9	5.0	-0.05	4.997500000000 0005	0.054	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-009-20	16.9	0.5	-0.8	0.496	0.804	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO		CONFORME
NII Manguera:	M98941	Serie:	637186-M2		Cara:	1	Orden:	2
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V008-20	16.3	5.0	-0.15	4.992500000000 001	0.154	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-009-20	15.9	0.5	-0.8	0.496	0.804	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO		CONFORME
NII Manguera:	M98950	Serie:	637186-M3		Cara:	2	Orden:	3
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**

Caudal máximo	V008-20	16.3	5.0	-0.05	4.997500000000 0005	0.054	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-009-20	17.0	0.5	-0.95	0.49525	0.957	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	
NII Manguera:	M98962	**Serie:**	637186-M4		**Cara:**	2	**Orden:**	4
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V008-20	17.5	5.0	-0.2	4.99	0.204	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-009-20	16.2	0.5	-0.55	0.49725	0.551	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	

ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL

CONTROL DE PRECIO UNITARIO

NII Manguera:	Precio galón ($)	Precio indicado por el instrumento ($)	Precio calculado ($)	Error ($)	EMP ($)	Resultado
M98940	$13920.0	$69600.0	$69600.0	0.0	696.0	CONFORME
M98941	$13920.0	$69600.0	$69600.0	0.0	696.0	CONFORME
M98950	$13920.0	$69600.0	$69600.0	0.0	696.0	CONFORME
M98962	$13920.0	$69600.0	$69600.0	0.0	696.0	CONFORME
					RESULTADO ENSAYO	CONFORME

CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO

NII Manguera:	Puesta a cero:	Observaciones:
M98940	CONFORME	
M98941	CONFORME	
M98950	CONFORME	
M98962	CONFORME	
	RESULTADO PUESTA A CERO	CONFORME

REPORTE DE PRECINTOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ANTES DE LA VERIFICACIÓN

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
20308	XAA2950000373762	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2020/11/11
19259	2950000149665	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/10
19259	2950000149663	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/10
19259	2950000149669	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/10
19259	2950000149668	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/10
19259	2950000149666	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000282902	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000282903	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000282904	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000149667	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000149664	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/10
19259	2950000149662	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/10
19259	2950000149659	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000149661	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000282898	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000282900	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000282899	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10

REPORTE DE PRECINTOS AUSENTES O VULNERADOS EN EL MOMENTO DE LA VERIFICACIÓN

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación

REPORTE DE PRECINTOS COLOCADOS POR EL VERIFICADOR

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
42478	XAA2950000501624	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2025/04/11

REPORTE DE PRECINTOS DETERIORADOS

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
19259	2950000282901	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10

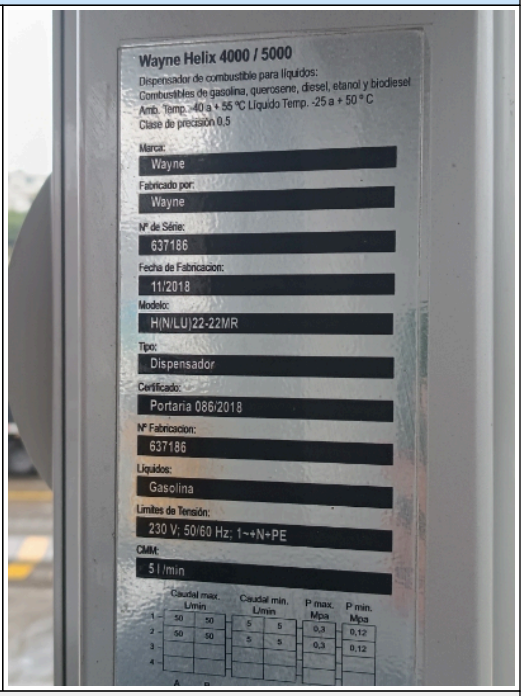
RESUMEN DE LA VERIFICACIÓN	
ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M98940	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M98941	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M98950	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M98962	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE PRECIO UNITARIO	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO	CONFORME
RESULTADO GENERAL DE LA VERIFICACIÓN	CONFORME

OBSERVACIONES	
Observaciones del OAVM - Verificador	CONFORME. El equipo se ajusta al reglamento técnico correspondiente, se instala etiquetas aplicables.
Observaciones de quien atiende la visita:	Se recibe la información técnica pertinente y el equipo funcionando correctamente y a satisfacción.
Errores a favor del consumidor:	NO

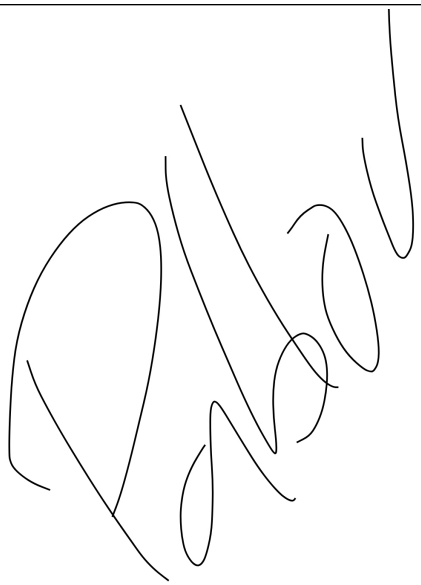
REGISTRO FOTOGRÁFICO







FIRMA DE QUIEN ATIENDE:	FIRMA DEL OAVM - VERIFICADOR:

			
Nombre de quien atiende:	LINA FERNANDA TAPIA ORTEGA	**Nombre del verificador:**	PABLO ANDRES VARGAS VELEZ
Cédula de ciudadania:	1088798930	**Cédula de ciudadania:**	1143977863

Superintendencia de Industria y Comercio

INFORME DE VERIFICACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Metrología Legal

CVM Consorcio Verificación Metrológica

ONAC ACREDITADO

CEA-3.0-14
CEA-3.0-15
17-OVM-001

Código del Hito:	195228	Tipo de Verificación:	Periódica	Estado del instrumento:	FUERA DE SERVICIO	Fecha:	2025/04/11

ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

NIT OAVM:	900987141	Razón Social OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM

INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Cámara de Comercio:	PASTO	Razón Social o Nombre:	ESTACION DE SERVICIO AMERICAS PASTO
Matricula Mercantil:	0000120846	Dirección:	CARRERA 19 NO 14 - 58

DATOS DEL INSTRUMENTO

NII:	S98951	Productor / Importador / OAVM:	GOMEZ VELASQUEZ S.A.S.		
No. de serie:	637185	Marca:	WAYNE	Modelo:	H (N/LU) 22-22 MR
Temperatura máxima (°C):	55.0	Temperatura mínima (°C):	-20.0	Conexión perifericos:	SI
Caudal mínimo (gal/min):	1.057	Caudal máximo (gal/min):	10.0	CMM (gal):	0.264
Número de caras:	2	Cantidad de Mangueras:	4	Ubicación Latitud	1.20751
Ubicación Longitud	-77.278148	Ubicación Descripción	EDS LAS AMÉRICAS CARRERA 19 # 14 - 58 PASTO NARIÑO		

PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN

Número de serie	Descripción	Capacidad	Error	Cert. Calibración	Temp. Calibración
V008-20	5-RECIPIENTE VOLUMETRICO 5 gal-S2-20	5.0	0.004	ILM24 - CC76086	20
V05G-009-20	5-RECIPIENTE VOLUMETRICO 0,5 gal-S2-20	0.5	-0.002	ILM24 - CC76088	20
07460064101-S34	D-TERMOMETRO DIGITAL	100.0	-2.2	PS_THR_4308	25
H160316583	5-TERMOHIGROMETRO-B1	100.0	-1.1	PSTH - 6205	25

CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES

Temperatura inicial (°C):	16.5	Temperatura intermedia (°C):	16.3	Temperatura final (°C):	16.5
Temperatura mínima (°C):	16.3	Temperatura máxima (°C):	16.5	Delta de T (°C):	0.2

ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES

Requisito	Conforme	No Conforme	Observaciones
Placa de características	X		
Contenido TCM	X		
Marca de regularización	X		
Comprobación de precintos conformes	X		
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo	X		
RESULTADO ENSAYO			CONFORME

ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES

NII Manguera:	M98952	Serie:	637185-M1		Cara:	1	Orden:	1
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V008-20	15.5	5.0	-0.35	4.9825	0.355	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-009-20	15.9	0.5	-0.95	0.49525	0.957	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO		CONFORME

NII Manguera:	M98953	Serie:	637186--M2		Cara:	1	Orden:	2
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V008-20	16.1	5.0	0.55	5.0275	-0.543	+/- 0.5	NO CONFORME
Caudal mínimo	V05G-009-20	15.5	0.5	-1.5	0.4925	1.521	+/- 1	NO CONFORME
						RESULTADO ENSAYO		NO CONFORME

NII Manguera:	M98954	Serie:	637185-M4		Cara:	2	Orden:	3
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**

Caudal máximo	V008-20	17.5	5.0	-0.35	4.9825	0.355	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-009-20	16.9	0.5	-0.8	0.496	0.804	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	

NII Manguera:	M98963	**Serie:**	637185-M3		**Cara:**	2	**Orden:**	4
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V008-20	15.7	5.0	0.05	5.0024999999999995	-0.046	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-009-20	15.6	0.5	-0.3	0.4985	0.299	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	

ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL

CONTROL DE PRECIO UNITARIO

NII Manguera:	Precio galón ($)	Precio indicado por el instrumento ($)	Precio calculado ($)	Error ($)	EMP ($)	Resultado
M98952	$13920.0	$69600.0	$69600.0	0.0	696.0	CONFORME
M98953	$13920.0	$69600.0	$69600.0	0.0	696.0	CONFORME
M98954	$13920.0	$69600.0	$69600.0	0.0	696.0	CONFORME
M98963	$13920.0	$69600.0	$69600.0	0.0	696.0	CONFORME
					RESULTADO ENSAYO	CONFORME

CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO

NII Manguera:	Puesta a cero:	Observaciones:
M98952	CONFORME	
M98953	CONFORME	
M98954	CONFORME	
M98963	CONFORME	
	RESULTADO PUESTA A CERO	CONFORME

REPORTE DE PRECINTOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ANTES DE LA VERIFICACIÓN

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
20308	XAA2950000373761	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2020/11/11
12489	508100000071	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2020/03/13
20308	2950000157831	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2020/03/12
20308	2950000157830	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2020/03/12
20308	2950000157829	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2020/03/12
7672	5486000M1170	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/18
7672	5486000M1169	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/18
19259	2950000149653	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/10
19259	2950000149657	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/10
19259	2950000149656	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/10
19259	2950000149655	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/10
19259	2950000149654	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/10
19259	2950000149651	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000149652	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000282891	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000282890	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000282889	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000282894	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000282892	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10

REPORTE DE PRECINTOS AUSENTES O VULNERADOS EN EL MOMENTO DE LA VERIFICACIÓN

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación

REPORTE DE PRECINTOS COLOCADOS POR EL VERIFICADOR

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
42478	XAA2950000501625	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2025/04/11
42478	XAA2950000501626	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2025/04/11
42478	XAA2950000501627	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2025/04/11

REPORTE DE PRECINTOS DETERIORADOS

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
20308	XAA2950000373760	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2020/11/11
19259	2950000282895	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10

RESUMEN DE LA VERIFICACIÓN

ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M98952	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M98953	NO CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M98954	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M98963	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE PRECIO UNITARIO	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO	CONFORME
RESULTADO GENERAL DE LA VERIFICACIÓN	NO CONFORME

OBSERVACIONES

Observaciones del OAVM - Verificador	NO CONFORME. El equipo NO se ajusta al reglamento técnico correspondiente, se instala etiqueta roja de NO conforme.Se indica al titular del instrumento que debe realizar la respectiva reparación. la(s) no conformidad(es) pueden generar un proceso administrativo sancionatorio por parte de la SIC hasta por 2000 SMLMV para manguera M98953.
Observaciones de quien atiende la visita:	Se recibe la información técnica pertinente y el equipo funcionando correctamente y a satisfacción.
Errores a favor del consumidor:	NO

REGISTRO FOTOGRÁFICO







FIRMA DE QUIEN ATIENDE:	FIRMA DEL OAVM - VERIFICADOR:

			
Nombre de quien atiende:	LINA FERNANDA TAPIA ORTEGA	**Nombre del verificador:**	PABLO ANDRES VARGAS VELEZ
Cédula de ciudadania:	1088798930	**Cédula de ciudadania:**	1143977863

Superintendencia de Industria y Comercio

INFORME DE VERIFICACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Metrología Legal

CVM Consorcio Verificación Metrológica

ONAC ACREDITADO

CEA-3.0-14
CEA-3.0-15
17-OVM-001

Código del Hito:	195227	Tipo de Verificación:	Periódica	Estado del instrumento:	EN SERVICIO	Fecha:	2025/04/11

ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

NIT OAVM:	900987141	Razón Social OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM

INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Cámara de Comercio:	PASTO	Razón Social o Nombre:	ESTACION DE SERVICIO AMERICAS PASTO
Matricula Mercantil:	0000120846	Dirección:	CARRERA 19 NO 14 - 58

DATOS DEL INSTRUMENTO

NII:	S98964	Productor / Importador / OAVM:	GOMEZ VELASQUEZ S.A.S.		
No. de serie:	637183	Marca:	WAYNE	Modelo:	H (N/LU) 22-22 MR
Temperatura máxima (°C):	55.0	Temperatura mínima (°C):	-20.0	Conexión perifericos:	SI
Caudal mínimo (gal/min):	1.057	Caudal máximo (gal/min):	10.0	CMM (gal):	0.264
Número de caras:	2	Cantidad de Mangueras:	4	Ubicación Latitud	1.2076
Ubicación Longitud	-77.27814	Ubicación Descripción	EDS LAS AMÉRICAS CARRERA 19 # 14 - 58 PASTO NARIÑO		

PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN

Número de serie	Descripción	Capacidad	Error	Cert. Calibración	Temp. Calibración
V008-20	5-RECIPIENTE VOLUMETRICO 5 gal-S2-20	5.0	0.004	ILM24 - CC76086	20
V05G-009-20	5-RECIPIENTE VOLUMETRICO 0,5 gal-S2-20	0.5	-0.002	ILM24 - CC76088	20
07460064101-S34	D-TERMOMETRO DIGITAL	100.0	-2.2	PS_THR_4308	25
H160316583	5-TERMOHIGROMETRO-B1	100.0	-1.1	PSTH - 6205	25

CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES

Temperatura inicial (°C):	16.6	Temperatura intermedia (°C):	16.8	Temperatura final (°C):	17.2
Temperatura mínima (°C):	16.6	Temperatura máxima (°C):	17.2	Delta de T (°C):	0.6

ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES

Requisito	Conforme	No Conforme	Observaciones
Placa de características	X		
Contenido TCM	X		
Marca de regularización	X		
Comprobación de precintos conformes	X		
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo	X		
RESULTADO ENSAYO			CONFORME

ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES

NII Manguera:	M98965	Serie:	637183-M1		Cara:	1	Orden:	1
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V008-20	16.5	5.0	-0.1	4.995	0.104	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-009-20	16.8	0.5	-0.65	0.49675	0.652	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO		CONFORME

NII Manguera:	M98966	Serie:	637183-M2		Cara:	1	Orden:	2
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V008-20	17.3	5.0	-0.1	4.995	0.104	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-009-20	18.8	0.5	-0.15	0.49925	0.148	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO		CONFORME

NII Manguera:	M98967	Serie:	637183-M3		Cara:	2	Orden:	3
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V008-20	18.7	5.0	0.05	5.0024999999999995	-0.046	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-009-20	15.7	0.5	-0.05	0.49975	0.048	+/- 1	CONFORME

						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	
NII Manguera:	M98968	**Serie:**	637183-M4		**Cara:**	2	**Orden:**	4
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del liquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V008-20	16.3	5.0	-0.05	4.9975000000000005	0.054	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-009-20	16.7	0.5	-0.1	0.4995	0.098	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	

ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL

CONTROL DE PRECIO UNITARIO

NII Manguera:	Precio galón ($)	Precio indicado por el instrumento ($)	Precio calculado ($)	Error ($)	EMP ($)	Resultado
M98965	$13920.0	$69600.0	$69600.0	0.0	696.0	CONFORME
M98966	$9800.0	$49000.0	$49000.0	0.0	490.0	CONFORME
M98967	$13920.0	$69600.0	$69600.0	0.0	696.0	CONFORME
M98968	$9800.0	$49000.0	$49000.0	0.0	490.0	CONFORME
					RESULTADO ENSAYO	CONFORME

CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO

NII Manguera:	Puesta a cero:	Observaciones:
M98965	CONFORME	
M98966	CONFORME	
M98967	CONFORME	
M98968	CONFORME	
	RESULTADO PUESTA A CERO	CONFORME

REPORTE DE PRECINTOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ANTES DE LA VERIFICACIÓN

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
20308	XAA2950000373759	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2020/11/11
19259	2950000149647	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/10
19259	2950000149645	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/10
19259	2950000149649	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000149650	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000149646	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/10
19259	2950000149648	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/10
19259	2950000149644	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/10
19259	2950000149643	Alambre con precinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2019/09/10
19259	2950000149641	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000149642	Alambre con precinto - TAPA MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000282883	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000282885	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000282884	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000282882	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000282888	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000282887	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10
19259	2950000282886	Alambre con precinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2019/09/10

REPORTE DE PRECINTOS AUSENTES O VULNERADOS EN EL MOMENTO DE LA VERIFICACIÓN

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación

REPORTE DE PRECINTOS COLOCADOS POR EL VERIFICADOR

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación

REPORTE DE PRECINTOS DETERIORADOS

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación

RESUMEN DE LA VERIFICACIÓN

ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M98965	CONFORME

ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M98966	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M98967	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M98968	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE PRECIO UNITARIO	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO	CONFORME
RESULTADO GENERAL DE LA VERIFICACIÓN	CONFORME

OBSERVACIONES

Observaciones del OAVM - Verificador	CONFORME. El equipo se ajusta al reglamento técnico correspondiente, se instala etiquetas aplicables.
Observaciones de quien atiende la visita:	Se recibe la información técnica pertinente y el equipo funcionando correctamente y a satisfacción.
Errores a favor del consumidor:	NO

REGISTRO FOTOGRÁFICO







FIRMA DE QUIEN ATIENDE:	**FIRMA DEL OAVM - VERIFICADOR:**

Nombre de quien atiende:	LINA FERNANDA TAPIA ORTEGA	**Nombre del verificador:**	PABLO ANDRES VARGAS VELEZ

Cédula de ciudadania:	1088798930	**Cédula de ciudadania:**	1143977863