CUELLO ORTOPÉDICO

1. Descripción

Dispositivo médico para inmovilizaciones y soporte de la región cervical (cuello) en caso de trauma o emergencias médicas

2. Uso:

Utilizado por el cuerpo médico para inmovilizaciones y soporte de la región cervical (cuello) en caso de trauma o emergencias médicas

3. Materia prima

- ✓ Poliuretano
- ✓ Estoquineta
- ✓ Velcro
- ✓ Polipropileno


4. Composición

- ✓ Dos láminas de poliuretano
- ✓ Un juego ortopédico (pieza en polipropileno)
- ✓ Estoquineta
- ✓ Dos tiras de velcro


5. Planos

5.1. Referencia: cuello ortopédico rígido Philadelphia


S, ADELANTE




S, ATRAS




M, ADELANTE




M, ATRAS



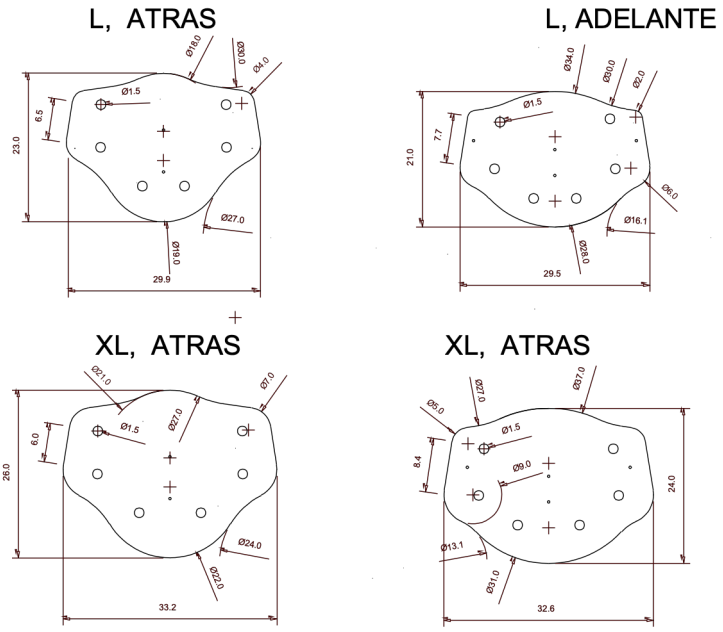

5.2. Referencia: cuello ortopédico blando – Thomas

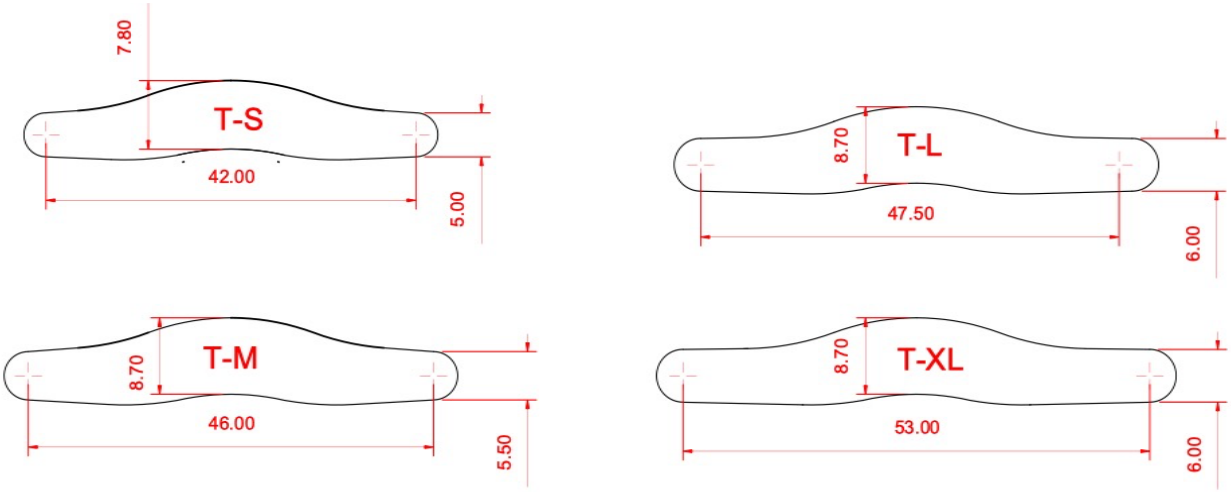

Medidas en Cm.

6. Especificaciones de calidad

Parámetro	Especificación	Prueba
Textura	Suave al tacto	Por observación
Termoformado	Sin deformación	Por observación
Costura	Sin puntadas sueltas	Por observación
Velcro	Funcionalidad del velcro	Por observación
Limpieza	Libre de impurezas visibles	Por observación
Juego ortopédico	Buena sujeción	Por observación
** Resistencia al Desgarre espuma de poliuretano	Unid. N/mm – límite inferior 0.410	NTC 2019
** Densidad espuma de poliuretano	Unid. Kg/m3 Límite inferior 56,1 y Límite Superior 62,0	NTC 2019
** Densidad de la lamina EVA poliuretano	33 ±5 Kg/m3	ISO 845

Las pruebas " ** " son realizadas por el fabricante de la materia prima

7. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

DISPROMED M K tiene almacenado este dispositivo médico en un lugar fresco y seco, protegido de la luz directa del sol, a temperatura ambiente (no mayor a 25 °C) y humedad relativa (no mayor a 85%), aislado del piso (sobre estibas) y pared, libre de humedad y buena ventilación. El cliente debe mantener estas condiciones para que el dispositivo médico conserve su calidad y vida útil.