
Mediimplantes S.A.	FICHA TÉCNICA DE REFERENCIA	COD: F-DD-10
		FE: 2016-09-12
		VE: 04

Nombre Genérico: 109-2-CI Conector Ilíaco

Nº 109-2-CI - 00

Nombre Comercial: Según Plano de Referencia

Producto: Sistema de Fijación Transpedicular ADVANCED
Código: 109

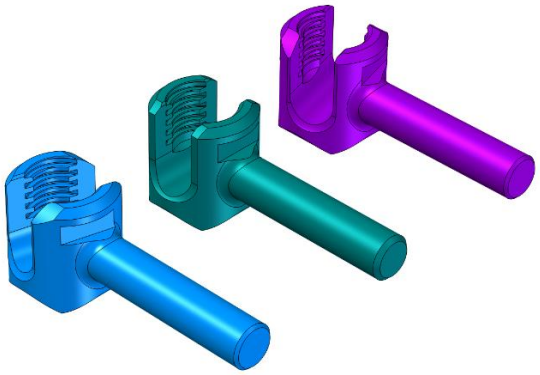


Descripción: Elemento con una extensión cilíndrica y una cabeza que posee ranuras para introducir la barra longitudinal, que se bloquea mediante un tornillo de bloqueo. Esta ranura puede brindar un nivel neutro (0°) y dos angulaciones (15° y -15°) en el plano sagital, también posee distintas longitudes de 20 mm, 25 mm, 30 mm, y 40 mm.

Uso: Utilizados para conectar la barra longitudinal a un Tornillo Poliaxial, Monoaxial o Ilíaco que se encuentre alejado de la misma.

Funcionamiento: Inserte la barra o extensión del conector a la cabeza del tornillo, luego, acople el conector con la barra longitudinal, finalmente, fije el sistema con un tornillo de bloqueo o tornillo de bloqueo fusible.

Clasificación y Tipo de Riesgo: Clase IIb, Riesgo Alto (Decreto 4725 de 2005, Colombia)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

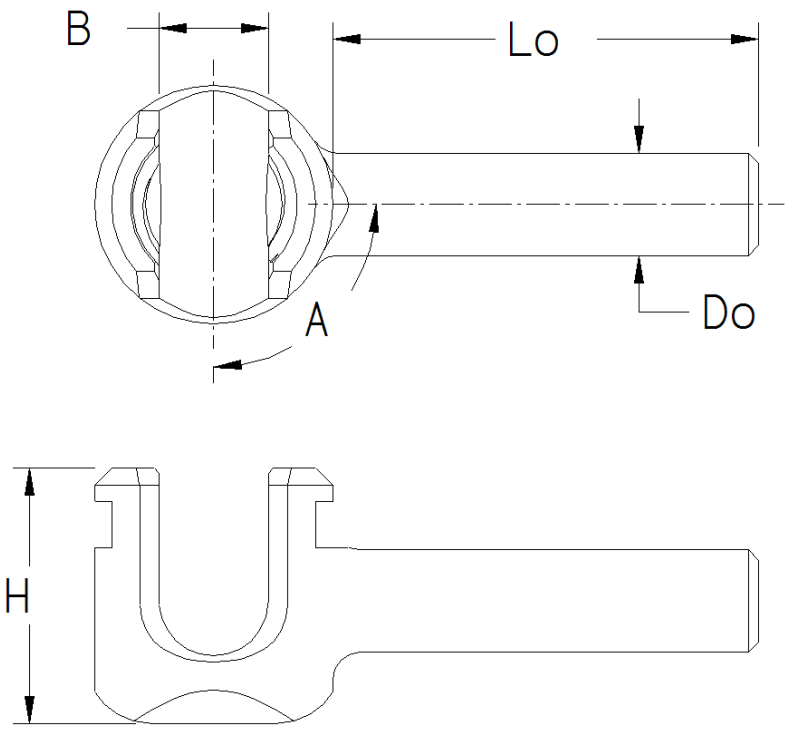

Mediimplantes S.A.	FICHA TÉCNICA DE REFERENCIA	COD: F-DD-10
		FE: 2016-09-12
		VE: 04

Gamas de Referencias						
Referencia	Grados - A (°)	Lo (mm)	Do (mm)	B (mm)	H (mm)	Peso (g)
109-10-CI01	90	20	6.0	6.4	15	9
109-10-CI02		25				
109-10-CI03		30				
109-10-CI04		40				
109-10-CI05	75	20				
109-10-CI06		25				
109-10-CI07		30				
109-10-CI08		40				
109-10-CI09	105	20				
109-10-CI10		25				
109-10-CI11		30				
109-10-CI12		40				
109-10-CI13	90	20			13	
109-10-CI14		25				
109-10-CI15		30				

DATOS TÉCNICOS	
Materiales :	Aleación de Titanio (Ti6Al4Va ELI), estándar ASTM F-136.
Color Superficial:	Anodizado Tipo III – Color según Lista de Acabado Superficial de Producto L-DD-04 - Patrón de Color Físico.
Limpieza Superficial:	Producto Limpio – Libre de Partículas Extrañas - Proceso de Limpieza Validado
Envase:	Empaque primario – Bolsa Grado Médico. Especificaciones en el I-PR-15 Instructivo de Envase y Etiquetado.
Etiqueta:	Material Resistente a la abrasión y alta resistencia y adherencia a la superficie del envase. No debe permitir la Reutilización - Diseño y contenido de acuerdo al Instructivo I-PR-15 Instructivo de Envase y Etiquetado.
Instrucción de Uso:	Contenido de las instrucciones de acuerdo al I-PR-15 Instructivo de Envase y Etiquetado.
Identificación:	Marcación Laser - Código y Lote de acuerdo el Instructivo de identificación de Producto - Ubicación según Plano de Marcación.
Presentación Comercial:	Empaque Individual. Suministrado Limpio NO ESTÉRIL.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
Almacenado y conservado en un lugar a temperatura ambiente, libre de polvo y humedad; debe manipularse de acuerdo a los métodos asépticos aplicables para evitar la contaminación.
ADVERTENCIAS Y CUIDADOS
Verifique que los tornillos bloqueadores estén sueltos antes de intentar acoplarlo a la barra longitudinal, esto facilita y agiliza el acople. Asegúrese de tener buen contacto superficial entre el conector ilíaco y la barra antes de ajustar el sistema. Después ser fracturado el tornillo de bloqueo fusible no se debe realizar un reapriete.