INFORME DE SUPERVISION No. 02 DEL CONTRATO No. 100 DE 2026 DEL 16 DE FEBRERO DE 2026, OTRO SI N° 1 DEL 03 DE MARZO DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Y GESTION TECNOLOGICA EN SALUD S.A.S.

1. DATOS GENERALES

No. De proceso	HSLV-CD-098-2026
Contrato N°:	100
Término:	HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2026, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aaaa):	19/02/2026
Fecha de Finalización (dd/mm/aaaa):	15/08/2026
Valor Inicial	$1.372.680.000
Otro si N°	MODIFICATORIO
Contratista:	GESTION TECNOLOGICA EN SALUD S.A.S
NIT o Cedula de Ciudadanía	902.014.857-8
Objeto del Contrato:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL HOSPITAL. SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E
Forma de pago:	6 PAGOS
No. Fecha Disponibilidad Presupuestal	131 DEL 02 DE FEBRERO DE 2026.
No. Registro presupuestal	155 DEL 16 DE FEBRERO DE 2026.
Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Período a que corresponde el informe	**DESDE (dd/mm/aaaa)**: **16/03/2026** — **HASTA (dd/mm/aaaa)**: **19/04/2026**
Fecha aprobación de la Garantía (SECOP II).	**19 DE FEBRERO DE 2026.**

2. SEGURIDAD SOCIAL

PAGO SEGURIDAD SOCIAL (PERSONA NATURAL)			
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (IBC 40%)		**PERIODO COTIZADO**	
EPS		**VALOR PAGADO**	
ARL		**VALOR PAGADO**	
AFP		**VALOR PAGADO**	
VALOR TOTAL PLANILLA		**PLANILLA No.**	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL 17 DE ABRIL DE 2026.**		

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.372.680.000
OTRO SI N°	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.372.680.000
VALOR EJECUTADO	$ 457.553.392
VALOR A PAGAR SEGÚN INFORME	$ 228.780.000
SALDO A EJECUTAR	$ 915.126.608

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE:

ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS		
ESPECIFICACIONES	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**SOPORTE**
El contratista realizará una (1) visitas de mantenimiento preventivo para los equipos biomédicos del Hospital, los cuales se encuentran relacionados en el Anexo 2, que hace parte integral del presente documento. En cuanto al mantenimiento correctivo el contratista, durante la vigencia del contrato, realizará visitas ilimitadas de conformidad con los reportes que se hagan por parte de las diferentes áreas del hospital, en donde se encuentren ubicados los equipos que presenten fallas. Para este tipo de mantenimiento, se relacionan todos los equipos biomédicos que se encuentran ubicados en la entidad – Anexo 3. Los repuestos que con ocasión a los mantenimientos relacionados requieran los equipos biomédicos, deberán ser suministrados por el contratista.	Se realiza mantenimiento preventivo a 101 equipos biomédicos del mes de marzo y 106 equipos biomédicos del mes de abril relacionados así: **MES DE MARZO 16-31** (1) lampara cuello de cisne, (1) laringoscopio, (1) máquina para trabajo de hombro, (2) masajeadores, (1) mesa quirúrgica, (30) monitor de signos, (2) monitores fetales, (5) pulsioxímetro, (15) reguladores de vacío, (1) sierra eléctrica, (1) tallímetro, (9) tensiómetros, (15) termohigrómetros, (4) termómetros, (1) balanza bebe, (2) reanimador neonatal, (1) rueda de hombro digital, (1) ultrasonido, (1) unidad de calentamiento, (1) videocolposcopio, (1) visualizador. **MES DE ABRIL 01 – 19** (1) agitador Mazzini, (2) aspiradores, (1) autoclave, (6) balanzas, (1) balanza bebe, (1) baño serológico, (1) bicicleta estática, (2) blender, (1) calentador de fluidos, (4) desfibriladores, (1) digitalizador de imágenes, (4) Doppler fetal, (1) ecógrafo, (1) electrobisturi, (1) electrocardiógrafo, (1) electroestimulador con ultrasonido, (2) equipos de órganos, (4) estimuladores, (1) gramera, (4) humidificador, (3) incubadora, (3) lampara cielítica, (4) lampara de calor radiante, (3) laringoscopio, (26) monitores de signos, (1) pulsoxímetro, (3) regulador de vacío, (5) termohigrómetro, (1) agitador de plaquetas, (3) equipos de órganos, (1) equipo de rayos x (1) hidrocolector, (3) lampara cuello de cisne, (3) lampara de fototerapia, (1) mesa quirúrgica, (1) microscopio quirúrgico, (2) monitores fetales, (1) nebulizador, (4) tensiómetros. **MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS:** (1) Monitor de signos, (1) lampara cuello de cisne	Se entregan los 207 reportes de mantenimientos preventivos de los equipos biomédicos relacionados en las actividades se entregan en forma física y digital con las firmas de revisión pertinentes y firmado por los jefes del servicio de la ejecución de los mismos se archivan en drive "CARPETA DEPARTAMENTO INGENIERIA BIOMEDICA - EQUIPOS BIOMEDICOS" en las respectivas carpetas de cada equipo. Se realizan 2 mantenimientos correctivos durante la vigencia del contrato. Se entrega acta de repuestos suministrada para los mantenimientos.
Para el caso de los mantenimientos correctivos, los cuales se realizarán en respuesta a la falla inesperada que presenta el equipo detectado por	a. Se brindó atención correctiva sin límite de visitas, en respuesta a reportes de fallas	a. Se entregan 2 mantenimientos correctivos de los llamados presentados, Anexo. Mantenimientos

VIGILADO Supersalud

el personal técnico en las rutinas de inspección o por el reporte generado por el área donde se encuentra ubicado aquel, el contratista deberá presentar en el informe para pago, el valor del mantenimiento correctivo, de los repuestos utilizados, relacionando el equipo médico al cual se le realizó, y el estado en el que queda con posterioridad al correctivo realizado. Para la prestación adecuada del servicio, el contratista deberá garantizar: a) Disponibilidad permanente de los insumos y herramientas requeridas para la ejecución de los adecuados mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos médicos teniendo en cuenta que todo estos materiales son indispensables para garantizar y evitar el deterioro de los equipos objeto del contrato (pegantes, lubricantes, tornillos, limpiadores, termoencogible diferentes calibres, grasa, desincrustante, soldadura, crema de soldadura, crema conductora de calor, silicona en varias presentaciones, teflón, cinta aislante, fusibles, entre otros),sin generar costos adicionales, es importante mencionar que podrá evaluarse el cumplimiento de esta actividad en cualquier momento.	generados por las áreas asistenciales o detectados en rutinas de inspección, sobre los equipos relacionados en el Anexo 3. Cada intervención correctiva se ejecutó con diagnóstico de falla, acciones técnicas de recuperación, pruebas de funcionamiento y cierre con informe del estado final del equipo. b. Se garantizó el suministro de repuestos requeridos para los mantenimientos preventivos y correctivos, y aseguró disponibilidad continua de insumos y herramientas necesarias (lubricantes, tornillería, fusibles, termoencogibles, soldadura, grasa, limpiadores, teflón, silicona, cinta aislante, entre otros). Cuando se requirió repuesto, se gestionó su aprobación por el líder de Gestión del Ambiente y la Tecnología y se suministró dentro del plazo establecido. c. Se dispuso personal 24/7, incluyendo fines de semana y festivos, para atención de contingencias correctivas. Se garantizó respuesta presencial en el área solicitante	correctivos. · Diagnóstico, acciones realizadas, pruebas de verificación y estado final. · Tiempo de respuesta (hora del llamado – hora de atención) cuando aplique. b. Relación de repuestos utilizados (cantidad, referencia, equipo asociado y justificación técnica). Anexo, Entrega de repuestos Soporte de aprobación del repuesto por el líder de Gestión del Ambiente y la Tecnología (correo, acta, formato interno o visto bueno en el informe). c. Se cumple con el personal disponible las 24/7 y festivos para la atención de llamados. d. Se entrega reporte de solicitudes generadas desde el 16 de marzo hasta el 19 de abril 2026. Se da cumplimiento con los formatos SM-02-F01 PMH 2025 SLV-GAT-GTB-1503
b) Los repuestos necesarios para la ejecución de los mantenimientos, los cuales serán suministrados por el contratista, en un tiempo máximo de quince (15) días, posteriores a la aprobación realizada por parte del líder de gestión del ambiente y la tecnología.	En un tiempo máximo de 3 horas desde el llamado, de acuerdo con lo establecido en las condiciones del servicio.	
c) Personal disponible 24 horas con el ánimo de brindar atención personalizada cuando se generen llamados a correctivos, esta actividad se incluye como garantía a la ejecución de las rutinas de inspección que se realizan en horario habitual, sin que esto genere un costo adicional al estimado por rutina. Esta disponibilidad también aplica para los fines de semana y Festivos.		
d) Respuesta a las solicitudes por correctivos requeridas para los equipos médicos objeto del presente contrato con una respuesta presencial en el área requirente de 3 horas a partir del llamado. La prestación del servicio objeto del contrato deberá ceñirse a los siguientes protocolos: · Plan de mantenimiento institucional de código SLV- SM-02-F01 PMH 2025, en el cual se establecen las frecuencias de la ejecución de cada equipo médico objeto del presente contrato.	Se da cumplimiento con los formatos SM-02-F01 PMH 2025 SLV-GAT-GTB-1503	
· **El protocolo de mantenimiento establecido por la institución de código SLV-GAT-GTB-1503**: Es la descripción detallada del paso a paso de las actividades definidas por el fabricante para el mantenimiento preventivo, descritas en una rutina o lista de chequeo que sirve como recordatorio para que el personal de ingeniería y técnico evite olvidos u omisiones que puedan generar inconvenientes en el mantenimiento preventivo		

VIGILADO Supersalud

incluir todos los requisitos definidos para el mantenimiento preventivo y deben ser basados en las recomendaciones del manual de mantenimiento preventivo mencionado en el documento propuesta para lineamientos a seguir en la gestión de mantenimiento de equipos biomédicos versión 10 expedido por el ministerio de salud y protección social y/o el que se encuentra en vigencia, e incluir como mínimo: Ø Actualización de software cuando el equipo lo requiere. Ø Revisión general y diagnóstico inicial. Ø Verificación de accesorios. Ø Mantenimiento preventivo, limpieza interna y pruebas de funcionamiento. Ø Mantenimiento correctivo si es necesario. Ø Informe sobre el servicio realizado y estado de cada equipo.		

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**SOPORTE**
1. El contratista se compromete a cumplir con todos los procedimientos y trámites administrativos internos establecidos por la entidad.	Se cumple con los procedimientos y trámites administrativos	N.A
2. Diligenciar Formato GF-P08- F01 (Informe de contratista), completamente diligenciado, incluyendo todos los ítems establecidos en la cláusula "ESPECIFICACIONES TECNICAS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA,". Adicionalmente, es obligatorio adjuntar fotografías pertinentes. No se aceptarán informes en formato checklist. Este informe debe ser presentado por cada visita contratada.	Formato diligenciado GF- P08-F01 (Informe de contratista) con descripción narrativa de actividades, equipos intervenidos,	• Formato GF-P08-F01 publicado en la plataforma Secop II con los soportes correspondientes.
3. Emitir la factura correspondiente y publicarla en la plataforma SECOP II con los documentos soporte requeridos por la entidad, una vez publicados, el contratista deberá notificar al supervisor al correo electrónico subadministrativa@hosusan a.gov.co.	Factura electrónica N° GTS5 del 20/04/2026.	Factura electrónica N° GTS5 del 20/04/2026 publicada en la plataforma SECOP II con los soportes correspondientes.
4. Efectuar las rutinas de mantenimiento preventivo cuya finalidad es encontrar y corregir los problemas antes de que estos provoquen fallas en los servicios en los que se han realizado, de acuerdo con los cronogramas entregados por el encargado del área de ingeniería biomédica.	Se ejecutó el mantenimiento preventivo conforme al cronograma (SLV-SM-02-F01 PMH 2025) y al protocolo SLV- GAT-GTB-1503. Se realizó mantenimiento preventivo a 207 equipos biomédicos (Anexo 2), con revisión general, verificación de accesorios, limpieza, ajustes y pruebas funcionales.	Anexo reportes de 207 mantenimientos preventivos por equipo (físico y digital) con firmas de recibido a satisfacción. Anexo Mantenimientos preventivos.
5. Ejecutar las actividades autorizadas por el supervisor y/o el personal apoyo al supervisor mediante las notas internas para realizar las actividades correctivas de Equipos médicos.	No se presentaron notas internas	No se presentaron notas internas
6. Toda actividad de mantenimiento preventivo y correctivo en equipos biomédicos que sea ejecutado debe ser facturada por el contratista.	Se facturaron todas las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo efectivamente ejecutadas durante el periodo, conforme a los informes técnicos y a la relación de actividades para pago.	Anexo Factura N° GTS5 del 20 de abril de 2026.
7. El contratista no podrá cobrar mano de obra de correctivos o reparación que hayan sido incluidas en un mantenimiento preventivo.	En los informes se discriminó el alcance de los correctivos ejecutados, garantizando que no se cobrara mano de obra por	Anexo reportes de 2 mantenimientos correctivos con alcance de intervención y observaciones.

VIGILADO Supersalud

	reparaciones o ajustes incluidos dentro de un mantenimiento preventivo.	Se entregan reportes de mantenimiento con firmas de conformidad del servicio. Anexo. Mantenimiento correctivo.
8. El contratista se compromete a realizar las actividades con personal capacitado e idóneo, para ello deben entregar las hojas de vida con sus respectivos soportes de idoneidad de sus trabajadores que realiza dichas actividades.	Se garantizó la ejecución del servicio con personal capacitado e idóneo. Se entregaron hojas de vida del personal asignado y sus soportes de idoneidad (formación, experiencia y certificaciones).	Anexo Hojas de vida y certificados (títulos, cursos, experiencia) en digital anexo. Hojas de vida.
9. Atender a las solicitudes del personal de la oficina de ingeniería biomédica para la realización de actividades que buscan satisfacer las necesidades del cliente interno y externo tales como: · Apoyo técnico de administrativo y realización de disponibilidades relacionados con el proceso de ingeniería Biomédica. · Demás actividades relacionadas con el objeto a contratar.	Se atendieron requerimientos del área de Ingeniería Biomédica para actividades complementarias al objeto contractual: apoyo técnico- administrativo, elaboración/soporte de disponibilidades y demás actividades relacionadas.	Anexo reporte de solicitudes comprendidos entre el 16 de marzo de 2026 al 19 de abril de 2026.
10. El plazo y horario para la ejecución de las actividades objeto del presente contrato comprenderá de lunes a domingo, durante las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana.	Se garantizó disponibilidad para ejecución de actividades de lunes a domingo, 24 horas al día, incluyendo fines de semana y festivos, según cronograma de disponibilidad. Se atendieron llamados y se coordinó respuesta presencial cuando fue requerido.	Anexo cronograma de disponibilidades. Anexo Cronograma disponibilidades
11. Efectuar el acondicionamiento y funcionamiento de los equipos biomédicos Mediante solicitudes realizadas por el proceso de ingeniería biomédica del Hospital quien será la encargada de revisar las cantidades y valores para posteriormente ser aprobados para su ejecución.	Se realizaron actividades de acondicionamiento, alistamiento y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos conforme a solicitudes del proceso de Ingeniería Biomédica y previa revisión/aprobación de cantidades y valores. Se efectuaron pruebas de funcionamiento y verificación de seguridad operativa.	Se entregan listas de chequeo donde se verifica con el cumplimiento de revisión y verificación de seguridad efectiva. Anexo. Listas de chequeo.
12. Las actividades ejecutadas serán entregadas por el contratista al área de ingeniería biomèdica que será el apoyo al supervisor.	Se entregaron al área de Ingeniería Biomédica los soportes de las actividades ejecutadas (físicos y digitales), para seguimiento y control contractual.	Se entrega informe consolidado de actividades ejecutadas con los soportes correspondientes. Anexo. Informe de actividades.
13. El contratista deberá comunicar al supervisor cualquier error u omisión que encuentre al confrontar las instrucciones con lo que se encuentre en la ejecución de actividades y le solicitará las aclaraciones y Modificaciones pertinentes.	No se presentaron inconsistencias	N.A.
14. Realizar un manejo adecuado de los residuos generados en la ejecución del contrato de acuerdo con lo establecido en el PGIRASA del Hospital.	Se dio cumplimiento a la obligación	N.A
15. El contratista deberá acatar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del Hospital Susana López de Valencia E.S.E., conocer su política y los objetivos ambientales; adquirir el compromiso de gestionar los aspectos ambientales asociados a las actividades derivadas de la ejecución del contrato (manejo adecuado de sustancias químicas, emisiones de gases de efecto invernadero – GEI y/o potenciales agotadores de ozono – PAO), generación de residuos sólidos) y	Se cumple con el sistema de gestión ambiental	N.A

VIGILADO Supersalud

garantizar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones como proveedor del servicio, según la normatividad ambiental aplicable vigente, así como también garantizar la adherencia al mejoramiento continuo de la certificación ISO 14001 :2015 de la cual la institución es acreedora.		
16. Garantizar buenas prácticas para una adecuada gestión integral de todos los resid uos generados durante el servicio, en cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable: Resolución No. 591 de 2024, Decreto 1076 de 2015 Título 6 – Residuos Peligrosos y Título 7A Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), o las normas que las modifiquen o sustituyan. Entregar el(los) certificado(s) de disposición final o de aprovechamiento de los residuos peligrosos y/o pos consumo realizada, emitido(s) por un Gestor con Licencia Ambiental vigente.	No aplica	N.A

OBLIGACIONES ESPECIFICAS		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**SOPORTE**
1. El contratista realizará rutinas de inspección a los equipos biomédicos, de conformidad al procedimiento de código SLV- SM-15 establecido por el hospital, las cuales se ejecutarán de manera diaria y a la totalidad de los equipos programados, y se ejecutarán de acuerdo a su programación o cronograma de rutinas de inspección planificado por el líder de gestión de la tecnología biomédica, el cual se realizará de acuerdo con la criticidad de los servicios y a la trazabilidad arrojada por daños presentados. 2. La ejecución de las rutinas de inspección se deberá realizar durante el transcurso del día a partir de las 7:00 am, hasta las 5:00 pm, con el ánimo de inspeccionar la condición de los equipos antes de que se generen notas internas o llamados y por la alta complejidad del área.	Se ejecutaron rutinas de inspección diarias a los equipos biomédicos programados, conforme al procedimiento SLV- SM-15 y al cronograma definido por criticidad y trazabilidad de fallas. Se verificó condición operativa, seguridad, accesorios y funcionamiento básico, registrando hallazgos y acciones inmediatas. Las rutinas de inspección se realizaron dentro del horario establecido (07:00 a 17:00), priorizando áreas de alta complejidad para verificar condición antes de llamados o notas internas.	Se entregan listas de chequeo Anexo. Listas de chequeo
3. En la ejecución de las rutinas de inspección para los equipos médicos contenidos en el Anexo 2, el contratista deberá dar solución a toda eventualidad presentada con los equipos y asegurar su normal funcionamiento para el transcurso del día.	Durante las rutinas de inspección se dio solución a eventualidades identificadas en los equipos del Anexo 2, realizando ajustes y correctivos menores para asegurar su normal funcionamiento durante el día. Se escaló al proceso de correctivo formal cuando la falla requirió repuesto o intervención mayor.	Se entregan listas de chequeo Anexo. Listas de chequeo • Se entregan 2 formatos de mantenimientos correctivos Anexo. Mantenimientos correctivos
4. Dar respuesta personalizada a las solicitudes por correctivos requeridas para los equipos médicos objeto del presente contrato en el área requirente, en un tiempo de mínimo de 24 horas.	Se atendieron solicitudes correctivas dentro del tiempo contractual (mínimo dentro de las 3 horas), con respuesta personalizada en el área requirente. Se registró el evento, diagnóstico, intervención y estado final del equipo.	Se entrega reporte de solicitudes. Anexo. Reporte de solicitudes.
5. La frecuencia de estas revisiones deberá quedar detallada en el cronograma de rutinas de inspección entregado al supervisor del contrato, utilizando el formato correspondiente para el desarrollo de esta actividad, el cual estará soportado con firma y sello del personal técnico	Se entrega cronograma de rutinas de inspección con frecuencias definidas y se ejecutó conforme a lo programado. Cada rutina quedó soportada en el formato	• Se entrega Cronograma de mantenimiento Anexo. Cronograma de mantenimiento.

VIGILADO Supersalud

que ejecuta la inspección, así como del jefe de servicio que recibe a satisfacción lo realizado.	institucional con firma y sello del técnico y firma del jefe del servicio.	
6. El contratista brindará garantía sobre la actividad de mantenimiento preventivo ejecutada, y su periodo será hasta su siguiente visita de mantenimiento programada. La garantía no cubre si el equipo presento falla por un daño ocasionado por mal uso o manejo de la institución previamente comprobado.	Se otorgó garantía sobre la actividad de mantenimiento preventivo ejecutada hasta la siguiente visita programada.	Se entrega carta de garantía Anexo. Carta de garantía del servicio.
7. Ejecutar actividades de mantenimiento correctivo; las cuales se realizarán en respuesta a la falla inesperada que presenta el equipo detectado por el usuario o por el personal técnico en las rutinas de inspección, y que busca poner nuevamente en servicio el equipo lo antes posible. Las notas internas que se generen en los diferentes servicios asistenciales del Hospital referente a los equipos objeto del contrato, deben solucionarse y radicarse en la oficina del líder de gestión del ambiente y la tecnología el mismo día en que son reportadas. De lo contrario el contratista debe justificar la no finalización de la actividad.	Se ejecutaron mantenimientos correctivos en respuesta a fallas inesperadas reportadas por usuarios o detectadas en inspecciones, priorizando la puesta en servicio en el menor tiempo posible.	• Se entrega 2 mantenimientos correctivos, almacenados en las carpetas físicas y digitales de los equipos médicos. Anexo. Mantenimientos correctivos
8. Si el mantenimiento correctivo o daño de un equipo médico implica salida de la institución para reparación y/o entrega de diagnóstico, el procedimiento se realizará entre el líder de gestión del ambiente y la tecnología y el proceso de almacén y suministros, la cual deberá contar con la autorización por parte del supervisor del contrato.	No se presentó retiro de ningún equipo para reparación.	No se presentó retiro de ningún equipo para reparación.
9. Se realizará una inspección detallada para corregir las desviaciones de cada equipo conforme al protocolo de mantenimiento preventivo dispuestos por fabrica, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos, incluyendo analizadores y/o insumos necesarios para obtener los resultados que garanticen el óptimo estado funcional de los equipos.	Se realizó inspección detallada para corregir desviaciones conforme a protocolos del fabricante, utilizando analizadores y/o insumos necesarios para verificar el estado funcional. Se documentaron resultados de pruebas y acciones correctivas aplicadas.	Se entregan 207 mantenimientos preventivos Anexo. Mantenimientos preventivos.
10. Tras la ejecución de cada uno de los mantenimientos realizados, deberá presentarse informe general sobre el servicio realizado y estado en que queda cada equipo.	Después de cada mantenimiento (preventivo/correctivo) se presentó informe general del servicio y el estado en que quedó cada equipo, incluyendo hallazgos, acciones y recomendaciones. Se consolidó información para seguimiento y pago.	Se entrega informe unificado de actividades realizadas. Anexo. Informe de actividades.
11. Los protocolos de mantenimiento preventivo programado, las rutinas de inspección, las notas correctivas, e informes entre otros, deberán tener nombres completos de los equipos médicos, así como sus áreas asistenciales de ubicación en las que se encuentran a la fecha, teniendo en cuenta que hay equipos que, por diferentes circunstancias, durante la ejecución del contrato pueden cambiar su área de ubicación.	Todos los documentos (protocolos, rutinas, notas e informes) fueron elaborados con identificación completa del equipo y su ubicación asistencial actual, actualizando cambios de área cuando se presentaron.	Se entrega en cada formato de mantenimiento las observaciones encontradas de los equipos médicos. Anexo. Mantenimientos preventivos
12. La persona encargada de brindar disponibilidad deberá estar atento a contestar el llamado de la línea móvil de disponibilidad o plataforma de solicitudes de la institución.	Se garantizó disponibilidad y atención permanente de la persona encargada, atendiendo llamados de la línea móvil de disponibilidad y/o plataforma institucional de solicitudes. Se registró cada llamado y su gestión.	Se lleva el seguimiento de solicitudes mediante la plataforma de solicitudes del HSLV, Anexo. Reporte de solicitudes.

VIGILADO Supersalud

13. En la disponibilidad de fin de semana, el personal disponible deberá realizar ronda de inspección en las áreas asistenciales, las cuales quedaran registradas en formato de rutinas de inspección, es importante establecer que la ronda de inspección en el área de cirugía deberá dar inicio antes de las 7:00 a.m., antes de que se inicie procedimientos en el área.	En fines de semana se realizaron rondas de inspección en áreas asistenciales, registradas en formato institucional. Para el área de cirugía, la ronda inició antes de las 07:00 a.m., previo al inicio de procedimientos, conforme a lo exigido.	Se entrega rondas de inspección completas por el tiempo de ejecución del contrato Anexo. Listas de chequeo
14. El informe de ejecución de actividades deberá entregarse durante los primeros diez (10) días del mes. En el evento de no poder ejecutar la actividad de mantenimiento preventivo a algún equipo médico acorde a su programación, se deberá registrar en el protocolo de mantenimiento el dato del paciente o detalle en el cual el jefe de servicio ratifica la no disponibilidad y/o presentar al supervisor del contrato documento en el que se soporte dicha justificación para evaluar la viabilidad de reprogramación.	• El informe mensual de ejecución se entregó dentro de los primeros diez (10) días del mes. • Cuando no fue posible ejecutar algún mantenimiento por no disponibilidad del equipo (paciente/uso), se dejó registro y/o soporte firmado por el jefe de servicio, y se gestionó reprogramación.	Se entrega informe unificado de actividades realizadas Anexo. Informe de actividades.
15. Garantizar transparencia en su actuar Informando y reportando los eventos adversos que ocurren en la prestación del servicio, o sobre las anomalías que se presenten en el desarrollo de sus actividades.	Se garantizó transparencia reportando eventos adversos, anomalías o situaciones de riesgo identificadas durante la prestación del servicio. Se comunicaron de manera oportuna al supervisor y a los responsables institucionales.	Se entrega informe de actividades ejecutadas en el cual se evidencia la transparencia de los reportes de eventos adversos Anexo. Informe de actividades
16. Garantizar el cubrimiento efectivo y suficiente de los servicios contratados, de forma que no se presenten retrasos en la prestación del servicio o falta de oportunidad en el mismo.	Se garantizó el cubrimiento efectivo del servicio, evitando retrasos y asegurando oportunidad en la atención (preventivos, inspecciones y correctivos). Se priorizaron servicios críticos y se reforzó cobertura cuando fue necesario.	Se entrega cronograma de disponibilidades. Anexo. Cronograma de disponibilidades.
17. El personal deberá presentarse uniformado y utilizar los equipos de protección personal necesarios de forma que permita la fácil identificación por parte de los usuarios del Hospital. Sobre el uniforme deberán tener escrito su rol y el nombre completo.	El personal se presentó uniformado y con uso de EPP, permitiendo identificación clara por rol y nombre completo.	No aplica
18. Garantizar que haya personal biomédico de turno de acuerdo a lo establecido en el anexo 02 del presente contrato, en el perfil biomédico de fin de semana y noches.	Se garantizó personal biomédico de turno según lo establecido en el Anexo 02, cubriendo noches y fines de semana conforme al perfil requerido. Se mantuvo continuidad operativa para atención de eventos.	Anexo. Cronograma de disponibilidad
19. Garantizar la atención de solicitudes generadas desde el hospital las 24 horas del día, los 7 días a la semana durante el término de ejecución del contrato. La no atención de solicitudes o llamados será una causa de incumplimiento. Las solicitudes atendidas fuera de los horarios del cuadro de turnos que presentará el contratista previamente al inicio del mes deberán ser cuantificadas e informadas al supervisor del contrato junto al informe mensual, describiendo la fecha, responsable de la atención, motivo de la solicitud, respuesta a la misma.	Se garantizó atención de solicitudes 24/7 durante toda la vigencia contractual. Las atenciones realizadas fuera del horario del cuadro de turnos fueron cuantificadas e incluidas en el informe mensual (fecha, Responsable, motivo y respuesta).	Anexo. Reporte de solicitudes.

20. Garantizar la aplicación de las rondas de seguridad a los servicios asistenciales, administrativos y de apoyo de acuerdo con el procedimiento e instrumentos generado por el hospital.	20. Se aplicaron rondas de seguridad en servicios asistenciales, administrativos y de apoyo, conforme al procedimiento institucional.	20. Se entrega listas de chequeo Anexo. Listas de chequeo
21. Desarrollar el trabajo dentro de las normas de seguridad con el fin de evitar accidentes tanto de su personal como personal del hospital y de otras personas.	Se cumple con las normas de seguridad, no se presentaron accidentes personales ni laborales	No aplica

5. OBSERVACIONES ADICIONALES:

6. DOCUMENTOS ANEXOS:

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
- Factura N° GTS5 del 20 de abril de 2026. ✓ - Certificación paz y salvo de seguridad social abril 2026. ✓ - Cuenta por pagar - Informe de actividades y soportes (Reportes de mantenimiento preventivo y correctivo, informe de actividades, cronograma de turnos y de disponibilidad, carta de repuestos, lista de chequeo, carta de garantía y reporte de solicitudes)	

7. DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:

- Factura N° GTS5 del 20 de abril de 2026. ✓
- Certificación paz y salvo de seguridad social abril 2026. ✓
- Cuenta por pagar
- Informe de actividades y soportes (Reportes de mantenimiento preventivo y correctivo, informe de actividades, cronograma de turnos y de disponibilidad, carta de repuestos, lista de chequeo, carta de garantía y reporte de solicitudes)

8. CERTIFICACION DE PAGO:

El suscrito supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones contractuales por lo tanto procede el pago correspondiente al periodo certificado.

Se han autorizado pagos por valor de:

PERIODO AUTORIZADO		VALOR
DESDE (dd/mm/aaaa)	**HASTA (dd/mm/aaaa)**	**228.780.000** ✓
16/03/2026	**19/04/2026**	

El anterior informe se firma a los 04 días del mes de mayo del 2026.

DIEGO ERNEY CAMPO SANCHEZ
Supervisor del contrato

Proyectó: Paola Andrea Vidal- Afiliada Participe ASIES
Aprobó: Ing. Deicy Rodriguez- Líder gestión del Ambiente y la tecnología- Afiliado Participe ASIES
Revisó: Ing. Natalia Victoria- Biomédico

INFORME TECNICO No. 02 DEL CONTRATO No. 100 DE 2026 DEL 16 DE FEBRERO DE 2026, OTRO SI N° 1 DEL 03 DE MARZO DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Y GESTION TECNOLOGICA EN SALUD S.A.S.

1. **DATOS GENERALES**

No. De proceso	HSLV-CD-098-2026
Contrato N°:	100
Término:	HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2026, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aaaa):	19/02/2026
Fecha de Finalización (dd/mm/aaaa):	15/08/2026
Valor Inicial	$1.372.680.000
Otro si N°	MODIFICATORIO
Contratista:	GESTION TECNOLOGICA EN SALUD S.A.S
NIT o Cedula de Ciudadanía	902.014.857-8
Objeto del Contrato:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL HOSPITAL. SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E
Forma de pago:	6 PAGOS
No. Fecha Disponibilidad Presupuestal	131 DEL 02 DE FEBRERO DE 2026.
No. Registro presupuestal	155 DEL 16 DE FEBRERO DE 2026.
Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Periodo a que corresponde el informe	**DESDE (dd/mm/aaaa)**: **16/03/2026** — **HASTA (dd/mm/aaaa)**: **19/04/2026**
Fecha aprobación de la Garantía (SECOP II).	**19 DE FEBRERO DE 2026.**
VALOR A PAGAR:	**$ 228.780.000**

2. **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ESPECIFICACIONES TECNCIAS DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE:**

ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS		
ESPECIFICACIONES	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**SOPORTE**
El contratista realizará una (1) visitas de mantenimiento preventivo para los equipos biomédicos del Hospital, los cuales se encuentran relacionados en el Anexo 2, que hace parte integral del presente documento. En cuanto al mantenimiento correctivo el contratista, durante la vigencia del contrato, realizará visitas ilimitadas de conformidad con los reportes que se hagan por parte de las diferentes áreas del hospital, en donde se encuentren ubicados los equipos que presenten fallas. Para este tipo de mantenimiento, se relacionan todos los equipos biomédicos que se encuentran ubicados en la entidad – Anexo 3. Los repuestos que con ocasión a los mantenimientos relacionados requieran los equipos biomédicos, deberán ser suministrados por el contratista.	Se realiza mantenimiento preventivo a 101 equipos biomédicos del mes de marzo y 106 equipos biomédicos del mes de abril relacionados así: **MES DE MARZO 16-31** (1) lampara cuello de cisne, (1) laringoscopio, (1) maquina para trabajo de hombro, (2) masajeadores, (1) mesa quirúrgica, (30) monitor de signos, (2) monitores fetales, (5) pulsioximetro, (15) reguladores de vacio, (1) sierra eléctrica, (1) tallimetro, (9) tensiómetros, (15) termohigrómetros, (4) termómetros, (1) balanza bebe, (2) reanimador neonatal, (1) rueda de hombro digital, (1) ultrasonido, (1) unidad de calentamiento, (1) videocolposcopio, (1) visualizador. **MES DE ABRIL 01 – 19** (1) agitador Mazzini, (2) aspiradores, (1) autoclave, (6) balanzas, (1) balanza bebe, (1) baño serológico, (1) bicicleta estatica, (2) blender, (1) calentador de fluidos, (4) desfibriladores, (1) digitalizador de Imágenes, (4) Doppler fetal, (1) ecógrafo, (1) electrobisturi, (1) electrocardiógrafo, (1) electroestimulador con ultrasonido, (2) equipos de órganos, (4) estimuladores, (1) gramera, (4) humidificador, (3) incubadora, (3) lampara cielitica, (4) lampara de calor radiante, (3) laringoscopio, (26) monitores de signos, (1) pulsoximetro, (3) regulador de vacio, (5) termohigrómetro, (1) agitador de plaquetas, (3) equipos de órganos, (1) equipo de rayos x (1) hidrocolector, (3) lampara cuello de cisne, (3) lampara de fototerapia, (1) mesa quirúrgica, (1) microscopio quirurgico, (2) monitores fetales, (1) nebulizador, (4) tensiómetros. **MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS:** (1)Monitor de signos , (1) lampara cuello de cisne	Se entregan los 207 reportes de mantenimientos preventivos de los equipos biomédicos relacionados en las actividades se entregan en forma física y digital con las firmas de revisión pertinentes y firmado por los jefes del servicio de la ejecución de los mismos se archivan en drive "CARPETA DEPARTAMENTO INGENIERIA BIOMEDICA - EQUIPOS BIOMEDICOS" en las respectivas carpetas de cada equipo. Se realizan 2 mantenimientos correctivos durante la vigencia del contrato. Se entrega acta de repuestos suministrada para los mantenimientos.
Para el caso de los mantenimientos correctivos, los cuales se realizarán en respuesta a la falla inesperada que presenta el equipo detectado por el personal técnico en las rutinas de inspección o por el reporte generado por el área donde se encuentra ubicado aquel, el contratista deberá presentar en el informe para pago, el valor del mantenimiento correctivo, de los repuestos utilizados, relacionando el equipo médico al cual se le realizó, y el estado en el que queda con posterioridad al correctivo realizado. Para la prestación adecuada del servicio, el contratista deberá garantizar: a) Disponibilidad permanente de los insumos y	a. Se brindó atención correctiva sin límite de visitas, en respuesta a reportes de fallas generados por las áreas asistenciales o detectados en rutinas de inspección, sobre los equipos relacionados en el Anexo 3. Cada intervención correctiva se ejecutó con diagnóstico de falla, acciones técnicas de recuperación, pruebas de funcionamiento y cierre con informe del estado final del equipo. b. Se garantizó el suministro de repuestos requeridos para los mantenimientos preventivos y correctivos, y aseguró	a. Se entregan 2 mantenimientos correctivos de los llamados presentados. Anexo. Mantenimientos correctivos. · Diagnóstico, acciones realizadas, pruebas de verificación y estado final. · Tiempo de respuesta (hora del llamado – hora de atención) cuando aplique. b. Relación de repuestos utilizados (cantidad, referencia, equipo asociado y justificación técnica). Anexo. Entrega de repuestos

herramientas requeridas para la ejecución de los adecuados mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos médicos teniendo en cuenta que todo estos materiales son indispensables para garantizar y evitar el deterioro de los equipos objeto del contrato (pegantes, lubricantes, tornillos, limpiadores, termoencogible diferentes calibres, grasa, desincrustante, soldadura, crema de soldadura, crema conductora de calor, silicona en varias presentaciones, teflón, cinta aislante, fusibles, entre otros),sin generar costos adicionales, es importante mencionar que podrá evaluarse el cumplimiento de esta actividad en cualquier momento.	disponibilidad continua de insumos y herramientas necesarias (lubricantes, tornillería, fusibles, termoencogibles, soldadura, grasa, limpiadores, teflón, silicona, cinta aislante, entre otros). Cuando se requirió repuesto, se gestionó su aprobación por el líder de Gestión del Ambiente y la Tecnología y se suministró dentro del plazo establecido. c. Se dispuso personal 24/7, incluyendo fines de semana y festivos, para atención de contingencias correctivas. Se garantizó respuesta presencial en el área solicitante	Soporte de aprobación del repuesto por el líder de Gestión del Ambiente y la Tecnología (correo, acta, formato interno o visto bueno en el informe). c. Se cumple con el personal disponible las 24/7 y festivos para la atención de llamados. d. Se entrega reporte de solicitudes generadas desde el 16 de marzo hasta el 19 de abril 2026. Se da cumplimiento con los formatos SM-02-F01 PMH 2025 SLV-GAT-GTB-1503
b) Los repuestos necesarios para la ejecución de los mantenimientos, los cuales serán suministrados por el contratista, en un tiempo máximo de quince (15) días, posteriores a la aprobación realizada por parte del líder de gestión del ambiente y la tecnología.	En un tiempo máximo de 3 horas desde el llamado, de acuerdo con lo establecido en las condiciones del servicio.	
c) Personal disponible 24 horas con el ánimo de brindar atención personalizada cuando se generen llamados a correctivos, esta actividad se incluye como garantía a la ejecución de las rutinas de inspección que se realizan en horario habitual, sin que esto genere un costo adicional al estimado por rutina. Esta disponibilidad también aplica para los fines de semana y Festivos.		
d) Respuesta a las solicitudes por correctivos requeridas para los equipos médicos objeto del presente contrato con una respuesta presencial en el área requirente de 3 horas a partir del llamado. La prestación del servicio objeto del contrato deberá ceñirse a los siguientes protocolos: · Plan de mantenimiento institucional de código SLV- SM-02-F01 PMH 2025, en el cual se establecen las frecuencias de la ejecución de cada equipo médico objeto del presente contrato.		
· **El protocolo de mantenimiento establecido por la institución de código SLV-GAT-GTB-1503:** Es la descripción detallada del paso a paso de las actividades definidas por el fabricante para el mantenimiento preventivo, descritas en una rutina o lista de chequeo que sirve como recordatorio para que el personal de ingeniería y técnico evite olvidos u omisiones que puedan generar inconvenientes en el mantenimiento preventivo incluir todos los requisitos definidos para el mantenimiento preventivo y deben ser basados en las recomendaciones del manual de mantenimiento preventivo mencionado en el documento propuesta para lineamientos a seguir en la gestión de mantenimiento de equipos biomédicos versión 10 expedido por el ministerio de salud y protección social y/o el que se encuentra en vigencia, e incluir como mínimo: Ø Actualización de software cuando el equipo lo requiere.	Se da cumplimiento con los formatos SM-02-F01 PMH 2025 SLV-GAT-GTB-1503	

Ø Revisión general y diagnóstico inicial. Ø Verificación de accesorios. Ø Mantenimiento preventivo, limpieza interna y pruebas de funcionamiento. Ø Mantenimiento correctivo si es necesario. Ø Informe sobre el servicio realizado y estado de cada equipo.		

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**SOPORTE**
1. El contratista se compromete a cumplir con todos los procedimientos y trámites administrativos internos establecidos por la entidad.	Se cumple con los procedimientos y trámites administrativos	Se cumple con los procedimientos y trámites administrativos
2. Diligenciar Formato GF-P08- F01 (Informe de contratista), completamente diligenciado, incluyendo todos los ítems establecidos en la cláusula "ESPECIFICACIONES TECNICAS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA,". Adicionalmente, es obligatorio adjuntar fotografías pertinentes. No se aceptarán informes en formato checklist. Este informe debe ser presentado por cada visita contratada.	• Se diligenció el Formato GF- P08-F01 (Informe de contratista) con descripción narrativa de actividades, equipos intervenidos,	• Formato GF-P08-F01 publicado en la plataforma secop.
3. Emitir la factura correspondiente y publicarla en la plataforma SECOP II con los documentos soporte requeridos por la entidad, una vez publicados, el contratista deberá notificar al supervisor al correo electrónico subadministrativa@hosusan a.gov.co.	Se emitió la factura correspondiente a las actividades ejecutadas y se realizó la publicación en SECOP II junto con los soportes requeridos. Se notificó al supervisor al correo institucional indicado una vez realizada la publicación.	Factura electrónica y soportes tributarios. Pantallazo/constancia de publicación en SECOP II. Correo de notificación enviado a subadministrativa@hosusana.gov. co.
4. Efectuar las rutinas de mantenimiento preventivo cuya finalidad es encontrar y corregir los problemas antes de que estos provoquen fallas en los servicios en los que se han realizado, de acuerdo con los cronogramas entregados por el encargado del área de Ingeniería biomédica.	Se ejecutó el mantenimiento preventivo conforme al cronograma (SLV-SM-02-F01 PMH 2025) y al protocolo SLV- GAT-GTB-1503. Se realizó mantenimiento preventivo a 207 equipos biomédicos (Anexo 2), con revisión general, verificación de accesorios, limpieza, ajustes y pruebas funcionales.	Se entregan 207 reportes de mantenimiento preventivo por equipo (físico y digital) con firmas de recibido a satisfacción. Anexo. Mantenimientos preventivos.
5. Ejecutar las actividades autorizadas por el supervisor y/o el personal apoyo al supervisor mediante las notas internas para realizar las actividades correctivas de Equipos médicos.	No se presentaron notas internas	No se presentaron notas internas
6. Toda actividad de mantenimiento preventivo y correctivo en equipos biomédicos que sea ejecutado debe ser facturada por el contratista.	Se facturaron todas las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo efectivamente ejecutadas durante el periodo, conforme a los informes técnicos y a la relación de actividades para pago.	Se entrega Factura y relación detallada de actividades facturadas.
7. El contratista no podrá cobrar mano de obra de correctivos o reparación que hayan sido incluidas en un mantenimiento preventivo.	En los informes se discriminó el alcance de los correctivos ejecutados, garantizando que no se cobrara mano de obra por reparaciones o ajustes incluidos dentro de un mantenimiento preventivo.	Se entregan 2 mantenimientos correctivos con alcance de intervención y observaciones. Se entregan reportes de mantenimiento con firmas de conformidad del servicio. Anexo. Mantenimiento correctivo.
8. El contratista se compromete a realizar las actividades con personal capacitado e idóneo, para ello deben entregar las hojas de vida con sus respectivos soportes de idoneidad de sus trabajadores que realiza dichas actividades.	Se garantizó la ejecución del servicio con personal capacitado e idóneo. Se entregaron hojas de vida del personal asignado y sus soportes de idoneidad (formación, experiencia y certificaciones).	Se entregan Hojas de vida y certificados (títulos, cursos, experiencia) en digital anexo. Hojas de vida.

9. Atender a las solicitudes del personal de la oficina de ingeniería biomédica para la realización de actividades que buscan satisfacer las necesidades del cliente interno y externo tales como: - Apoyo técnico de administrativo y realización de disponibilidades relacionados con el proceso de ingeniería Biomédica. - Demás actividades relacionadas con el objeto a contratar.	Se atendieron requerimientos del área de Ingeniería Biomédica para actividades complementarias al objeto contractual: apoyo técnico- administrativo, elaboración/soporte de disponibilidades y demás actividades relacionadas.	Se presenta reporte de solicitudes del mes de enero, donde se discrimina (Numero de solicitud, estado, fecha, prioridad).
10. El plazo y horario para la ejecución de las actividades objeto del presente contrato comprenderá de lunes a domingo, durante las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana.	Se garantizó disponibilidad para ejecución de actividades de lunes a domingo, 24 horas al día, incluyendo fines de semana y festivos, según cronograma de disponibilidad. Se atendieron llamados y se coordinó respuesta presencial cuando fue requerido.	Se entrega cronograma de disponibilidades. Anexo, Cronograma disponibilidades
11. Efectuar el acondicionamiento y funcionamiento de los equipos biomédicos Mediante solicitudes realizadas por el proceso de ingeniería biomédica del Hospital quien será la encargada de revisar las cantidades y valores para posteriormente ser aprobados para su ejecución.	Se realizaron actividades de acondicionamiento, alistamiento y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos conforme a solicitudes del proceso de Ingeniería Biomédica y previa revisión/aprobación de cantidades y valores. Se efectuaron pruebas de funcionamiento y verificación de seguridad operativa.	Se entregan listas de chequeo donde se verifica con el cumplimiento de revisión y verificación de seguridad efectiva. Anexo. Listas de chequeo.
12. Las actividades ejecutadas serán entregadas por el contratista al área de ingeniería biomédica que será el apoyo al supervisor.	Se entregaron al área de Ingeniería Biomédica los soportes de las actividades ejecutadas (físicos y digitales), para seguimiento y control contractual.	Se entrega informe consolidado de actividades ejecutadas con los soportes correspondientes. Anexo. Informe de actividades.
13. El contratista deberá comunicar al supervisor cualquier error u omisión que encuentre al confrontar las instrucciones con lo que se encuentre en la ejecución de actividades y le solicitará las aclaraciones y Modificaciones pertinentes.	No se presentaron inconsistencias	No se presentaron inconsistencias.
14. Realizar un manejo adecuado de los residuos generados en la ejecución del contrato de acuerdo con lo establecido en el PGIRASA del Hospital.	14. no aplica	No aplica
15. El contratista deberá acatar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del Hospital Susana López de Valencia E.S.E., conocer su política y los objetivos ambientales; adquirir el compromiso de gestionar los aspectos ambientales asociados a las actividades derivadas de la ejecución del contrato (manejo adecuado de sustancias químicas, emisiones de gases de efecto invernadero – GEI y/o potenciales agotadores de ozono – PAO), generación de residuos sólidos) y garantizar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones como proveedor del servicio, según la normatividad ambiental aplicable vigente, así como también garantizar la adherencia al mejoramiento continuo de la certificación ISO 14001 :2015 de la cual la institución es acreedora.	15.se cumple con el sistema de gestión ambiental	15. se cumple con el sistema de gestión ambiental

16. Garantizar buenas prácticas para una adecuada gestión integral de todos los resid uos generados durante el servicio, en cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable: Resolución No. 591 de 2024, Decreto 1076 de 2015 Titulo 6 – Residuos Peligrosos y Titulo 7A Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), o las normas que las modifiquen o sustituyan. Entregar el(los) certificado(s) de disposición final o de aprovechamiento de los residuos peligrosos y/o pos consumo realizada, emitido(s) por un Gestor con Licencia Ambiental vigente.	No aplica	No aplica

OBLIGACIONES ESPECIFICAS		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**SOPORTE**
1. El contratista realizará rutinas de inspección a los equipos biomédicos, de conformidad al procedimiento de código SLV- SM-15 establecido por el hospital, las cuales se ejecutarán de manera diaria y a la totalidad de los equipos programados, y se ejecutarán de acuerdo a su programación o cronograma de rutinas de inspección planificado por el líder de gestión de la tecnología biomédica, el cual se realizará de acuerdo con la criticidad de los servicios y a la trazabilidad arrojada por daños presentados. 2. La ejecución de las rutinas de inspección se deberá realizar durante el transcurso del día a partir de las 7:00 am, hasta las 5:00 pm, con el ánimo de inspeccionar la condición de los equipos antes de que se generen notas internas o llamados y por la alta complejidad del área.	Se ejecutaron rutinas de inspección diarias a los equipos biomédicos programados, conforme al procedimiento SLV- SM-15 y al cronograma definido por criticidad y trazabilidad de fallas. Se verificó condición operativa, seguridad, accesorios y funcionamiento básico, registrando hallazgos y acciones inmediatas. Las rutinas de inspección se realizaron dentro del horario establecido (07:00 a 17:00), priorizando áreas de alta complejidad para verificar condición antes de llamados o notas internas.	Se entregan listas de chequeo Anexo. Listas de chequeo
3. En la ejecución de las rutinas de inspección para los equipos médicos contenidos en el Anexo 2, el contratista deberá dar solución a toda eventualidad presentada con los equipos y asegurar su normal funcionamiento para el transcurso del día.	Durante las rutinas de inspección se dio solución a eventualidades identificadas en los equipos del Anexo 2, realizando ajustes y correctivos menores para asegurar su normal funcionamiento durante el día. Se escaló al proceso de correctivo formal cuando la falla requirió repuesto o intervención mayor.	Se entregan listas de chequeo Anexo. Listas de chequeo • Se entregan 2 formatos de mantenimientos correctivos Anexo. Mantenimientos correctivos
4. Dar respuesta personalizada a las solicitudes por correctivos requeridas para los equipos médicos objeto del presente contrato en el área requirente, en un tiempo de mínimo de 24 horas.	Se atendieron solicitudes correctivas dentro del tiempo contractual (mínimo dentro de las 3 horas), con respuesta personalizada en el área requirente. Se registró el evento, diagnóstico, intervención y estado final del equipo.	Se entrega reporte de solicitudes. Anexo. Reporte de solicitudes.
5. La frecuencia de estas revisiones deberá quedar detallada en el cronograma de rutinas de inspección entregado al supervisor del contrato, utilizando el formato correspondiente para el desarrollo de esta actividad, el cual estará soportado con firma y sello del personal técnico que ejecuta la inspección, así como del jefe de servicio que recibe a satisfacción lo realizado.	Se entrega cronograma de rutinas de inspección con frecuencias definidas y se ejecutó conforme a lo programado. Cada rutina quedó soportada en el formato institucional con firma y sello del técnico y firma del jefe del servicio.	• Se entrega Cronograma de mantenimiento Anexo. Cronograma de mantenimiento.

6. El contratista brindará garantía sobre la actividad de mantenimiento preventivo ejecutada, y su periodo será hasta su siguiente visita de mantenimiento programada. La garantía no cubre si el equipo presento falla por un daño ocasionado por mal uso o manejo de la institución previamente comprobado.	Se otorgó garantía sobre la actividad de mantenimiento preventivo ejecutada hasta la siguiente visita programada.	Se entrega carta de garantía Anexo. Carta de garantía del servicio.
7. Ejecutar actividades de mantenimiento correctivo; las cuales se realizarán en respuesta a la falla inesperada que presenta el equipo detectado por el usuario o por el personal técnico en las rutinas de inspección, y que busca poner nuevamente en servicio el equipo lo antes posible. Las notas internas que se generen en los diferentes servicios asistenciales del Hospital referente a los equipos objeto del contrato, deben solucionarse y radicarse en la oficina del líder de gestión del ambiente y la tecnología el mismo día en que son reportadas. De lo contrario el contratista debe justificar la no finalización de la actividad.	Se ejecutaron mantenimientos correctivos en respuesta a fallas inesperadas reportadas por usuarios o detectadas en inspecciones, priorizando la puesta en servicio en el menor tiempo posible.	• Se entrega 2 mantenimientos correctivos, almacenados en las carpetas físicas y digitales de los equipos médicos. Anexo. Mantenimientos correctivos
8. Si el mantenimiento correctivo o daño de un equipo médico implica salida de la institución para reparación y/o entrega de diagnóstico, el procedimiento se realizará entre el líder de gestión del ambiente y la tecnología y el proceso de almacén y suministros, la cual deberá contar con la autorización por parte del supervisor del contrato.	No se presentó retiro de ningún equipo para reparación.	No se presentó retiro de ningún equipo para reparación.
9. Se realizará una inspección detallada para corregir las desviaciones de cada equipo conforme al protocolo de mantenimiento preventivo dispuestos por fabrica, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos, incluyendo analizadores y/o insumos necesarios para obtener los resultados que garanticen el óptimo estado funcional de los equipos.	Se realizó inspección detallada para corregir desviaciones conforme a protocolos del fabricante, utilizando analizadores y/o insumos necesarios para verificar el estado funcional. Se documentaron resultados de pruebas y acciones correctivas aplicadas.	Se entregan 207 mantenimientos preventivos Anexo. Mantenimientos preventivos.
10. Tras la ejecución de cada uno de los mantenimientos realizados, deberá presentarse informe general sobre el servicio realizado y estado en que queda cada equipo.	Después de cada mantenimiento (preventivo/correctivo) se presentó informe general del servicio y el estado en que quedó cada equipo, incluyendo hallazgos, acciones y recomendaciones. Se consolidó información para seguimiento y pago.	Se entrega informe unificado de actividades realizadas. Anexo. Informe de actividades.
11. Los protocolos de mantenimiento preventivo programado, las rutinas de inspección, las notas correctivas, e informes entre otros, deberán tener nombres completos de los equipos médicos, así como sus áreas asistenciales de ubicación en las que se encuentran a la fecha, teniendo en cuenta que hay equipos que, por diferentes circunstancias, durante la ejecución del contrato pueden cambiar su área de ubicación.	Todos los documentos (protocolos, rutinas, notas e informes) fueron elaborados con identificación completa del equipo y su ubicación asistencial actual, actualizando cambios de área cuando se presentaron.	Se entrega en cada formato de mantenimiento las observaciones encontradas de los equipos médicos. Anexo. Mantenimientos preventivos
12. La persona encargada de brindar disponibilidad deberá estar atento a contestar el llamado de la línea movil de disponibilidad o plataforma de solicitudes de la institución.	Se garantizó disponibilidad y atención permanente de la persona encargada, atendiendo llamados de la línea móvil de disponibilidad y/o plataforma institucional de solicitudes. Se registró cada llamado y su gestión.	Se lleva el seguimiento de solicitudes mediante la plataforma de solicitudes del HSLV, Anexo. Reporte de solicitudes.

VIGILADO Supersalud

13. En la disponibilidad de fin de semana, el personal disponible deberá realizar ronda de inspección en las áreas asistenciales, las cuales quedaran registradas en formato de rutinas de inspección, es importante establecer que la ronda de inspección en el área de cirugía deberá dar inicio antes de las 7:00 a.m., antes de que se inicie procedimientos en el área.	En fines de semana se realizaron rondas de inspección en áreas asistenciales, registradas en formato institucional. Para el área de cirugía, la ronda inició antes de las 07:00 a.m., previo al inicio de procedimientos, conforme a lo exigido.	Se entrega rondas de inspección completas por el tiempo de ejecución del contrato Anexo. Listas de chequeo
14. El informe de ejecución de actividades deberá entregarse durante los primeros diez (10) días del mes. En el evento de no poder ejecutar la actividad de mantenimiento preventivo a algún equipo médico acorde a su programación, se deberá registrar en el protocolo de mantenimiento el dato del paciente o detalle en el cual el jefe de servicio ratifica la no disponibilidad y/o presentar al supervisor del contrato documento en el que se soporte dicha justificación para evaluar la viabilidad de reprogramación.	• El informe mensual de ejecución se entregó dentro de los primeros diez (10) días del mes. • Cuando no fue posible ejecutar algún mantenimiento por no disponibilidad del equipo (paciente/uso), se dejó registro y/o soporte firmado por el jefe de servicio, y se gestionó reprogramación.	Se entrega informe unificado de actividades realizadas Anexo. Informe de actividades.
15. Garantizar transparencia en su actuar informando y reportando los eventos adversos que ocurren en la prestación del servicio, o sobre las anomalías que se presenten en el desarrollo de sus actividades.	Se garantizó transparencia reportando eventos adversos, anomalías o situaciones de riesgo identificadas durante la prestación del servicio. Se comunicaron de manera oportuna al supervisor y a los responsables institucionales.	Se entrega informe de actividades ejecutadas en el cual se evidencia la transparencia de los reportes de eventos adversos Anexo. Informe de actividades
16. Garantizar el cubrimiento efectivo y suficiente de los servicios contratados, de forma que no se presenten retrasos en la prestación del servicio o falta de oportunidad en el mismo.	Se garantizó el cubrimiento efectivo del servicio, evitando retrasos y asegurando oportunidad en la atención (preventivos, inspecciones y correctivos). Se priorizaron servicios críticos y se reforzó cobertura cuando fue necesario.	Se entrega cronograma de disponibilidades. Anexo. Cronograma de disponibilidades.
17. El personal deberá presentarse uniformado y utilizar los equipos de protección personal necesarios de forma que permita la fácil identificación por parte de los usuarios del Hospital. Sobre el uniforme deberán tener escrito su rol y el nombre completo.	El personal se presentó uniformado y con uso de EPP, permitiendo identificación clara por rol y nombre completo.	No aplica
18. Garantizar que haya personal biomédico de turno de acuerdo a lo establecido en el anexo 02 del presente contrato, en el perfil biomédico de fin de semana y noches.	Se garantizó personal biomédico de turno según lo establecido en el Anexo 02, cubriendo noches y fines de semana conforme al perfil requerido. Se mantuvo continuidad operativa para atención de eventos.	Anexo. Cronograma de disponibilidad.
19. Garantizar la atención de solicitudes generadas desde el hospital las 24 horas del día, los 7 días a la semana durante el término de ejecución del contrato. La no atención de solicitudes o llamados será una causa de incumplimiento. Las solicitudes atendidas fuera de los horarios del cuadro de turnos que presentará el contratista previamente al inicio del mes deberán ser cuantificadas e informadas al supervisor del contrato junto al informe mensual, describiendo la fecha, responsable de la atención, motivo de la solicitud, respuesta a la misma.	Se garantizó atención de solicitudes 24/7 durante toda la vigencia contractual. Las atenciones realizadas fuera del horario del cuadro de turnos fueron cuantificadas e incluidas en el informe mensual (fecha, Responsable, motivo y respuesta).	Anexo. Reporte de solicitudes.

20. Garantizar la aplicación de las rondas de seguridad a los servicios asistenciales, administrativos y de apoyo de acuerdo con el procedimiento e instrumentos generado por el hospital.	20. Se aplicaron rondas de seguridad en servicios asistenciales, administrativos y de apoyo, conforme al procedimiento institucional.	20. Se entrega listas de chequeo Anexo. Listas de chequeo
21. Desarrollar el trabajo dentro de las normas de seguridad con el fin de evitar accidentes tanto de su personal como personal del hospital y de otras personas.	Se cumple con las normas de seguridad, no se presentaron accidentes personales ni laborales	No aplica

3. ANEXOS:

1. Informe de actividades
2. Reportes de Mantenimiento preventivo y correctivo
3. Cronograma de turnos y de disponibilidad
4. Carta de repuestos
5. Lista de chequeo
6. Carta de Garantía
7. Reporte de solicitudes

El anterior informe se firma a los 04 días del mes de mayo de 2026.

ING. DEICY JACKELINE RODRIGUEZ MUÑOZ
Líder Gestión del Ambiente y la Tecnología- Afiliado Participe ASIES

ING. NATALIA VICTORIA
Ingeniera Biomédica

VIGILADO Supersalud

GESTIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD S.A.S.
Servicios de mantenimiento y gestión de tecnología biomédica
NIT: 901014857-8 Cel: 3006603723 e-mail: gtsaludpopayan@gmail.com

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MARZO - 2026

ITEM	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN	Semana 3 (16 -21 Mar 2026)	Semana 4 (23 - 31 Mar 2026)	VALOR
1	ASPIRADOR	THOMAS MEDI-PUMP	1615	0 6070001526	URGENCIAS ADULTO			
2	BALANZA	SECA	874	1000000825535	URGENCIAS ADULTO			
3	BALANZA	SECA	874	1000000825513	URGENCIAS ADULTO			
4	ELECTROCARDIÓGRAFO	MINDRAY	BENEHEART R12	FH-03020293	URGENCIAS ADULTO			
5	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	RIESTER	Ri - Former	014896	URGENCIAS ADULTO			
6	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	RIESTER	Ri - Former	1814014003	URGENCIAS ADULTO			
7	LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	GS 300	NO IDENTIFICA	URGENCIAS ADULTO			
8	MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRICO	MINDRAY	ePM 10M	AD1-04011715	URGENCIAS ADULTO			
9	MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRICO	MINDRAY	ePM 10M	AC7-04000933	URGENCIAS ADULTO			
10	PULSOXIMETRO PORTATIL	EDAN	i60B	360101-BI1909190921	URGENCIAS ADULTO			
11	REGULADOR DE VACIO	AMVEX	CHA	CHAC002041	URGENCIAS ADULTO	X		$ 674.000
12	REGULADOR DE VACIO	AMVEX	C2A	C2AZ001082	URGENCIAS ADULTO	X		$ 674.000
13	TENSIOMETRO ANEROIDE	RIESTER	BIG BENDROUND	180449492	URGENCIAS ADULTO	X		$ 674.000
14	TENSIOMETRO ANEROIDE	WELCH ALLYN TYCOS	CE0297	0 6102 1024843	URGENCIAS ADULTO	X		$ 674.000
15	TENSIOMETRO ANEROIDE	RIESTER	BIG BEND	1801494B5	URGENCIAS ADULTO		X	$ 674.000
16	TERMOHIGROMETRO	MULTICOMP PRO	TA298	URGENCIAS_A_02	URGENCIAS ADULTO		X	$ 674.000
17	TERMOHIGROMETRO	HTC 1	NO REGISTRA	ALM 204	URGENCIAS ADULTO		X	$ 674.000
18	TERMOHIGROMETRO	UBIBOT	GS1-A		URGENCIAS ADULTO		X	$ 674.000
19	BALANZA	SECA	874	1000000839929	URGENCIAS GINECOLOGIA			
20	DESFIBRILADOR	PRIMEDIC	DEFIMONITOR - XD -10	73676000163	URGENCIAS GINECOLOGIA			
21	DOPPLER FETAL PORTÁTIL	EDAN	BASIC A	560054-M2501171 0016	URGENCIAS GINECOLOGIA			
22	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	REF.767	13153	URGENCIAS GINECOLOGIA			
23	LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	GS 300	452	URGENCIAS GINECOLOGIA	X		$ 674.000
24	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12-1	EV-98046542	URGENCIAS GINECOLOGIA	X		$ 1.000.000
25	TENSIOMETRO ANEROIDE	WELCH ALLYN	7670-01	19150151486	URGENCIAS GINECOLOGIA		X	$ 822.700
26	TERMOHIGROMETRO	MULTICOMPRO	TA298	URGENCIAS_G_02	URGENCIAS GINECOLOGIA		X	$ 822.700
27	ASPIRADOR DE ALTA POTENCIA	THOMAS MEDI-PUMP	1630	21100006750	CIRUGIA ADULTOS			
28	ASPIRADOR DE ALTA POTENCIA	SAIAF	YX980D	D13.21.045	CIRUGIA ADULTOS			
29	ASPIRADOR DE ALTA POTENCIA	SAIAF	YX980D	D12.21.164	CIRUGIA ADULTOS			
30	ELECTROBISTURI	WEM	SS501SX	CAE0004236	CIRUGIA ADULTOS			
31	LAMPARA CIELITICA	DRAGER	POLARIS 100	ASRH-0067WASRH-0113WASRH-0171	CIRUGIA ADULTOS			
32	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60613	NO REGISTRA	CIRUGIA ADULTOS			
33	MESA QUIRÚRGICA	DRAGER	DIAMOND 40 IK	110149	CIRUGIA ADULTOS			
34	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	525NF0382	CIRUGIA ADULTOS	X		$ 1.000.000
35	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12	EV6104469	CIRUGIA ADULTOS	X		$ 1.000.000
36	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC-1200	CC-09415480	CIRUGIA ADULTOS	X		$ 1.000.000
37	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	LIFE SCOPE	45124	CIRUGIA ADULTOS	X		$ 1.000.000
38	REGULADOR DE VACIO	AMVEX	C2A	C2AV000932	CIRUGIA ADULTOS		X	$ 1.000.000
39	REGULADOR DE VACIO	AMVEX	C2A	C2AZ000846	CIRUGIA ADULTOS		X	$ 674.000
40	REGULADOR DE VACIO	AMVEX	CHA	CHAC001998	CIRUGIA ADULTOS		X	$ 674.000
41	TENSIOMETRO	RIESTER	BIG BEN ROUND	210242020	CIRUGIA ADULTOS		X	$ 676.929
42	CENTRIFUGA - BACK UP	CLAY ADAMS	DYNAC III	A520138	LABORATORIO CLINICO			
43	CENTRIFUGA	CLAY ADAMS	DYNAC III	5180012	LABORATORIO CLINICO			
44	CENTRIFUGA - BACK UP	ZENITHLAB	TDL-4A	70518731	LABORATORIO CLINICO			
45	CENTRIFUGA	CLAY ADAMS	DYNAC III	A530009	LABORATORIO CLINICO			
46	MICROSCOPIO	OLYMPUS	CX-31RBSFA	1A51177	LABORATORIO CLINICO			

47	MICROSCOPIO	OLYMPUS	CX-31RBSFA	1A51189	LABORATORIO CLINICO			
48	TERMOMETRO	DIGITAL THERMOMETER	NR	NR	LABORATORIO CLINICO	X		$ 820.000
49	TERMOHIGROMETRO	KTJ	TA318B	1063TH	LABORATORIO CLINICO	X		$ 820.000
50	TERMOMETRO	FRIDGE FREEZER	NR	NR	LABORATORIO CLINICO	X		$ 820.000
51	TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	THERMO-HYGROMETER	H12	LABORATORIO CLINICO		X	$ 820.000
52	TERMOMETRO DIGITAL	DIGITAL THERMOMETER	N.R	SEROT1	LABORATORIO CLINICO		X	$ 1.639.328
53	TERMOMETRO DIGITAL	DIGITAL THERMOMETER	N.R	N/A-2	LABORATORIO CLINICO		X	$ 574.270
54	BALANZA	HEALTH O METER	160KG	1B00003227	CONSULTA EXTERNA			
55	BALANZA	SECA	LENA 354	835401921 00286	CONSULTA EXTERNA			
56	BALANZA	SECA	813	68132161 70614	CONSULTA EXTERNA			
57	COLPOSCOPIO BINOCULARES DE 3 AUMENTOS FILTRO VERDE KAIKA	CARL ZEISS MEDITEC AG	FOLMASTER	168147	CONSULTA EXTERNA			
58	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	HEINE	77710-7 0ML	NR	CONSULTA EXTERNA			
59	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	RIESTER	R1 - Fonnar	I4900	CONSULTA EXTERNA			
60	LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	GS 300	397	CONSULTA EXTERNA			
61	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	MINDRAY	IMEC-1200	CC-09115174	CONSULTA EXTERNA	X		$ 1.000.000
62	MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRICO	DRAGER	VISTA 1203	BSNF0723	CONSULTA EXTERNA	X		$ 1.000.000
63	SIERRA ELÉCTRICA	AESCULAP	ARTIKEL	31210-21SE	CONSULTA EXTERNA	X		$ 820.000
64	TALLIMETRO	SECA	213	100000124244	CONSULTA EXTERNA	X		$ 515.220
65	TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	TYCOS	502001013 10	CONSULTA EXTERNA		X	$ 576.920
66	TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	7670-01	110715162701	CONSULTA EXTERNA		X	$ 575.920
67	TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	NR	DCEXT1	CONSULTA EXTERNA		X	$ 574.600
68	VIDEOCOLPOSCOPIO (DIGITAL CON SOFTWARE DE IMAGENES Y VIDEO)	LEISEGANG COOPER SURGICAL	IDS UL GERVIPATH	06-555822	CONSULTA EXTERNA		X	$ 576.920
69	BICICLETA ESTÁTICA	SPORT FITNESS	MONZA	NO REGISTRA	FISIOTERAPIA			
70	ELECTROESTIMULADOR	METRON	VECTORSURGE VS470	9200702510	FISIOTERAPIA			
71	ESTIMULADOR ELÉCTRICO PORTÁTIL	CHATTANOOGA	INTELECT NMES	B206495	FISIOTERAPIA			
72	ESTIMULADOR ELÉCTRICO PORTÁTIL	CHATTANOOGA	BLD T250	B701501	FISIOTERAPIA			
73	ESTIMULADOR ELÉCTRICO PORTÁTIL	CHATTANOOGA	INTELECT NMES	B206494	FISIOTERAPIA			
74	HIDROCOLECTOR	CHATTANOOGA	2602/2604	24765	FISIOTERAPIA			
75	MÁQUINA PARA TRABAJO DE HOMBRO	JUV	N.A	N.A	FISIOTERAPIA	X		$ 675.000
76	MASAJEADOR FACIAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	FISIOTERAPIA	X		$ 675.220
77	MASAJEADOR TIPO PISTOLA CON PERCUSIÓN	ELEFOR	EM8-7A	NO REGISTRA	FISIOTERAPIA	X		$ 574.000
78	RUEDA DE HOMBRO DIGITAL	JUV	NO REGISTRA	NO REGISTRA	FISIOTERAPIA		X	$ 675.220
79	ULTRASONIDO	METRON	ACCUSONIC PLUS AP 120	5206897143	FISIOTERAPIA		X	$ 820.000
80	BALANZA	SECA	334	33422417Z507.	SALA PARTOS			
81	DOPPLER FETAL PORTÁTIL	EDAN	SONOTRAX II PRO	660054-M23C10120065	SALA PARTOS			
82	GRAMERA DIGITAL	SECA	856	85562861 90164	SALA PARTOS			
83	INCUBADORA DE TRANSPORTE	NINGBO DAVID	T2000	A36BB0110003	SALA PARTOS			
84	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	MINDRAY	IMEC 12	EV-98048510	SALA PARTOS			
85	MONITOR FETAL	EDAN	F3 DUAL	660034-M22809780003	SALA PARTOS	X		$ 575.000
86	PULSOXIMETRO PORTATIL	EDAN	H100B	360101-M23801640004	SALA PARTOS	X		$ 675.000
87	REANIMADOR NEONATAL (NEOPUFF)	FISHER & PAYKEL	RD900ASU	1709130126 58	SALA PARTOS		X	$ 422.500
88	REGULADOR DE VACIO	AMVEX	C2A	C2AZ001222	SALA PARTOS		X	$ 422.500
89	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	MINDRAY	ePM 10M	A01-04011721	AMBULANCIAS			
90	TENSIOMETRO ANEROIDE	FAZZINI ITALY	CE 0123 PEDIATRICO	LOTE 19910	AMBULANCIAS			
91	ASPIRADOR	SMAF	SXT-5A	L 32.30.210	AMBULANCIAS			
92	PULSOXIMETRO PORTATIL	EDAN	H100B	360101-M23900670111	AMBULANCIAS			
93	MONITOR DE SIGNOS VITALES	CONTEC	CMS6000	23110400021	AMBULANCIAS	X		$ 1.800.000
94	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60810	72129	AMBULANCIAS	X		$ 675.220
95	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	MINDRAY	ePM 12	AC6-32047197	AMBULANCIAS		X	$ 1.000.000
96	TENSIOMETRO	GMD	Adulto	No Registra	AMBULANCIAS		X	$ 675.220
97	BLENDER	BIOMED-DEVICES	2003FL	BX1852364	UCI PEDIATRIA			
98	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-85005732	UCI PEDIATRIA			
99	HUMIDIFICADOR	FISHER & PAYKEL	MR850JSU	1308250 89470	UCI PEDIATRIA			
100	HUMIDIFICADOR	FISHER & PAYKEL	MR850J9U	0 9512 1066690	UCI PEDIATRIA			
101	MANTA TÉRMICA	COVIDIEN	5016000/WT 6000	SP19059165	UCI PEDIATRIA			
102	BLENDER	BIO-MED	2003FL	BX1852368	UCI NEONATAL			
103	GRAMERA	SECA	856	8556286 190321	UCI NEONATAL			
104	HUMIDIFICADOR	FISHER & PAYKEL	MR850	180409052910	UCI NEONATAL			
105	HUMIDIFICADOR	FISHER & PAYKEL	MR850	101200099276	UCI NEONATAL			
106	INCUBADORA SERVOCONTROLADA	DRAGER	ISOLETTE C2000	AH36568	UCI NEONATAL			
107	INCUBADORA SERVOCONTROLADA	DRAGER	ISOLETTE C2000	DSRF-0069	UCI NEONATAL			
108	LAMPARA DE CALOR RADIANTE	DRAGER	RESUSCITAIRE	DSRA-0026	UCI NEONATAL			
109	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	DRAGER	BILILUX	1116837002	UCI NEONATAL			
110	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	DRAGER	BILILUX	1116837025	UCI NEONATAL			
111	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	DRAGER	BILILUX	1116435015	UCI NEONATAL			
112	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	ePM 10M	A01-04011720	UCI NEONATAL	X		$ 1.000.000
113	MONITOR SIGNOS VITALES	MINDRAY	BENEVIEW T5	CM-74153605	UCI PEDIATRIA	X		$ 1.000.000

114	MONITOR SIGNOS VITALES	MINDRAY	BENEVIEW T5	CM-SCH47337	UCI PEDIATRIA	X		$ 1.000.000
115	MONITOR SIGNOS VITALES	MINDRAY	BENEVIEW T5	CM-S1147583	UCI PEDIATRIA		X	$ 1.000.000
116	REGULADOR DE VACIO	ALIVEX	C2A	C2AZ0011099	UCI PEDIATRIA		X	$ 574.000
117	REGULADOR DE VACIO	HERSILL	VASCUSILL 2HV	43758-0161	UCI PEDIATRIA		X	$ 574.000
118	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM 10M	AD1-04011722	UCI NEONATAL	X		$ 1.000.000
119	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM 10M	AD1-04011718	UCI NEONATAL	X		$ 1.000.000
120	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12	EV-84038658	UCI NEONATAL	X		$ 1.000.000
121	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12	EV-89048182	UCI NEONATAL	X		$ 1.000.000
122	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12	EV-84036654	UCI NEONATAL	X		$ 1.000.000
123	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KH-04074449	UCI NEONATAL		X	$ 1.000.000
124	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KH-04074485	UCI NEONATAL		X	$ 1.000.000
125	NEOPUFF	FISHER & PAYKER	RD900ASV	110120000079	UCI NEONATAL		X	$ 575.229
126	PULSIOXIMETRO PORTATIL	COVIDIEN	PM10N	MBP1809188	UCI NEONATAL		X	$ 575.229
127	REGULADOR DE VACIO	ALIVEX	VRA	VRA06157JM	UCI NEONATAL		X	$ 575.229
128	BALANZA BEBE DIGITAL (NUEVA	SECA	334	10000000957535	UCI NEONATAL		X	$ 870.000
129	BALANZA PESA BEBE	SECA	334	NR	HOSPITALIZACION PEDIATRIA			
130	LAMPARA DE EXAMEN	WELCH ALLYN	G5300	NR	HOSPITALIZACION PEDIATRIA			
131	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12	EV-89048926	HOSPITALIZACION PEDIATRIA			
132	PULSOXÍMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-02215384	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	X		$ 630.000
133	REGULADOR DE VACÍO	GENTEC	682VR-300-CH-C	61K1910001600228	HOSPITALIZACION PEDIATRIA		X	$ 422.000
134	AUTOCLAVE	PROMED	MSG.B (450L)	MS210825	CENTRAL ESTERILIZACION UMI			
138	BAÑO SEROLOGICO	MEMMERT	WNB-10	L322,0010	CIRUGIA PEDIATRICA			
139	DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5631	00255	CIRUGIA PEDIATRICA			
140	ELECTROBISTURI	COVIDIEN	VALLEYLABFT10	TSB876780X	CIRUGIA PEDIATRICA			
141	LAMPARA CIELITICA	JW BIOSCIENCE	HONEY LUX LED 160C/120C	LED2210578	CIRUGIA PEDIATRICA			
142	LÁMPARA DE CALOR RADIANTE	DRAGER	RESUSCITAIRE	DSRJ-0022	CIRUGIA PEDIATRICA			
143	LARINGOSCOPIO ADULTO	WELCH ALLYN	60813	NR	CIRUGIA PEDIATRICA			
144	LARINGOSCOPIO PEDIATRICO	WELCH ALLYN	60814	0073209425011 4	CIRUGIA PEDIATRICA			
145	MESA QUIRÚRGICA	BENQ	Dr MAX 7000SKB	2A315-U0-0007 009	CIRUGIA PEDIATRICA	X		$ 850.000
146	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM 10M	AD1-04011716	CIRUGIA PEDIATRICA	X		$ 1.000.000
147	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12	EV-81034505	CIRUGIA PEDIATRICA	X		$ 1.000.000
148	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12	EV-81034493	CIRUGIA PEDIATRICA	X		$ 1.000.000
149	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 1209	SZSNF0715	CIRUGIA PEDIATRICA		X	$ 1.000.000
150	REGULADOR DE VACIO	ALIVEX	C2A	C2AZ001085	CIRUGIA PEDIATRICA		X	$ 550.000
151	TERMOHIGROMETRO	UBIBOT	GS1-AIRS	E517ASRGS1A	CIRUGIA PEDIATRICA		X	$ 550.000
152	TERMOHIGROMETRO	UBIBOT	GS1-AIRS	KMQRFGGS1A	CIRUGIA PEDIATRICA		X	$ 550.000
153	DESFIBRILADOR	PRIMEDIC	DEFIMONITOR - XD -10	7387800016 1	IMÁGENES DIAGNOSTICAS			
154	TERMOHIGROMETRO	KTJ	TA218D	0 015	IMÁGENES DIAGNOSTICAS			
155	TERMOHIGROMETRO	UBIBOT	GS1 - AIRS	F9SKKG2GS1A	IMÁGENES DIAGNOSTICAS	X		$ 625.220

156	TERMOMETRO	DIGITAL THERMOMETER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	IMÁGENES DIAGNOSTICAS		X	$ 575.200
157	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	LIFE SCOPE G5	2101	UCI INTERMEDIOS			
158	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	LIFE SCOPE G5	21148	UCI INTERMEDIOS			
159	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	LIFE SCOPE G5	2139	UCI INTERMEDIOS			
160	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	VISMO	6628	UCI INTERMEDIOS			
161	MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M21B13610009	UCI INTERMEDIOS	X		$ 592.700
162	REGULADOR DE VACIO	AMVEX	C2A	C2AZ000433	UCI INTERMEDIOS	X		$ 574.000
163	TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	NR	007	UCI INTERMEDIOS		X	$ 574.000
164	DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5631	0 3826	UCI ADULTOS			
165	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET	228-128	UCI ADULTOS			
166	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	90813	50013	UCI ADULTOS			
167	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	LIFE SCOPE G5	0 0976	UCI ADULTOS			
168	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	LIFE SCOPE G5	0 0977	UCI ADULTOS			
169	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	LIFE SCOPE G5	0 0979	UCI ADULTOS			
170	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	LIFE SCOPE G5	0 0981	UCI ADULTOS			
171	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	LIFE SCOPE VS	33818	UCI ADULTOS			
172	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	LIFE SCOPE G5	2146	UCI ADULTOS	X		$ 1.000.000
173	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12	EV-01055855	UCI ADULTOS	X		$ 1.000.000
174	REGULADOR DE VACIO	AMVEX	C2A	C2AZ0000842	UCI ADULTOS			$ 409.262
174	REGULADOR DE VACIO	AMVEX	C2A	C2AZ0001099	UCI ADULTOS	X		$ 409.262
175	REGULADOR DE VACIO	AMVEX	C2A	C2AZ0001097	UCI ADULTOS	X		$ 409.262
176	REGULADOR DE VACIO	AMVEX	C2A	VRA10446AP	UCI ADULTOS		X	$ 409.262
177	REGULADOR DE VACIO	AMVEX	C2A	C2AZ0000837	UCI ADULTOS		X	$ 575.229
178	UNIDAD DE CALENTAMIENTO	WARM TOUCH NELLCOR	WT 6000	SP19050183	UCI ADULTOS		X	$ 575.229
179	VISUALIZADOR	VEIN VIEWER	M97013400210202 16	M97013400210202 16	UCI ADULTOS		X	$ 575.229
180	ELECTROBISTURI	ERBE	VIO3	11561598	ENDOSCOPIA			
181	MODULO APC 3	ERBE	10135-000	11562475	ENDOSCOPIA			
182	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC12	KO-2C096301	ENDOSCOPIA	X		$ 1.000.000
183	TERMOHIGROMETRO MAX Y MIN	HTC-1	DIGITAL SERIES	ALM 026	ENDOSCOPIA		X	$ 1.250.000
184	TERMOHIGROMETRO	UBBIBOT	GS1-A	S15838G51A	ALMACEN	X		$ 650.000
185	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	FP5-46006815/NUEVO	TRAMO 4 Y 5			
186	EQUIPO ORGANOS PORTABLE	WELCH ALLYN	92871-BLK	901026/NUEVO	TRAMO 4 Y 5			
187	MONITOR SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12	EV-81034495	TRAMO 4 Y 5			
188	MONITOR SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC12	KO-2C096283	TRAMO 4 Y 5			
189	REGULADOR DE VACIO	AMVEX	C2A	C2AZ0001092	TRAMO 4 Y 5	X		$ 1.000.000
190	TENSIOMETRO PEDESTAL	RIESTER	BIG BENROUND	210242011	TRAMO 4 Y 5	X		$ 575.229
191	TENSIOMETRO PORTABLE	GMD	CE0123	NO REGISTRA	TRAMO 4 Y 5		X	$ 1.000.000
192	ASPIRADOR	MEDI-PLUS	1630	031700010479	URGENCIAS PEDIATRIA			
193	BASCULA DIGITAL	SECA	874	100000008265Z3	URGENCIAS PEDIATRIA			
194	EQUIPO DE ORGANOS PORTABLE	WELCH ALLYN	REF. 727	NO REGISTRA	URGENCIAS PEDIATRIA			
195	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC10	XN-01068112	URGENCIAS PEDIATRIA			
196	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC12	EV-99018927	URGENCIAS PEDIATRIA	X		$ 640.000
197	PULSOXIMETRO PORTABLE	EDAN	H100B	360101-M1990190038	URGENCIAS PEDIATRIA	X		$ 1.000.000
198	REGULADOR DE VACIO	AMVEX	C2A	VRA090238N	URGENCIAS PEDIATRIA		X	$ 1.000.000
199	MONITOR SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	625NN1353	TRAILER			
200	TERMOHIGROMETRO	UBBIBOT	GS1-ARS	S6A38F10S1A	FARMACIA UMI			
201	TERMÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	F. URG 01	FARMACIA UMI			
202	TERMÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	F. URG 02	FARMACIA UMI	X		$ 575.200
203	TERMÓMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	FARMACIA UMI		X	$ 575.200
204	BASCULA DIGITAL	SECA	874	100000008841S	TRAMOS 2 Y 3			
205	MONITOR SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC12	KO-2C096281	TRAMOS 2 Y 3			
206	PULSOXIMETRO PORTABLE	EDAN	H100B	360101-M2390164O023	TRAMOS 2 Y 3			
207	REGULADOR DE VACIO	AMVEX	C2A	C2AZ001221	TRAMOS 2 Y 3			
208	TENSIOMETRO PEDESTAL	WELCH ALLYN	CE0207	100121114720	TRAMOS 2 Y 3	X		$ 575.200
209	TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	THERMO-HYGROMETER	261101	TRAMOS 2 Y 3		X	$ 1.000.000
210	BASCULA DIGITAL	SECA	874	100000012732G4	TRAMO 1			
211	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M23C101200047 EQUIPO NUEVO	TRAMO 1			
212	MONITOR FETAL	EDAN	F6 EXPRESS	560037-M2420-00300057 EQUIPO NUEVO	TRAMO 1			
213	MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M2260978O005	TRAMO 1			
214	MONITOR SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC12	KO-2C096280	TRAMO 1	X		$ 1.000.000
215	MONITOR SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC12	KO-2C096285	TRAMO 1	X		$ 1.000.000
216	PULSOXIMETRO PORTABLE	EDAN	H100B	360101-M2390164O002	TRAMO 1		X	$ 1.000.000
217	TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	THERMO-HYGROMETER	ETHMX119	TRAMO 1		X	$ 1.000.000
								$ 79.899.868

GESTIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD S.A.S.
Servicios de mantenimiento y gestión de tecnología biomédica
NIT : 902014857-8 Cel: 3008603723 e-mail gtsalud popayan@gmail.com

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ABRIL - 2026

ABRIL								
ITEM	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN	Semana 1 (01-11 Abril 2026)	Semana 2 (12-18 Abril 2026)	VALOR
1	BALANZA	SECA	874	10000000825529	URGENCIAS ADULTO	X		$ 574.000
2	DESFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	CARDIOLIFE-TEC5631	00256	URGENCIAS ADULTO	X		$ 575.229
3	ELECTROCARDIÓGRAFO	EDAN	SE-1201	360253-M252051500004	URGENCIAS ADULTO	X		
4	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	RIESTER	RI - Former	014888	URGENCIAS ADULTO	X		$ 575.229
5	LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	GS 300	NO IDENTIFICA	URGENCIAS ADULTO		X	$ 574.000
6	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO REGISTRA	URGENCIAS ADULTO		X	$ 574.000
7	MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRICO	MINDRAY	ePM 10M	AD1-04010763	URGENCIAS ADULTO		X	$ 1.000.000
8	MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRICO	MINDRAY	ePM 10	AC7-04008837	URGENCIAS ADULTO		X	$ 1.000.000
9	PULSOXIMETRO PORTATIL	EDAN	H100B	360101-M18402240040	URGENCIAS ADULTO			
10	REGULADOR DE VACIO	AMVEX	CHA	CHAC002040/NU EVO	URGENCIAS ADULTO			
11	REGULADOR DE VACIO	AMVEX	CHA	CHAC002042/NU EVO	URGENCIAS ADULTO			
12	REGULADOR DE VACIO	AMVEX	CHA	CHAC002052	URGENCIAS ADULTO			
13	TENSIOMETRO ANEROIDE	RIESTER	BIG BEND	190943851	URGENCIAS ADULTO			
14	TENSIOMETRO ANEROIDE	GMD	NO REGISTRA	NO REGISTRA	URGENCIAS ADULTO			
15	TENSIOMETRO ANEROIDE	LORD	NO REGISTRA	1178817	URGENCIAS ADULTO			
16	TERMOHIGROMETRO	UBIBOT	GS1-ARS	TTQ1F13GS1A	URGENCIAS ADULTO			
17	ASPIRADOR	THOMAS - MEDIPUMP	1630	0 21100006752	URGENCIAS GINECOLOGIA	X		$ 574.000
18	BALANZA	SECA	874	10000000825517	URGENCIAS GINECOLOGIA	X		$ 574.000
19	DOPPLER FETAL PORTÁTIL	EDAN	BASIC A	560042-M226097600038	URGENCIAS GINECOLOGIA	X		$ 574.000
20	LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	GS 300	NO REGISTRA	URGENCIAS GINECOLOGIA		X	$ 574.000
21	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12-1	EV-04056006	URGENCIAS GINECOLOGIA		X	$ 1.000.000
22	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12-1	EV-98048543	URGENCIAS GINECOLOGIA		X	$ 1.000.000
23	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12-1	EV-98048544	URGENCIAS GINECOLOGIA			
24	MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M21B13500002	URGENCIAS GINECOLOGIA			
25	TENSIOMETRO ANEROIDE	WELCH ALLYN	CE 0297	0 404081612	URGENCIAS GINECOLOGIA			
26	TENSIOMETRO ANEROIDE	ALPK	SPYGNOMANOMETER	002947	URGENCIAS GINECOLOGIA			
27	TENSIOMETRO ANEROIDE	RIESTER	1459	181044577	URGENCIAS GINECOLOGIA			
28	TERMOHIGROMETRO	MULTICOM-PRO	TA288	URGENCIAS_G_03	URGENCIAS GINECOLOGIA			
29	ELECTROBISTURI	WEM	SS501SX	CAE0004760	CIRUGIA ADULTOS	X		$ 422.600
30	ESTIMULADOR DE NERVIOS	TDF WATCHS	NO REGISTRA	28-2006077	CIRUGIA ADULTOS	X		$ 574.000
31	LAMPARA CIELITICA	DRAGER	POLARIS 100	ASRH-0114/ASRH 0098//ASRH-0172	CIRUGIA ADULTOS	X		$ 575.229
32	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NO REGISTRA/CARRO DE PARO	CIRUGIA ADULTOS			
33	MESA QUIRÚRGICA	MERCEDES IMEC	MI 3001E	9087	CIRUGIA ADULTOS			
34	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0721	CIRUGIA ADULTOS		X	$ 1.000.000
35	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EMP 10M	AC7-04009215	CIRUGIA ADULTOS		X	$ 1.000.000
36	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12	EV01034491	CIRUGIA ADULTOS		X	$ 1.000.000
37	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	ePM 12	AC6-32047178	CIRUGIA ADULTOS			
38	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	LIFE SCOPE	33814	CIRUGIA ADULTOS			
39	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	LIFE TIME	71128064415	CIRUGIA ADULTOS			
40	TERMOHIGROMETRO	UBIBOT	GS1-A	N2PAX9HGS1A	CIRUGIA ADULTOS			
41	TERMOHIGROMETRO	UBIBOT	GS1-A	AP97094GS1A	CIRUGIA ADULTOS			

42	TERMOMETRO	DIGITAL THERMOMETER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	CIRUGIA ADULTOS			
43	UNIDAD DE CALENTAMIENTO	BAIRHUGGER	675	23807	CIRUGIA ADULTOS			
44	AGITADOR DE MAZZINI	BOECO	OS-20	1010822020086	LABORATORIO CLINICO	X		$ 820,000
45	AGITADOR DE PLAQUETAS	HELMERT	PF151	1020790	LABORATORIO CLINICO		X	$ 575.229
46	TERMOHIGROMETRO	UBIBOT	GS1-1	D4C2GG9GS1A	LABORATORIO CLINICO		X	$ 820.000
47	TERMOHIGROMETRO	UBIBOT	GS1-AIRS	VR032M0GS1A	LABORATORIO CLINICO		X	$ 820.000
48	AUTOCLAVE	PROMED	MSG.B (450L)	MS2001055	CENTRAL ADULTOS	X		$ 820.000
49	SELLADORA DE PEDAL	N.R	N.R	N.R	CENTRAL ADULTOS	X		
50	BALANZA BEBE	HEALTH O METER	524	5240001147	UCI NEONATAL	X		$ 820.000
51	BLENDER	BIO-MED	2003FL	BX1852397	UCI NEONATAL	X		$ 820.000
52	GRAMERA	SECA	856	8866288180351	UCI NEONATAL	X		$ 1.109.328
53	HUMIDIFICADOR	FISHER & PAYKEL	MR850	101203089285	UCI NEONATAL	X		$ 575.229
54	HUMIDIFICADOR	FISHER & PAYKEL	MR850	140310208321	UCI NEONATAL	X		$ 575.229
55	TRANSPORTE	MEDIX	TR-200	2783-16	UCI NEONATAL	X		$ 575.229
56	INCUBADORA SERVOCONTROLADA	DRAGER	ISOLETTE C2000	AH36571	UCI NEONATAL	X		$ 575.229
57	INCUBADORA SERVOCONTROLADA	DRAGER	ISOLETTE C2000	DSRF-0061	UCI NEONATAL		X	$ 575.229
58	RADIANTE	DRAGER	RESUSCITAIRE	DSRJ-0024	UCI NEONATAL		X	$ 575.229
59	RADIANTE	DRAGER	RESUSICTAIRE	DSRJ-0025	UCI NEONATAL		X	$ 575.229
60	RADIANTE	DRAGER	RESUSCITAIRE	DSRJ-0023	UCI NEONATAL		X	$ 575.229
61	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	DRAGER	BILLILUX	1116495020	UCI NEONATAL		X	$ 1.000.000
62	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	DRAGER	BILLILUX	1116837021	UCI NEONATAL		X	$ 1.000.000
63	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	DRAGER	BILLILUX	1116495013	UCI NEONATAL		X	$ 820.000
64	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM 10M	AC7-04008904	UCI NEONATAL		X	$ 1.000.000
65	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM 10M	AD1-04010751	UCI NEONATAL			
66	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM 10M	AD1-04010755	UCI NEONATAL			
67	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM 10M	AD1-04D10750	UCI NEONATAL			
68	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12	EV-99049160	UCI NEONATAL			
69	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12	EV-99049163	UCI NEONATAL			
70	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 8	EW-64028127	UCI NEONATAL			
71	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-04068113	UCI NEONATAL			
72	NEOPUFF	FISHER & PAYKER	RD900ASV	110120000078	UCI NEONATAL			
73	PULSIOXIMETRO PORTATIL	COVIDIEN	PM10N	MBP2007060	UCI NEONATAL			
74	REGULADOR DE VACIO	HERSILL	NR	43716-0172	UCI NEONATAL			
75	REGULADOR DE VACIO	AMVEX	RX ONLY	VRA06158JM	UCI NEONATAL			
76	TERMOHIGROMETRO	UBIBOT	GS1-A	C71C7DKGS1A	UCI NEONATAL			
77	TERMOHIGROMETRO	UBIBOT	GS1-A	CXG12BBGS1A	UCI NEONATAL			
78	TERMOMETRO	FRIDGE/FREEZER	DIGITAL THERMOMETER	20211996	UCI NEONATAL			
79	ANUEVA	SECA	334	10000000957524	UCI NEONATAL			
80	BLENDER	MEDIN	1085 EASY	26851	UCI PEDIATRIA	X		$ 575.000
81	EQUIPO ORGANOS PORTABLE	WELCH ALLYN	REF, 727	NO REGISTRA	UCI PEDIATRIA	X		$ 575.000
82	HUMIDIFICADOR	FISHER & PAYKEL	MR850JSU	140317208609	UCI PEDIATRIA	X		$ 575.000
83	HUMIDIFICADOR	FISHER & PAYKEL	MR850JSU	14317208604	UCI PEDIATRIA		X	$ 575.000
84	MONITOR GASTO CARDIACO PICCO	PULSION	PICCO 2	A148500002	UCI PEDIATRIA		X	$ 1.000.000
85	MONITOR SIGNOS VITALES	MINDRAY	BENEVIEW T5	CM-74163604	UCI PEDIATRIA		X	$ 1.000.000
86	MONITOR SIGNOS VITALES	MINDRAY	BENEVIEW T5	CM-61147680	UCI PEDIATRIA			
87	REGULADOR DE VACIO	AMVEX	RX ONLY	VRA07075BK	UCI PEDIATRIA			
88	TENSIOMETRO PORTABLE	WELCH ALLYN TYCOS	NR	100120131922	UCI PEDIATRIA			
89	TERMOHIGROMETRO	UBIBOT	GS1-A	M95KA89GS1A	UCI PEDIATRIA			
90	TERMOHIGROMETRO	UBIBOT	GS1 - AIRS	PGBKN1DGS1A	UCI PEDIATRIA			
91	LARINGOSCOPIO PEDIATRICO	WELCH ALLYN	60814	00732084250114	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	X		$ 574.000
92	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	ePM 10	AC7-04006671	HOSPITALIZACION PEDIATRIA	X		$ 574,000
93	TENSIÓMETRO ANEROIDE	RIESTER	BIG BENROUND	210242031	HOSPITALIZACION PEDIATRIA		X	$ 1.000,000
94	TERMOHIGROMETRO	NO REGISTRA	HTC-2	20240909-19	HOSPITALIZACION PEDIATRIA			
95	TERMOHIGRÓMETRO	N.R	HTC-2	20240913-3	HOSPITALIZACION PEDIATRIA			
96	BASCULA ADULTO	SECA	SECA 874	10000000886125	CIRUGIA PEDIATRICA	X		$ 575,229
97	CALENTADOR DE FLUIDOS DE IRRIGACIÓN	3M	RANGER 245	72167	CIRUGIA PEDIATRICA	X		$ 472.500
98	DOPPLER	HUNTLEIGH	FD1	FD1PX0378676-16	CIRUGIA PEDIATRICA	X		$ 575.229
99	LAMPARA CIELITICA	MINDRAY	HyLED 600/600	54-2A002146	CIRUGIA PEDIATRICA	X		$ 575.229
100	MESA QUIRÚRGICA	MINDRAY	HYBASE 6100	G9-11000555	CIRUGIA PEDIATRICA		X	$ 575,229

101	MICROSCOPIO QUIRURGICO	MARCO	JACKSONVILLEFLA	99J0004	CIRUGIA PEDIATRICA		X	$ 575.229
102	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0383	CIRUGIA PEDIATRICA		X	$ 575.229
103	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNM0908	CIRUGIA PEDIATRICA		X	$ 575.000
104	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 12	KQ-4A130223	CIRUGIA PEDIATRICA			
105	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12	EV-81034501	CIRUGIA PEDIATRICA			
106	REGULADOR DE VACIO	AMVEX	C2A	C2AZ000845	CIRUGIA PEDIATRICA			
107	TERMOHIGROMETRO	UBIBOT	GS1-AIRS	YYE0NY1GS1A	CIRUGIA PEDIATRICA			
108	TERMOHIGROMETRO	UBIBOT	GS1-AIRS	H92C85MGS1A	CIRUGIA PEDIATRICA			
109	TERMOHIGROMETRO	HTC	A2	20240913-8	CIRUGIA PEDIATRICA			
110	ASPIRADOR	SMAF	SXT-5A	L12.20.212	CONSULTA EXTERNA	X		$ 575.229
111	BALANZA	HEALTH O METER	160KG	1600004204	CONSULTA EXTERNA	X		$ 800.000
112	BALANZA	SECA	813	8813216170496	CONSULTA EXTERNA	X		$ 1.000.000
113	BALANZA	SECA	SECA 874	10000000295761	CONSULTA EXTERNA	X		$ 1.000.000
114	DOPPLER FETAL PORTÁTIL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M18303100008	CONSULTA EXTERNA		X	$ 1.000.000
115	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	HILROM	77710-71ML	CONSULTORIO 2	CONSULTA EXTERNA		X	$ 1.000.000
116	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	RIESTER	RI - Former	14904	CONSULTA EXTERNA		X	$ 574.000
117	LAMPARA CUELLO DE CISNE	WELCH ALLYN	LS-135	N.R	CONSULTA EXTERNA		X	$ 574.000
118	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	MINDRAY	IMEC 8	EW64026129	CONSULTA EXTERNA			
119	MONITOR FETAL	GENERAL MEDITECH	G6A PLUS	G6A1712T21	CONSULTA EXTERNA			
120	TALLIMETRO	SECA	213	10000001724248	CONSULTA EXTERNA			
121	TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	TYCOS	40061619	CONSULTA EXTERNA			
122	TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	TYCOS	61012144729	CONSULTA EXTERNA			
123	TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	NR	110715164258	CONSULTA EXTERNA			
124	BICICLETA ESTÁTICA	SPORT FITNESS	MONZA	NO REGISTRA	FISIOTERAPIA	X		$ 1.000.000
125	ELECTROESTIMULADOR CON ULTRASONIDO	CHATTANOOGA	CH2762CC	T5803	FISIOTERAPIA	X		$ 575.229
126	ESTIMULADOR ELÉCTRICO PORTÁTIL	CHATTANOOGA	INTELECT TENS	B712663	FISIOTERAPIA	X		$ 575.229
127	ESTIMULADOR ELÉCTRICO PORTÁTIL	BIOMED	2000 XL	N/A	FISIOTERAPIA		X	$ 575.229
128	ESTIMULADOR ELÉCTRICO PORTÁTIL	CHATTANOOGA	THETA	ZH5004401	FISIOTERAPIA		X	$ 620.000
129	HIDROCOLECTOR	INTERFISIO A	TE-T05F	NR	FISIOTERAPIA		X	$ 620.000
130	MÁQUINA DE MOVIMIENTO PASIVO PARA HOMBRO	ARTROMOTS3	80.00.024	12561	FISIOTERAPIA			
131	MASAJEADOR FACIAL	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	FISIOTERAPIA			
132	MONOPEDAL	MOVIFIT	EJ-E39C	NO REGISTRA	FISIOTERAPIA			
133	TANQUE DE PARAFINA	PARABATH	24050	20171199	FISIOTERAPIA			
134	BAÑO SEROLOGICO	MEMMERT	WMB7	L2090104	SALA PARTOS	X		$ 574.000
135	LAMPARA DE CALOR RADIANTE	ADVANCE	A4051	AA0063052	SALA PARTOS	X		$ 575.000
136	LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL	BENQ	LS800-5008	2E342-R6-0010002	SALA PARTOS	X		$ 575.000
137	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	MINDRAY	IMEC 12	EV-98048541	SALA PARTOS		X	$ 575.000
138	MONITOR FETAL	EDAN	F3 DUAL	560034-M19A03260004	SALA PARTOS		X	$ 620.000
139	PULSOXIMETRO PORTATIL	EDAN	H100B	360101-M23BD1640010	SALA PARTOS			
140	REANIMADOR NEONATAL (NEOPUFF)	FISHER & PAYKEL	RD900ASU	180323014787	SALA PARTOS			
141	TERMÓMETRO	FRIDGE FREEZZER	NR	ALM002	SALA PARTOS			
142	TEERMOHIGROMETRO	HTC-2	NO REGISTRA	20240909-12	SALA PARTOS			
143	ASPIRADOR	PORTABLE PHLEGRM	H003-C	M0231013004021 3	AMBULANCIA			
144	PULSOXIMETRO PORTATIL	CHOICEMMED	MD300C21	202511504701	AMBULANCIA	X		$ 422.600
145	VENTILADOR MECANICO	HAMILTON MEDICAL	T1	30531	AMBULANCIA			
146	NEBULIZADOR	DEVILBISS	3855DX	3DX6548143	AMBULANCIA		X	$ 1.000.000
147	TENSIOMETRO ANEROIDE	GMD	ADULTO	N.R	AMBULANCIA		X	$ 1.000.000
148	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA)	MINDRAY	BENEHEART C2	AE9-33006794	AMBULANCIA		X	$ 1.000.000
149	MONITOR DE SIGNOS VITALES	CONTEC	CMS6000	24011400617	AMBULANCIA			
150	NEBULIZADOR	THOMAS MEDI PUMP	1121	1,004E+11	AMBULANCIA			
151	TENSIOMETRO ANEROIDE	GMD	NR	NR	AMBULANCIA			
152	DIGITALIZADOR DE IMÁGENES RADIOGRÁFICAS CR	AGFA	CR-15X	91330	IMÁGENES DIAGNOSTICAS	X		$ 650.000

153	ECÓGRAFO	PHILIPS	AFFINITI 70 ULTRASOUND SYSTEM	US721F2008	IMÁGENES DIAGNOSTICAS	X		$ 550.000
154	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	61108	IMÁGENES DIAGNOSTICAS		X	$ 575.229
155	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	CARESTRE AM	MOTION MOBILE CON UN FOCUS 35	MTN22/809	IMÁGENES DIAGNOSTICAS			
156	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	MINDRAY	MEC-1200	CC-09115137	IMÁGENES DIAGNOSTICAS			
157	TERMOHIGROMETRO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	SUSA001	IMÁGENES DIAGNOSTICAS			
158	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	CMS-1502	2133	UCI INTERMEDIOS	X		$ 1.000.000
159	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	CSM-1500	2145	UCI INTERMEDIOS	X		$ 1.000.000
160	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	CSM-1500	2072	UCI INTERMEDIOS		X	$ 1.000.000
161	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	CU- 152R	6627	UCI INTERMEDIOS		X	$ 1.000.000
162	REGULADOR DE VACIO	AMVEX	C2A	C2AZ001221	UCI INTERMEDIOS			
163	TERMOHIGROMETRO	NR	NR	ALM008	UCI INTERMEDIOS			
	GRAMERA	SECA	856	885628810026B	UCI INTERMEDIOS			
164	TERMOHIGROMETRO	UBIBBOT	GS1-A	VH36133GS1A	UCI INTERMEDIOS			
165	DOPPLER FETAL PORTÁTIL	HUNTLEIGH	FD1	FD1PX34822318	UCI ADULTOS	X		$ 574.000
166	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	CSM-1500	1671	UCI ADULTOS	X		$ 1.000.000
167	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	CSM-1500	1673	UCI ADULTOS	X		$ 1.000.000
168	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-3562	33620	UCI ADULTOS		X	$ 1.000.000
169	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-3562	33617	UCI ADULTOS		X	$ 1.000.000
170	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KOHDEN	BSM-3562	33619	UCI ADULTOS		X	$ 1.000.000
171	MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M184122200003	UCI ADULTOS		X	$ 1.000.000
172	REGULADOR DE VACIO	AMVEX	C2A	C2AZ000429	UCI ADULTOS		X	$ 1.000.000
173	REGULADOR DE VACIO	AMVEX	C2A	VRA06163	UCI ADULTOS		X	$ 1.000.000
174	REGULADOR DE VACIO	AMVEX	C2A	C2AZ001223	UCI ADULTOS			
175	UNIDAD DE CALENTAMIENTO	WARM TOUCH NELLCOR	WT 6000	SP19050168	UCI ADULTOS			
176	LARINGOSCOPIO ADULTO	WELCH ALLY	60813	N.R	ENDOSCOPIA	X		$ 409.252
177	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC12	KQ-2C096295	ENDOSCOPIA		X	$ 1.000.000
178	REGULADOR DE VACIO	AMVEX	CHA	CHAC002048	ENDOSCOPIA			$ 575.229
179	TERMOHIGROMETRO	UBIBOT	GS1-AIRS	A9973X0GS1A	ALMACEN	X		$ 575.229
180	TERMOHIGROMETRO	NO REGISTR	NO REGISTRA	NO REGISTRA	VACUNACION	X		$ 575.229
181	MONITOR SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0391	TRAMO 4 Y 5	X		$ 615.000
182	TENSIOMETRO PEDESTAL	RIESTER	BIG BENROUND	210242021	TRAMO 4 Y 5		X	$ 1.000.000
183	TENSIOMETRO PORTABLE	GMD	SPHYGMOMANOMETER	211008947	TRAMO 4 Y 5			
184	TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	THERMO - HYGROMETER	TMHG261102	TRAMO 4 Y 5			
185	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-85005734	URGENCIAS PEDIATRIA	X		$ 574.000
186	ELECTROCARDIOGRAFO	MINDRAY	BENEHEARTH R12	FN-03020291	URGENCIAS PEDIATRIA	X		$ 674.000
187	EQUIPO DE ORGANOS PARED	RIESTER	RI-FORMER	14099	URGENCIAS PEDIATRIA		X	$ 1.000.000
188	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10M	AD1-04011717	URGENCIAS PEDIATRIA		X	$ 1.000.000
189	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-84026125	URGENCIAS PEDIATRIA			
190	REGULADOR DE VACIO	AMVEX	C2A	C2AZ001219	URGENCIAS PEDIATRIA			
191	VIDEOLARINGOSCOPIO	KING VISION	ABLADE	C12019A309590	URGENCIAS PEDIATRIA			
192	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ-03006930	TRAMOS 2 Y 3	X		$ 1.000.000
193	REGULADOR DE VACIO	AMVEX	C2A	VRA09023BU	TRAMOS 2 Y 3	X		$ 1.000.000
194	TENSIOMETRO PEDESTAL	RIESTER	BIG BENROUND	210242018	TRAMOS 2 Y 3		X	$ 1.000.000
195	TENSIOMETRO PEDESTAL	RIESTER	BIG BENROUND	210242010	TRAMOS 2 Y 3			
196	TERMOHIGROMETRO	BIOTEMP	THERMO-HYGROMETER	261103	TRAMOS 2 Y 3			
218	MONITOR DE SIGNOS	MINDRAY	IMEC 12	EV-98048641	SALA PARTOS		X	$ 1.000.000
197	TERMOHIGROMETRO	OCK/HUMIDI	HTC-1	ALM019	TRAMO 6	X		$ 620.000
								$ 84.261.334

REPUESTO	EQUIPOS	VALOR UNITARIO CON IVA	CANTIDAD ENTREGA	VALOR TOTAL
BRAZALETE REUSABLE DE NIBP ADULTO -S951D, 13 CM	MONITOR SIGNOS	714.000	23	16.422.000
BRAZALETE REUSABLE DE NIBP ADULTO -S951D, 13 CM (DOS VIAS)	MONITOR SIGNOS	714.000	4	2.856.000
ACCES POINT ARUBA	RAYOS X MOVIL	9.104.399	2	18.208.797
CABLE LATIGUILLO ECG 6 DERIVADAS	MONITOR SIGNOS	2.142.000	9	19.278.000
SENSOR DE SPO2	MINDRAY	654.500	12	7.854.000
			TOTAL	**64.618.797**

Fecha Actual : lunes, 27 abril 2026

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Nit : 891501676

Dirección : Calle 15 No 17 a - 196 **Telefono : 0928211721** **PAGINA:** 1/1

Cuenta por Pagar: 78266 **N°.Radicacion: GTS5**

CUENTA X PAGAR

Proveedor:GESTIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD S.A.S. Fecha: 27/04/2026 8:41:47 a. m.

Direccion:CALLE 11 A NO. 11-33 NIT:902014857 Codigo: 902014857

Contrato: Ciudad: POPAYÁN

Estado: Telefonos:3006603723 Orden Servicio:

Confirmado Orden Compra:

Factura: GTS5 Plazo: 0 Vencimiento: 27/04/2026 12:00:00 a. m. Cuenta: 24010102

Observaciones.

Registro Factura No. GTS4 expedida el 20/04/2026. Contrato No. 100 del 16/02/2026, cuyo objeto es PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Codigo	Nombre del Concepto	Cuenta	Centro de Costo	Nombre de la Cuenta	M	Vr. Unitario
508	MANTENIMIENTO	5897231115		MANTENIMIENTO	D	$228780000,00
010	PROELECTRIFICACION	24403501		PROELECTRIFICACION	C	$3845042,00
011	PRODESARROLLO	24403502		PRODESARROLLO	C	$3845042,00
013	PRO - DEPORTE	24402401		TASA PRODEPORTE	C	$2883782,00
035	PRO ADULTO MAYOR	24403509		PRO ADULTO MAYOR	C	$5767563,00
423	PRO CULTURA	24403513		PRO CULTURA	C	$961261,00
440	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	24403511		PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	C	$1922521,00
413	RETEFUENTE SERVICIOS	24360501		RETEFUENTE SERVICIOS PERSONA JURIDICA	C	$7690084,00
406	RETE IVA SERVICIOS	24362502		IMPUESTO VENTAS RETENIDO - SERVICIOS	C	$5479185,00
415	RETENCION ICA	24362701		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	C	$1153513,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	
1	27/04/2026	Valor $ 195.232.007,00

Valor Total Cuotas : $ 195.232.007

INFORME GESTION TECNOLOGICA

REPUBLICA DE COLOMBIA- DEPARTAMENTO DEL CAUCA		HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.	
FORMATO Informe de Contratista Trámite de pago		Página 1 de 18	Código: SLV-FIN-VSC-16-F01
		Versión: 1	SLV-DES-01-F01

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME DESDE (dd/mm/año)	HASTA (dd/mm/año)
PARCIAL	X	FINAL		100	15/03/2026	19/04/2026
CONTRATANTE				HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.		
N° PROCESO CONTRATACIÓN SECOP				HSLV-CD-098-2026		
CONTRATISTA				GESTION TECNOLOGICA EN SALUD S.A.S.		
No. DE IDENTIFICACIÓN				900.014.857-8	EXPEDIDA EN	POPAYAN
No. TELEFONO y/o CELULAR				3116778399		
SUPERVISOR y/o INTERVENTOR				DIEGO ERNEY CAMPO SANCHEZ		
No. DE IDENTIFICACIÓN				10649970	EXPEDIDA EN	POPAYAN
No. TELEFONO y/o CELULAR				3176435650		
REGISTRO PRESUPUESTAL				131 D.D. 02 DE FEBRERO 2026	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1.372.480.000,00
FORMA DE PAGO				6 PAGOS	PAGO No.	02
VALOR A PAGAR				228.780.000		
PAGO SEGURIDAD SOCIAL (PERSONA NATURAL)						
Sistema de Seguridad Social (NIC 4406)					PERIODO COTIZADO	03/2026
EPS				SANITAS	VALOR PAGADO	200.000
ARL				POSITIVA	VALOR PAGADO	8.400
AFP				COLPENSIONES	VALOR PAGADO	256.000
VALOR TOTAL PLANILLA					PLANILLA No.	9497758742
Certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales				Certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del 15 de abril de 2026		
SEGUIMIENTO FINANCIERO						

REPUBLICA DE COLOMBIA- DEPARTAMENTO DEL CAUCA		HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.	
FORMATO Informe de Contratista Trámite de pago		Página 2 de 18	Código: SLV-FIN-VSC-16-F01
		Versión: 1	SLV-DES-01-F01

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	1 372 000 000
OTROSI N°	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1 372 000 000
VALOR EJECUTADO	427 093 392
VALOR A PAGAR SEGÚN INFORME	228.780.000
SALDO A EJECUTAR	945 000 000

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E

ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS

ESPECIFICACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	SOPORTE
El contratista realizará una (1) visita de mantenimiento preventivo para los equipos biomédicos del Hospital, los cuales se encuentran relacionados en el Anexo 2, que hace parte integral del presente documento. [illegible]	Se realizó mantenimiento preventivo a 101 equipos biomédicos del mes de marzo y 106 equipos biomédicos del mes de abril relacionados así: MES DE MARZO [illegible] MES DE ABRIL [illegible]	Se entregan los 207 reportes de mantenimiento de los equipos biomédicos relacionados [illegible] CARPETA DEPARTAMENTO INGENIERIA BIOMEDICA EQUIPOS BIOMEDICOS [illegible] Se realizan 2 mantenimientos correctivos durante la vigencia del contrato. Se entrega acta de repuestos suministrados para los mantenimientos

REPUBLICA DE COLOMBIA- DEPARTAMENTO DEL CAUCA		HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.	
FORMATO Informe de Contratista Trámite de pago		Página 3 de 18	Código: SLV-FIN-VSC-16-F01
		Versión: 1	SLV-DES-01-F01

	Doppler fetal, (1) ecógrafo, (1) electrobisturí, (1) electrocardiógrafo, (1) [illegible] MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS: (1) Monitor de signos. (1) lámpara cuello de cisne	

REPUBLICA DE COLOMBIA- DEPARTAMENTO DEL CAUCA		HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.	
FORMATO Informe de Contratista Trámite de pago		Página 4 de 18	Código: SLV-FIN-VSC-16-F01
		Versión: 1	SLV-DES-01-F01

Para el caso de los mantenimientos correctivos, [illegible]	a. Se presta atención correctiva [illegible]	a. Se entregan 2 mantenimientos correctivos [illegible]

REPUBLICA DE COLOMBIA- DEPARTAMENTO DEL CAUCA		HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.	
FORMATO Informe de Contratista Trámite de pago		Página 5 de 18	Código: SLV-FIN-VSC-16-F01
		Versión: 1	SLV-DES-01-F01

[illegible]	Se da cumplimiento con los formatos SN-02-F01 PMH 2026 SLV-GAT-OTE-1003	

REPÚBLICA DE COLOMBIA- DEPARTAMENTO DEL CAUCA	FORMATO Informe de Contratista Trámite de pago	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.	
		Página 9 de 18	Código: SLV-FSN-ASC-16-F01
		Versión: 1	SLV-DES-01-F01

El proceso de mantenimiento solicitado por la Institución de código SLV-CAT-0181-1521 Es la descripción detallada del paso a paso de las actividades definidas por el fabricante para el mantenimiento preventivo, abarcan un amplio listado de chequeo que sirve como acompañamiento para el proceso de seguridad y limpieza evitando daños o accidentes que puedan generar inconvenientes en el mantenimiento preventivo dentro de las fortalezas durantes para el mantenimiento preventivo y deben ser basados en las recomendaciones del fabricante de mantenimiento preventivo monitoreado en el cronograma propuesta para lasmantenidos a cargo en la gestión de mantenimiento de equipos biomédicos variado IB expuesto por el ministerio de salud y protección social ya el que se encuentra en vigencia, e inicial como mínimo. Ø Autoclavación de cabezal cuando el equipo lo amerite Ø Revisión general y diagnostico inicial Ø Verificación de accesorios. Ø Mantenimiento preventivo, limpieza interna y pruebas de funcionamiento. Ø Mantenimiento correctivo si es necesario. Ø Informe sobre el servicio realizado y estado de este mismo		

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA		
OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	SOPORTE
1. El contratista se compromete a cumplir con todos los procedimientos y trámites establecidos por la entidad.	Se cumple con los procedimientos y trámites administrativos	Se cumple con los procedimientos y trámites administrativos

VIGILADO SUPERSALUD

Hospital Susana López de Valencia E.S.E. Nivel de Atención II
Calle 15 No. 17A - 09E La Unión, Tel: 8257171, 8257172 Fax: Ext. 101
Página: www.hospitalsusanalopez.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA- DEPARTAMENTO DEL CAUCA	FORMATO Informe de Contratista Trámite de pago	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.	
		Página 10 de 18	Código: SLV-FSN-ASC-16-F01
		Versión: 1	SLV-DES-01-F01

2. Diligenciar Formato CF-F08-F01 Informe de comisión completamente diligenciado incluyendo todas las actividades de la oficina "ESPECIFICACIONES TECNICAS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA". Adicionalmente, es obligatorio adjuntar fotografías pertinentes. No se aceptan informes en formato diferente. Este informe debe ser presentado por cada visita realizada.	Se diligencia el Formato CF-F08-F01 informe de comisión con descripción detallada de actividades, equipos intervenidos.	*Formato CF-F08-F01 publicado en la plataforma secop
3. Enviar la factura correspondiente y soportes a la plataforma SECOP II con todos los documentos exigidos requeridos por la entidad, una vez finalizado el contrato deberá realizar el cargue de la factura electrónica subida/radicada/expedida en el secop II	Se envió la factura correspondiente a las actividades ejecutadas y se radicó la factura en SECOP II junto con los soportes requeridos. Se realizó el cargue al supervisar el servicio institucional indicado una vez instalado la plataforma	Factura electrónica y soportes adjuntos. Pantallazo constancia de publicación en SECOP II Correo de notificación enviado a estadisticashospital@hotmail.com por la
4. Elaborar un informe de mantenimiento preventivo cada trimestre de vigencia y cargar los soportes antes de que cese prestación física en los servicios en Mipres en homologación de cada uno de los equipos intervenidos por el encargado del área de Ingeniería biomédica.	Se ejecutó el mantenimiento preventivo conforme cronograma (SLV-ST-02-F05 PMH 2026) y el presente SLV- CAT-0181-1521 Se realizo mantenimiento preventivo a 207 equipos biomédicos (Anexo 2) con revisión general verificación de accesorios, limpieza interna y pruebas funcionales.	Se entregan 207 informes de mantenimiento preventivo por cinco (físico y digital) con firmas de realizado y validación Área Mantenimiento preventivos.
5. Ejecutar las actividades solicitadas por el supervisor y/o el personal apoyo al supervisor mediante las cartas de turnos para realizar las actividades correctivas de Equipos médicos	No se presentaron notas internas	No se presentaron notas internas
6. Toda actividad de mantenimiento preventivo y correctivo en equipos biomédicos que sea ejecutada debe ser facturada por el contratista	Se formularon todas las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo efectivamente ejecutadas durante el periodo, conforme a las fichas técnicas y a la relación de actividades para pago	Se entrega Factura y relación detallada de actividades facturadas.
7. El contratista no podrá cobrar mano de obra de colectivos a	En las informes se discriminó el tiempo de los colectivos y	Se entregan 2 mantenimientos correctivos con alcance de intervención

OBLIGACIONES ESPECIFICAS		
OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	SOPORTE

VIGILADO SUPERSALUD

Hospital Susana López de Valencia E.S.E. Nivel de Atención II
Calle 15 No. 17A - 09E La Unión, Tel: 8257171, 8257172 Fax: Ext. 101
Página: www.hospitalsusanalopez.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA- DEPARTAMENTO DEL CAUCA	FORMATO Informe de Contratista Trámite de pago	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.	
		Página 8 de 18	Código: SLV-FSN-ASC-16-F01
		Versión: 1	SLV-DES-01-F01

suscriben que hayan sido retirados en el publicitamiento preventivo	cobrará mano de obra por reparaciones A ejecutar resultado dentro de un mantenimiento preventivo	Se entregan informes de mantenimiento con firmas de responsable del servicio
8. El contratista se compromete a realizar las actividades con personal capacitado y idóneo, para la ejecución entregar las hojas de vida con los respectivos soportes de idoneidad de sus trabajadores que realice dicha actividad.		Anexo Hoja de vida con soporte
	Se convenio la ejecución con personal con personal especializado y idóneo Se entregaron hojas de vida con los soportes de idoneidad (formación, experiencia y certificaciones)	Se entregan Hojas de vida y certificados. (Título curso, capacitación) se anexa anexo Hojas de vida
9. Atender a las solicitudes del proceso de la oficina de ingeniería biomédica para la realización de actividades que hacen referencia a la necesidad del cliente interno y externo	Se atendieron requerimientos del área de ingeniería biomédica para actividades complementarias al objeto contractual y apoyo técnico asistencial, valoración diagnostico de disponibilidad y apoyo actividades telefónicas Apoyo técnico de mantenimiento y reparación de dispositivos relacionados con el proceso de Ingeniería Biomédica Demas actividades relacionadas con el objeto a contratar.	Se entregan registros de actividades complementarias al objeto contractual y apoyo técnico asistencial, valoración diagnostico de disponibilidad y apoyo actividades telefónicas
10. El pago y tramite para la ejecución de las actividades objeto del presente contrato deberá de ser dado a conocer durante las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana.	Se presento disponibilidad para atención de actividades de forma inmediata, 24 horas al día, incluyendo días de semana y festivos, según requerimiento de actividades Se atendieron llamadas y se brindó respuesta pronta y oportuna por celular	Se entregan evidencias de especificidades. Anexo. Cronograma especificidades.

VIGILADO SUPERSALUD

Hospital Susana López de Valencia E.S.E. Nivel de Atención II
Calle 15 No. 17A - 09E La Unión, Tel: 8257171, 8257172 Fax: Ext. 101
Página: www.hospitalsusanalopez.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA- DEPARTAMENTO DEL CAUCA	FORMATO Informe de Contratista Trámite de pago	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.	
		Página 10 de 18	Código: SLV-FSN-ASC-16-F01
		Versión: 1	SLV-DES-01-F01

11. Efectuar el acondicionamiento y funcionamiento de los equipos biomédicos Mediante actividades realizadas por el personal de ingeniería biomédica del hospital dando con ello la categoría de verificación, las cantidades y valores como posteriormente son ejecutados para su ejecución.	Se realizaron actividades de acondicionamiento, alistamiento y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos conforme a solicitudes del personal de Ingeniería Biomédica para verificación de seguridad y funcionalidad de los mismos Se efectuaron pruebas de funcionamiento y verificación de seguridad operativa	Se entregan hojas de chequeo donde se verifica con el cumplimiento de revisión y verificación de seguridad eléctrica Anexo Listas de chequeo
12. Las actividades ejecutadas serán entregadas por el contratista al área de Ingeniería Biomédica que hará el apoyo al supervisor	Se entregaron al área de Ingeniería Biomédica los informes de las actividades ejecutadas (Excel y digitales), para seguimiento y control contractual	Se entrega al sector formalización de actividades ejecutadas con los soportes correspondientes Anexo informe de actividades
13. El contratista deberá consultar al supervisor cualquier error o irregularidad que encuentre al ejecutar las instalaciones con lo que se encuentre en la ejecución de actividades si existiera las adecuaciones y Modificaciones pertinentes.	Ade las presentaron inconvenientes	Nada se presentaron inconvenientes.
14. Realizar un manejo adecuado de los residuos generados en la ejecución del contrato de acuerdo con lo establecido en el PGIRASA del Hospital	14 no aplica	No aplica

VIGILADO SUPERSALUD

Hospital Susana López de Valencia E.S.E. Nivel de Atención II
Calle 15 No. 17A - 09E La Unión, Tel: 8257171, 8257172 Fax: Ext. 101
Página: www.hospitalsusanalopez.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA- DEPARTAMENTO DEL CAUCA	FORMATO Informe de Contratista Trámite de pago	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.	
		Página 11 de 18	Código: SLV-FSN-ASC-16-F01
		Versión: 1	SLV-DES-01-F01

15. El contratista deberá acatar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del Hospital Susana López de Valencia E.S.E., conocer las políticas y los objetivos ambientales, adoptar el compromiso de cumplir los aspectos ambientales asociados a las actividades derivadas de la ejecución del contrato (manejo adecuado de sustancias químicas, consumos de agua de oficio innecesarios – OFI) y participar activamente en las actividades de – PAGA generadas en reuniones ordinarias y promover el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones como proveedor del servicio, según la normatividad ambiental aplicable vigente, así como también promover la continuidad al mejoramiento continuo de la certificación ISO 14001:2015 de la cual la institución es acreedora.	15 se cumple con el sistema de gestión ambiental	15. se cumple con el sistema de gestión ambiental
16. Garantizar dotación pública con una adecuada gestión integral de todos los riesgos laborales durante el servicio, en cumplimiento de la normatividad nacional aplicable Resolución No 491 de 2023, Decreto 1076 de 2015, Título 6 – Resolución Reglamento y Título 7.6 Resolución de Agentes Eléctricos y Electrónicos (RAEE), a los riesgos que las manifiesten o produzcan. Entregar copia certificado(s) de disposición final o de aprovechamiento de los residuos peligrosos y/o con posterior realizado, emitido por un Gestor con Licencia Ambiental vigente.	No aplica	no aplica

OBLIGACIONES ESPECIFICAS		
OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	SOPORTE

VIGILADO SUPERSALUD

Hospital Susana López de Valencia E.S.E. Nivel de Atención II
Calle 15 No. 17A - 09E La Unión, Tel: 8257171, 8257172 Fax: Ext. 101
Página: www.hospitalsusanalopez.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA- DEPARTAMENTO DEL CAUCA	FORMATO Informe de Contratista Trámite de pago	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.	
		Página 12 de 18	Código: SLV-FSN-ASC-16-F01
		Versión: 1	SLV-DES-01-F01

1. El contratista realizará rutinas de inspección a los equipos biomédicos, de conformidad al procedimiento de código SLV- SM-15 establecido por el hospital. La cual consiste en ejecutarlas de manera diaria y a la medida de las equipos programados, y en ejecución de acuerdo a su programación o cronograma de rutina de inspección planificada por el líder de gestión de la tecnología biomédica, de esta se realizara en acuerdo con la criticidad de los servicios y/o la inmediatez asignada por fichas presentadas 2. Las ejecución de las rutinas de inspección se deberá realizar durante el transcurso del día, a partir de las 7:00 hrs hasta las 5:00 pm, con el criterio de interrumpir la ejecución de los equipos antes de que se generen picos eléctricos o fluctuaciones y por la alta complejidad del área.	Se ejecutaron rutinas de inspección diarias a los equipos biomédicos programados, mediante el procedimiento SLV- SM-15 y al cronograma diseñado por criticidad y necesidad de cada Se realizo conexión operativa, seguridad, accesorios y funcionamiento básico, registrando hallazgos y soportes fotográficos. Las rutinas de inspección se realizaron dentro del horario establecido (07:00 a 17:00), priorizando áreas de alta complejidad para evitar conexiones antes de tormentas o picos eléctricos.	Se entregan listas de chequeo Anexo. Listas de chequeo
3. En la ejecución de las rutinas de inspección para los equipos anexos enlistados en el Anexo 2, el contratista deberá dar soporte de toda novedad presentada para los equipos, y asegurar su normal funcionamiento para el transcurso del día.	Durante las rutinas de inspección se dio solución a contratiempos identificados en los equipos del Anexo 2, realizando aseo y cambio de fusibles para asegurar su normal funcionamiento durante el día. Se anexo el proceso de corrective normal cuando el ítem requirió reparo o intervención mayor	Se entregan listas de chequeo Anexo Listas de chequeo • Se cargan 2 formatos en mantenimiento correctivo. Anexo Mantenimientos correctivos
4. Dar respuesta personalizada a las solicitudes por consultores requeridas para los equipos médicos objeto del presente contrato en el área rectoría, en un tiempo de mínimo de 24 horas	Se atendieron consultores correctivos dentro del tiempo establecido (mínimo de dos de los 3 horas), con respuesta personalizada en el área requerida Se registro el evento, disponiendo intervención y estado final del equipo.	Se entrega soporte de solicitudes Anexo Soporte de solicitudes

VIGILADO SUPERSALUD

Hospital Susana López de Valencia E.S.E. Nivel de Atención II
Calle 15 No. 17A - 09E La Unión, Tel: 8257171, 8257172 Fax: Ext. 101
Página: www.hospitalsusanalopez.gov.co

	REPÚBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL CAUCA		HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.	
	FORMATO Informe de Contratista Trámite de pago		Página 12 de 18	Código: SLV-FIN-VSC-16-F01
			Versión: 2	SLV-GDE-01-F01

5. La frecuencia de estas revisiones deberá quedar detallada en el cronograma de rutinas de inspección entregado al supervisor del contrato, utilizando el formato correspondiente para el desarrollo de esta actividad, el cual deberá soportado con firma y sello del personal técnico que ejecuta la inspección, así como del jefe de servicio que recibe a satisfacción lo realizado	Se entrega cronograma de rutinas de inspección con frecuencias definidas y se ejecutó conforme a lo programado. Cada rutina quedó soportada en el formato institucional con firma y sello del técnico y firma del jefe del servicio.	• Se entrega Cronograma de mantenimiento Anexo Cronograma de mantenimiento
6. El contratista otorgará garantía sobre la calidad del mantenimiento preventivo ejecutado, y su período será hasta la siguiente visita de mantenimiento programada. La garantía no cubre si el equipo presenta falla por un daño proveniente de [illegible] o manejo de la [illegible] previamente comprobado	Se otorgó garantía sobre la calidad de mantenimiento preventivo ejecutado hasta la siguiente visita programada	Se entrega carta de garantía. Anexo Carta de garantía del servicio
7. Ejecutar actividades de mantenimiento correctivo; las cuales se realizarán en respuesta a la falla inesperada que presenta el equipo detectado por el usuario o por el personal técnico en las rutinas de inspección, y que busca poner nuevamente en servicio el equipo lo antes posible. Las fallas internas que se generen en los diferentes servicios asistenciales del Hospital referente a los equipos objeto del contrato, deben solucionarse y reportarse en la oficina del líder de gestión del ambiente y la tecnología el mismo día en que son reportadas. De lo contrario el contratista debe justificar la no finalización de la actividad	Se ejecutaron mantenimientos correctivos en respuesta a fallas inesperadas reportadas por usuarios o detectadas en inspecciones, priorizando la puesta en servicio en el menor tiempo posible.	• Se entrega 3 mantenimientos correctivos, [illegible] en las carpetas físicas y digitales de los equipos [illegible]. Anexo Mantenimientos correctivos
8. Si el mantenimiento correctivo o daño de un equipo médico implica retiro de la institución para reparación y/o entrega de diagnóstico, el procedimiento se realizará entre el líder de gestión del ambiente y la tecnología y el proceso de almacén y suministros, lo cual deberá contar con la autorización por parte del supervisor del contrato	No se presentó retiro de ningún equipo para reparación.	No se presentó retiro de ningún equipo para reparación

	REPÚBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL CAUCA		HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.	
	FORMATO Informe de Contratista Trámite de pago		Página 13 de 18	Código: SLV-FIN-VSC-16-F01
			Versión: 1	SLV-DES-01-F01

9. Se realizará una inspección detallada para corregir las desviaciones de cada equipo conforme al protocolo de mantenimiento preventivo dispuesto por fábrica, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos, [illegible] analizadores y/o insumos necesarios para ejecutar las reparaciones que garanticen el óptimo estado funcional de los equipos	Se realizó inspección detallada para corregir desviaciones conforme a protocolos del fabricante, utilizando analizadores y/o insumos necesarios para verificar el estado funcional. Se documentaron resultados de pruebas y acciones correctivas aplicadas.	Se entregan 207 mantenimientos preventivos. Anexo Mantenimientos preventivos.
10. Tras la ejecución de cada uno de los mantenimientos realizados, deberá presentarse informe general sobre el servicio realizado y estado en que queda cada equipo.	Después de cada mantenimiento (preventivo/correctivo) se presentó informe general del servicio y el estado en que quedó cada equipo, incluyendo hallazgos, acciones y recomendaciones. Se consolidó información para seguimiento y pago.	Se entrega informe unificado de actividades realizadas. Anexo Informe de actividades
11. Los protocolos de mantenimiento preventivo propuesto, las rutinas de inspección, las notas correctivas, e informes entre otros, deberán tener datos completos de los equipos médicos, así como sus áreas asistenciales de ubicación en las que se encuentren a la fecha, teniendo en cuenta que hay equipos que, por diferentes circunstancias, durante la ejecución del contrato pueden cambiar su área de ubicación	Todos los documentos (protocolos, rutinas, actas o informes) fueron elaborados con información completa del equipo y su ubicación asistencial actual, actualizando cambios de área cuando se presentaron.	Se entrega en cada formato de mantenimiento las observaciones relacionadas de los equipos médicos. Anexo Mantenimientos preventivos
12. La persona encargada de prestar disponibilidad deberá estar atento a contestar el llamado de la línea móvil de disponibilidad o plataforma de solicitudes de la institución	Se garantizó disponibilidad y atención permanente de la persona encargada, atendiendo llamadas de la línea móvil de disponibilidad y/o plataforma institucional de solicitudes. Se registró cada llamado y su atención.	Se lleva el seguimiento de solicitudes mediante la plataforma de solicitudes del HSLV. Anexo Reporte de solicitudes
13. En la disponibilidad de fin de semana, el personal disponible deberá realizar ronda de inspección en las áreas asistenciales, las cuales quedarán registradas en formato de rutinas de inspección, es importante establecer que la ronda	En fines de semana se realizaron rondas de inspección en áreas asistenciales, registradas en formato institucional. Para el área de cirugía, la ronda inició antes de las 07:00 a.m.	Se entrega rondas de inspección completas por el tiempo de ejecución del contrato. Anexo Listas de chequeo

	REPÚBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL CAUCA		HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.	
	FORMATO Informe de Contratista Trámite de pago		Página 14 de 18	Código: SLV-FIN-VSC-16-F01
			Versión: 1	SLV-DES-01-F01

de inspección en el área de cirugía deberá ser realizada antes de las 7:00 a.m., antes de que se inicie procedimientos en el área	previo al inicio de procedimientos, conforme a lo exigido	
14. El informe de ejecución de actividades deberá entregarse durante los primeros diez (10) días del mes. En el evento de no poder ejecutar la actividad de mantenimiento preventivo a algún equipo médico acorde a su programación, se deberá registrar en el protocolo de mantenimiento el daño del paciente o detalle en el cual el jefe de servicio indique la no disponibilidad y/o presentar al supervisor del contrato documento en el que se exponga dicha justificación para evaluar la viabilidad de reprogramación	• El informe mensual de ejecución se entregó dentro de los primeros diez (10) días del mes. • Cuando no fue posible ejecutar algún mantenimiento por no disponibilidad del equipo (paciente/uso), se dejó registro y/o soporte firmado por el jefe de servicio, y se gestionó reprogramación	Se entrega informe unificado de actividades realizadas. Anexo Informe de actividades
15. Garantizar transparencia en su actuar informando y reportando los eventos adversos que ocurran en la prestación del servicio, o sobre las anomalías que se presenten en el desarrollo de sus actividades.	Se garantizó transparencia reportando eventos adversos, anomalías o novedades de riesgo identificadas durante la prestación del servicio. Se comunicaron de manera oportuna al supervisor y a los responsables pertinentes.	Se entrega informe de actividades ejecutadas en el cual se evidencia la transparencia de los reportes de eventos adversos. Anexo Informe de actividades
16. Garantizar el cubrimiento efectivo y suficiente de los servicios contratados, de forma que no se presenten retrasos en la prestación del servicio o falta de oportunidad en el mismo	Se garantizó el cubrimiento efectivo del servicio, evitando retrasos y asegurando oportunidad en la atención (preventivos, inspecciones y correctivos). Se priorizaron servicios críticos y se reforzó cobertura cuando fue requerido.	Se entrega cronograma de disponibilidades. Anexo Cronograma de disponibilidades.
17. El personal deberá presentarse uniformado y utilizar los equipos de protección personal requeridos, de forma que permita la fácil identificación por parte de los usuarios del Hospital. Sobre el uniforme debe portar el carné institucional y el nombre completo	El personal se presentó uniformado y con uso de EPP, portando identificación clara por rol y nombre completo	No aplica
18. Garantizar que haya personal biomédico de turno de acuerdo a lo establecido en el anexo 02 del presente contrato, en el perfil biomédico en fin de semana y festivos	Se garantizó personal biomédico de turno según lo establecido en el Anexo 02, cubriendo noches y fines de semana conforme al perfil requerido	Anexo Cronograma de disponibilidad

	REPÚBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL CAUCA		HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.	
	FORMATO Informe de Contratista Trámite de pago		Página 15 de 18	Código: SLV-FIN-VSC-16-F01
			Versión: 1	SLV-GDE-01-F01

	Se mantuvo continuidad operativa para atención de eventos.	
19. Garantizar la atención de solicitudes generadas desde el hospital las 24 horas del día, los 7 días a la semana durante el término de ejecución del contrato. La no atención de solicitudes o llamados será una causal de incumplimiento. Las solicitudes atendidas fuera de los horarios del cuadro de turnos que presentará el contratista previamente al inicio del mes deberán ser justificadas e informadas al supervisor del contrato junto al informe mensual, referenciando la fecha, responsable de la atención, motivo de la solicitud, respuesta a la misma.	Se garantizó atención de solicitudes 24/7 durante toda la vigencia contractual. Las atenciones realizadas fuera del horario del cuadro de turnos fueron justificadas e incluidas en el informe mensual (fecha, responsable, motivo y respuesta)	Anexo. Reporte de solicitudes
20. Garantizar la aplicación de las rondas de seguridad a los servicios asistenciales, administrativos y de apoyo de acuerdo con el procedimiento e instrumentos diseñados por el hospital	20. Se aplicaron rondas de seguridad en servicios asistenciales, administrativos y de apoyo, conforme al procedimiento institucional	20. Se entrega listas de chequeo. Anexo Listas de chequeo
21. Desarrollar el trabajo dentro de las normas de seguridad con el fin de evitar accidentes, tanto de su personal como personal del hospital y de otros contratos	Se cumplió con las normas de seguridad, no se presentaron accidentes personales ni laborales	No aplica

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
Anexo Mantenimientos preventivos Anexo Mantenimiento correctivo Anexo Lista de chequeo Anexo Cronograma de disponibilidad Anexo Cronograma de mantenimientos Anexo. Carta de repuestos Anexo Reporte de solicitudes Anexo. Carta de garantía Anexo Informe de actividades	

Dado en la ciudad de Popayán, a los 20 días de abril de 2026

FIRMA CONTRATISTA	[signature]

INFORME INGENIEROS

MANUAL DE ACTIVIDADES GESTION TECNOLOGICA EN SALUD S.A.S

INGENIERIA BIOMEDICA

[illegible]

ACTIVIDADES CONTRACTUALES	PRODUCTO	ACTIVIDADES	SOPORTES
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

			biológica del mantenimiento correctivo. • **16/07/2025**: entrega del proceso para revisión Adquisición de mantenimiento y corrección de defectos para atualización de endorsement de hoy.
Apoyar el proceso de soporte de la tecnología en las sedes asistenciales con la contratación de bienes y servicios necesarios para la ejecución del mantenimiento hospitalario	Asistir al proceso de gestión con la tecnología en los procesos relacionados con la contratación de bienes y servicios necesarios para la ejecución del mantenimiento hospitalario	Ejecutar la identificación de necesidades de bienes y servicios para la ejecución del mantenimiento hospitalario	Dentro de los 5 días hábiles del mes de abril se identificaron las necesidades de bienes y servicios de los servicios especializados para el año 2026. La información correspondiente se encuentra cargada en el repositorio de evidencias de la carpeta denominada "3. Contratación – 2026" relacionada de manera "Contratación – 2026", en la cual se detalla cada una de las empresas con las que se genera interacción.
		Realizar la gestión de los procesos de contratación de bienes y servicios, asegurando que cumplan con los requisitos técnicos, legales y presupuestales establecidos por el líder del proceso	Se ejecuta la gestión de cada (5) procesos los cuales fueron entregados en el mes de periodo de los cuales tres (3) se encuentran en la plataforma de secop II en fases o cargue de piezas por parte de las empresas: 1. Prestar el servicio de mantenimiento correctivo de equipo de rayos x convencional – modelo DAX. Apoyo cotización y ejecución del contrato en el hab. 2. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los de los equipos Rad Ware del hab. 3. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de laboratorio clínico del hab.

			la información correspondiente se encuentra cargada en el repositorio de evidencias de la carpeta denominada "3. Contratación – 2026", en la cual se detalla cada una de las empresas con las que se genera interacción. La modalidad de contratación para el corte es la establecida en el cronograma publicado en la página de las especialidades y especialidades establecidas. 4. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ventiladores marca pulmonar modelo hab. 5. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de rayos x convencional – modelo DAX. Apoyo cotización y ejecución del contrato en el hab. 6. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a bisturí de segunda (2) colegas del hab. 7. Adquisición de videolaringoscopio y compresor de pistón para optimización de procesos del hab. La modalidad de contratación para el corte es la establecida en el cronograma publicado en la página de las especialidades y especialidades establecidas. 8. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y corrección de los equipos

Realizar la elaboración y entrega de los soportes e informes mensuales de las actividades del personal de gestión tecnológica en Salud E.A.A.	Ejecutar la realización y entrega de los soportes e informes correspondientes al mes de elaboración de acta de la de la sede del personal de gestión tecnológica en Salud E.A.A.	Ejecutar la elaboración y entrega del informe unificado sobre la ejecución de actividades del personal del proceso	Se realizó y entregó el informe de actividades del personal del ESE HUILA SALUD E.A.A. de los meses de enero a diciembre de gestión tecnológica en salud E.A.A. el finalizar la entrega del informe, agrupando los mantenimientos preventivos, correctivos y preventivos de mantenimiento y mantenimientos correctivos de los equipos evaluados, junto con cada una de las actividades generales y realizadas por los ingenieros biomédicos de los diferentes servicios. Se anexan el informe de revisión de los siguientes biomédicos, el cual será ejecutado el 20/04/2026. Se informa al líneas de proceso para cumplimiento de cumplimiento a solicitud de revisión de mantenimiento de equipos 30/11/2025. Se anexan listados de mantenimientos preventivos a realizar en el mes de abril. 15/04/2026 Se informa a líneas de soporte correctivo al 100% de avance. El informe al líneas de soporte sobre la visita a realizarse con el cronograma de mantenimiento para mantenimiento de calificación y envío a del hospital de 04/03/2026 Se anexa documentación pertinente a planillas de seguridad social 14/07/2026.

			preventivo de ventiladores marca pulmonar hab. 7. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ventiladores marca pulmonar modelo hab. 8. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo instrumental quirúrgico del hab. 9. Prestar el servicio de calibración de equipos biomédicos del hab. 10. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos automotores del hab.
		Gestionar la actualización de la base de datos de especificaciones técnicas de los equipos biomédicos de la institución	La evaluación técnica realizada a la adquisición de tecnología de rayos ajustada a los requerimientos del servicio y a la compatibilidad de infraestructura tecnológica. En este sentido, la generación de un concepto de esta información no resulta pertinente, dado que el trabajo se ejecutó y se resolvió de manera conjunta. Debido a que no se cuentan con la indicación sobre una tecnología vigente y actualizada con las mejores prácticas y normas del sector.
Brindar apoyo en la implementación y seguimiento del modelo de evaluación de tecnología biomédica, en coordinación con el Eje del proceso de ingeniería biomédica.	Brindar apoyo y velar del proceso de gestión de la tecnología en la gestión, utilización y seguimiento del modelo de evaluación de tecnología biomédica	Apoyar la gestión de metrología de evaluación de tecnologías	Durante el transcurso del 16 de mes abril 17 días del mes de abril solo se dio apoyo en la evaluación de tecnología biomédica para el mantenimiento a funcionario de público para evaluación de endoscopia.
		Soporte y documentar las mejoras implementadas en el procedimiento de hoy vigente.	Desde el 1 Ene/ mes 4 hab. 31 días del mes de abril se ha realizado mejoras en el procedimiento del HAV.
Gestionar la gestión de las actividades relacionadas con la entrega		Elaborar y enviar informe sobre la ejecución de actividades relacionadas con la gestión de la	Dia 5 de 16 de mes 4 hab. 31 días del mes de abril se ejecutó la actividad de formulación de las

			Se anexa informe de mantenimiento 19/04/2026 Se informa a todos los ingenieros activos de líneas terminar a cierre a cronograma para terminar de ejecución. Se realiza entrega final del proceso de actualización del proceso contratos a 100.
Gestionar la identificación de los requisitos normativos y reglamentarios del componente de salud con el fin de cumplir el proceso de Gestión Tecnológica en Salud E.A.A.	Ejecutar la identificación de los requisitos normativos y reglamentarios del componente de salud con el fin de cumplir el proceso de Gestión Tecnológica en Salud E.A.A.	Ejecutar el seguimiento del cumplimiento de las actividades asignadas del personal de Gestión Tecnológica en Salud E.A.A., verificando que se cumplan las obligaciones contractuales establecidas por el líder del proceso de Gestión Tecnológica, y reportando las desviaciones o faltas encontradas	Durante del seguimiento realizado se dejó constancia del cierre mes de las agendas mensuales del personal de Gestión Tecnológica en Salud E.A.A. verificando que se cumplan las obligaciones contractuales establecidas por el líder del proceso de Gestión Tecnológica en Salud E.A.A. Desde el 16 de mes 4 hab. el 30 de abril no se presentaron novedades y el periodo de cierre con las disponibilidades correspondientes cubiertas, sin evidencia alguna por parte de los ingenieros. Por ningún inconveniente con la fecha de entrega de los informes, de días completos del 1 al 15 los siguientes deben tener, debido entregados, hab. Solicitud mes, tomado su proceso de disponibilidad en ningún incumplimiento encontrado, no cuentan al día inmediato hasta la fecha del presente informe. Con corte a la fecha de elaboración del presente informe (abril 16 mes 4 hab.) el 16 de abril (Pascua el 20 de abril por lo cual se deja el corte de mes hasta la fecha 16/04/2026) no se presentaron novedades reportadas.

tecnología, como apoyo al líder del proceso	corrección de acuerdo con la criticidad de intervención establecidas y en apoyo al líder del proceso de gestión de la tecnología	tecnológica, ejecutar el procedimiento de atención de equipos biomédicos y bajo la coordinación del líder del proceso.	proceso de mantenimiento preventivo. Se hace adición que los 3 primeros días y entrega para los 3 primeros hab: • **17/07/2026**: entrega del proceso para revisión Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de rayos x convencional – modelo DAX. Apoyo cotización y ejecución del contrato en el hab. Apoyo cotización y ejecución del contrato en el hab. **20/04/2026**: entrega final de ejecución. • **21/07/2026**: entrega del proceso para revisión Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de rayos x convencional – modelo DAX. Apoyo cotización y ejecución del contrato en el hab. **20/04/2026**: entrega final de ejecución. • **22/07/2026**: entrega del proceso para revisión Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos Rad Ware del hab. **20/04/2026**: entrega final de ejecución. • **23/07/2026**: entrega del proceso para revisión Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de rayos x convencional – modelo DAX. Apoyo cotización y ejecución del contrato en el hab. **20/04/2026**: entrega final de ejecución. • **24/07/2026**: entrega del proceso para revisión Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a bisturí de segunda (2) colegas del hab. **20/04/2026**: entrega final de ejecución. • **25/07/2026**: entrega del proceso para revisión Adquisición de videolaringoscopio y compresor de pistón para optimización de procesos del hab. **20/04/2026**: entrega final de ejecución. • **26/07/2026**: entrega del proceso para revisión Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a bisturí de segunda (2) colegas del hab. **20/04/2026**: entrega final de ejecución.

	Elaboración de informes técnicos cada vez que los equipos biomédicos de una especialidad, incluyendo la identificación de las fallas y las posibles correctivas implementadas (INV-SIS-HB-002)	Elaboración y entrega del 100 % de los informes técnicos correspondientes a las fallas presentadas durante el periodo. los documentos detallan causa, acciones tomadas y estado final de la intervención	Se elaboró y entregó el 100% de los informes técnicos correspondientes a las fallas presentadas durante el periodo. los documentos detallan causa, acciones tomadas y estado final de la intervención
	Ejecución, revisión y adecuación de los equipos biomédicos de uso hospitalario, de acuerdo al diagnóstico, asegurando su correcto funcionamiento y optimizando su vida útil (INV-CAT-GTB-003)	Adecuada inspección, revisión y adecuación de los equipos biomédicos, de acuerdo a lo establecido	Ejecución del 100 % de las solicitudes de instalación, traslado y adecuación de los equipos biomédicos de uso hospitalario, conforme a la categorización de prioridad y a los tiempos de respuesta establecidos
	Se ejecutó el 100% de los traslados programados bajo criterios de prioridad. Del 26 de marzo al 16 de abril de 2026 no se han realizado solicitudes de traslado de equipos en los servicios hospitalarios activos.	Se dejó constancia del acompañamiento realizado a la inducción del cargo el 03/03/2026 en el auditorio de la universidad cooperativa.	Se dejó constancia del acompañamiento realizado a la inducción del cargo el 03/03/2026 en el auditorio de la universidad cooperativa.
	Capacitación y entrenamiento del personal usuario de los equipos biomédicos de uso hospitalario, asegurando el manejo seguro y eficiente de los equipos (INV-CAT-GTB-004)	Garantizar que el 100 % del personal usuario de los equipos biomédicos de uso hospitalario sea debidamente capacitado y entrenado en el manejo de los mismos, considerando características propias del servicio de salud e inicio de turno y atendiendo la demanda especializada.	Garantizar que el 100 % de las usuarios de los equipos biomédicos sean debidamente capacitados y entrenados en su manejo, conforme con los estándares de calidad y programa documentado de la organización	El objetivo no se cumplió; se programará para otra fecha de junio.

			Se dejó constancia del acompañamiento realizado a la inducción del cargo el 03/03/2026 en el auditorio de la universidad cooperativa. Se deja constancia de la visita realizada a la universidad Antonio Nariño el día 26/03/2026 con la ejecución del proyecto de manejo gestión. Se deja constancia del acompañamiento realizado a la inducción del cargo el 03/03/2026 en el auditorio de la universidad cooperativa. En el cronograma del mantenimiento del mes de abril se programaron 4 ingenieros biomédicos y 1 técnico para la ejecución de los mantenimientos preventivos programados. Se deja constancia del acompañamiento realizado a la inducción del cargo y creación y entrega de credencial de identificación de la empresa de la tecnología biomédica

Controlar y supervisar el cumplimiento del funcionamiento de los equipos biomédicos de uso hospitalario, asegurando su operatividad, seguridad y cumplimiento de los estándares técnicos	Controlar y supervisar el funcionamiento de los equipos biomédicos de los servicios hospitalarios, conforme a las fallas de operación detectadas por el hospital, asegurando su correcto ingreso y seguridad	Garantizar que el 100 % de las fallas de operación de los equipos biomédicos del hospital sean diagnosticadas de manera clara y oportuna, conforme a los procedimientos establecidos, en cada de que el diagnóstico no supere el 20% % se deberá informar y realizar seguimiento al estado de la intervención [INV-SIS-HB-003]	Del 16 de marzo al 16 de abril de 2026. Se garantizó el 100% de cumplimiento en las fallas del Dingo VAL, Hospitalización pediatra y Geriatría de Intervención U.V.I.
Garantizar la disponibilidad del servicio las 24 horas, los 7 días de la semana, con un tiempo máximo de respuesta ante las urgencias, con un tiempo máximo de respuesta presencial de 2 horas	Brindar la disponibilidad del servicio las 24 horas, los 7 días de la semana, con un tiempo máximo de respuesta presencial de 2 horas	Mantener el cronograma anterior de los mantenimientos en el mes de MAR, asegurando que más del 90% sea ejecutado al siguiente mes con una plataforma de solicitudes donde el grupo de soporte es [INV-CAT-GTB-001]	Durante el periodo 16 de marzo al 16 de abril de 2026, la atención fue garantizada por el personal asignado en el turno de disponibilidad para el mes de marzo (24 al 28) se realizó la atención de todas las solicitudes ordenadas.
		Recepción y registro de todas las solicitudes de servicio de equipos biomédicos fuera del horario hábil, asegurando que más del 90% sea ingresado al siguiente turno en una plataforma de solicitudes donde el grupo de soporte es [INV-CAT-GTB-001]	Se cumplió con el registro y ingreso del 100% de las solicitudes recibidas. Durante el periodo de 16 de marzo al 18 de abril de 2026, se gestionaron aproximadamente todos los casos asignados a mi cargo, garantizando la trazabilidad en la plataforma y el cierre de solicitudes
		Restablecimiento del servicio posterior al cierre del mismo dentro del tiempo máximo de 3 horas desde	durante el periodo de 16 de marzo al 18

MANUAL DE ACTIVIDADES GESTION TECNOLOGICA EN SALUD S.A.S

INFORMACIÓN GERENCIA

Se informa que este ítem del apartado "SOPORTES" debe estar debidamente justificado, explicando de manera específica cada actividad realiza de por periodo, las se aceptadas evidencias generales o respectivas. La justificación debe distinto complementar la ejecutado y consignado en forma clara y que no sea lo mismo como soporte.

En caso de que la información presentada no corresponda, sea incompleta o no esté debidamente justificada, el GESTIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD S.A.S. se reserva el derecho de tomar las medidas correspondientes por el incumplimiento de la seguridad establecida.


INGENIEROS BIOMÉDICOS			
ACTIVIDADES CONTRATADAS	PRODUCTO	CALIDAD Y MANDATORIO	SOPORTES
Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos hospitalarios según el plan de mantenimiento programado entregado con el cronograma [INV-SIS-HB-004]	Garantizar que los equipos biomédicos de uso hospitalario se mantengan en óptimas condiciones de funcionamiento durante todo el periodo de operación del contrato	Garantizar el funcionamiento óptimo y continuo de los equipos biomédicos de uso hospitalario	En el periodo comprendido del 16 de marzo al 16 de abril de 2026, se reporta el cierre del ciclo de mantenimientos de MARZO, con la ejecución de los 10 equipos que se encontraban pendientes, alcanzando así un cumplimiento del 100% para dicho mes. Se reporta al mes de ABRIL se reportan un avance de 9 de las 19 mantenimientos programados (47% de cumplimiento a la fecha). Se adjuntan los protocolos debidamente firmados por los jefes de servicio, los cuales poseen los.

		la notificación de la falla.	de abril MANTENIMIENTO GARANTIA la disponibilidad y el cumplimiento del mantenimiento asignado durante del tiempo. No se presentaron novedades ni inconvenientes en los tiempos de respuesta.
		Evaluar y corregir las fallas reportadas, documentando las acciones realizadas e los repuestos utilizados, garantizando la operatividad continua de equipo	Durante el periodo de 16 de marzo al 16 de abril de 2026 Se cumplió con la entrega de protocolos de mantenimientos correctivos.
		Elaborar informe técnico de cada intervención, estableciendo fecha de la falla, relación aplicada y tiempo de respuesta, para seguimiento y mejora continua [INV-SIS-HB-002]	Se cumplió con el formato SIS-SPI-DA-002, debidamente creado, validado y cargado de respuesta de cada falla.
		Reportar y documentar cualquier caso en el que no se cumpla el tiempo de respuesta de 3 horas, analizando la causa y las acciones tomadas al respecto/acciones	No aplica.

		Ejecución total y oportuna del plan de mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos de uso hospitalario, conforme al cronograma establecido en el plan de mantenimiento hospitalario anual.	Se cumplió con el 47% del plan de ABRIL (9 de 19 equipos) Se entregan protocolos de: HOSPITALIZACION PEDIATRIA (1 lampara de pedestal, 1 monitor de signos vitales, 1 aspirador de vacio, 1 tensiómetro aneroide, 1 termohigrometro); CIRUGIA PEDIATRICA (1 aspirador de vacio, 1 termohigrometro)
		Evaluación técnica de los mantenimientos correctivos de los equipos biomédicos, conforme a la categorización de prioridad y a los tiempos de respuesta establecidos	Se ejecutó el 100% de los mantenimientos correctivos del periodo, cumpliendo con los tiempos de respuesta y protocolos establecidos.
	Solicitud oportuna y documentación de los repuestos y/o materiales necesarios para la ejecución de fallas en los equipos biomédicos de uso hospitalario	Registro y seguimiento del 100 % de las solicitudes al mismo día en que se presentan el daño o la falla del equipo.	Se gestionaron el 100% (12 de 12) de las solicitudes de falta el mismo día de su reporte. La atención inmediata reporta en la planilla de control de solicitudes de repuestos Presupuestales


MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MARZO 16 – 31 DE 2026

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA				
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM 10M	A28-0-9817916	CIRUGÍA PEDIÁTRICA

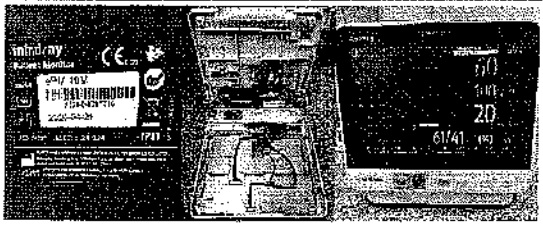

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MARZO 16 – 31 DE 2026

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA				
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN
ELECTROBISTURI	MINDRAY	ES-60	CN-00215851	HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA

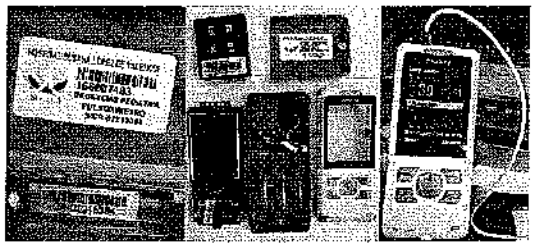


MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MARZO 16 – 31 DE 2026

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA				
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12	EV-B1815505	CIRUGÍA PEDIÁTRICA




MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MARZO 16 – 31 DE 2026

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA				
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN
REGULADOR DE VACÍO	GENTEC	3GVL2 2CH-C	01LV0018E0720	HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA

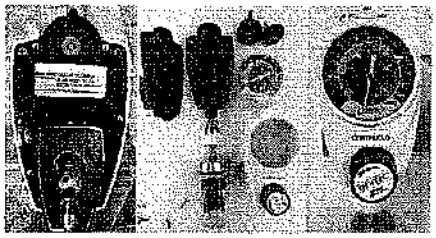


MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MARZO 16 – 31 DE 2026

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA				
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12	EV-B1811490	CIRUGÍA PEDIÁTRICA

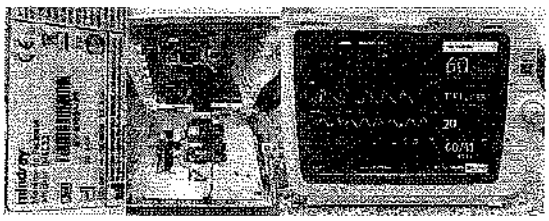

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MARZO 16 – 31 DE 2026


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA				
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN
BOMBA DE INFUSIÓN	BD	BD ALARIS PCU	2023-US-0007-0CD	CIRUGÍA PEDIÁTRICA

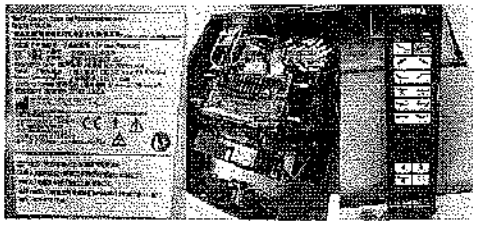

GESTIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD SAS

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MARZO 16 - 31 DE 2026


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA				
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN
TERMÓMETRO CLÍNICO	WELCH	05J-A1A5	1140/0054GS1A	CIRUGÍA PEDIÁTRICA

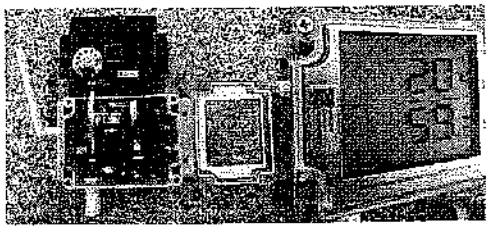

GESTIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD SAS

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MARZO 16 - 31 DE 2026


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA				
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN
MONITOR DE SIGNOS VITALES	GARDER	VISTA 1205	1125910716	CIRUGÍA PEDIÁTRICA

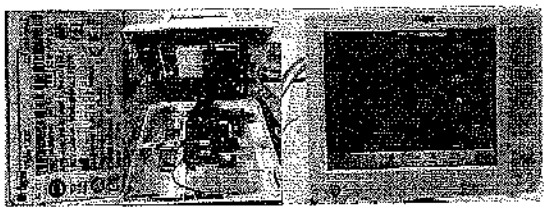

GESTIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD SAS

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS ABRIL 1 - 15 DE 2026


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA				
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN
LARINGOSCOPIO PEDIATRICO	WELCH ALLYN	69814	001320943501J8	HOSPITALIZACIÓN PEDIATRIA

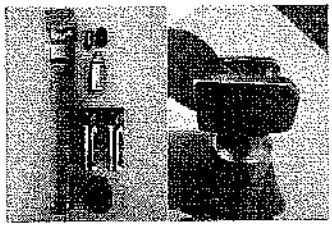

GESTIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD SAS

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MARZO 16 - 31 DE 2026


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA				
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN
REGULADOR DE VACIO	ANVEZ	CGA	CGA0010965	CIRUGÍA PEDIÁTRICA

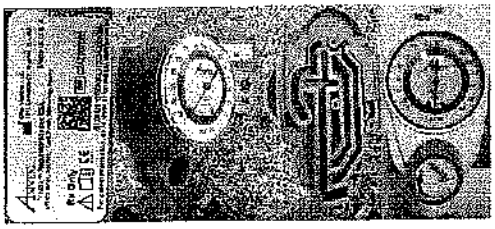

GESTIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD SAS

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS ABRIL 1 - 15 DE 2026


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA				
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN
MONITOR DE SIGNOS VITALES	M MEDY	EPM 10	ACC-01-0006 F1	HOSPITALIZACIÓN PEDIATRIA

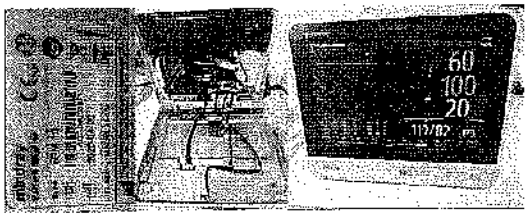

GESTIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD SAS


MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MARZO 16 - 31 DE 2026

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA				
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN
TERMÓMETRO CLÍNICO	WELCH	05J-A1A5	1140/0054GS1A	CIRUGÍA PEDIÁTRICA

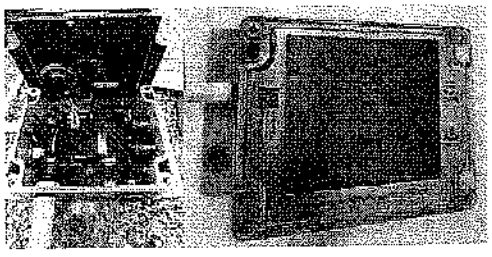


GESTIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD SAS

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA				
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN
REGULADOR DE VACIO	AMVEX	CPA	CZA2000845	CIRUGIA PEDIATRICA

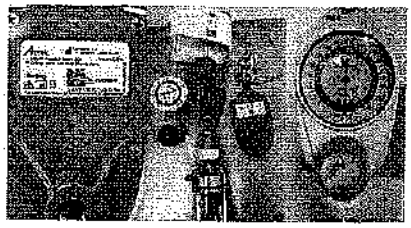


GESTIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD SAS

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA				
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN
TENSIOMETRO ARTERIAL	RIESTER	ESFIGMOMANO	210142031	HOSPITALIZACION PEDIATRIA

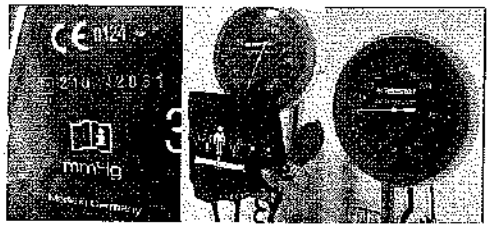


GESTIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD SAS

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA				
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN
TENSIOMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	4200-B-MX	201GMT10516	CIRUGIA PEDIATRICA

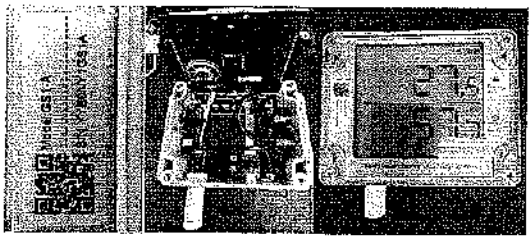


GESTIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD SAS

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA				
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN
TERMOMETRO DIGITAL	IRB	HTC-2	20240909-33	HOSPITALIZACION PEDIATRIA

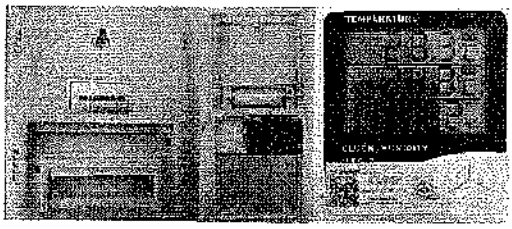


GESTIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD SAS

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA				
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN
ESFIGMOMANOMETRO	WELCH ALLYN	4200-B-MX	201GMT10514	CIRUGIA PEDIATRICA

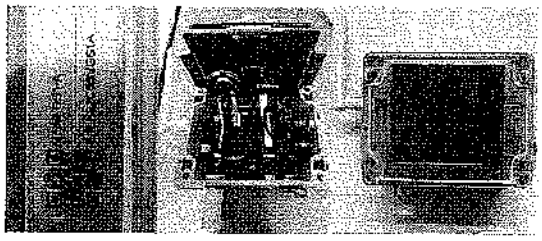

GESTIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD SAS

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA				
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN
TERMOMETRO	N/A	HTC-2	20240913-5	HOSPITALIZACION PEDIATRIA

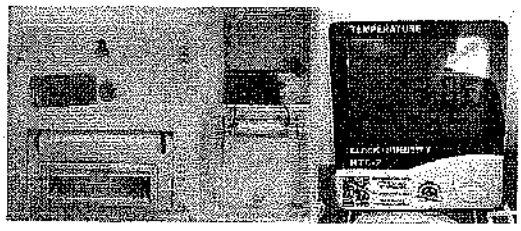


			Instalaciones del Departamento (SEGUNDO PERIODO MARZO 2026) ▸ 1 TERMOHIGROMETRO ▸ 1 TERMOMETRO DIGITAL UCI ADULTOS (SALIDA DEL PERIODO ABRIL 2026) ▸ 5 MONITORES DE SIGNOS ▸ 5 DOPPLER FETAL ▸ 5 MONITOR FETAL ▸ 2 REGULADORES DE VACIO UCI INTERMEDIOS ADULTOS (SALIDA DEL PERIODO ABRIL 2026) ▸ 4 MONITORES DE SIGNOS ▸ 2 REGULADOR DE VACIO ▸ 1 TERMOHIGROMETRO ENDOSCOPIA (PRIMER PERIODO ABRIL 2026) ▸ 2 MONITOR DE SIGNOS ▸ 1 REGULADOR DE VACIO ▸ 1 LARINGOSCOPIO ADULTO IMÁGENES DIAGNOSTICAS (PRIMER PERIODO ABRIL 2026) ▸ 1 DOPPLER ▸ 1 RATOS Y FORFATIL

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS ABRIL 2026

EQUIPO 35

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN
TERMOHIGROMETRO	HTC	AZ	20120813-6	CONSULTA PEDIATRICA

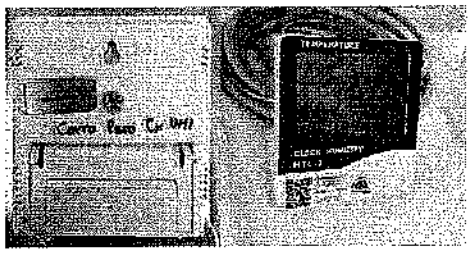

		Ejecución total de los mantenimientos correctivos de los equipos biomédicos, conforme a la asignación de prioridad y a los tiempos de respuesta establecidos	Durante los meses de Marzo (Segundo periodo) y Abril (Primer periodo) se realizan diariamente labores en los servicios con respecto a posibles fallas en los equipos biomédicos, sin embargo, no se presenta la necesidad de realizar el formal mantenimiento correctivo debido a la categorización del daño y la cercanía al inicio de cada periodo.
	Solicitud oportuna y por escrito de los recursos y/o materiales necesarios para la ejecución de fallas en los equipos biomédicos de vital importancia.	Registro y presentación del 100 % de las solicitudes al interior de cada servicio y el daño de la misma.	Durante el segundo periodo del mes de Marzo y primer periodo del mes de Abril se alcanzó el 100% de las solicitudes realizadas por los servicios, los cuales permitieron cumplir (4) equipos biomédicos en estado "fuera de servicio" debido a requerimientos técnicos específicos que no pudieron ser resueltos. EQUIPOS CON LIMITACIÓN TÉCNICA IDENTIFICADA: ▸ **Equipo de rayos X portátil AGFA S/N: 40076: Necesita reemplazo de la tarjeta controladora del sistema debido a la falla en sus condensadores.**

MANUAL DE ACTIVIDADES GESTION TECNOLOGICA EN SALUD S.A.S

INGENIERIA BIOMEDICA

Se informa que cada ítem del apartado "SOPORTES" debe estar debidamente justificado, detallando de manera específica cada actividad desarrollada por servicio. No se aceptan descripciones generales o imprecisas. La justificación debe diligenciarse completamente de forma clara y exacta con lo realizado en no soporte.

En caso de que la información presentada no corresponda, se incumpla con lo aquí debidamente justificado, **GESTIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD S.A.S.** se reserva el derecho de tomar las medidas correspondientes por el incumplimiento de la actividad establecida.

ACTIVIDADES CONTRATADAS	PRODUCTO	CALIDAD Y OPORTUNIDAD	SOPORTES
Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos hospitalarios según el plan de mantenimiento establecido por el Hospital. 2026-341-03-0016	Ejecución de los equipos biomédicos hospitalarios programados en el plan de mantenimiento preventivo del mes de Abril de 2026	Garantizar el funcionamiento seguro y confiable de los equipos biomédicos de uso hospitalario	Para el Segundo periodo del mes de Marzo y el primer periodo del mes de Abril de 2026, se programó el mantenimiento preventivo de 35 equipos biomédicos en los hospitales adscritos en los servicios de UCI ADULTOS, UCI INTERMEDIOS ADULTOS, ENDOSCOPIA Y IMÁGENES DIAGNOSTICAS, de la totalidad de equipos programados se ejecutaron 35 equipos representando el porcentaje del 100% de cumplimiento de esta actividad.

			▸ **Equipo de rayos X portátil Carestream Motion Mobile S/N: HTEN22/055: Requiere instalación y ajuste porque el sistema opera únicamente con un protocolo de conexión (Ethernet).** ▸ **Monitor equipo para signos vitales S/N: 00180: Con pantalla táctil averiada.**
Diligenciar de manera veraz y oportuna los formatos de los equipos biomédicos de los formatos, cumpliendo la normatividad vigente de calidad y las exigencias correctas implementadas (IGN SAS 001)	Entrega de y archivo del 100% de los informes técnicos correspondientes a los servicios (mantenimientos correctivos y preventivos)	Durante el periodo se realizaron reuniones con los encargados de mantenimiento correctivo, en donde se socializo la importancia de diligenciar los formatos de manera correcta y completa, con el fin de evitar inconsistencias en la información registrada.	▸ Reprocesamiento, pérdida de competencias, disponibilidad o reactivos.

		Ejecución total o parcial del plan de mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos de una hospitalización, conforme al cronograma de actividades establecido en el proveedor mensual correspondiente.	Durante el periodo de mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos se realizaron a cabo las siguientes actividades: UCI ADULTOS (SEGUNDO PERIODO MARZO 2026) ▸ 2 MONITOR DE SIGNOS ▸ 5 REGULADORES DE VACIO ▸ 1 UNIDAD DE CAUTERIO ▸ 1 VENTILADOR UCI INTERMEDIOS ADULTOS (SEGUNDO PERIODO MARZO 2026) ▸ 3 MONITOR FETAL ▸ 1 TERMOHIGROMETRO ENDOSCOPIA (SEGUNDO PERIODO MARZO 2026) ▸ 1 MONITOR DE SIGNOS ▸ 1 TERMOHIGROMETRO


			TECNOLOGÍA BIOMÉDICA, se realizó el mantenimiento preventivo a un ventilador mecánico, se entregan a jefe de turno. • Solicitud de revisión de Stryker que atendieron los Ingenieros del servicio de Mantenimiento Hospitalario, se realiza ajustes a la solicitud se realiza equipo, se envía Corrective, se entregan operativos
		Desplazamiento del ingeniero para dar el servicio externo al hospital más de 3 horas después de la notificación de la falla	Se realizan atenciones a Farmacia que requieren el apoyo urgente por las fallas de funcionalidad en los equipos de Impresión los días 20, 22, 23 de Marzo de 2026, se cumple la atención dentro del tiempo establecido para responder la solicitud reportada.
		Evaluar y corregir las fallas reportadas, dentro del tiempo de ocho horas después de la primera visita en sitio de la falla	Para la fecha de el 15 al 23 de Marzo de 2026, fecha que se tiene programada la actividad de disponibilidad, se observa casa solicitud resuelta y cumplida en la fecha reportada, entregando los equipos operativos al servicio

			TECNOLOGÍA BIOMÉDICA, se realiza el mantenimiento de ventilador para quienes queda libre, genera intervención detallada mente. • 21 de Marzo de 2026: Solicitud de mantenimiento preventivo Philips monitor signos del servicio de UCI intermedios, se interviene mantenimiento, se deja en funcionamiento funcional. Solicitud para monitor de Stress que no se encuentra en servicio de Hospitalización UCI, se inspecciona equipo se diagnostica funciona correcta, se pone al Ingeniero del equipo, se solicita autorización para intervenir equipo, se realiza cambio de Transpor, se deja equipo operativo. Solicitud de revisión Sensor Spo2 que no funciona, monitor signos paciente de UCI intermedio, se atiende personal, se encuentra


IMÁGENES DIAGNÓSTICAS MARZO DE 2026 (SEGUNDO PERIODO)

FECHA DE MANTENIMIENTO: 24 DE MARZO DE 2026

1. TERMOHIGROMETRO MARCA OTG51-A1 N/S: H6RK020534 – ECOGRAFIA 2









		Debemos informar técnicamente la inoperancia, por cuanto dentro de la hoja, se tienen ajustado y tiempo de respuesta, caso contrario y grandes quemaduras (ANEXO CD-ROM)	No TECNOLOGISTA de mantenimiento biomédico para los servicios y/o equipos su que los a mi cargo.
		Informar y documentar evidencia/por caso en el que no se cumple el tiempo de respuesta de 3 horas, indicando la causa raíz, acciones correctivas implementadas	Durante la actividad de disponibilidad día de fecha de el 16 al 23 de Marzo de 2026, no dio total cumplimiento en el tiempo de respuesta a cada solicitud en Salud.

NOTA: A continuación, adjuntar evidencia fotográfica sobre el mantenimiento preventivo realizado a los servidores de UCI ADULTOS, UCI INTERMEDIOS ADULTOS, ENDOSCOPIA E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS divididas por cada periodo Marzo (segundo periodo), Abril (primero periodo), Servidores que se encuentra a mi cargo a partir del 24 de Marzo de 2026.

2. TERMOHIGROMETRO DIGITAL NO REGISTRA – TO MORAVIA





MANTENIMIENTO PREVENTIVO MARZO 2026 (SEGUNDO PERIODO)

ENDOSCOPIA MARZO 2026 (SEGUNDO PERIODO)

FECHA DE MANTENIMIENTO: 24 DE MARZO DE 2026

1. MONITOR SIGNOS MARCA: MINDRAY MODEL: IPM 12 SN: 3Q1-30056346 – (OPERACIÓN)









UCI INTERMEDIOS ADULTO MARZO DE 2026 (SEGUNDO PERIODO)

FECHA DE MANTENIMIENTO: 23 DE MARZO DE 2026


1. TERMOHIGROMETRO BIOBELT SN 007 – CAMA 09 PARO









2. TERMOHIGROMETRO NO REGISTRA SIN ALARMAS – SALA PROCEDIMIENTOS









1. REGULADOR DE VACIO ANNEX CGA SN: CGA2001997 – FUERA DE SERVICIO

2. MONITOR FETAL EDAN F3 SN: S0603340N2181261003 – DAÑO DE PANTALLA



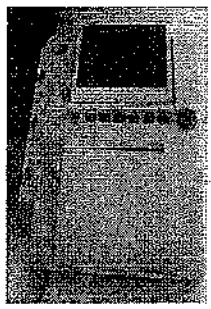

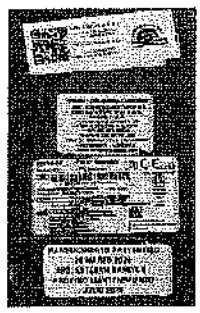3. REGULADOR DE VACIO ANNEX CGA SN: CGA2001997 – FUERA DE SERVICIO






UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS NUEVO DE SOMA (SEGUNDO PISO DO)



FECHA DE MANTENIMIENTO 25 DE MARZO DE 2026

3. MONITOR DE SIGNOS MINDRAY BENEVIEW CSM – LSCD 3-4802246 – CUBICULO 9






4. REGULADOR DE VACIO ANNEX CGA SN: CGA2001999 FUERA DE SERVICIO







5. MONITOR DE SIGNOS MINDRAY BENEVIEW T8 SN: EV-00015559 – TRASLADO DE



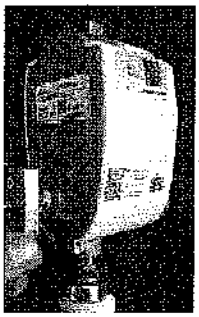


5. REGULADOR DE VACIO AMYEX CIA SN: CIA2006852 – RUTA EN SERVICIO



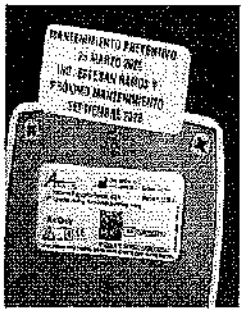

6. REGULADOR DE VACIO AMYEX SN: VNA3044BAP – RUTA EN SERVICIO





IMAGENES DIAGNOSTICAS ABRIL DE 2026 (8 EQUIPOS)


FECHA DE MANTENIMIENTO: 8 DE ABRIL DE 2026


1. RECORRAFO PHILIPS AFINITY 30 SN: US75102068 – CIRUGIA ADULTOS






7. VISUALIZADOR VITALVIEWER PUESTO SN: M2010-00010000008 – CUARTO DE EQUIPOS

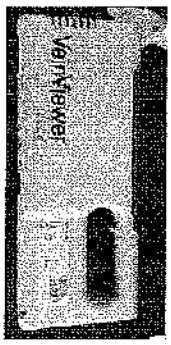

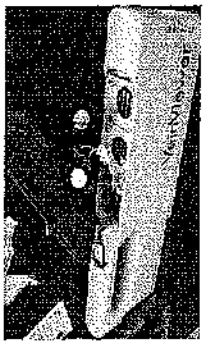



2. RATOS X PORTATIL SI ENDOS POLYVIOS II SN: S5306 – RUTA EN SERVICIOS






8. UNIDAD DE CALENTAMIENTO NELCOR WARMTOUCH SN: E0005N: SP0005B






UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS ADULTOS ABRIL DE 2026 (PRIMER PERIODO)

GESTIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD SAS

FECHA DE MANTENIMIENTO: 9 DE ABRIL DE 2026

1. MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMPRESORA CSM-1502 SN: 02333 – CUBÍCULO 28

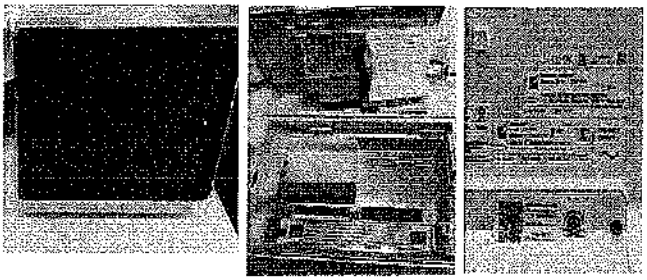


UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS ADULTOS ABRIL DE 2026 (PRIMER PERIODO)

GESTIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD SAS

FECHA DE MANTENIMIENTO: 9 DE ABRIL DE 2026

1. SUPERGOSCOPIO ADULTO WELCH ALLYN 69813 AF: 166001362 – SALA DE PROCEDIMIENTOS

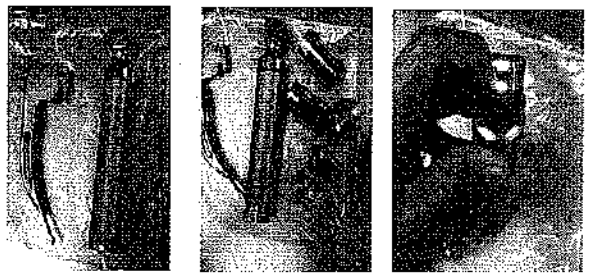


2. MONITOR DE SIGNOS MINDRAY IMPRESORA CSM-1502 SN: 03032 – CUBÍCULO 33

GESTIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD SAS



2. MONITOR DE SIGNOS MINDRAY IMPRESORA CSM-1502 SN: 03032 – CUBÍCULO 33

GESTIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD SAS

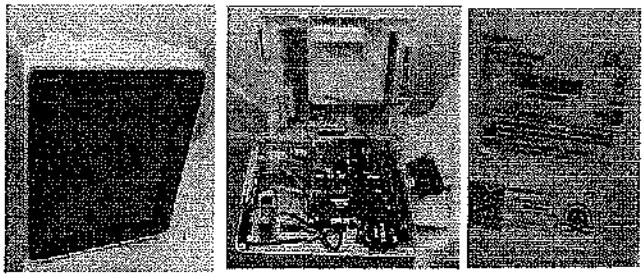


3. MONITOR DE SIGNOS MINDRAY IMPRESORA CSM-1502 SN: 02622 – CUBÍCULO 37

GESTIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD SAS



3. REGULADOR DE VACIO ANWEL CHAZNI CHACCOMB – SALA DE PROCEDIMIENTOS


GESTIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD SAS

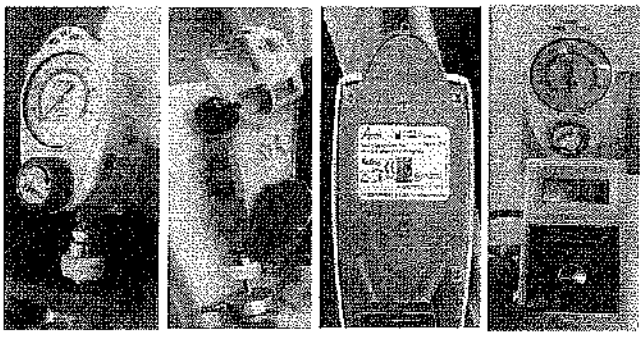

(VIGILANCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS ABRIL DE 2026 (PRIMER PERIODO)


FECHA DE MANTENIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 2026

3. MONITOR DE SIGNOS MINDRAY IMPRESORA CSM-1502 SN: 01673 – CUBICULO 9

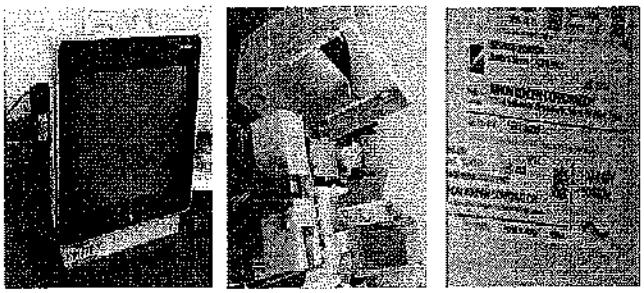


FECHA DE MANTENIMIENTO: 13 DE ABRIL DE 2026

4. MONITOR DE SIGNOS MINDRAY IMPRESORA CSM-1502 SN: 02543 – CUBICULO 02

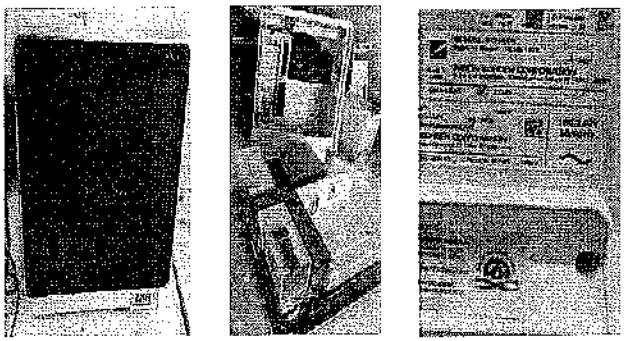


FECHA DE MANTENIMIENTO: 13 DE ABRIL DE 2026

2. MONITOR SIGNOS MINDRAY IMPRESORA CSM-1502 SN: 01673 – CUBICULO 12

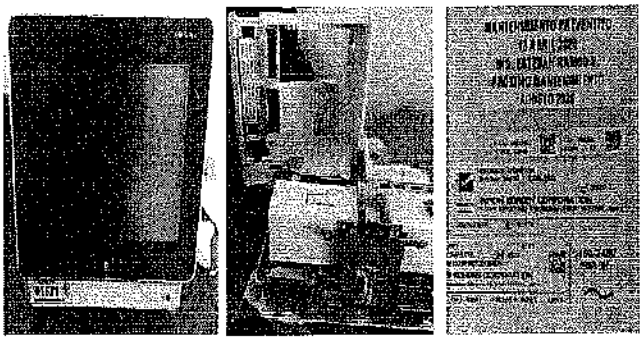


FECHA DE MANTENIMIENTO: 10 DE ABRIL DE 2026

5. TERMOHIGROMETRO NO REGISTRA SN; ALM 008 – CUARTO DE INSUMOS

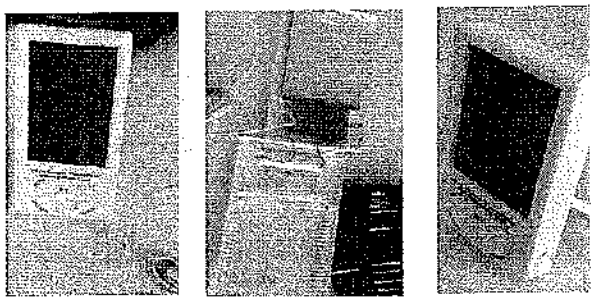



3. MONITOR DE SIGNOS MINDRAY IMPRESORA CSM-1502 SN: 01670 – CUBICULO 23

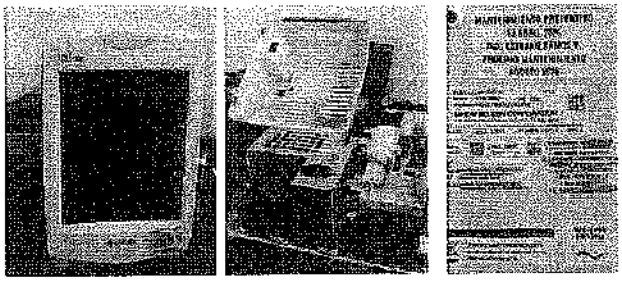



FECHA DE MANTENIMIENTO: 16 DE ABRIL DE 2026


6. INSTALADOR DE VACIO AMVEX CZA CZA1500221 – ALTA EN SERVICIO

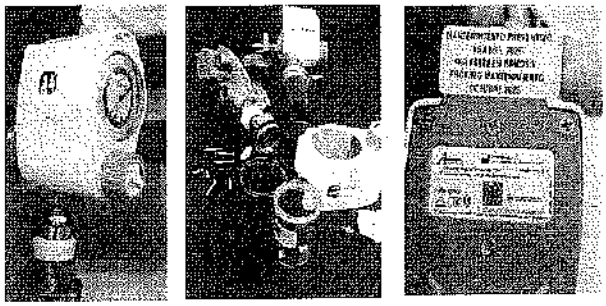


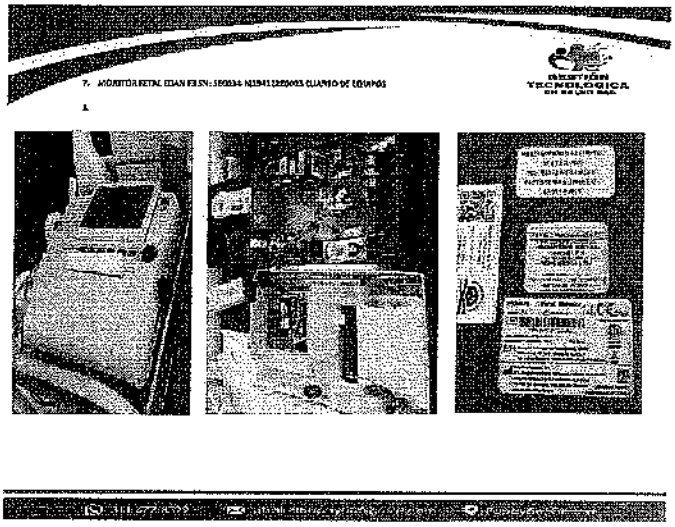

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

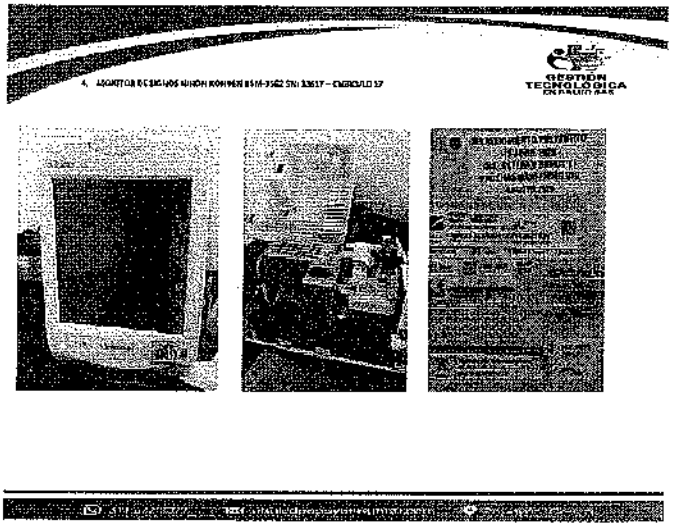
GESTIÓN
TECNOLÓGICA

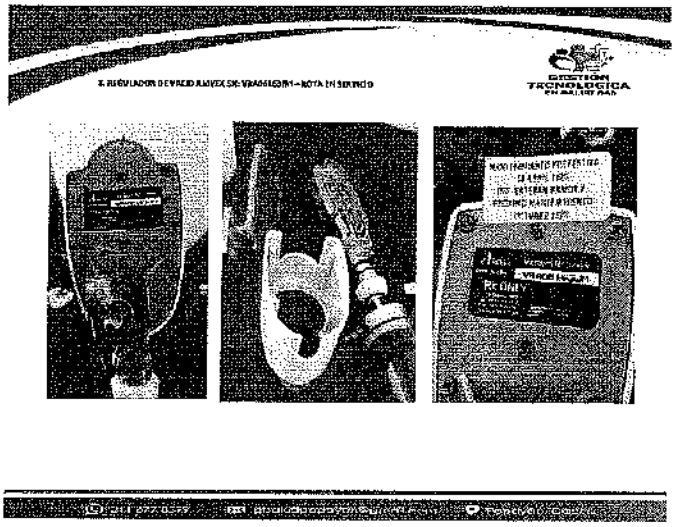
GESTIÓN
TECNOLÓGICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
15 ABRIL 2025
NO ESTEBAN MALOS Y
PRODUJIN MANTENIMIENTO
OCTUBRE 2025

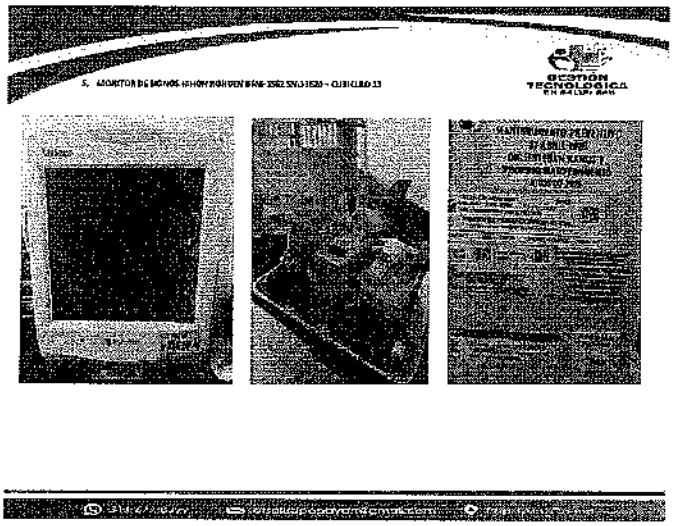
GESTIÓN
TECNOLÓGICA

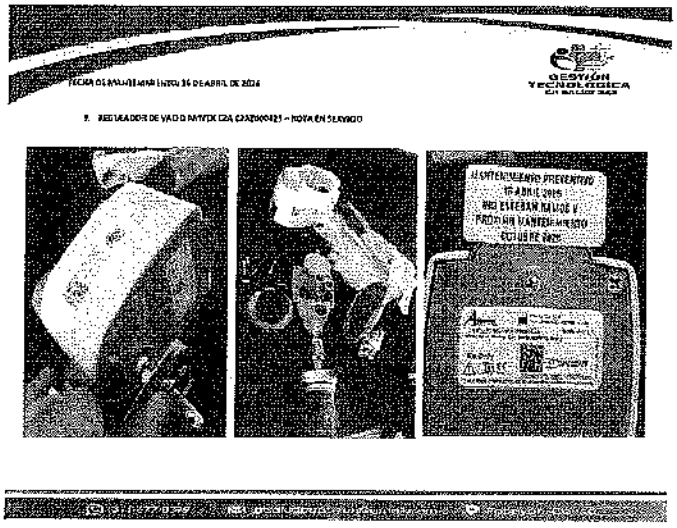
GESTIÓN
TECNOLÓGICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
15 ABRIL 2025
NO ESTEBAN MALOS Y
PRODUJIN MANTENIMIENTO
OCTUBRE 2025

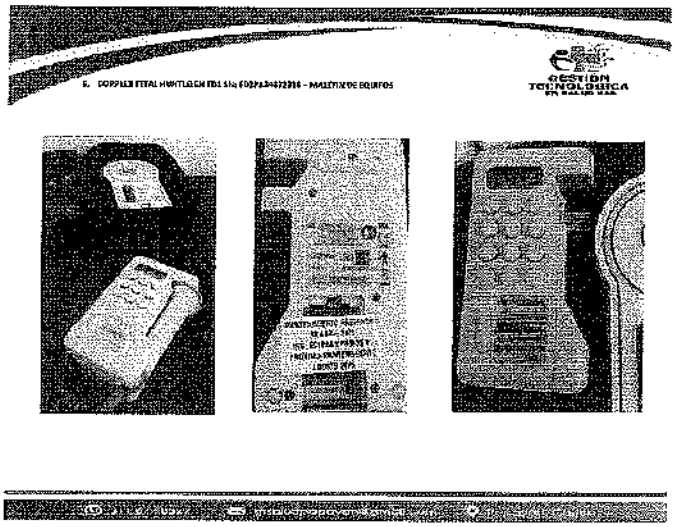
GESTIÓN
TECNOLÓGICA

Capacitación y entrenamiento del personal usuario de los equipos biomédicos en el uso adecuado, seguro y eficiente de los equipos. [INVIMA 2013 M83]	Garantizar que el 100 % del personal usuario de los equipos biomédicos en uso hospitalario sea debidamente capacitado y entrenado en su manejo, de tal manera que se cumpla con la totalidad de las actividades de formación programadas	Garantizar que el 100 % de los usuarios de los equipos biomédicos estén debidamente capacitados y entrenados en el uso adecuado, seguro y eficiente de los mismos, registrando esta información en los soportes de evidencia documentada establecidos	No aplica ya que el 100% de las capacitaciones se realizó en meses posteriores.
Controlar y supervisar periódicamente el funcionamiento de los equipos biomédicos de uso hospitalario, adoptando las acciones correctivas y preventivas a que haya lugar, para garantizar su correcto desempeño	Controlar y supervisar diariamente el funcionamiento de los equipos biomédicos de uso hospitalario, garantizando su disponibilidad, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas	Garantizar que el 100 % de las listas de chequeo de los equipos biomédicos del hospital sean diligenciadas de manera clara y completa, conforme a los procedimientos establecidos, en caso de que el diligenciamiento sea incorrecto se deberá informar y capacitar oportunamente al área o de la unidad [INVIMA 2013 M71]	Del 16 marzo al 17 abril de 2026 se garantiza el 100% de las listas de chequeo de los siguientes servicios: Cirugía Adultos, Laboratorio Clínico y Central de Esterilización Adultos. Donde se evidencia los soportes, sus cantidades y observaciones dentro de registro novedades
		Mantener el cronograma actual de los siguientes mantenimientos de la marca 3M, asegurando idóneo y continuo del servicio.	Durante el periodo de marzo 16 hasta el 17 abril según el cronograma, no se corresponde realizar el mantenimiento
		Las pruebas y seguridad de todos los accesorios de equipos biomédicos (cero del hospital incluye), asegurando que cada una sea asignada al ingeniero de forma tal que en periodo no se cruce las pruebas y mantenimientos [INVIMA 2013 M71]	Se cumple y se alinean las actividades correspondientes con el funcionamiento de la tecnología biomédica
		Desplazamiento del ingeniero durante el tiempo de la atención (ida y vuelta).	Durante el periodo de marzo 16 hasta el 17 abril según el cronograma, no se corresponde realizar desplazamiento

NOTA: Como observación, algunos de los equipos a los que se les realizo mantenimiento preventivo en el periodo del mes de abril de 2026 que en las fotos no se evidencia el respectivo sticker de mantenimiento por motivo de Anestesia en el momento en el cual pasó para la obtención de las fotos, a la fecha todos los equipos ya cuentan con dicho sticker de mantenimiento preventivo de mayo (segunda semana) y Abril (primer periodo) de 2026 ya evertido con sus respectivos stickers de mantenimiento.

		Realizar y entregar los soportes de mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos a los responsables de cada área (enfermeras jefes), dentro de los 5 días hábiles siguientes a la ejecución [INVIMA 2013 M71]	Se cumple y se entrega los soportes de mantenimiento preventivo a los responsables de cada área
		Mantener y documentar cualquier falla en el que no se cumpla el tiempo de respuesta de 3 horas, incluyendo la causa y las acciones correctivas implementadas	No Aplica

MANUAL DE ACTIVIDADES GESTION TECNOLOGICA EN SALUD S.A.S

MANTENIMIENTO BIOMÉDICA

Se informa que cada ítem del apartado "**SOPORTES**" debe ser claramente legible, fechado de manera específica cada actividad realizada por cantidad no se aceptarán observaciones generales y/o imprecisas. La falta de cualquiera de los datos mínimos comprometerá la ejecución y cobrado de forma oficial y acorde con la información como soporte.


En caso de que la información presentada sea incompleta o no esté debidamente justificada, gestión tecnológica EN SALUD S.A.S. se reserva el derecho de tomar las medidas correspondientes por el incumplimiento de lo aquí establecido.

ACTIVIDADES CONTRACTUALES	PRODUCTO	NAGNEDIOS BIOMÉDICOS CRONOGRAMA	SOPORTES
Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos hospitalarios según el plan de mantenimiento establecido para el año [INVIMA 2013 M71]	Realizar que los equipos biomédicos de uso hospitalario se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento durante todo el periodo de ejecución del contrato	Garantizar el funcionamiento óptimo y seguro de los equipos biomédicos en el hospitalario	Se garantiza el funcionamiento óptimo y continuo de los equipos biomédicos de uso hospitalario de los servicios Cirugía Adultos, Laboratorio clínico y Central de esterilización Adultos.
		Ejecución total y específica del plan de mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos de acuerdo a lo establecido en el cronograma de actividades establecido en el primer trimestre contractual vigente.	Se realiza ejecución total y oportuna de una cantidad de 15 mantenimientos preventivos para Cirugía Adultos y Central de esterilización Adultos del 16 marzo hasta el 17 de abril 2026. Electrobisturí: 1 Estimulador de nervios: 3 Lámpara Quirúrgica: 1 Agitador Magnético: 3 Agitador Pequeño: 2 Autoclaves: 1

FOTOGRAFIAS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MARZO 16 AL 17 ABRIL 2026


Cirugía Adultos

- Monitor signos vitales, Drager, Vista 120 s, S2SNF0382

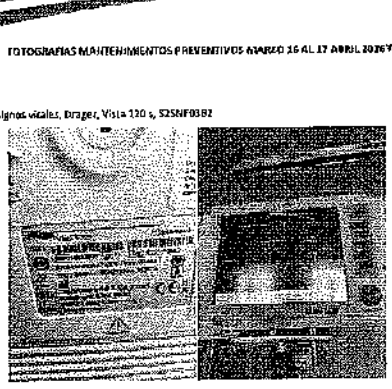


			Monitor signos vitales: 3 Termoregulador (bomba): 3 Reguladores de vacío: 3 Electrobisturí: 1 Hemoglobinómetro: 4 Termoselladora: 2
		Ejecución total de los mantenimientos correctivos de los equipos biomédicos, conforme a la categorización de prioridad y a los tiempos de respuesta establecidos	Se presentaron mantenimientos correctivos, se garantiza el buen funcionamiento de la tecnología biomédica
	Solicitud oportuna y por escrito de los recursos y personales requeridos para la ejecución de fallas en los equipos biomédicos de uso hospitalario	Registro y presentación del 100 % de las solicitudes de recursos ante el proveedor, el cual debe ser de fecha del reporte	Se reportan un total de 17 no creado, las cuales se atendida y se da su respectiva respuesta, cumpliendo con el 100% desde 16 marzo hasta 17 abril 2026
	Elaboración de informes técnicos sobre las fallas de los equipos biomédicos de uso hospitalario, posterior a la intervención, así como y las acciones correctivas [INVIMA 2013 M71]	Elaboración y entrega del 100 % de los informes técnicos correspondientes a las fallas de los equipos biomédicos en los tres meses	No se presentaron mantenimientos correctivos, se garantiza el buen funcionamiento de la tecnología biomédica.
Ejecución, control y seguimiento de los equipos biomédicos de uso hospitalario, preparando su correcto funcionamiento y previniendo que los existentes fallen y [INVIMA 2013 M71]	Adquirir materiales usados y actualización de los equipos biomédicos de uso hospitalario	Ejecución del 100 % de los mantenimientos de actualización, traslado y adquisición de los equipos biomédicos de uso hospitalario, conforme a la categorización de prioridad y a los tiempos de respuesta establecidos	Se realizan un total de 12 traslados de equipos entre ellos: monitor signos vitales y electrocirugía (bisturí) el por el mantenimiento encuentra funcionando en el periodo al que pertenecen


- Monitor signos vitales, Mindray, MEC 1200, CC-09115160

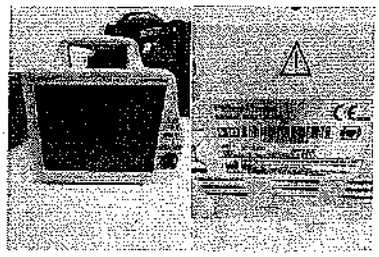




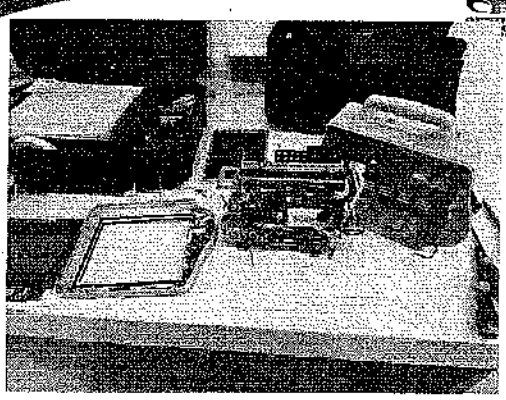

- Monitor signos vitales, Mindray, IMEC 12, EV-81034489

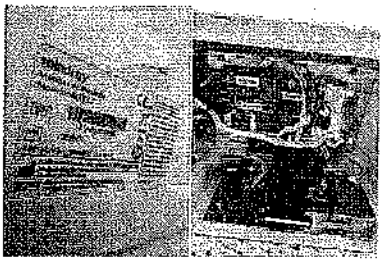


- Monitor signos vitales, Tribon Kohden, 15124

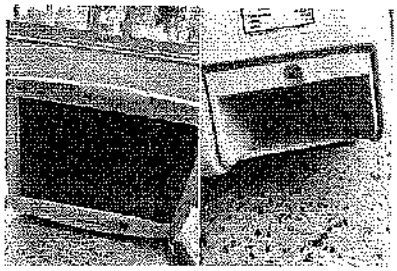






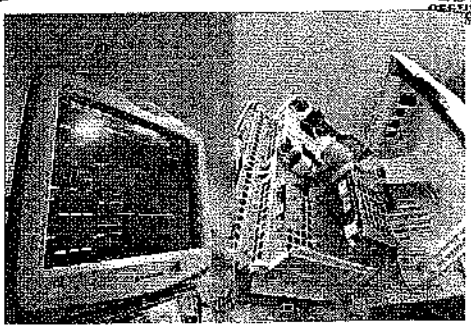


- Regulador de vacío, Anvex, C2A, C2AZ000846



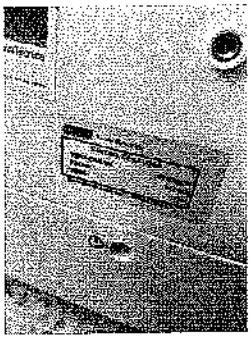






- Regulador de vacío, Anvex, C2A, C2AY000932

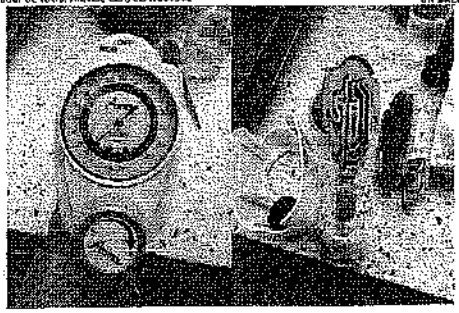


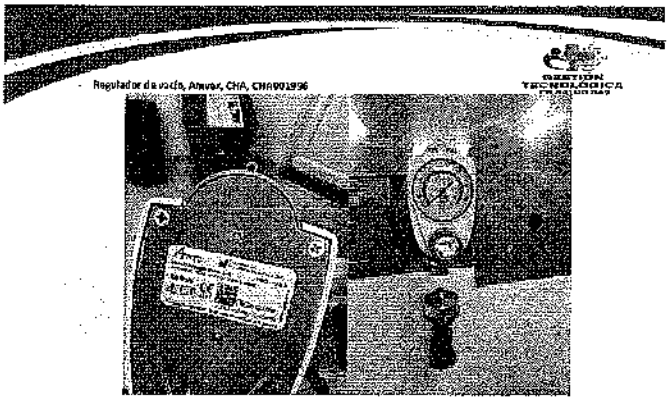



Regulador de vacío, Ahwar, CHA, CHA901996

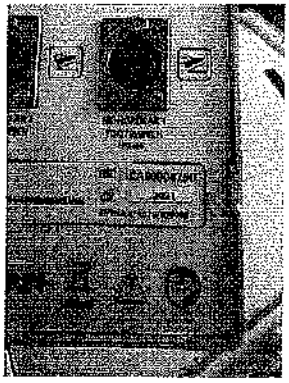


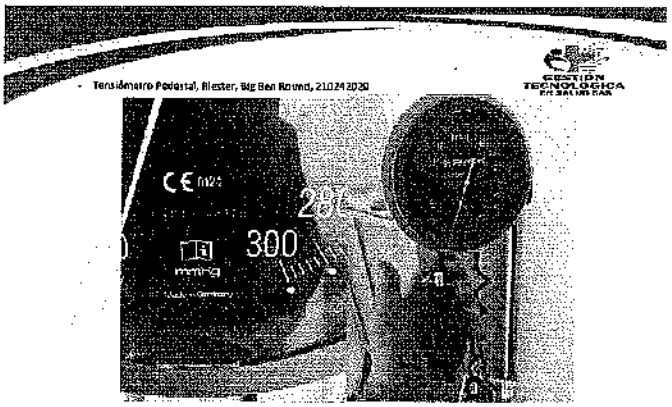
Tensiómetro Pedestal, Riester, Big Ben Round, 21024 2020
300

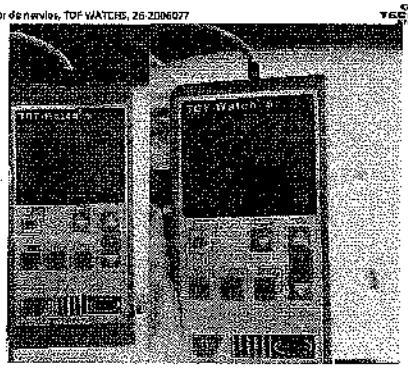

Estimulador de nervios, TOF WATCH S, 26-2006077



Electrobisturí, WEM, SS501SX, CHE0004760

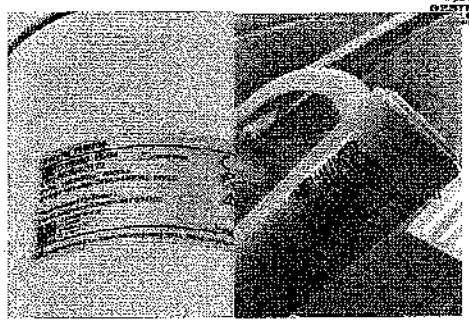


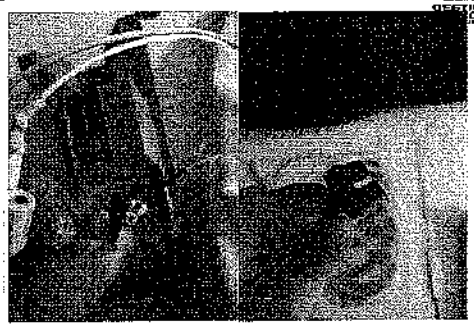


Monitor signos vitales, Dragar, Vista 120s, S2SNP0723

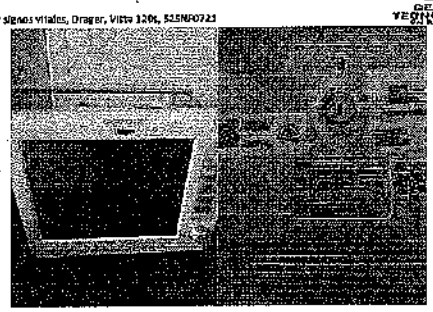

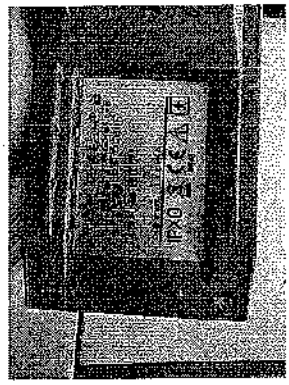


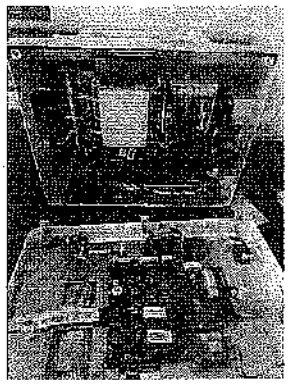


Lámpara Cialítica, Polaris 100, ASRH-0114/ASRH-0098/ASRH-0372

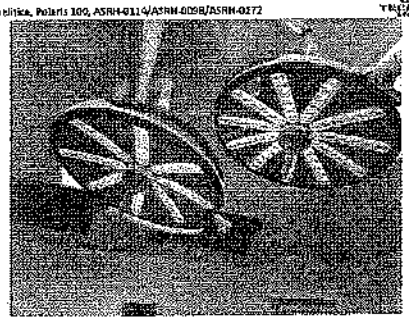



- Monitor signos vitales, Mindray, iMEC 12, EV-81034491

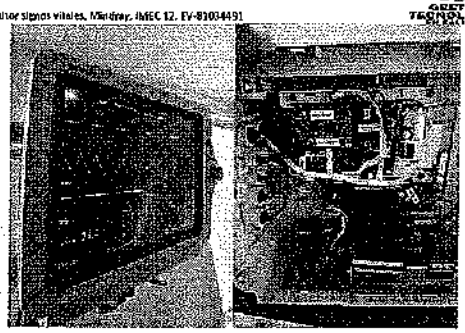

- Monitor signos vitales, Mindray, BPM 10, AC7-04009215

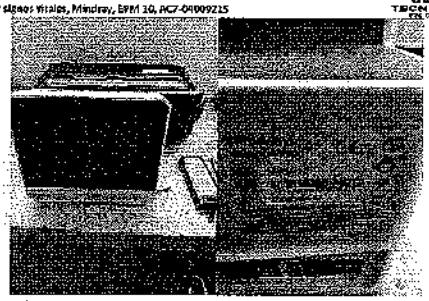

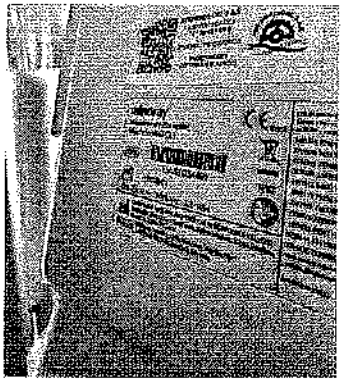


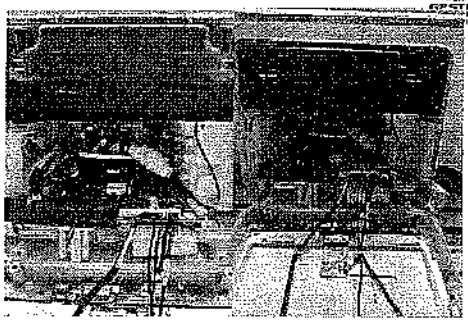

FOTOGRAFIAS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MARZO 16 AL 17 ABRIL 2026

Laboratorio Clínica


- Termómetro, Digital Thermometer

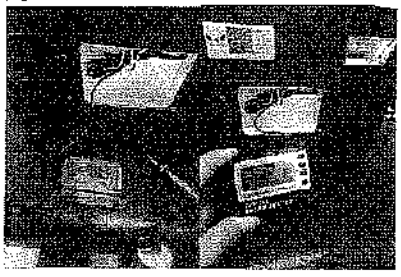



- Termohigrómetro Biotems, HL2



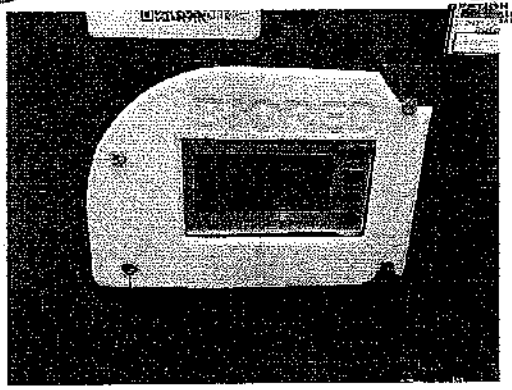





- Termohigrómetro, KTJ, TA318, 3061TH



- Termómetro, Fridge/Freezer, SEROTI

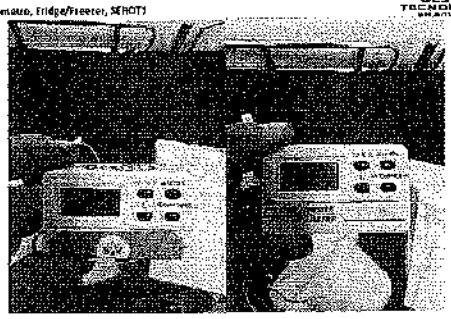



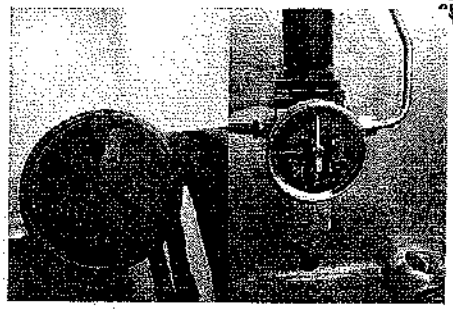






- Termómetro, KEK GERMANY, RT-803E, N/A2




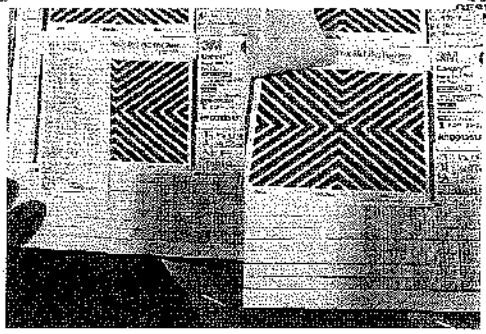



Central Esterilización Adultos


- Autoclave, Promed, MSG.B (450 L), MS12003055



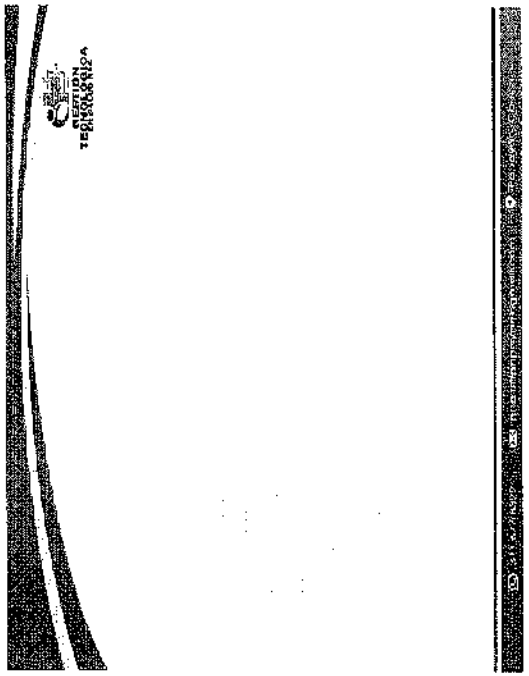

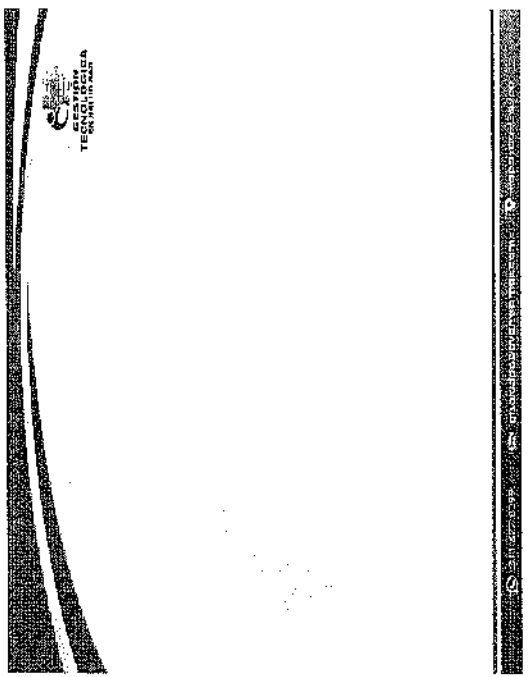

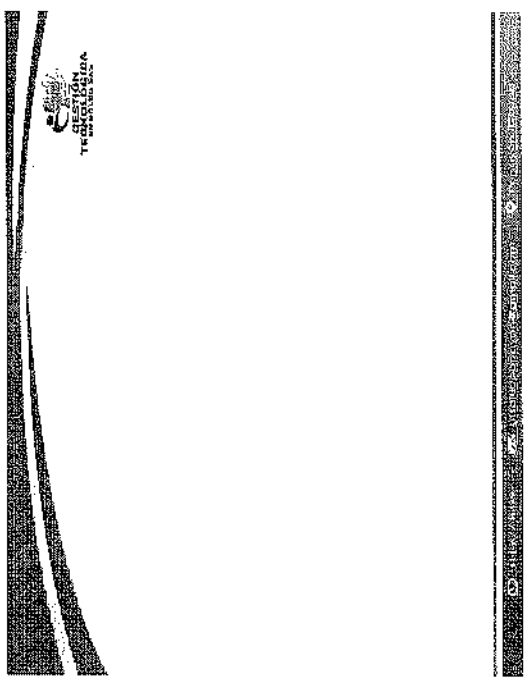

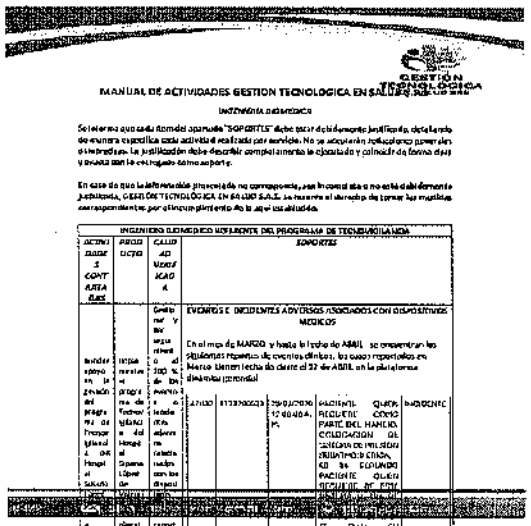

MANUAL DE ACTIVIDADES GESTION TECNOLOGICA EN SALUD S.A.S.

INSTRUCCIÓN DIARIO MEDICO

Se informa que cada día del apartado "SOPORTES" debe estar debidamente justificado, de la lado de cruzar específica esta actividad realizada por servicio. No se aceptarán reiteradas generalidades. La justificación debe describir completamente la ejecución y colección de forma clara y exacta con la evidencia como soporte.

En caso de que la información proporcionada no corresponda, sea incompleta o no esté debidamente justificada, GESTIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD S.A.S. se reserva el derecho de formular las medidas correspondientes, por el incumplimiento de la siguiente actividad.

INGENIERO BIOMÉDICO RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE TECNOVIGILANCIA							
ACTIVIDADES CONTRACTUALES	PERIODICIDAD	CALIFICACIÓN MENSUAL	SOPORTES				
Brindar apoyo en la gestión del programa de Tecnovigilancia del Hospital Local del Sur	Informe mensual del programa de Tecnovigilancia del Hospital Local del Sur	Cumplir y dar seguimiento al 100 % de los puntos establecidos en el plan de trabajo	EVENTOS E INCIDENTES ADVERSOS ASOCIADOS CON DISPOSITIVOS MEDICOS En el mes de MARZO y hasta la fecha de ABRIL se presentaron los siguientes reportes de eventos clínicos, los cuales reportados en Merlin Elementos fecha de corte el 27 de ABRIL en la plataforma diseñada para tal				
			47100	811300023	29/02/2024 12:00:00 A. M.	PACIENTE QUIEN REQUIERE DE MANEJO CON SONDA DE INTUBACION SELECTIVA DERECHA, SOLICITA SE REALICE CAMBIO DE SONDA DE INTUBACION SELECTIVA DERECHA, ES EL SEGUNDO PACIENTE QUIEN REQUIERE DE ESTE	INCIDENTE
e CAL, contribuir a la identificación, registr	Reportar mensualmente las actividades realizadas en el	Reportar en Elmin del aplicativo o quejas las				EL CUAL EN NUMEROSAS PRUEBAS CON LA PARTE ADMINISTRATIVA SE CONCIENTO QUE TENEMOS DIFICULTAD CON	

a cabo el registro y análisis de eventos adversos a causa de riesgos reales con los cuales trabaja la empresa	reportar y analizar todos los registros que genera el programa de tecnovigilancia	otro resultado durante el periodo, asegurando el seguimiento y cumplimiento a las					
			47100	811430203	29/02/2024 12:00:00 A. m.	PACIENTE QUIEN REQUIERE DE MANEJO CON SONDA DE INTUBACION SELECTIVA DERECHA, DEBIDO HACE MAS DE 8 MESES SE HA REPORTADO QUE NO HAY UN ADECUADO SISTEMA PARA SOPORTAR EL MANEJO EN CON EL OPTIMO CONFIRMANDO POR EL HOSPITAL QUE ES TEMPORAL	INCIDENTE	OTRO INAPROPIADO PARA EL PROCEDIMIENTO
			47705	811430203	29/02/2024 12:00:00 A. m.	EN TORNO DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN AREA DE SEMANA DE HOSPITALIZACION SE ADQUIERE PAPAS, UN BARQUILLA ACTIVA, SE EVIDENCIA AMBIENTE CON ACTIVA UNO INDICADO OCHO TERAPIA QUE SE ENCUENTRA NO FUNCIONAL DESTINANDOSE EL EQUIPO ANALIZADO, Y SEGÚN REPORTE DE LA JEFE DE TURNO	INCIDENTE	TROTINAL FUNCIONAMIENTO SIN IDENTIFICAR
						SITUACION QUE NUMEROSAS INTERRUPCION DEL TRATAMIENTO, HECHO PARA LA EVOLUCION DE LA NOCHE Y DEPENDIENDO	

						LA SEGURIDAD DEL PACIENTE.	
			45016	2424681	29/02/2024 12:00:00 A. M.	PINZAS DE LAPAROSCOPIA FALLANDO. INTIGALES DE 10 Y DE 10MM CON TRATAMIENTOS. NUEVA MONTADA CONTINUAL LO QUE SOLICITA SU MANTENIMIENTO.	INCIDENTE
			32637	1800075302	29/02/2024 12:00:00 A. M.	PINZAS DE LAPAROSCOPIA FALLANDO. DESCARGO DE 10 Y DE LAPAROSCOPIA REQUITAMIES. NUEVA MONTADA CONTINUAL LO QUE SOLICITA SU MANTENIMIENTO.	INCIDENTE
			47041	1905465317	29/02/2024 12:00:00 A. M.	SE VERIFICA EL SIGUIENTE REPORTE DEBIDO A QUE EL PACIENTE ACUDIRA PARA SU TRATAMIENTO DEL MISMO REALIZAN RELACIONES CON GALLANTE HECHO QUE NO CUENTA A LA INTERCONSULTA HOSPITALARIA, PERO ENFOQUE EL	INCIDENTE
			45016	2424681	29/02/2024 12:00:00 A. M.	REPORTA DE INCIDENTE SUCEDIDO EL PACIENTE EL DIA SUCEDIO QUIRÓFANO HORA DE INICIO DEL EVENTO: 2000	INCIDENTE

				HORAS SIENDO LAS 20:20 HORAS DURANTE LA REALIZACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO ANESTÉSICO CON EL PACIENTE BAJO ANESTESIA GENERAL, SE EVIDENCIA QUE EL MONITOR DE SIGNOS VITALES NO PRESENTA REGISTRO NI VISUALIZACIÓN DE CAPNOGRAFÍA NI DE LA CONCENTRACIÓN MÍNIMA ALVEOLAR (CAM) DEL AGENTE HALOGENADO. DE MANERA INMEDIATA SE INFORMA LA SITUACIÓN A LA JEFE DE TURNO, SOLICITANDO EL APOYO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS DE ANESTESIA, CON EL FIN DE RESTABLECER LA MONITORIZACIÓN DE DICHOS PARÁMETROS. POSTERIORMENTE, LA JEFE DE TURNO INDICA AL QUIRÓFANO ESTABLECIENDO COMUNICACIÓN [illegible]		
				ENCARGADO DEL SOPORTE TÉCNICO, QUIEN BRINDA INDICACIONES PARA REALIZAR AJUSTES EN EL MONITOR. LAS INDICACIONES RECIBIDAS SON		

			EJECUTADAS DE FORMA INMEDIATA EN EL EQUIPO PRESENTE EN SALA; SIN EMBARGO, NO SE LOGRA RESTABLECER LA VISUALIZACIÓN NI EL REGISTRO DE LOS PARÁMETROS DE CAPNOGRAFÍA NI DE CAM. DURANTE LA MISMA COMUNICACIÓN SE SOLICITA AL INGENIERO, IDENTIFICADO COMO JHONATAN, SU PRESENCIA EN EL QUIRÓFANO PARA VALORACIÓN DIRECTA DEL EQUIPO, CONSIDERANDO QUE SE TRATABA DE UNA SITUACIÓN TÉCNICA QUE NO PODÍA SER RESUELTA MEDIANTE LOS AJUSTES INDICADOS DE FORMA REMOTA. ANTE DICHA SOLICITUD, EL INGENIERO MANIFIESTA LA EXPRESIÓN "UUU, QUÉ MAL", FINALIZANDO POSTERIORMENTE LA COMUNICACIÓN [illegible]		
			DE [illegible] REPORTADO NUEVAMENTE LA SITUACIÓN, EL INGENIERO SE PRESENTA EN EL QUIRÓFANO Y PROCEDE A		

			REALIZAR LA REVISIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO, LOGRANDO RESTABLECER EL FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR Y LA VISUALIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS PREVIAMENTE MENCIONADOS. EL PRESENTE INFORME SE REALIZA CON EL FIN DE DEJAR REGISTRO FORMAL DEL EVENTO OCURRIDO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA MONITORIZACIÓN DE LA CAPNOGRAFÍA Y DE LA CONCENTRACIÓN MÍNIMA ALVEOLAR DEL AGENTE HALOGENADO CONSTITUYE UN ESTÁNDAR DE SEGURIDAD EN PACIENTES BAJO ANESTESIA GENERAL, Y QUE LA AUSENCIA DE ESTOS PARÁMETROS REPRESENTA UNA LIMITACIÓN EN LA MONITORIZACIÓN ANESTÉSICA INTRAOPERATORIA, [illegible]		
			LA [illegible] CORRESPONDIENTE Y QUE SE BRINDÓ APOYO TÉCNICO PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA DESDE EL MOMENTO EN QUE		

					FUE IDENTIFICADA. ASÍ MISMO, SE REFIERE QUE LOS HECHOS DESCRITOS OCURRIERON EN PRESENCIA DEL EQUIPO QUIRÚRGICO QUE SE ENCONTRABA EN SALA DURANTE EL PROCEDIMIENTO, QUIENES PUEDEN DAR CONSTANCIA DE LA SITUACIÓN PRESENTADA. EL PRESENTE REPORTE SE REMITE PARA CONOCIMIENTO INSTITUCIONAL, ANÁLISIS DENTRO DE LOS PROCESOS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO, ASÍ COMO PARA LAS ACCIONES QUE LA INSTITUCIÓN CONSIDERE PERTINENTES.		
		Incidente 47832 47830: análisis causal: 1) se revisa la HC del paciente para determinar si hubo lesión o si solo se trató de un potencial riesgo de daño 2) se realiza entrevista al Especialista 3) comunico los reportes a Servicio farmacéutico, suministros y activos fijos y líder de enfermería de quirófano para definir las acciones de mejora 3) se define el siguiente plan de mejora: - Realizar la solicitud de pedido ante el proveedor Avanzo de los equipos de terapia por presión negativa marca KCI contratados. [illegible] Acta de ingreso de los equipos de terapia de presión negativa y orden de despacho de los equipos a central de esterilización) - Realizar seguimiento y apoyo a la gestión de la capacitación sobre el manejo integral de equipos e insumos del sistema de terapia por presión negativa dirigido al personal asistencial y técnico. (soporte: informe de adherencia con resultados) nota: la actividad se ejecutará una vez los equipos hayan sido ingresados al Hospital. - Informar al Servicio					

		Farmacéutico los insumos que se requieren para la terapia de presión negativa en cavidad abdominal, especificando sus nombres (apósitos, cánister, entre otros) y cantidades. Realizar esta actividad con el Jefe Víctor Olave gestor del proceso de (Soporte: correo enviado). • Gestionar la solicitud de pedido ante el proveedor Avanzo de los insumos que se requieren para la terapia de presión negativa (apósitos, cánister, entre otros). Una vez recibidos, disponer estos dispositivos en las farmacias satélites asignadas a quirófanos. Nota: El requerimiento se ejecutará una vez el coordinador o líder quirúrgico remita la información detallada de los insumos y cantidad de cada uno. (Soporte de la actividad: orden de despacho de los insumos a las farmacias de quirófano. Incidentes 47778: 1) Solicitar al proveedor QNA Medical la trazabilidad técnica del equipo de terapia de presión negativa vinculado al incidente, especificar si la unidad fue reemplazada durante la hospitalización del paciente, y realizar la entrega del informe técnico de revisión del equipo el cual debe describir las pruebas de verificación realizadas y la identificación de la causa que provocó la falla en el equipo. 2) RECORDAR AL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA LA IMPORTANCIA DE INDAGAR ESCALA DE COLOR Y ACTUALIZACIÓN DE ESTE VALOR EN PLAN DE CUIDADO DE ENFERMERÍA, IMPORTANCIA DE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL VAC Y DE ACUDIR A LA ENCARGADA LEIDY EN CASO DE NO FUNCIONAMIENTO O MÁQUINA APAGADA, VERIFICACIÓN DE LOS PICC, CURACIONES SEGÚN PROTOCOLO E INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL MISMO responsable Líder de Enfermería de Hospitalización adultos Incidente 47698 y 46697 :1) se revisa hc del paciente para determinar si hubo lesión o no 2) realizar entrevista al especialista para que especifique la falla identificada en el tractor y fijador con rachet 3) se direcciona al líder de central de esterilización la siguiente actividad previamente acordada: Realizar la inspección física y funcional de los dispositivos médicos [illegible] insumos o instrumental con desgaste o avería para proceder con su reemplazo, garantizando así la operatividad y seguridad del equipo. Soporte de la actividad: Informe que incluya el Estado Inicial de cada caneca, describiendo por cada dispositivo: nombre, marca, referencia, lote y registro INVIMA. Asimismo, se debe relacionar las medidas correctivas aplicadas y el Estado

		Final de la caneta, detallando nuevamente la información técnica de los dispositivos que aseguran su funcionalidad. Incidente 47508: reportar a Disoplenets y Biotikot el incidente presentado con las inhaloccámaras, para solicitar análisis del lote reportado, certificado de calidad e informe con resultados y seguimiento a la respuesta emitida por el responsable del registro sanitario. Incidente 46491: solicitar a sistemas de información lo siguiente: Por medio de la presente, solicito comedidamente la extracción y transcripción detallada de los datos consignados en la gráfica del registro anestésico con fecha del 13 de marzo de 2027, perteneciente a la paciente Amparo Carazo Mojín, identificada con la Historia Clínica No. 25122718. Se requiere que la información sea tabulada cada 5 min (o en los intervalos registrados) siguiendo el eje temporal (Eje X), iniciando a las 20:10 horas y finalizando a las 21:35 horas. Es indispensable incluir la toma inicial de las 20:21 horas. Las variables solicitadas para cada intervalo de 5 minutos son: Sevoflurano (%), Isoflurano (%) y Desflurano (%), Presión Arterial presentada en formato TAS/TAD (Sistólica/Diastólica) y Frecuencia Cardíaca (FC), ETCO2, Fracción Inspirada de Oxígeno (FIO2 %), Frecuencia Respiratoria Espontánea (FR) y Saturación de Oxígeno (SPO2 %). Ejemplo de formato requerido: Hora 20:30: TAS/TAD: 120/80 mmHg | FC: 75 lpm | SPO2: 98% | ... (demás variables). Agradezco de antemano su gestión para la obtención de estos datos vitales para el seguimiento del caso. 2) Se reporta incidente al Ing Biomédico para que suministre información de la inconsistencia o falla identificada y las acciones realizadas para restablecer el monitoreo de la capnografía y CAM **Fallas de MARZO asociadas con dispositivos médicos** En total se reportaron 37 fallas, de estos los siguientes son gestionados por el programa de tecnovigilancia con apoyo del ingeniero biomédico del proceso asistencial.

47781	25/03/2026 12:00:00 A. M.	PACIENTE CON ABDOMEN AGUDO QUE REQUIERE DE TERAPIA DE PRESIÓN SUBATMOSFÉRICA PERO NO HAY DISPONIBLE	FALLA O RIESGO	SEGUIMIENTO CON DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS	FALTAS EN EL SUMINISTRO DEL DISPOSITIVO MÉDICO	ATENCIÓN QUIRÚRGICA

		IDAD DE ESTE DISPOSITIVO EN EL HOSPITAL, CONSTITUYENDO A RIESGO DE FALLA EN EL CIERRE DE LA PARED POR PLANOS.					

Falla 47781: análisis causal: 1) se revisa la HC del paciente para determinar si hubo lesión o si solo se trata de un potencial riesgo de daño 2) se realiza entrevista al Especialista 3) comunico los reportes a Servicio farmacéutico, suministros y activos fijos y líder de enfermería de quirófano para definir las acciones de mejora 3) se define el siguiente plan de mejora - Realizar la solicitud de pedido ante el proveedor Avanza de los equipos de terapia por presión negativa marca KCI contratados. Una vez recibidos proceder con la entrega a la Central de Esterilización para su almacenamiento y dispensación, priorizando el proceso quirúrgico. (Soporte de la actividad doc: Acta de ingreso de los equipos de terapia de presión negativa y orden de despacho de los equipos a central de esterilización) - Realizar seguimiento y apoyo a la gestión de la capacitación sobre el manejo integral de equipos e insumos del sistema de terapia por presión negativa dirigido al personal asistencial y técnico. (soporte informe de adherencia con resultados) nota : la actividad se ejecutará una vez los equipos hayan sido ingresados al hospital - Informar al Servicio [illegible] Realizar esta actividad con el jefe Victor Olave gestor del proceso qx (Soportes correo enviado) - Gestionar la solicitud de pedido ante el proveedor Avanza de los insumos que se requieren para la terapia de presión negativa (apósitos, cánister, entre otros). Una vez recibidos, disponer estos dispositivos en las farmacias satélites priorizando quirófanos. Nota: El requerimiento se

ejecutará una vez el coordinador o líder quirúrgico [illegible] la información detallada de los insumos y cantidad [illegible] uno. (Soporte de la actividad; orden de despacho de los insumos a las farmacias de quirófano.
Otras fallas direccionadas para ingeniería biomédica:

47927	REGISTRO DE RIESGO GENERAL HSLV	30/03/2026 12:00:00 a. m.	En ronda de seguridad del paciente en el servicio de UCI Adultos, en búsqueda activa, se evidencia monitoreo de pacientes con alarmas desactivadas.	Falla o Riesgo	Seguridad con Dispositivos Médicos y Equipos Biomédicos	Falla en la alarma	Programa de Seguridad del Paciente
47688	SANDRO HOYOS [illegible]	20/03/2026 12:00:00 a. [illegible]	En ronda de seguridad del [illegible] servicio cuidados intermedios (servicio de	Falla o Riesgo	Seguridad con Dispos[illegible] Equipos Biomédicos	Falla en la [illegible]	Programa del Segur[illegible] nte

			cuidado crítico) se evidencia alarmas desactivadas en monitores, incluyendo presión sistólica, diastólica, presión arterial media y temperatura baja, lo que representa alto riesgo de no detección oportuna de deterioro clínico del paciente.				
4756[illegible]	JESUS [illegible] QUIJANO CAMAYO	14/03/2026 12:00 [illegible] m.	En ronda de [illegible] paciente UCI adultos se evidencian alarmas	Falla o [illegible]	Seguridad [illegible] Dispositivos Médicos y Equipos	Falla [illegible] alarma	Programa [illegible] idad del Paciente

			desactivadas en presión, presión sistólica y temperatura baja.		Biomédicos		
45286	REGISTRO DE RIESGO GENERAL HSLV	1/03/2026 12:00:00 a. m.	En ronda de seguridad del paciente en búsqueda activa en el servicio se evidencia que dispositivos biomédicos correspondientes a monitores de signos vitales presenta[illegible] desactivadas en los parámetros de tensión arterial y	Falla o Riesgo	Seguridad con Dispositivos Médicos y Equipos Biomédicos	Falla en la alarma	Programa de Seguridad del Paciente

			frecuencia respiratoria en los cubículos 29, 32, 33 y 35, situación que genera riesgo para la detección oportuna de alteraciones hemodinámicas y respiratorias en los pacientes y compromete la vigilancia clínica continua. Este hallazgo representa [illegible] seguro de equipos biomédicos y en el monitoreo del				


			paciente, pudiendo retrasar la identificación de eventos adversos.				

Plan de mejora: se direcciona la siguiente actividad al Ingeniero Biomédico del proceso asistencial : Ejecutar en cada monitor de signos vitales (msv) del proceso asistencial la validación y/o revisión de la persistencia de datos posterior a ciclos de apagado y encendido de los parámetros fisiológicos (fc, fr, spo2, PAI, PANI (sistólica, diastólica y media), Temp etc) , así como el estado de activación de la alarma y los niveles de volumen preestablecidos para cada uno. En relación a la configuración del volumen de la alarma esta se debe dejar en estado activo y en nivel mínimo la mitad del nivel más uno. Como soporte de esta actividad diligenciar el informe modelo, y las dos tablas inmersas en el documento por cada proceso asistencial.


EVENTOS E INCIDENTES DEL MES DE ABRIL HASTA LA FECHA .

Eventos


48371	25265661	14/04/2026 12:00:00 a. m.	EL DIA 13 DE ABRIL SE REALIZO SUSTITUCIÓN DE SONDA DE GASTROSTOMÍA A LA PACIENT	Evento Adverso	Seguridad con Dispositivos Médicos y Equipos Biom	Otro (mal funcionamiento sin identificar)	C. Evitable [illegible]

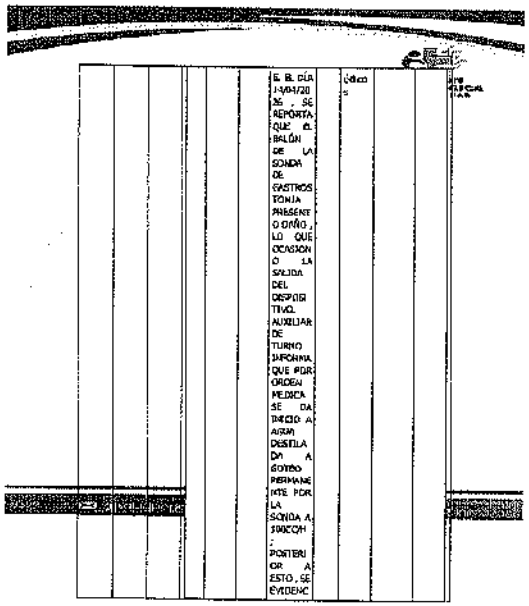


				E. B. DÍA 14/04/2026 , SE REPORTA QUE EL BALÓN DE LA SONDA DE GASTROSTOMIA PRESENTO DAÑO , LO QUE OCASIONO LA SALIDA DEL DISPOSITIVO. AUXILIAR DE TURNO INFORMA QUE POR ORDEN MEDICA SE DA INICIO A ARIM DESILDA DA A GOTEO PERMANENTE POR LA SONDA A 30ML/CH . POSTERIOR A ESTO , SE EVIDENC	Clínicos			

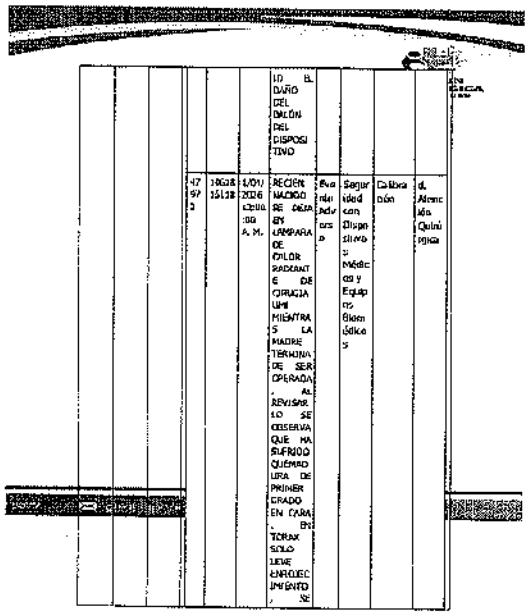


				ID EL DAÑO DEL BALÓN DEL DISPOSITIVO				
47972	1068115128	1/04/2026 10:00 a. m.	RECIEN NACIDO SE DEJA EN CAMPARA DE CALOR RADIANTE DE CIRACIA UMI MIENTRAS LA MADRE TERMINA DE SER OPERADA , AL REVISAR LO SE OBSERVA QUE HA SUFRIDO QUEMADURA DE PRIMER GRADO EN CARA , EN TORAX SOLO LEVE ENROJECIMIENTO , SE	Evaluación Adversa	Seguridad con Dispositivos Médicos y Equipos Biomédicos	Calibración	d. Atención Química

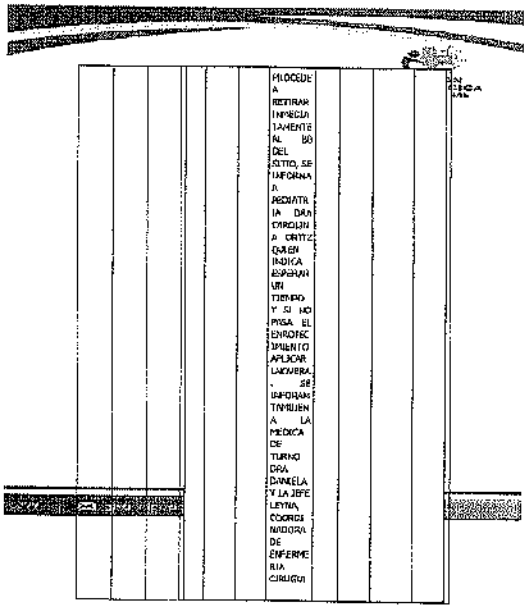


				PROCEDE A RETIRAR IMPRECIONTAMENTE AL BB DEL SITIO, SE INFORMA A PEDIATRA DRA CAROLINA ORTIZ QUIEN INDICA ESPERAR UN TIEMPO Y SI NO PASA EL ENROFECIMIENTO APLICAR LACIMERA , SE INFORMA TINMUJEN A LA MEDICA DE TURNO DRA DANIELA Y LA JEFE LEYNA, COORDINADORA DE ENFERMERIA CIRUGIA				

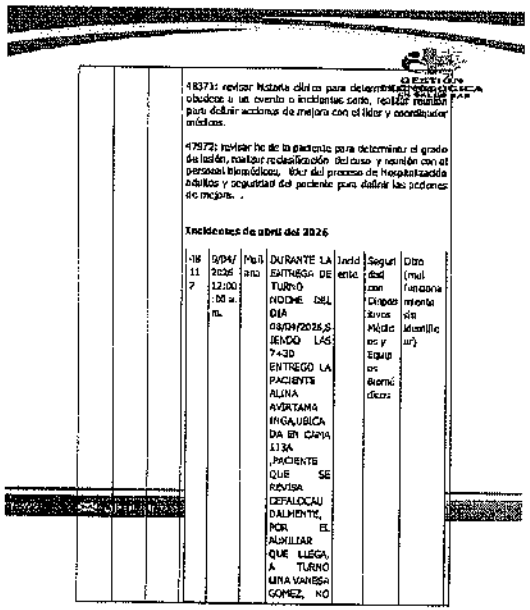

				48371: revisar historia clínica para determinar el grado de lesión, realizar reclasificación del caso y reunión con el personal biomédicos, líder del proceso de Hospitalización adultos y seguridad del paciente para definir las acciones de mejora. . 47972: revisar hc de la paciente para determinar el grado de lesión, realizar reclasificación del caso y reunión con el personal biomédicos, líder del proceso de Hospitalización adultos y seguridad del paciente para definir las acciones de mejora. . **Incidentes de abril del 2026**				
48117	8/04/2026 12:00:00 a. m.	Manilla	DURANTE LA ENTREGA DE TURNO NOCHE DEL DIA 08/04/2026,SIENDO LAS 7:30 ENTREGO LA PACIENTE ALINA AVERTAMA INGA,UBICADA EN CAMA 113A ,PACIENTE QUE SE REVISA CEFALOCAUDALMENTE, POR EL AUXILIAR QUE LLEGA, A TURNO LINA VANESA GOMEZ, NO	Incidente	Seguridad con Dispositivos Médicos y Equipos Biomédicos	Otro (multifuncional sin identificar)	

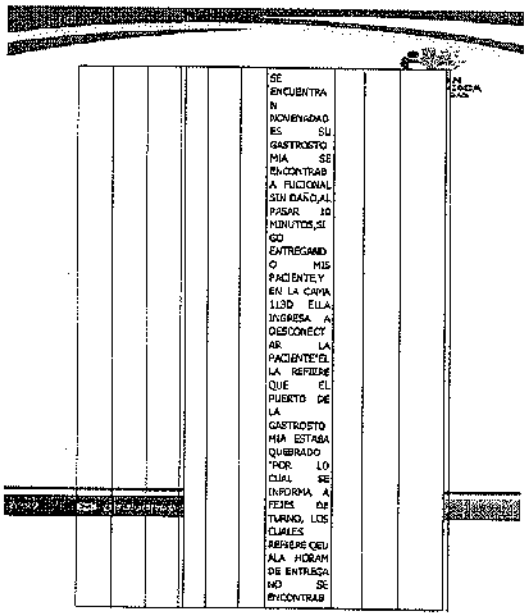

				SE ENCUENTRA IN INCONVENIENTES SU GASTROSTOMIA SE ENCONTRABA FUNCIONAL SIN DAÑO,AL PASAR 10 MINUTOS,SIGO ENTREGANDO MIS PACIENTE,Y EN LA CAMA 113D ELLA INGRESA A DESCONECTAR LA PACIENTE'EL LA REFIERE QUE EL PUERTO DE LA GASTROSTOMIA ESTABA QUEBRADO POR LO CUAL SE INFORMA A FEFES DE TURNO, LOS CUALES REFIERE QEU ALA HORA DE ENTREGA NO SE ENCONTRAB				

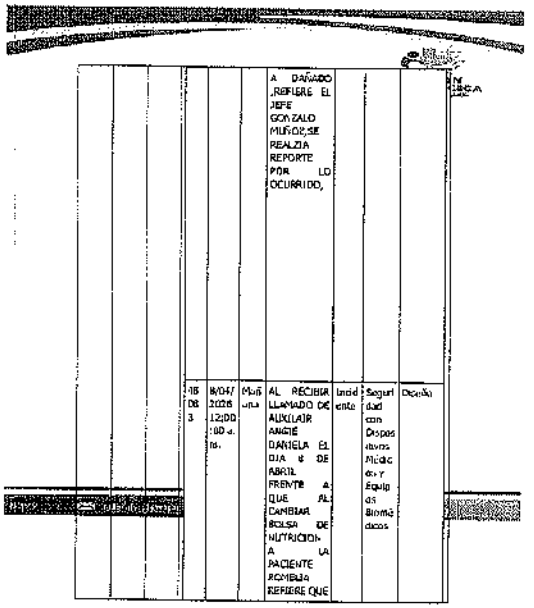

				A DAÑADO ,REFIERE EL JEFE GONZALO MUÑOZ,SE REALZIA REPORTE POR LO OCURRIDO,				
48103	8/04/2026 12:00:00 a. m.	Manilla	AL RECIBIR LLAMADO DE AUXILIAR ANGIE DANIELA EL DIA 8 DE ABRIL FRENTE A QUE AL CAMBIAR BOLSA DE NUTRICION A LA PACIENTE ROMELIA REFIERE QUE	Incidente	Seguridad con Dispositivos Médicos y Equipos Biomédicos	Dañado	

SE ENCUENTRA MUY APRETADA LO QUE IMPOSIBILITA EL CAMBIO. JEFE DE TURNO Y JEFE GONZALO ACUDEN A LA HABITACION ; SE COLOCA ESPARADRAPO Y SE LOGRA DESCONECTAR PARA CAMBIO . JEFE DE TURNO REALIZA LLAMADA TELEFONICA A JEFE LORENA SOBRE LA DIFICULTAD QUE AL OBSERVAR EL CONECTOR DE LA SONDA NASOYEYUNAL ES DE ROSCA MIENTRAS

EL DE LA NUTRICION NO TIENE LABRADO. AL RECIBIR TURNO SE OBSERVA FLOJA LA CONEXION DEL DISPOSITIVO Y LA FAMILIAR VUELVE A PREGUNTAR SOBRE DICHA DIFICULTAD. SE INFORMA A MEDICA DE TURNO Y A JEFE LORENA ENCARGADA DEL SERVICIO DE GASTROSTOMIA PERSONALMENTE.

48008	5/04/2026 12:00:00 a. m.	Tar de	PACIENTE QUE ES DE DIFICIL ACCESO Y POR PROTOCOLO INSTITUCIONAL SE FIJA CON ESENTA	Incidente	Seguridad con Dispositivos Médicos y Equipos	Otro (mal funcionamiento sin identificar)

PARA MEJOR ADHERENCIA DEL FIXOMULL Y PELICULA TRASPARENTE CON PUNTO DE INSERCCION VISIBLE, EL CUAL SE DESPEGA POR SUDURACION DE LA PACIENTE CUASANDO LA PERDIDA DEL ACCESO VENOSO LO QUE HA OCURRIDO EN TRES OCASIONES POR ENDE SE DEJEA LA FIJACION CON PUNTO DE INSERCCION VISIBLE CON ESPARADRAPO	Biomédico

48117 - 48081 : revisar la hc del paciente para verificar si hubo lesión o no , determinar si fue necesario estubinzar al paciente para realizar un nuevo procedimiento , realizar entrevista la personal con el fin de determinar la causa real

de la falla en el dispositivo médico, y así generar las acciones correctivas necesarias para mitigar el riesgo.


48008: revisar la calidad del dispositivo médico, reportar al proveedor y fabricante para solicitar, otras alternativas de insumos que sean de mejor en la adherencia a la piel del paciente o indicado para pacientes pediátricos.

Medir y analizar el 100 % de los eventos e incidentes adversos relacionados con los dispositivos médicos, garantizando la disponibilidad de equipos ... acciones preventivas


INDICADOR DE EVENTOS E INCIDENTES DE TECNOVIGILANCIA

Porcentaje de ocurrencia de Eventos e incidente adversos con Dispositivos médicos.

En el mes de MARZO del 2026 se ha presentado 7 incidentes asociados con dispositivos médicos. Todos los reportes del programa se encuentran registrados en la plataforma Dinámica gerencial, con su respectivo análisis y plan de acción.



Porcentaje de ocurrencia de Eventos



Reforzar el reporte institucional del programa de Tecnovigilancia del Hospital ... reportes de salud del Departamento y al INVIMA | Realizar el reporte oportuno y cumplimiento del 100 % de los eventos e incidentes adversos relacionados con dispositivos médicos ... al periodo evaluado a la secretaría de


Se envía de manera trimestral al Invima y la secretaría de salud departamental del cauca los reportes trimestrales de eventos e incidentes no serios: archivo llamado; PRIMER REPORTE TRIMESTRAL, el cual se envió en la primer semana de enero de 2026.

Ruta del archivo: Z:\AÑO 2026\TECNOVIGILANCIA\REPORTES TRIMESTRALES A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL E INVIMA archivo llamado; PRIMER REPORTE TRIMESTRAL ENERO 2026

Se realiza cargue de los reportes del programa de tecnovigilancia al Invima y la secretaría salud departamental del cauca el día 08 de enero debido a que, el día 8 al cargar el archivo en la plataforma página del INVIMA el documento presentaba un error , motivo por el cual se envía ese mismo día correo al Invima y la secretaría de salud departamental del cauca para solicitar la revisión del archivo e identificación del error, posteriormente se recibe respuesta del Invima indicando el posible error . Se realiza la corrección del archivo con las indicaciones del Invima y se carga archivo. .

Se realiza segundo cargue correspondiente al tercer trimestre el 08 de abril archivo que se encuentra en la ruta : Z:\AÑO 2026\TECNOVIGILANCIA\REPORTES TRIMESTRALES A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL E INVIMA\SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL ABRIL DEL 2026.

... al de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). | Salud del Departamento y al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), según corresponda, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de tecnovigilancia, la trazabilidad de la información.



... alertas sanitarias de dispositivos médicos | ... del 100 % de las alertas sanitarias ...

De manera mensual se realiza la verificación de alertas e informe de Seguridad con Dispositivos médicos publicadas por el INVIMA. Para esta Gestión se toma como base el archivo de recepción Técnico del Servicio Farmacéutico y el plan

	INVIMA	uso	de mantenimiento de Ingeniería Biomédica. Las alertas relacionadas con material quirúrgico e instrumental quirúrgicas se remiten a la Central de Esterilización y al proceso de Suministros y Activos Fijos para su revisión En caso de que alguna de las alertas afecte y/o involucre a los dispositivos médicos (dm) del hospital, se contactará al importador, distribuidor o comercializador correspondiente. El objetivo es obtener recomendaciones específicas sobre el uso de los productos afectados e involucrados y determinar el plan de acción y/o medidas preventivas y correctivas. En caso de aplicar la alerta, se pondrá en cuarentena los dispositivos y se remitirá comunicado al proveedor, responsable del registro sanitario e importador para que indique las acciones y/o medidas a tomar. En la fecha de ejecución del presente informe (17/04/2026), el INVIMA publicó : Para el mes de MARZO 7 alertas Sanitarias y 3 informes de seguridad, y en el mes de ABRIL no hay reportes de alertas.

RESA RH	Nombre del Dispositivos médicos	Registro Invima	Lote / Referencia	Descripción
DA260 2-00187	LAMPARA DE QUIROFANO	2025E M	Referencia(s) / Lote(s) / Serial(es): CB 6361018 / CB 6361033	No aplica para los dispositivos médicos del hospital
	LAMPARA PARA CIRUGIA			

DA260 2-00187	MINIMED 780G INSULIN PUMP / BOMBA DE INSULINA MINIMED 780G	2025E BC-00235 28	Referencia(s) / Código(s): MMT-1886	No aplica para los dispositivos médicos del hospital	
DI260 3-00193	AMBULATORY BLOOD PRESSURE MONITORANO ASSOC. SUPPLIES & ACCESSORIES - MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL AMBULATORIA & INSUMOS Y ACCESORIOS ASOCIADOS	2020D M-00220 38	Version 11.6.0 logiciel Sentinel	No aplica para los dispositivos médicos del hospital	
DI260 3-00192	BD KIESTRA™ - Equipo para la automatización del flujo de trabajo Laboratorio de microbiología	2019D M-00199 35	Lote / Serial Todos	No aplica para los dispositivos existentes del hospital	
DI260 3-00186	VITROS XT 7600 INTEGRATED SYSTEM	2018D M-00167 64	Lote / Serial Varios enlaces COMUNICA	No aplica para los dispositivos	

			SISTEMA INTEGRADO VITROS XT 7600 ACCESORIOS Y REPUESTOS	2020D M-00212 05, 2021D M-00069 24-R1	CION INF_SEG VITROS-DI2601-00186 SISTEMA INTEGRADO VITROS.pdf
DR260 3-00189	Cables DVI Validados con el Qube Compact Monitor y el Xpression Bedside (Q UBE must MONITOR AND..	2018E BC-00177 09	Referencia(s) / Código(s): Monitores Xpression (91393) y Qube (91390) Pantalla 94267-L19, 94267-L19, 94267-L17 y 94267-L15	No aplica para los dispositivos médicos del hospital	
DA260 3-00194	EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA	2018E BC-00180 40	Vantage Galan 3T MRT-3028 (Periodo de envío: de junio de 2016 a junio de 2025) Vantage Titan 3T MRT-3030 (Periodo de envío: de junio de 2022	No aplica para los dispositivos médicos del hospital	
DR260 2-00166	LENTES DE CONTACTO BLANDOS - STENFILCON A	2024D M-00121 26	Referencia(s) / Código(s): MYDAY Lote(s) /	No aplica para los dispositivos médicos	

DR261 2-00161	UNIDAD DE CRIOCIRUGÍA / ERBECRYO 2	2025E BC-00121 49-R1	Referencia(s) / Código(s): 20402-401 Lote(s) / Serial(es): WO165287	No aplica para los dispositivos médicos del hospital
DA261 2-00167	LEKSELL GAMMA KNIFE ICON - EQUIPO DE RADIOCIRUGÍA	2017E BC-00163 64 / 2020E BC-00050 28-R1	Referencia(s) / Código(s): Todos Fuente de la alertas: AEMPS "AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS"	No aplica para los dispositivos médicos del hospital

INDICADOR PORCENTAJE DE GESTION DE ALERTAS SANITARIAS DE MARZO DEL 2026

En la fecha de ejecución del presente informe, 17 de ABRIL resultando que ninguna aplica para los dispositivos médicos del hospital .

Gestión de Alertas por

Se participará en comité primario de Gestión de Tecnología en cuanto el jefe Lucia de planeación comunique la fecha de la reunión, la frecuencia de este comité es bimensual.

En cuanto al Comité de Gestión de Tecnología y Tecnovigilancia, este se llevará a cabo en el mes MARZO, y se ejecutará de manera trimestral; en este comité se definio en conjunto con los integrantes el plan de accide del año.

GESTIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD S.A.S


MANUAL DE ACTIVIDADES GESTION TECNOLOGICA EN SALUD S.A.S

INGENIERIA BIOMEDICA

Se informara que cada item del apartado "observaciones" debe ser debidamente justificada, orientando de manera concisa cada actividad realizada por servidor. No se aceptarán redacciones genéricas o de poca precisión. La justificación debe describir completamente lo ejecutado y evidenciar el ajuste diario y acuerdo con la entrega del cronograma.


En caso de que la información aquí plasmada no corresponda, o la incumplimiento no esté debidamente justificada, GESTIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD S.A.S. se reserva el derecho de tomar las medidas correspondientes por el incumplimiento de lo establecido.

ACTIVIDADES CONTRATADAS	RESULTADO	OBSERVACIONES RECIBIDAS	OBSERVACIONES
Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos programados según el plan de mantenimiento hospitalario entregado por el Hospital (ESE-SAN-01-009)	Garantizar que los equipos biomédicos de uso hospitalario reciban mantenimientos preventivos oportunos durante todo el periodo de ejecución del contrato	El proceso difiere en cuanto a tiempo y contenido de los equipos biomédicos de uso hospitalario	En los días 17 al 20 del mes de Marzo y en los días 1 al 13 del mes de Abril del 2026 se programaron 45 mantenimientos preventivos a los siguientes equipos: A. Camillas eléctricas, se programaron 16 mantenimientos B. Sillas de ruedas se programaron 9 mantenimientos C. Electrocardiógrafos se programaron 11 mantenimientos D. Transporte de pacientes se programaron 8 mantenimientos

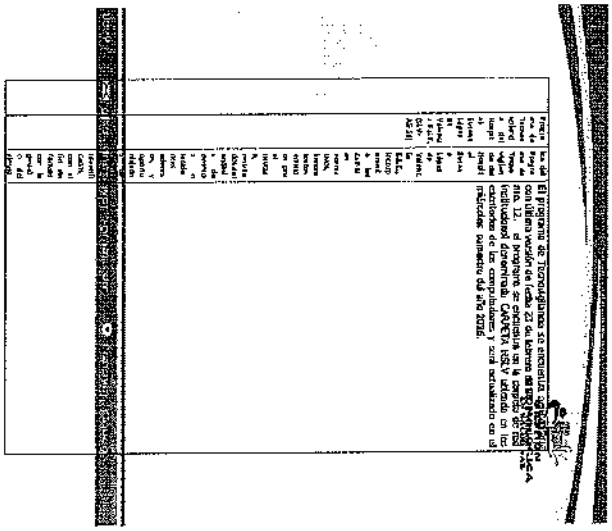

El presente de Tecnologías se encuentra de con último versión de fecha 23 de Marzo Vigencia 2026 Acta 12. el propósito se encuentra en la carpeta de los Instituciones diamantina, CARVEN HSLV adjunto en los cronogramas de los computadores y será actualizado en las mismas fechas del año 2026.


Fecha de Mantenimiento	Nombre del Equipo	Marca	Modelo	Serial	Ubicación	Estado del Equipo	Observaciones
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0142	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0143	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0144	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0145	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0146	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0147	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0148	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0149	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0150	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0151	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0152	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0153	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0154	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0155	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0156	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0157	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0158	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0159	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0160	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0161	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0162	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0163	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0164	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0165	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0166	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0167	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0168	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0169	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0170	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0171	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0172	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0173	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0174	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0175	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0176	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0177	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0178	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0179	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0180	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0181	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0182	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0183	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0184	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0185	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0186	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0187	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0188	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0189	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0190	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0191	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0192	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0193	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0194	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0195	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0196	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0197	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0198	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0199	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad
17/03/2026	Camilla Eléctrica	Stryker	3005	CE-3005-0200	Urgencias	Operativo	Mantenimiento preventivo realizado sin novedad

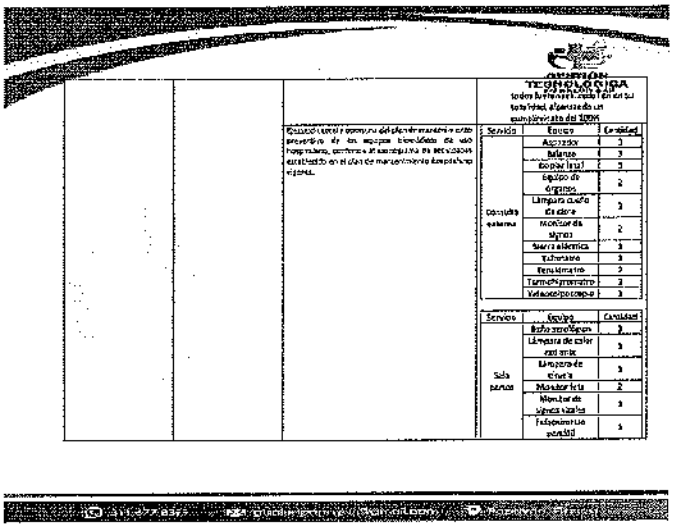

			todos los equipos biomédicos asociados a este fueron intervenidos dentro del plan de mantenimiento preventivo en su totalidad, ajustándose al cumplimiento del 100%
		Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos de uso hospitalario, conforme al cronograma establecido en el plan de mantenimiento hospitalario vigente.	


Servicio	Equipo	Cantidad
Consulta externa	Aspirador	3
	Balanza	3
	Bomba de jugo	3
	equipo de órganos	2
	Lámpara cuello de cisne	3
	Monitor de signos	2
	Nevera eléctrica	3
	Tensiómetro	3
	Termohigrometro	3
	Videocolposcopio	3

Servicio	Equipo	Cantidad
Sala partos	Bisturí electrógeno	2
	Lámpara de calor radiante	3
	Lámpara de cielo	3
	Monitor fetal	2
	Monitor de signos vitales	3
	Fototerapia de piso	3

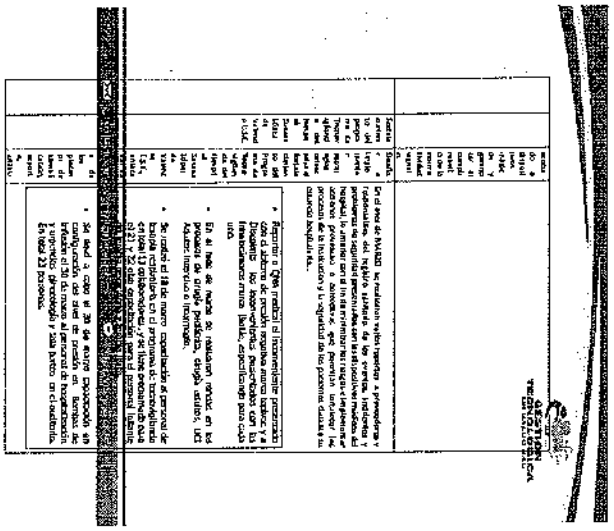

En el mes de MARZO se realizaron varias capacitaciones y presentaciones del equipo biomédico de los puestos, incidentes y relacionados, así como también se realizaron las capacitaciones del personal de enfermería en el manejo de los equipos biomédicos de uso hospitalario, asistencia, preventivo o correctivo, así como los procesos de inducción y reinducción del personal de nuevo ingreso.

- Reportar a QMS medical el incumplimiento presentado con el informe de acción seguida marca sobre y a Diagnóstico los incumplimientos encontrados con las irregularidades encontradas, especialmente para cada uno.
- En el mes de marzo se realizaron mejoras en los procesos de cirugía pediátrica, cirugía adultos, UCI Adultos, urgencias e neumología.
- Se realizó el 18 de marzo capacitación al personal de Estudio relacionado en el programa de tecnovigilancia con total 13 colaboradores, y se hizo entrega de la 27 y 28 de marzo se realizó capacitación al personal de Hospital en el 30 de marzo al personal de hospitalización y urgencias, procedimiento está punto en el pasillo. En total 23 personas.

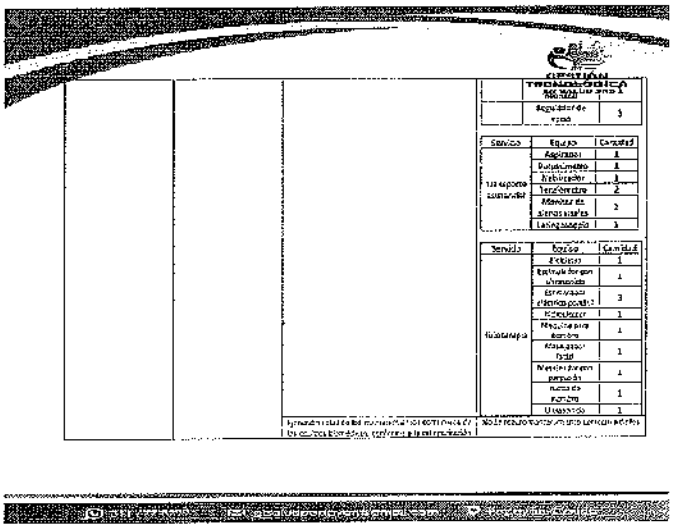


			Seguridad de vigilancia	3

Servicio	Equipo	Cantidad
Uso exterior sostenible	Aspirador	1
	Balanza/pesabebé	1
	Bisturí eléctrico	1
	Tensiómetro	2
	Monitores de signos vitales	2
	Lámpara cuello de cisne	1

Servicio	Equipo	Cantidad
Fisioterapia	Electrodos	1
	Electrodo de gran dimensión	1
	Electrodos eléctricos portátil	3
	Fisioestimulador	1
	Negatoscopio para imágenes	1
	Resuscitador manual	1
	Monitor de presión arterial	1
	Nebulizador de membrana	1
	Ultrasonido	1

Ningún equipo biomédico de uso hospitalario presentó fallas durante el periodo de ejecución del contrato	NO SE PRESENTARON FALLAS DURANTE EL PERIODO

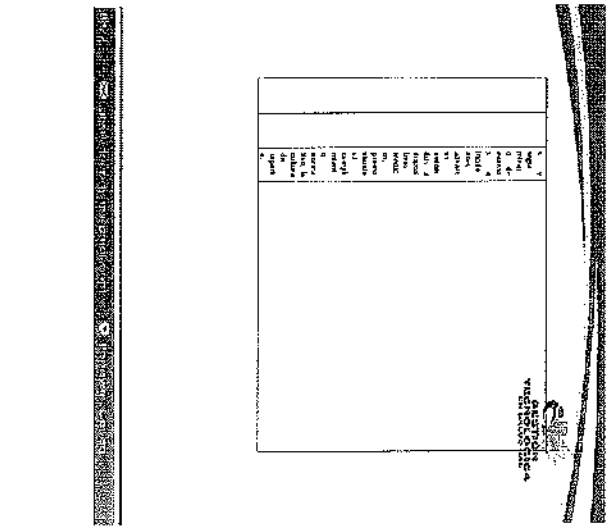

siguiente inventario de mantenimiento:

cada punto:

1. BAÑO SEROLOGICO MARCA: MEMMERT modelo: WNB7 serie: I2060109




	Solicitud oportuna y por escrito de los repuestos y/o materiales necesarios para la ejecución de labor en los equipos biomédicos de una Hemoclínica.	Registro y presentación del 100 % de las solicitudes el mismo día en que se genera un informe de falla o el mes del cierre.	Se realizaron 12 solicitudes con el mes de corte del cual se entregaron el 100% de los repuestos solicitados
	Elaboración de informes técnicos sobre las actividades de cada uno biomédico de una Hemoclínica, indicando la identificación de las causas y las acciones correctivas implementadas (SIV-SPI-07-008)	Elaboración y entrega del 100 % de los informes técnicos correspondientes a las fallas de los equipos biomédicos de cada hemoclínica	Durante este periodo (mensualmente) no se generaron informes técnicos, debido a que no se presentaron fallas en los equipos biomédicos de los hospitales
Elaboración, archivo y actualización de las fichas técnicas de cada equipo biomédico, asegurando su correcta identificación y conformidad con los estándares técnicos y normativos. (SIV-CAT-GAM-018)	Adecuado mantenimiento, archivo y actualización de las fichas técnicas de los equipos biomédicos, de una Hemoclínica	Ejecución del 100 % de las tareas de mantenimiento, archivo y actualización de las fichas técnicas de los equipos biomédicos, distribuye a la programación de preventivos y de mantenimiento de maquinaria estacionaria	De realizaron 5 mantenimientos en el periodo (1 a las sedes de C y J de periodo de mayores de mantenimiento 1. Arco en C de endoscopia a adultos 2. De cauterio en endoscopia 3. De endoscopia a colonoscopia 4. De cauterio en cirugía 5. Esterilizador de vapor en cirugía
Capacitación y entrenamiento del personal usuario de los equipos biomédicos de una hemoclínica, asegurando el manejo seguro y eficiente de los mismos. (SIV-GAR-018-2493)	Garantizar que el 100 % del personal usuario de los equipos biomédicos de una hemoclínica sean debidamente capacitados y entrenados en su manejo, a través de sesiones presenciales, virtuales o a	Alcanzar un mínimo del 100 % de las sesiones de capacitación y entrenamiento en el manejo seguro de los equipos biomédicos de una hemoclínica	No se registró capacitaciones para el periodo comprendido entre el 15 marzo al 17 de abril

2. LAMPARA DE CAMA BARRAJE, marca: ADVANCE modelo: A4051 serie: A4004305I




	punto de forma y asegurar el funcionamiento correcto		
Controlar e inspeccionar periódicamente el funcionamiento de los equipos biomédicos en una hemoclínica, asegurando su estabilidad, seguridad y cumplimiento de los estándares técnicos	Garantizar el mantenimiento adecuado y funcionamiento de los equipos biomédicos de los servicios hospitalarios, conforme a las listas de verificación establecidas por el cargo, asegurando su correcto desempeño y seguridad	Garantizar que el 100 % de las listas de chequeo de los equipos biomédicos del hospital sean diligenciadas de manera clara y completa, cumpliendo con los procedimientos establecidos, en caso de que el cumplimiento no alcance el 100 %, se deberá informar y explicar oportunamente el motivo de la omisión (SIV-SIN-SIS-F01)	A la fecha se han arreglado en 100% la totalidad de las sillas de mano, de una pasan, cambio cuero y fallecido y las necesidades identificadas 19 mantenimientos ejecutados del 19% del total se encuentra el 100% de ejecutado las cuales dones, diligenciados oportunamente.
Garantizar la disponibilidad del servicio las 24 horas, los 7 días de la semana, garantizando una atención continua para los hospitales con un tiempo máximo de respuesta preestablecido	Mantener la disponibilidad del servicio las 24 horas, los 7 días de la semana, con un tiempo máximo de respuesta preestablecido de 3 horas	Mantener el cronograma continuo de los mantenimientos preventivos de la unidad SIV-SIN-SIS-F01, especialmente cumplimiento del servicio.	En el mes de abril en las fechas del 6 al 12 se estableció en el cronograma dentro semana de disponibilidad en la cual se asistió a los llamados en los tiempos estipulados y en la ejecución de dicho actividad se realizó lo siguiente: 5 realizados de abril en E cronograma de soporte de soporte a cama UCI, comida de pack de máquina de gases de aislados y uci P, respond 5 llamados de camas fallado, bloqueados todos 3, auxiliar uni falsedad, error "error en vapor" se "desbloqueo" solderin, se deja equipo funcionando correctamente
		Recepción y registro de todas las solicitudes de soporte de equipos biomédicos fuera del horario habitual, asignando cada caso a un técnico de turno de acuerdo a la disponibilidad y carga de trabajo del momento, garantizando la atención oportuna de las solicitudes (SIV-SIN-SIS-F01)	Se cumplen con las políticas establecidas, brindando al 100% registrando así atención para disponibilidad 24 / 7


3. LAMPARA CIRUGICA PORTATIL marca: BIPED modelo: LS300 serie: 2 ES10-B1-0010302

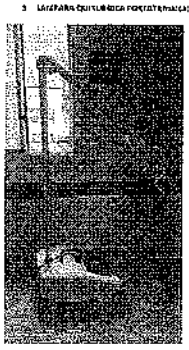

		Diligenciamiento del informe asignado al área del equipo biomédico dentro de las 3 horas dentro la recepción de la falla.	No hubo llamadas registradas a responder en 3 horas en 24/7 todas fueron respondidas dentro de las 3 horas máximas
		Cotizar y entregar las fallas reparación, documentando las piezas reemplazadas y los repuestos utilizados, presentando la cotización y firmada la cotización.	No aplica
		Diligenciar informe técnico de cada intervención, indicando diagnóstico, solución aplicada, tiempo de resumen, para seguimiento y registro conforme (SIV-SIN-FRO)	No aplica
		Informar y documentar cualquier repuesto en el que exceda el tiempo de recepción de 3 horas, indicando motivos y plazo estimado de llegada	No aplica

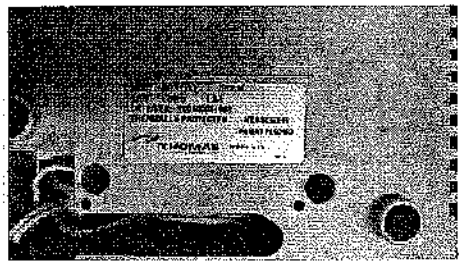









AMBULANCIAS



4. HIDROCOLECTOR MARCA INTERFISICA MODELO: TE-T05F SERIE: NO REGISTRA



FISIOTERAPIA

1. BICICLETA ESTÁTICA marca: SPIRIT modelo: MONZA serie: no registra



CONSULTRA EXTERNA:


1. ASPIRADOR SHOF



2. ELECTROESTIMULADOR COM ULTRASONIDO CHATTANOOGA




2. BALANZA SECA 813

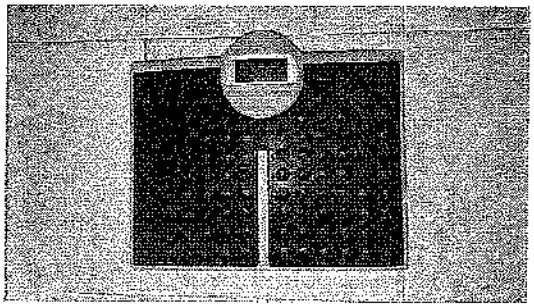

3. ESTIMULADOR ELECTRICO marca: CHATTANOOGA modelo: THETA serie: ZH5904301



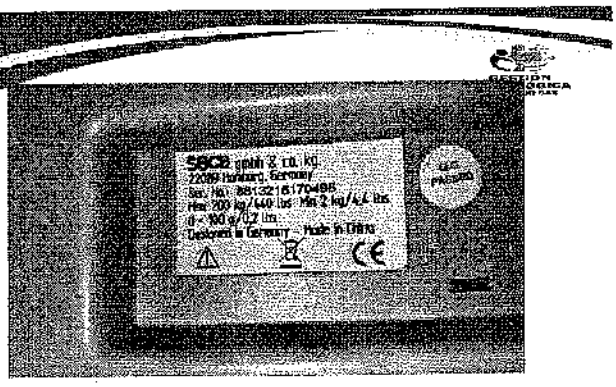

MANUAL DE ACTIVIDADES GESTION TECNOLOGICA EN SALUD S.A.S


INGENIERIA BIOMEDICA

Se informa que cada ítem del acordado "SOPORTES" debe estar debidamente justificado, dictaminado de manera específica cada actividad desarrollada por servicio. No se aceptarán redacciones generales o imprecisas, la justificación debe describir completamente lo ejecutado y cuantificar de forma clara y exacta con lo ordenado como soporte.

En caso de que la información relacionada no corresponda, no sea pertinente o no esté debidamente justificada, GESTIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD S.A.S. se reserva el derecho de tomar las medidas correspondientes por el incumplimiento de lo aquí manifestado.

SOPORTES BIOMEDICOS			
ACTIVIDADES CONTRATADAS	PRODUCTO	CALIDAD Y CANTIDAD	SOPORTES
Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos pertenecientes según el plan de mantenimiento preventivo	Garantizar que los equipos biomédicos se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento durante todo el periodo de duración del contrato	Garantizar el funcionamiento óptimo y confiable de los equipos biomédicos de cada hospital	Se garantiza el 100 % de supervisión de los equipos biomédicos en las áreas misionales de Cuidados Intensivos Neonatal y Pediátrico asegurando su correcto funcionamiento. Durante el periodo comprendido entre el 15 y el 28 de marzo y del 1 al 12 de abril, se dio cumplimiento al 100 % de los mantenimientos preventivos programados para los equipos biomédicos, de acuerdo con el cronograma establecido en el Plan de Mantenimiento Hospitalario vigente.
			En ejecución se presentan diecisiete (17) mantenimientos preventivos realizados de manera y veintiuno (21) durante el periodo del

3 BALANZA	SECA	374	0000000000374

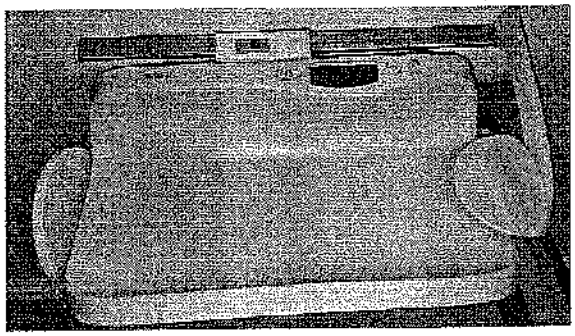

mantenimiento preventivo del equipo biomédico			realizado de manera correcta garantizando el correcto funcionamiento de los equipos biomédicos durante la ejecución del mantenimiento
		Entregar informe técnico y soporte del plan de mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos de cada hospital, detallando el tipo de mantenimiento realizado en el plan de mantenimiento hospitalario vigente.	En cada uno de los mantenimientos preventivos realizados se diligencia un formato de mantenimiento preventivo en el cual se describe el procedimiento realizado, las actividades de revisión ejecutadas, el estado del equipo antes y después del mantenimiento, las observaciones encontradas y las recomendaciones para el usuario. Estos formatos son firmados por el personal responsable del equipo biomédico, dando constancia de la ejecución del mantenimiento. Los formatos diligenciados son archivados como soporte documental del cumplimiento del plan de mantenimiento hospitalario vigente.


4 EQUIPO DE OPTAMOLOGIA DE LOS SENTIDOS	RESTER	AVAPRIMER	11202





			reparación correctiva y mejora continua
		Informar y documentar posibles casos en el que se supere el tiempo de respuesta de 3 horas, evidenciando la causa raíz sobre las acciones implementadas	ADMIRA


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA


ANTES DEL MANTENIMIENTO	DURANTE EL MANTENIMIENTO	DESPUES DEL MANTENIMIENTO
		


			Una (1) balanza, dos (2) básculas, un (1) equipo de dygest, cuna (1) de calibración, (1) incubadora de transporte, dos (2) incubadoras convencionales, una (1) lámpara de calor radiante, tres (3) lámparas de fototerapia led y (1) cronógrafo (para validar
		Ejecución total de los mantenimientos correctivos de los equipos biomédicos, conforme a la categorización de prioridad y a los tiempos de respuesta establecidos	En el mes de marzo no se realizaron correctivos durante el periodo por lo que no se cuenta con el 85 y el 95 de marzo, siendo el 85 y el 95 el plan
	Solicitud oportuna y por medio de los recursos y/o materiales necesarios para la ejecución de fallas en los equipos biomédicos de uso hospitalario	Asignar y gestionar en un 100 % de las solicitudes el mismo día en que se produce el daño o la falla del equipo. El 100 % de las solicitudes fueron reparadas y presentadas el mismo día en que se produjo el daño o la falla del equipo. En el periodo comprendido entre el 16 y el 28 de febrero se registraron 9 solicitudes, siendo este entre el 3 y el 15 de marzo no se presentó ninguna	No fueron asignar y la presentación del 100 % de las solicitudes el mismo día en que se produjo el daño o la falla del equipo. Durante el mes de marzo y del 1 al 15 de abril no se presentaron solicitudes para ejecutar
	Elaboración de informes técnicos sobre las fallas de los equipos biomédicos de uso hospitalario, incluyendo la identificación de las causas y las acciones correctivas implementadas (SAV-SMEI-[illegible]	Cubrir con la entrega del 100 % de los informes técnicos correspondientes a las fallas de los equipos biomédicos de establecimiento	No fueron realizados los informes técnicos durante el periodo comprendido entre el 28 de febrero y el 15 de marzo, teniendo en 1 y el 15 de abril


	FUR)		
Instalación, ubicación y puesta en funcionamiento de los equipos biomédicos de uso hospitalario, asegurando su correcta funcionamiento y conformidad con las especificaciones técnicas y normativas (SAV-GAT-GHS-21)	Realizar la instalación, ubicación y puesta en funcionamiento de los equipos biomédicos de uso hospitalario, asegurando su correcta funcionamiento y conformidad con las especificaciones técnicas y normativas (SAV-GAT-GHS-21)	Ejecución del 100 % de las actividades de instalación, montaje y puesta en funcionamiento de los equipos biomédicos de uso hospitalario, conforme a la categorización de prioridad y a los tiempos de respuesta establecidos Durante los periodos comprendidos entre el 16 y el 28 de febrero y del 1 al 15 de marzo no se presentaron instalaciones de equipos biomédicos de uso hospitalario por lo tanto, no se pudo evaluar el cumplimiento de este requerimiento para el periodo evaluado.	Durante el periodo comprendido entre el 15 y el 31 de marzo no se realizaron instalaciones de equipos biomédicos de uso hospitalario, por lo tanto no es pertinente calificar para ejecutar durante del periodo evaluado
Capacitación y entrenamiento del personal usuario de los equipos biomédicos de uso hospitalario, asegurando el correcto manejo y aplicación de los mismos (SAV-GAT-GHS-22)	Garantizar que el 100 % del personal usuario de los equipos biomédicos de uso hospitalario sea debidamente capacitado y entrenado en su manejo, ya sea mediante capacitaciones internas del servicio o a través de ferias y convocatorias de terceros especializados	Se cumplió con el 100 % de los usuarios de los equipos biomédicos establecidos inicialmente capacitados y entrenados en el manejo, respaldado con los Estudios de capacitación o evidencia documental de la ejecución.	Durante los meses del 15 al 31 de marzo no se realizaron capacitación, ni se realizaron durante los primeros 15 del día del mes de abril
Gestionar e implementar oportunamente el mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos de uso hospitalario, asegurando su operatividad, seguridad y cumplimiento de los estándares técnicos	Gestionar e implementar oportunamente el mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos de uso hospitalario, de acuerdo a las fichas de verificación diseñadas por el hospital, asegurando su correcto desempeño y seguridad	Se cumplió con el 100 % de las fichas de chequeo de los equipos biomédicos del hospital sean diligenciadas de manera clara y oportuna, conforme a las programaciones establecidas en cada uno de los diligenciamientos realizados, en un porcentaje inferior al 100 %, se debió informar y realizar oportunamente el cierre de la gestión (SAV-GAT-GHS-24)	Se efectuó el diligenciamiento completo (100%) de las fichas de chequeo de los equipos biomédicos del hospital en las semanas comprendidas entre el 15 y el 31 de marzo y del 1 al 15 de abril, todas ellas dentro del periodo evaluado. No se observaron novedades.


Garantizar la disponibilidad 24 horas, los 7 días de la semana, para que los usuarios puedan reportar fallas en los equipos, con un tiempo máximo de respuesta presencial de 3 horas	Ejecutar la disponibilidad del servicio las 24 horas, los 7 días de la semana, con un tiempo máximo de respuesta presencial de 3 horas	Monitorear el cumplimiento estricto de los indicadores responsables de la atención 24/7, asegurando estándares de servicio	Durante el periodo comprendido entre el 16 y el 28 de febrero no se realizó mantenimiento debido a que, por un lado, el cronograma asignado a los ingenieros responsables de la atención 24/7 se retomó en la semana del 09 de marzo al 5 de abril de 2026, garantizando la continuidad operativa del servicio.
		Ejecución y registro de todas las actividades de soporte de equipos biomédicos fuera del horario laboral, asegurando que cada caso sea atendido al momento de su ingreso en el sistema de información y dentro del plazo de solución (SAV-GHS-GDI-07)	Se establecieron acciones de seguimiento de las solicitudes de soporte de equipos biomédicos fuera del horario laboral, las cuales fueron oportunamente canalizadas y registradas para su inicio en el día hábil siguiente de horario, dentro de los plazos de solución acordados según el grupo de prioridad.
		Realizar mantenimiento de equipos biomédicos en el sitio del usuario, en caso de ser necesario, brindando la verificación del daño	Se da cumplimiento al tercer (3) mantenimiento (PREVENTIVO SEMESTRAL) especial (preventivo) correspondiente a la programación ejecutada del 30 de marzo al 5 de abril de 2026
		Realizar control de fallas recurrentes, documentando las medidas tomadas y los repuestos utilizados, garantizando la operatividad continua del equipo	No se tuvieron controles durante el periodo evaluado del 16 de marzo y del 1 al 15 de abril
		Elaborar informes de mantenimiento, incluyendo registro de la hoja de vida de los equipos y cargos de respuesta, para seguimiento y mejora continua (SAV-GHS-GDI-08)	Se elaboraron y diligenciaron los formatos de mantenimiento correspondientes a cada intervención, asegurando el control conforme a SAV-GHS-GDI, incluyendo la causa de la falla, la solución aplicada y el tiempo

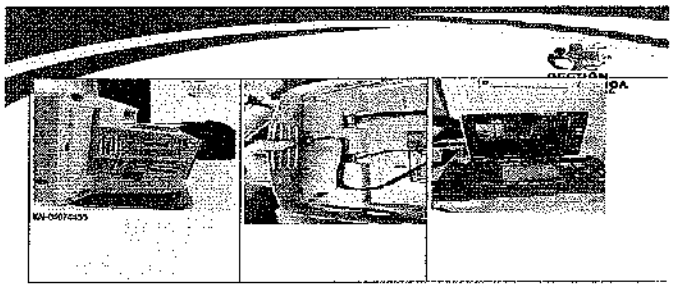


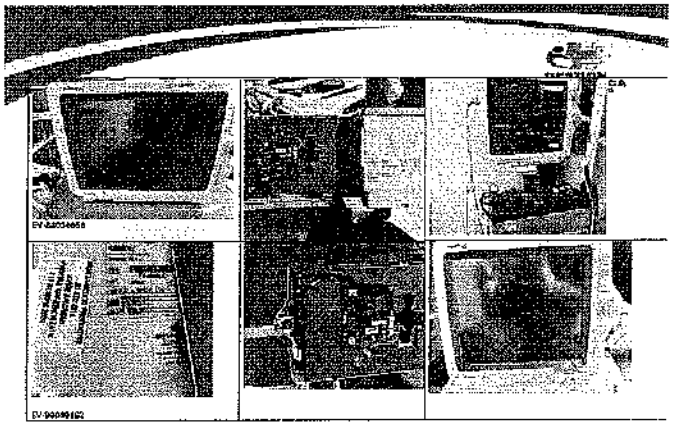


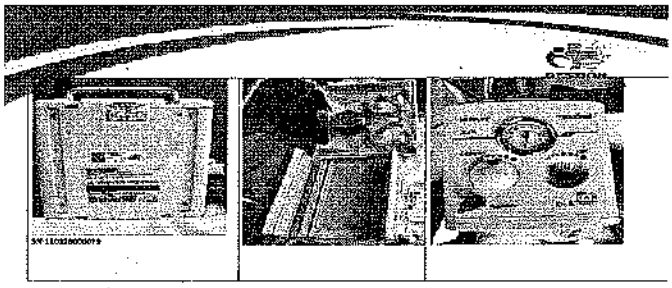


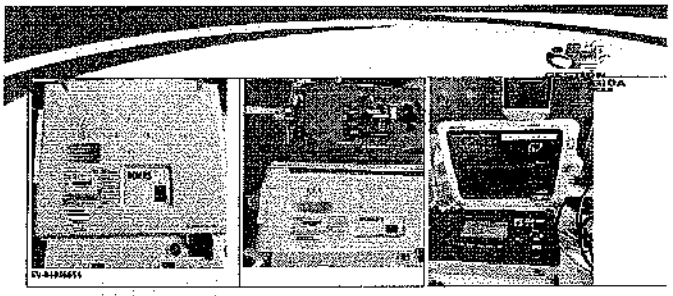


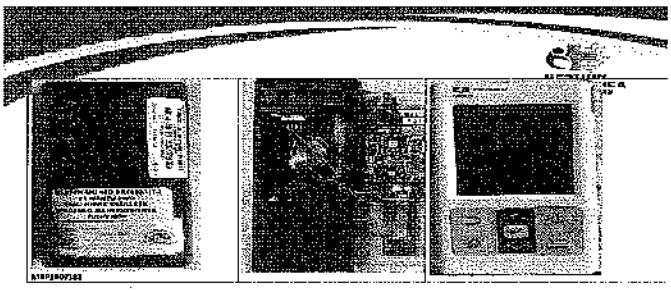


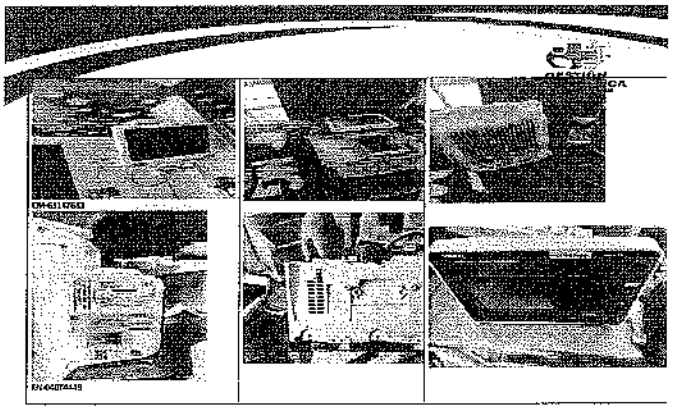

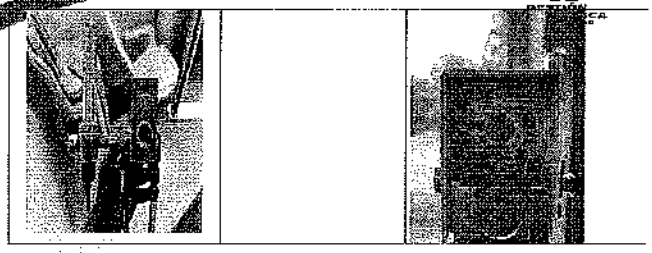


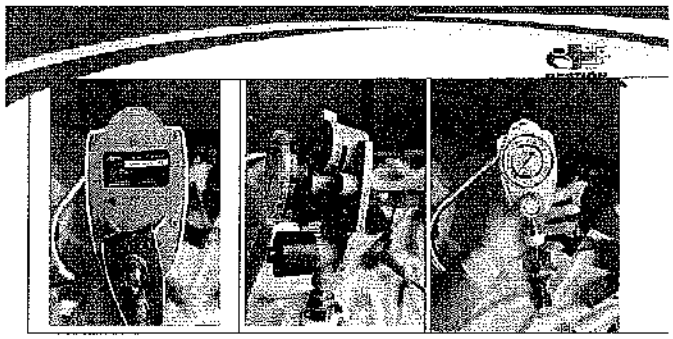


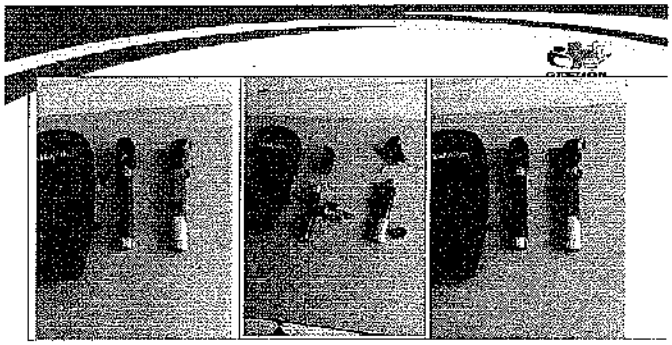


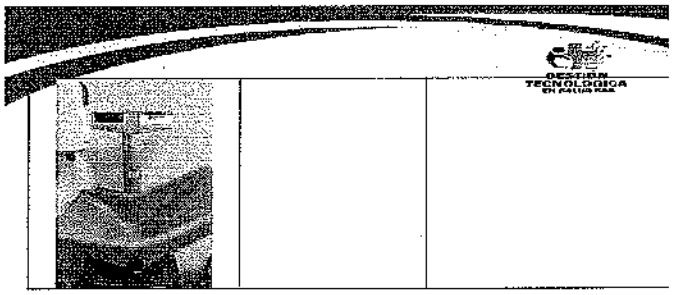


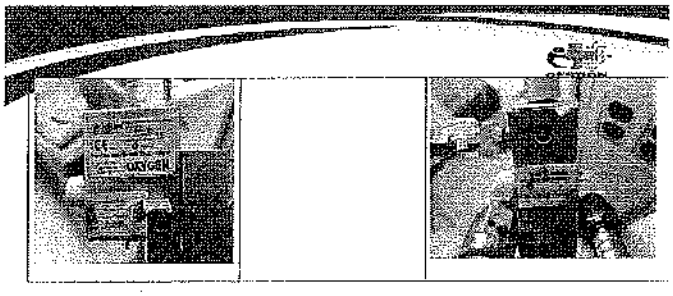




OXYGEN

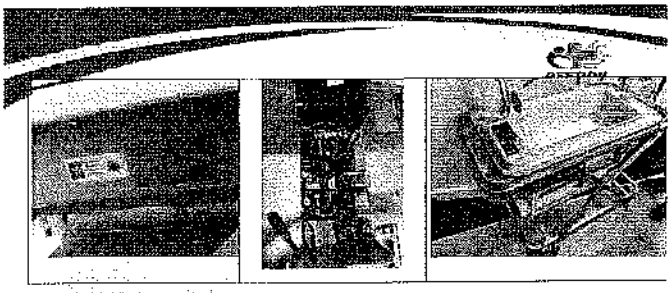


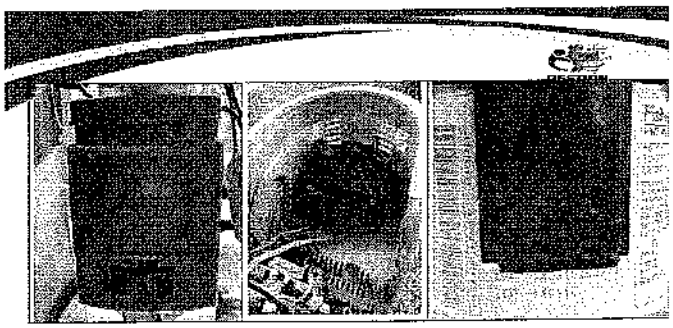


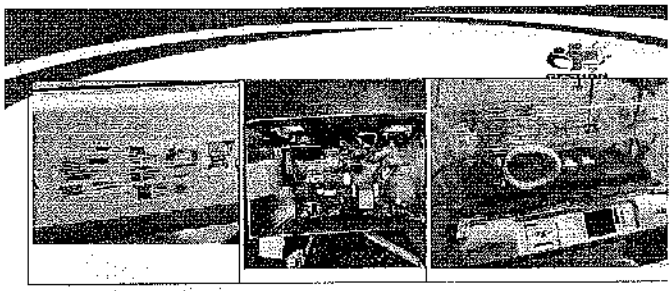


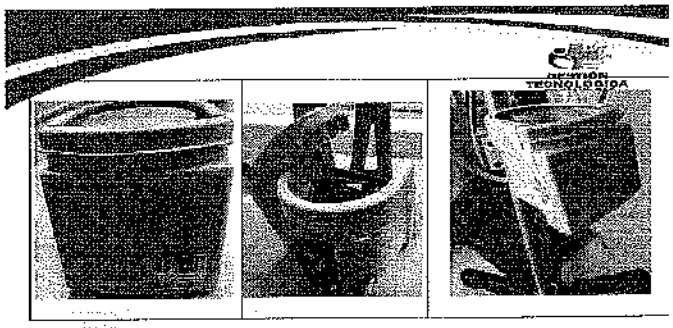


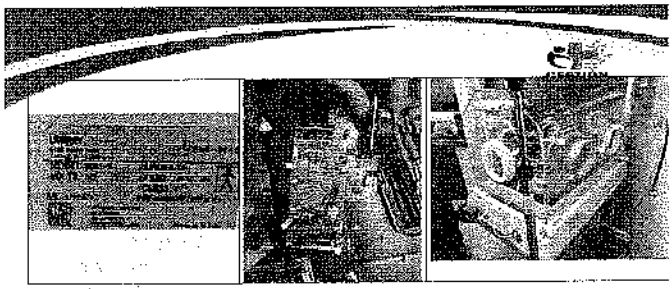


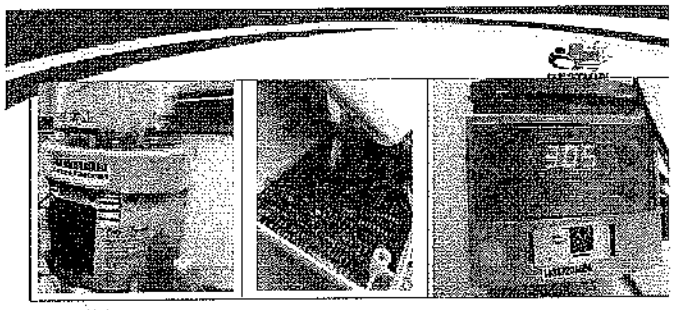


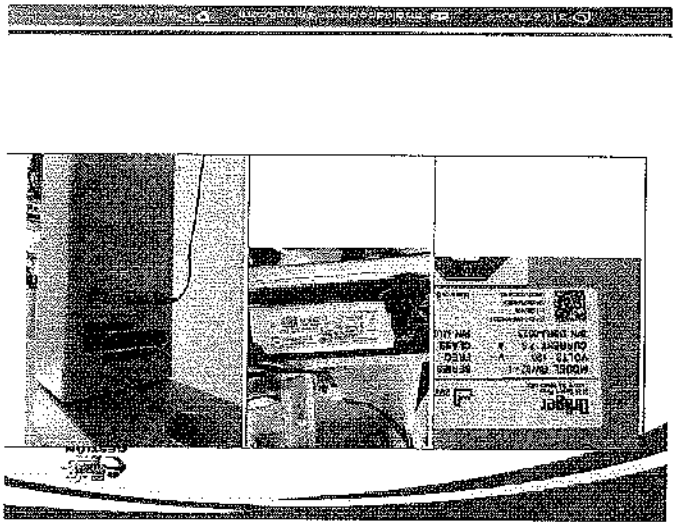


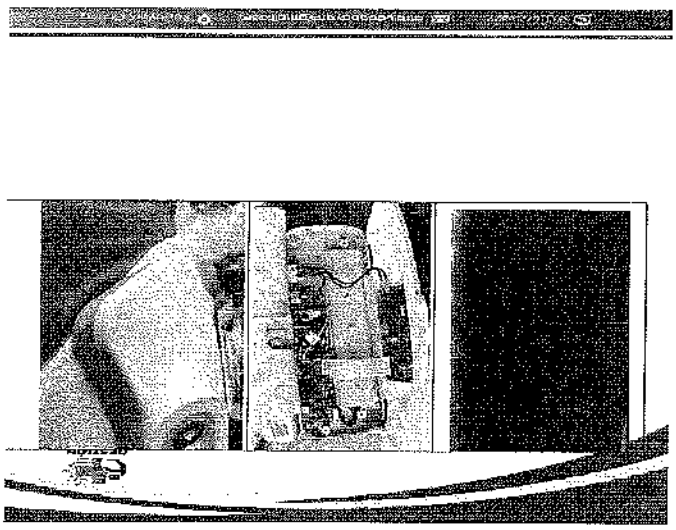

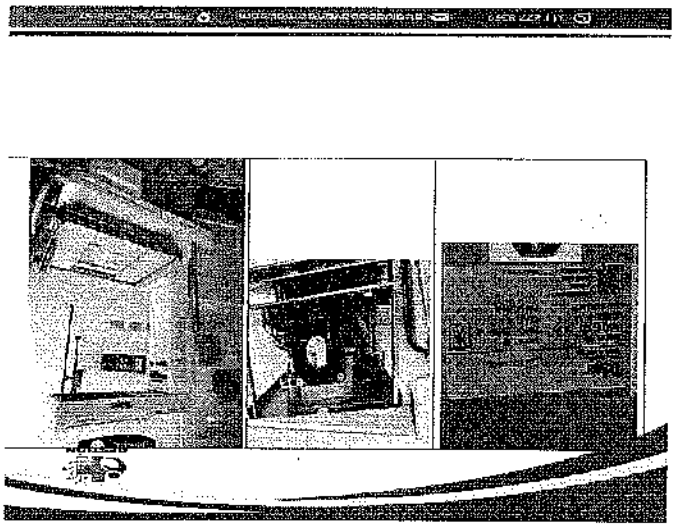

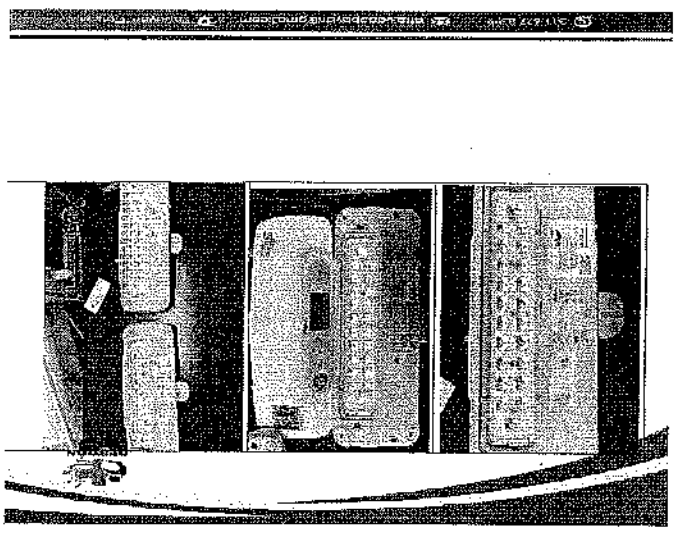

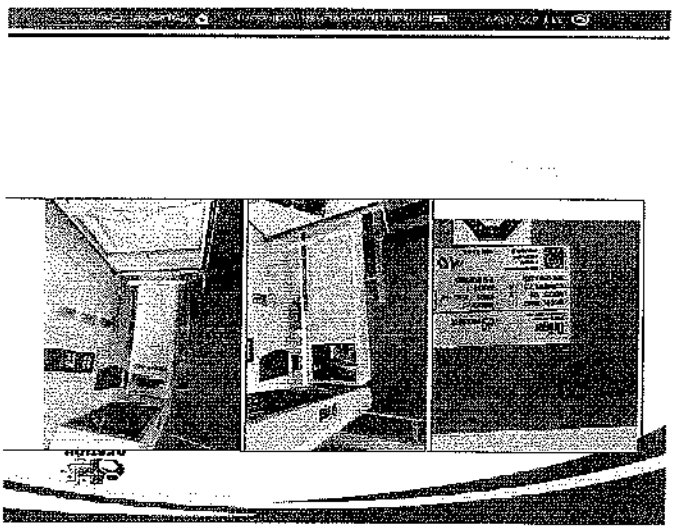

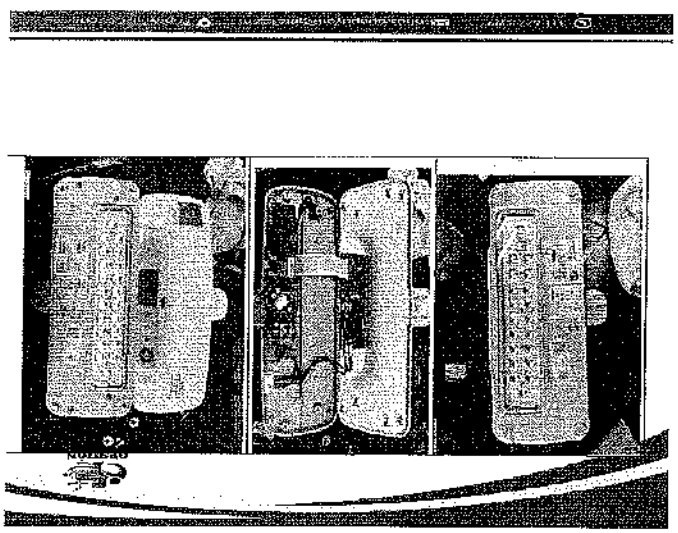

GESTION TECNOLOGICA EN SALUD SAS


MANUAL DE ACTIVIDADES GESTION TECNOLOGICA EN SALUD S.A.S

INSTRUCTIVO ECONOMICA

Se informa que cada item del apartado "SOPORTES" debe estar debidamente justificado, detallando de manera específica cada actividad realizada por servicio. No se aceptarán redacciones generales o imprecisas. La justificación debe describir completamente la ejecución y culminación de forma clara y exacta con la evidencia como soporte.

En caso de que la información presentada no corresponda, sea incompleta o no esté debidamente justificada, GESTION TECNOLOGICA EN SALUD S.A.S. se reserva el derecho de tomar las medidas correspondientes por el incumplimiento de lo aquí establecido.

TECNICO BIOMEDICO			
ACTIVIDADES CONTRATADAS	PRODUCTO	CRITERIO VERIFICABLE	SOPORTES
Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos hospitalarios según el plan de mantenimiento hospitalario entregado por la Hospital(NOMBRE)	Garantizar que los equipos biomédicos de una hospitalaria se encuentren en optimas condiciones de funcionamiento durante todo el periodo de ejecución del contrato	Garantizar el funcionamiento óptimo y continuo de los equipos biomédicos de manera similar	DEL 25 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2026, SE CUMPLE AL 100% CON LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS
		Ejecución total y oportuna del plan de mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos en la institución, asegurar el cumplimiento de estándares establecidos en el área de mantenimiento hospitalario y salud.	SE REALIZA EL 100% DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN CRONOGRAMA ENTREGADO DEL 25 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2026 - SEMANA 6-2ND ABRIL 1 REPORTE DE TRABAJO 1: TERAPIA GLOBULETTO SERIE AL#019

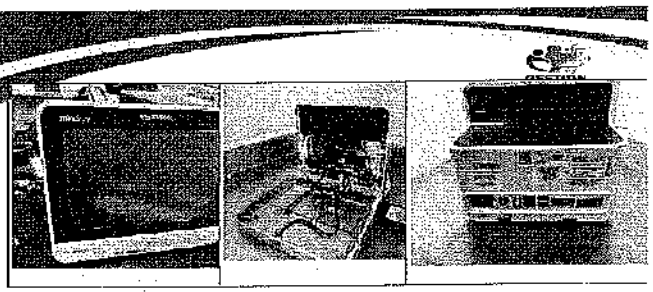


			2 ALMOHADILLAS PARA PRESION NO PAR -REGULADOR DE VACIO SERIE CAL0004216 -REGULADOR MINDRAY SERIE DR-03006619 1 REPORTE DE TRABAJO DE 5: MONITOR DE SIGNOS VITALES 51 M E SERIE 51308 L 2 REPORTES DE UROFLUJOMETRO: -ELECTROCARDIOGRAFO MINDRAY SERIE FN-03002029L -DESFIBRILADOR M INDRAY SERIE IZ-05005A3H 1 REPORTE DE ALMACEN: TERAPIA GLOBULETO UBILOT SERIE N0973H00518 1 REPORTE DE VOLUMEN: TERAPIA GLOBULETO
		Inspección total de los mantenimientos correctivos de los equipos biomédicos, conforme a la documentación de procedimientos y los formatos de recolección establecidos	DEL 25 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2026 SE REPARARON DAÑOS EN LOS EQUIPOS BIOMEDICOS, HASTA LA FECHA EQUIPOS FUNCIONAN 100 CORRECTAMENTE



	Servicio oportuno y con apoyo de los repuestos y/o insumos necesarios para la corrección de fallas en los equipos biomédicos de una hospitalaria.	Asegurar y proporcionar el 100 % de los servicios en el mismo día en que se produce el daño o en tan corto espacio	DEL 25 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2026 NO SE REALIZARON SOLICITUDES POR DAÑOS O FALLOS DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS, EN LAS RONDAS DIARIAS SE EVIDENCIAN AJUSTES DE ESALE DE PODER A TEMPERATURE.
	Elaboración de informes técnicos sobre el estado de los equipos biomédicos de una hospitalaria, detallando la identificación de las fallas y las acciones correctivas implementadas (NIV-SM-01-2025)	Elaborar y entregar el 100 % de los informes técnicos correspondientes a los fallos de los equipos biomédicos de una hospitalaria)	NO SE GENERARON REPORTES DE CORRECTIVOS. EQUIPOS BIOMÉDICOS FUNCIONANDO CORRECTAMENTE HASTA LA FECHA
Ejecución, traslado y adecuación de los equipos biomédicos de una hospitalaria, asegurando su correcto funcionamiento y conformidad con los estándares técnicos y regulatorios (NIV-SM-01-2025)	Adecuado reinstalación, traslado y instalación de los equipos biomédicos de una hospitalaria	Ejecución del 100 % de las actividades de instalación, traslado y de ubicación de los equipos biomédicos de una hospitalaria, asegurando la configuración de precisión y la limpieza de repuestos establecidos	DEL 25 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2026 NO SE REPORTARON POR MEDIO DE LOS FIFES DE LOS SERVICIOS TRASLADOS DE EQUIPOS BIOMEDICOS
Capacitación y entrenamiento del personal usuario de los equipos biomédicos de una hospitalaria, asegurando su manejo seguro y eficiente de los equipos (NIV-SM-01-2025)	Realizar una el 100 % del personal usuario de los equipos biomédicos de una hospitalaria este entrenado adecuado y capacitado en su manejo ya sea mediante capacitaciones internas de terceros o a través de ferias y actividades de formación especializadas	Garantizar que el 100 % de las unidades de los equipos biomédicos estén siendo operadas capacitados y entrenados por personal, asegurando así los niveles de seguridad y eficiencia operativa	DEL 25 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2026 SE REALIZARON CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CAPACITACIONES PROGRAMADAS A PARTIR DE LOS SIGUIENTES MESES
Corregir e implementar planes de acción en	Gestión e incidencias del mantenimiento al	Garantizar que el 100 % de las fallas de equipos de los equipos biomédicos del hospital sean diagnosticadas en	SE REALIZA LAS RONDAS DIARIAS DE LOS SERVICIOS A CARGO



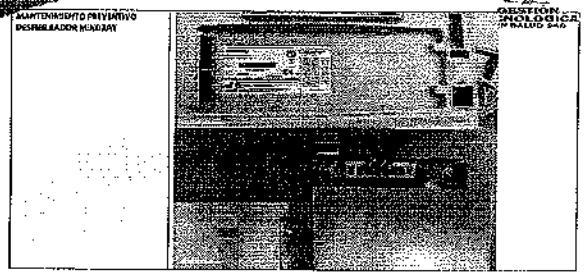



MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DESFIBRILADOR MARCA

Mantenimiento de los equipos biomédicos de las diferentes áreas, asegurando su operatividad, seguridad y confiabilidad de los procedimientos	Funcionamiento de los equipos biomédicos de las diferentes áreas, conforme a las listas de verificación diligenciadas por el hospital, asegurando su correcto desempeño y seguridad	Informe diario y oportuno, conforme a los procedimientos establecidos en caso de que el diligenciamiento sea inferior al 100 % se deberá informar y reportar oportunamente mediante el correo	
Garantizar la disponibilidad del servicio las 24 horas, los 7 días de la semana, realizando de manera rotativa entre los ingenieros, con un tiempo máximo de respuesta presencial de 3 horas	Ejecutar la disponibilidad del servicio las 24 horas, los 7 días de la semana, con un tiempo máximo de respuesta presencial de 3 horas	Asistencia al cronograma anterior de los ingenieros – técnicos responsables de la atención 24/7, mediante acciones correctivas diligenciadas	DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2026 NO TENGO PROGRAMADO PERMISOS O INCAPACIDAD.
		Recepción y registro de todas las solicitudes de soporte de equipos biomédicos fuera del horario habitual, asegurando que cada caso sea asignado al ingeniero de turno vía correo electrónico de soporte técnico con el propósito solicitado (SIV-SM-03-F08)	DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2026 NO SE REALIZARON SOLICITUDES DE FALLAS O DAÑOS RESPECTOS A LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS POR PARTE DE LOS JEFES DEL SERVICIO.
		Proporcionar una respuesta inicial vía correo electrónico dentro del tiempo máximo de 3 horas desde la notificación de la falla	SE CUMPLE CON EL INFORME MENSUAL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO (SIV-SM-03-F08) SUMINISTRADO POR EL HOSPITAL
		Evaluar y convocar los ingenieros disponibles de los diferentes municipios y los equipos afectados, garantizando la cobertura total incluyendo el equipo.	DEL 15 DE MARZO AL 15 ABRIL 2026 NO SE GENERARON SOLICITUDES DE FALLAS O DAÑOS RESPECTO A LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS POR PARTE DE LOS JEFES DEL SERVICIO.
		Elaborar informe técnico de cada intervención, incluyendo causa de la falla, solución aplicada y tiempo de respuesta, para seguimiento y mejora continua (SIV-SM-03-F02)	SE CUMPLE CON EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO (SIV-SM-03-F02) SUMINISTRADO POR EL HOSPITAL
		Informar y documentar cualquier caso en el que no se cumpla el tiempo de respuesta de 3 horas, indicando la causa y las acciones correctivas implementadas	NO APLICA





INCORPORACION DE EQUIPOS
EQUIPO DE CIRUGIAS
UNIDADES DE PEDIATRIA
Y EQUIPOS

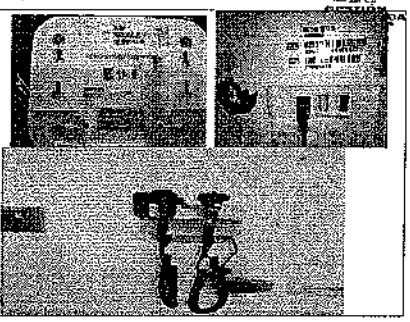


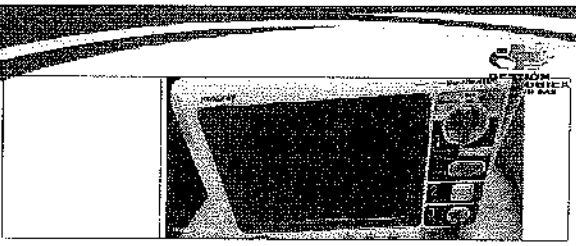


INCORPORACION MESA RIEL
CONSULTORIO N°2 URGENCIAS
PEDIATRIA

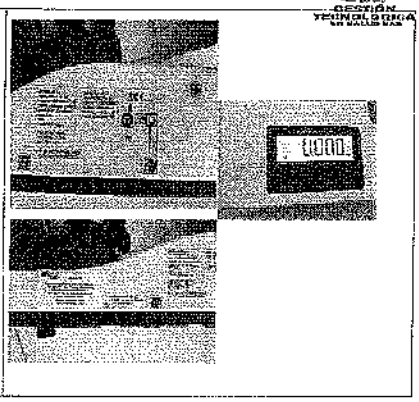





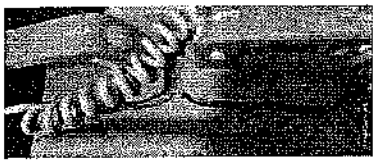

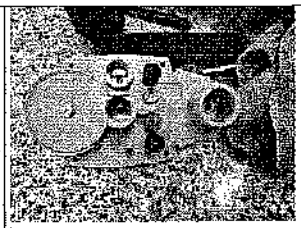

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MONITOR SIGNOS VITALES DRAGER
VISTA

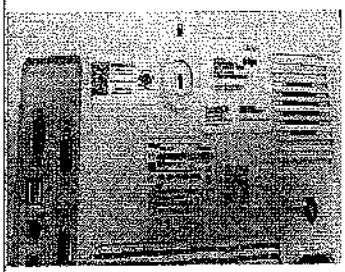






MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REGULADOR DE VACIO



MANTENIMIENTO
TERMOHIGROMETRO

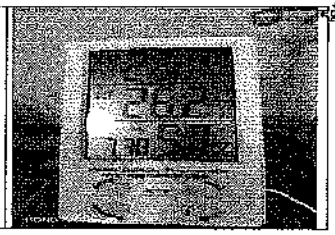





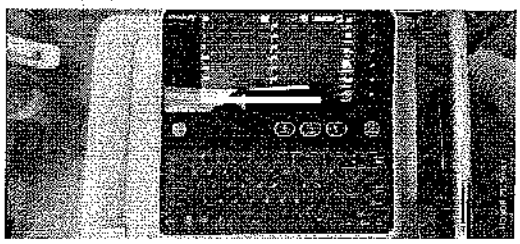


MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ELECTROCARDIOGRAFO MARCA AMV
SERIE N° 8122059



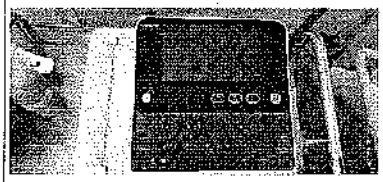

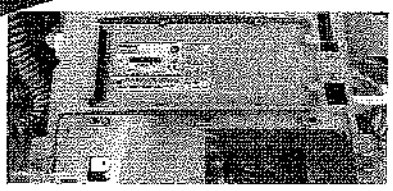


VERIFICACION TERMOHIGROMETRO
UBIBOT

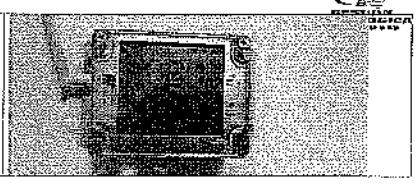


		a realizarlos en el plan de mantenimiento hospitalario vigente.	preventivos • UNG. ADULTOS 4 mantenimientos preventivos en el periodo, se ejecutaron 0 mantenimientos presentaron en protocolo institucional de código (SEV-SM-01-F01). • UNG. GINECOLOGIA 4 mantenimientos preventivos en el periodo, se ejecutaron 0 mantenimientos presentaron en protocolo institucional de código (SEV-SM-01-F01). EQUIPOS INTERVENIDOS: LAMPARA CUELLO DE GANS: 1 MONITOR DE SIGNOS VITALES: 3 REGULADOR DE VACIO: 2 TENSIOMETRO: 1 TERMOHIDROMETRO: 4 TOTAL: 12 PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO Durante el 1 al 31 de ABRIL se plantean

N. CRONOGRAMA		
Numero programados	Numero realizados	Cumplimiento
12	0	0.00%

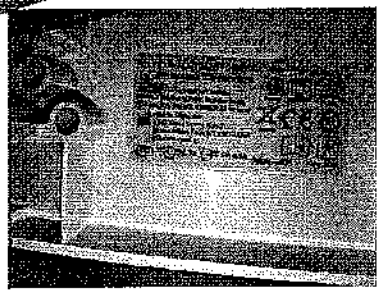


			Los siguientes mantenimientos preventivos: • UNG. ADULTOS 3 mantenimientos preventivos en el periodo, se ejecutaron 0 mantenimientos preventivos en protocolo institucional de código (SEV-SM-01-F01). NOTA: EL ELECTROCARDIOGRAFO DE SALA MICRO-QUIRURGICO, NO SE ENCUENTRA POR QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN GARANTIA. EL PULSO DE OXIMETRO DE MARCA DATASCOPE, FUE REMPLAZADO POR UN EQUIPO NUEVO. • UNG. GINECOLOGIA 6 mantenimientos preventivos en el periodo, se 6 ejecutaron mantenimientos preventivos en protocolo institucional de código (SEV-SM-01-F01). EQUIPOS INTERVENIDOS: ASPIRADOR: 1 BASCULA: 2 DESFIBRILADOR: 1 DOPPLER FETAL: 1 LAMPARA CUELLO DE GANS: 2

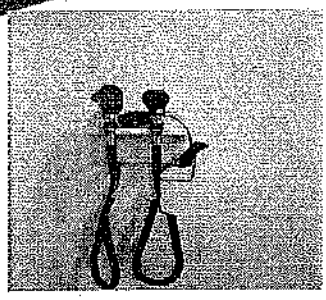

			UNG. ADULTOS Y GINECOLOGIA MANTENIMIENTO REALIZADOS TOTAL: 12 PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO
		Elaboración (100 %) de los mantenimientos preventivos de los equipos biomédicos con asistencia a los programados de producción y a los Kardex de mantenimiento complementario	Se reportan 2 mantenimientos preventivos durante el periodo del presente informe.
	Solicitud mantenimiento y gestión de las autorizaciones para la ejecución de los mantenimientos preventivos ante la aseguradora.	Reporte y programación del 100 % de las solicitudes de servicio que se produzcan el diario o semanal	Durante el periodo no se solicitaron 27 solicitudes con cumplimiento al 100%. SOLICITUDES DE SERVICIO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS

FETO DE SEGUNDA	ADULTO CENTRO ESPECIALIDAD	% CUMPLIMIENTO
27	0	100%

	Elaboración y entrega del 100 % de los informes técnicos generados sobre las fallas de los equipos biomédicos en uso hospitalario	No se generan informes técnicos reportados a fallas de los equipos biomédicos del servicio de UNG. ADULTOS y la UNG. GINECOLOGIA.
Instalación, traslado y adecuación de los equipos biomédicos de uso hospitalario requeridos en el servicio fundamental y asistencial con las condiciones técnicas y normativas (SEV-SM-01-F03)	Adecuado traslado, instalación, montaje y adecuación de los equipos biomédicos de uso hospitalario	Ejecución del 100% de las actividades de traslados, montajes y adecuación de los equipos biomédicos de uso hospitalario, cuando se le entregue la programación de prioridad y a cumplir con las programas establecidas	Se realiza traslado de area con el cambio de cirugia una a endoscopia el dia 31/03/2016, el traslado se realiza correctamente. Se realiza traslado de area con el servicio de cirugia adulto a cirugia oral el dia 19/04/2016, el traslado se realiza

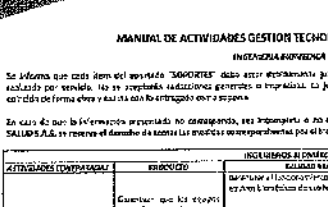


MANUAL DE ACTIVIDADES GESTION TECNOLOGICA EN SALUD S.A.S

INGENIERIA BIOMEDICA

Se informa que cada item del apartado "OBSERVACIONES" debe estar debidamente justificado, diligenciado de manera específica cada actividad realizada por servicio. No se aceptarán redacciones generales o imprecisas. La justificación debe describir completamente lo ejecutado y el estado de forma clara y así mismo ser entregado con la propuesta.


En caso de que la información presentada no corresponda, sea incompleta o no sea debidamente justificada. GESTIÓN TECNOLOGICA EN SALUD S.A.S. se reserva el derecho de tomar las medidas correspondientes por el incumplimiento de lo establecido.


INGENIEROS BIOMEDICOS			
ACTIVIDADES CONTRATADAS	EJECUTO	EQUIPO INTERVENIDO	OBSERVACIONES
Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos electromedicos biomedicos según el plan de mantenimiento programado anualmente por el departamento de ingeniería biomédica	Cumplir con los equipos biomédicos de una determinada área de mantenimiento cuando el fabricante lo recomiende	Realizar el mantenimiento correctivo a los equipos de las siguientes dependencias:	Durante el 16 de MARZO al 15 de ABRIL se garantizo el funcionamiento de los equipos biomédicos de los servicios a cargo UNG. ADULTOS y UNG. GINECOLOGIA) En el servicio de IMAGENOLOGIA ADULTOS de hospitalario 5 equipos de organo en uso de cabeza, se abrio orden institucional (UNG. ADULTOS 01 falla) el cual realizaron en cada oportunidad. En el servicio de URGENCIAS ADULTOS se recepcion equipo fetal portatil de serie 5600P0000ACCE0350G6, ubicado en el triage.
		Incumplimiento reportado del plan de mantenimiento preventivo de los equipos electromedicos biomedicos, conforme al cronograma establecido.	Durante el 16 al 31 de MARZO se gestiono con las siguientes observaciones:

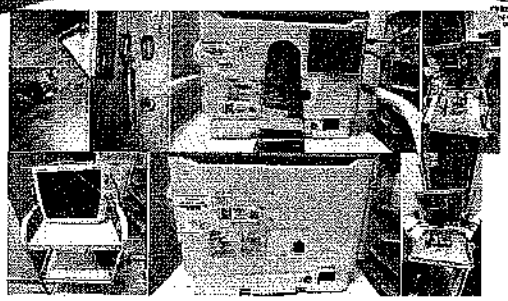



			correctivo de [illegible] MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINA DE SIGNOS VITALES MARCA MEDITTA MODELO H40 NUMERO DE SERIE 19-03004405. • SERVICIOS: UPS. GINECOLOGIA: No aplica UCI. ADULTOS: No aplica
		Informar y coordinar con [illegible] el día 19 de ABRIL para el cambio de equipo de [illegible]	No aplica


ANEXOS FOTOGRAFICOS

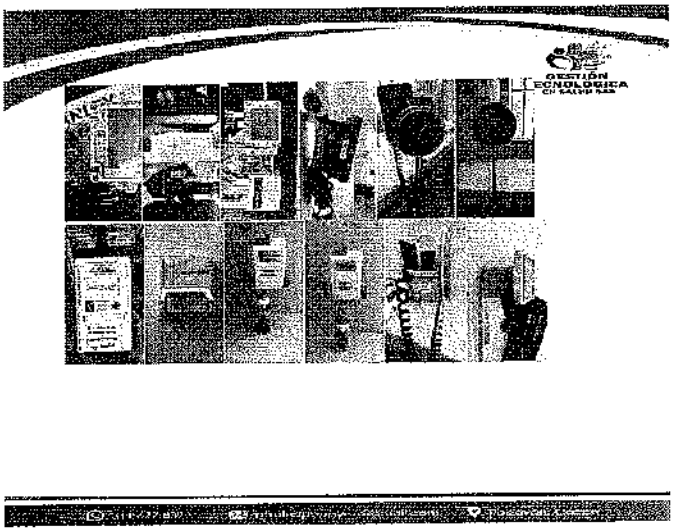


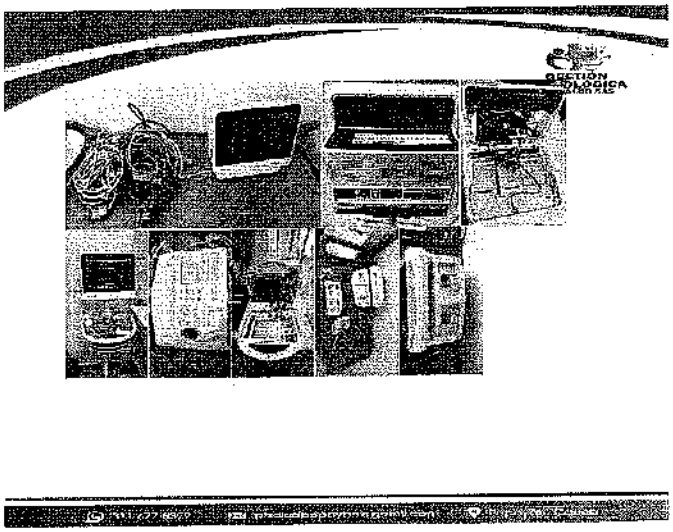


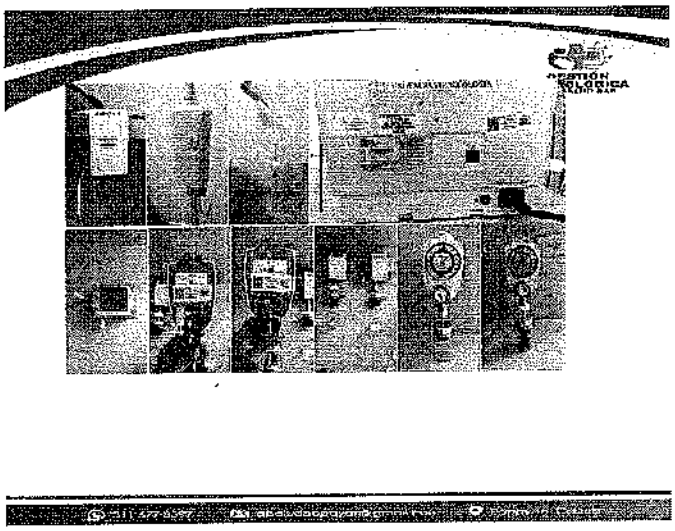


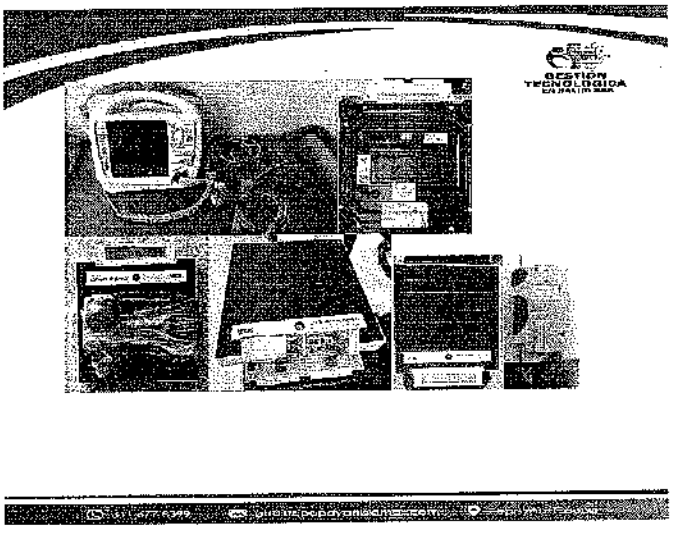


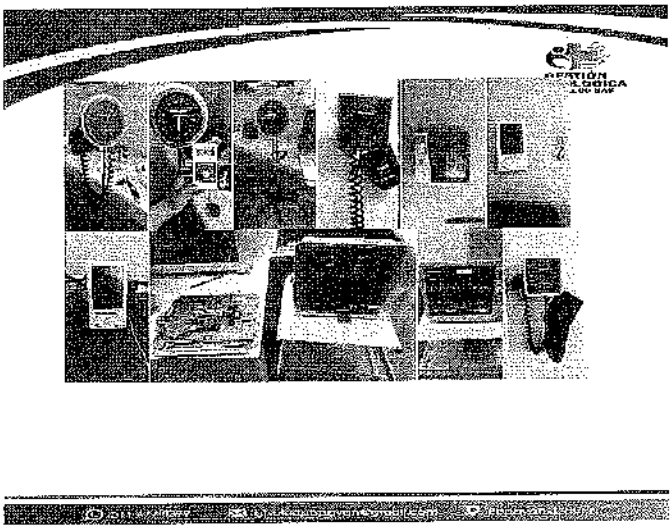


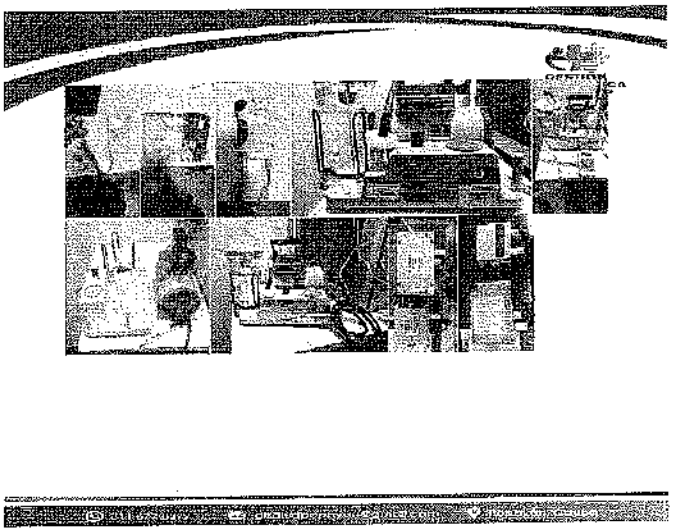

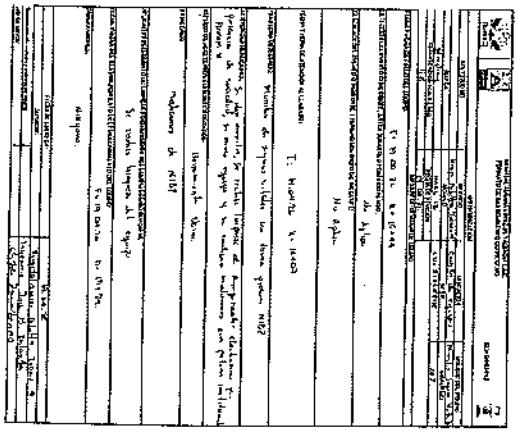

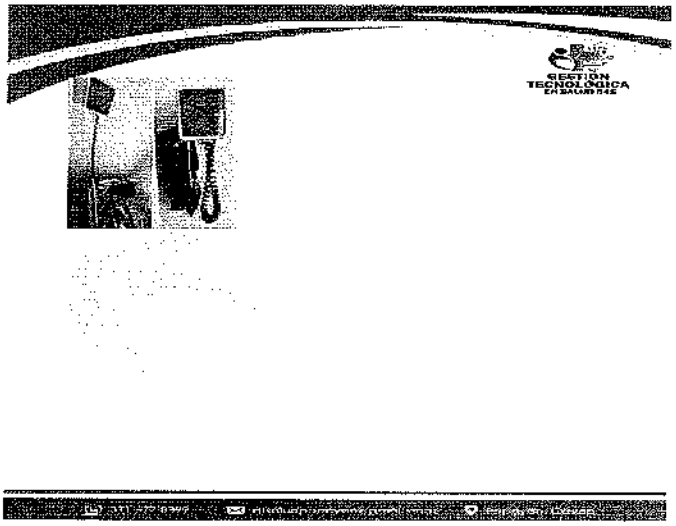


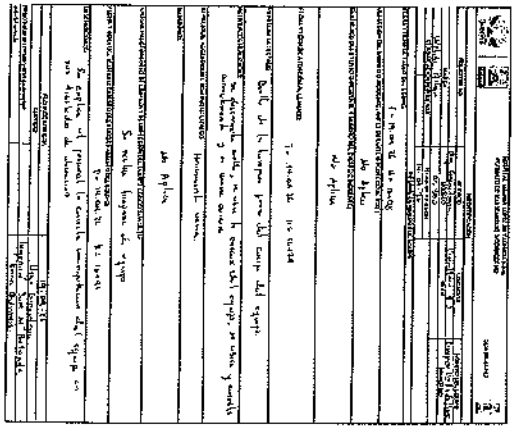

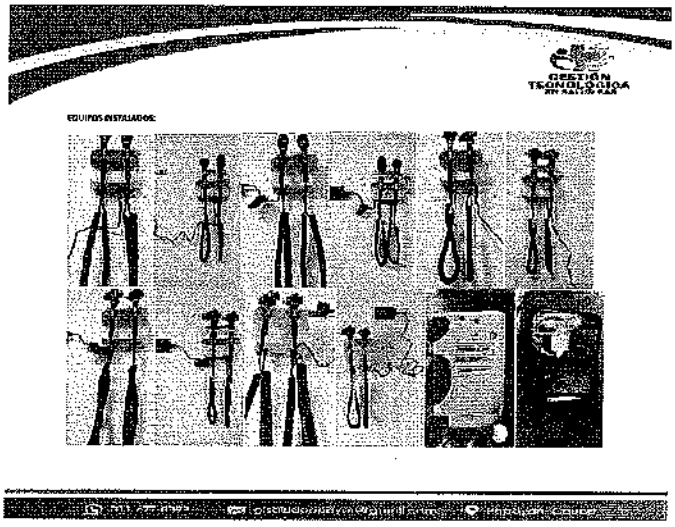

CRONOGRAMA
DISPONIBILIDAD


MANTENIMIENTOS
CORRECTIVOS

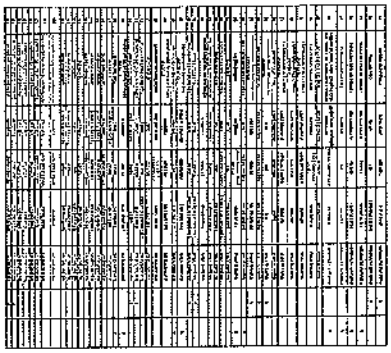


FEBRERO							
LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	DESCRIPCION
						DANILO	PRIMERO DE FEBRERO DANILO
		5 ROAS					2 AL 8
		C JORGE					9 AL 15
		Y ADRIAN					16 AL 22
		L MARIO					23 AL 28


MARZO							
LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	DESCRIPCION
						1 MARIO	PRIMERO MARZO
		BALANTA					2 AL 8
		SOLARTE					9 AL 15
		[illegible]					16 AL 23 FESTIVO
DANILO		ROAS					MARTES 24 AL 29
JORGE							30 Y 31 DE MARZO


ABRIL							
LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	DESCRIPCION
		JORGE	JORGE	JORGE		JORGE	SEMANA SANTA
		ADRIAN					6 AL 12
		L MARIO					13 AL 19
		BALANTA					20 AL 26
SOLARTE							27 AL 30 JUEVES

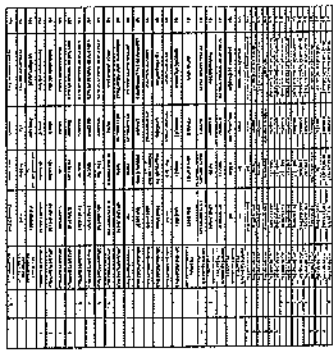



CRONOGRAMA MANTENIMIENTOS

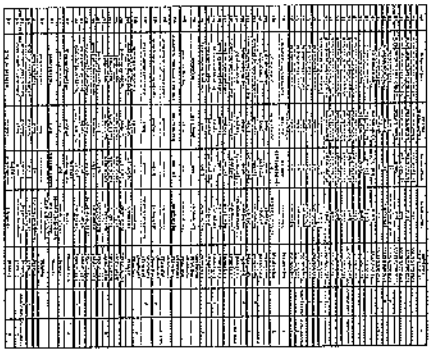


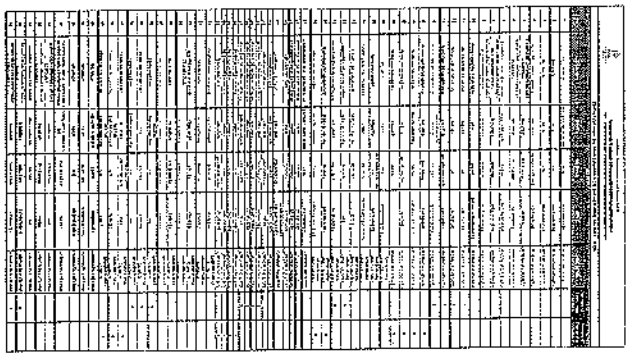

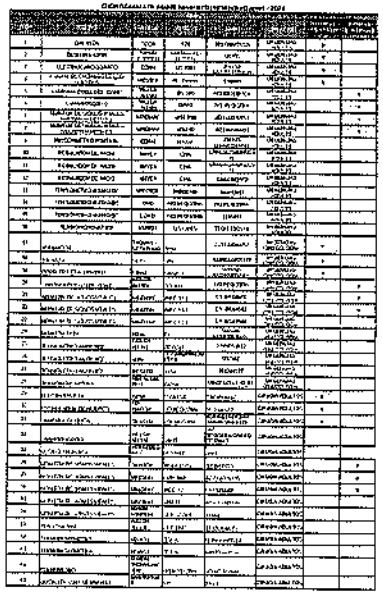

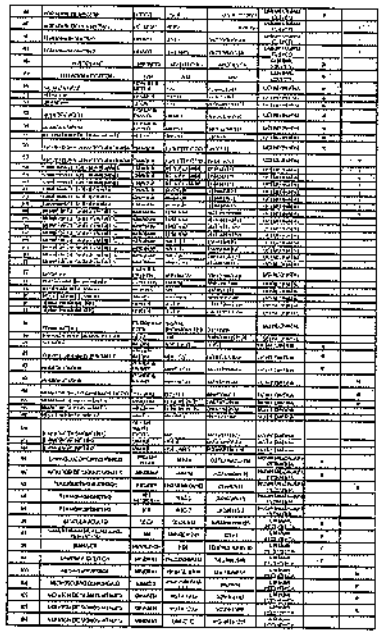

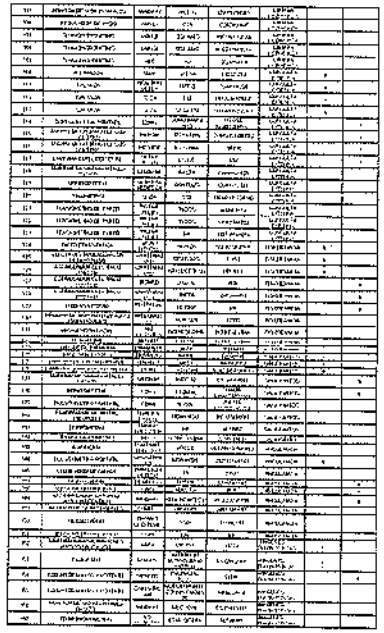

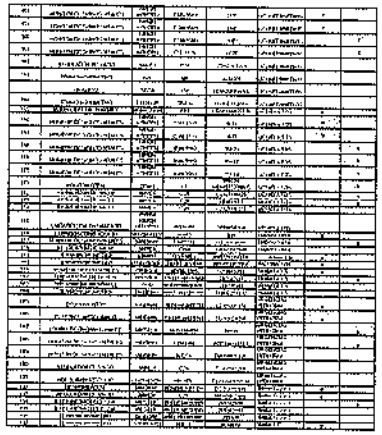

GARANTIA

GESTIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD SAS

Popayan 17 de abril de 2026.

Señores

HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.


Asunto: Garantía por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo


Yo, Luz Dary Perez Viveros, identificado con cédula N° 34,564.776 de Popayán, en calidad de representante Legal de GESTIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD S.A.S., identificada con NIT 901.814.457-8, manifiesto de manera expresa que otorgo la presente Carta de Garantía por los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo prestados a los equipos biomédicos del Hospital Susana López de Valencia E.S.E.


Atentamente,

Representante Legal
Gestión Tecnológica en Salud S.A.S.
NIT: 901.814.457-8
Cel: 3004627723
Correo: gestiontecnologicasas@gmail.com


HOJAS DE VIDA

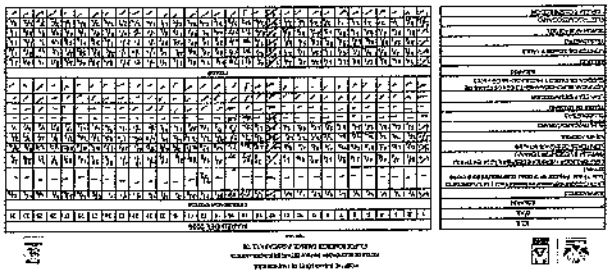


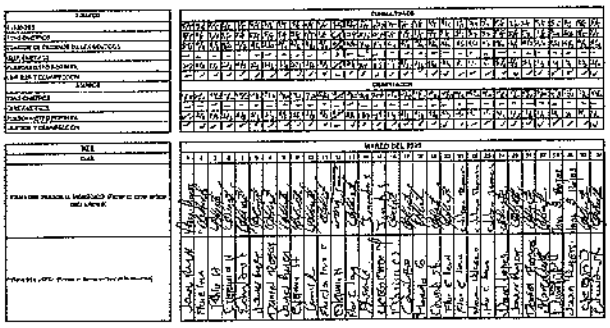


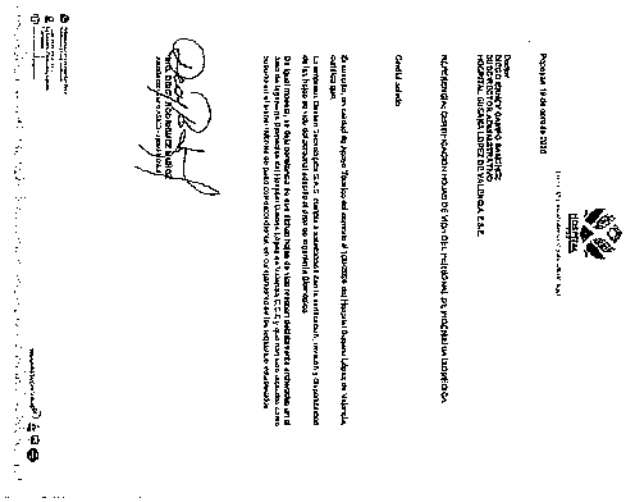



LISTAS DE CHEQUEO

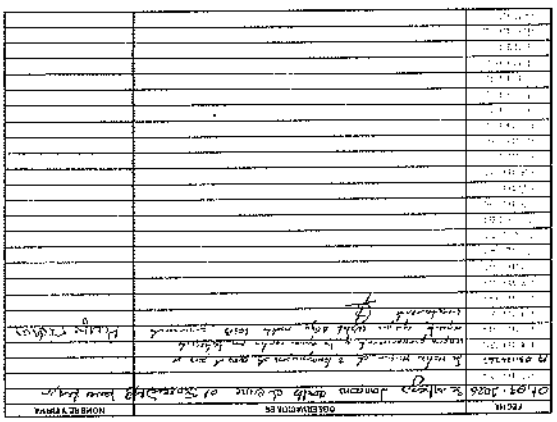


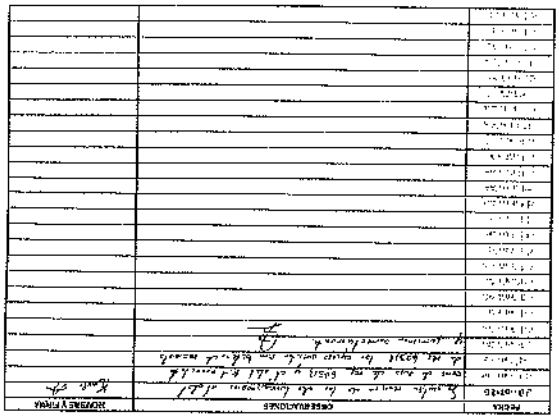

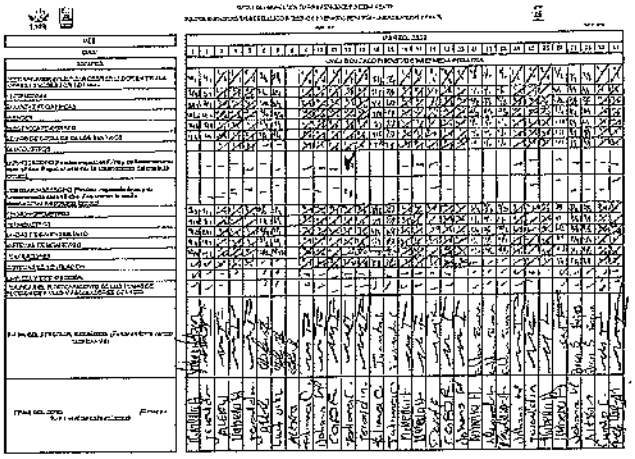


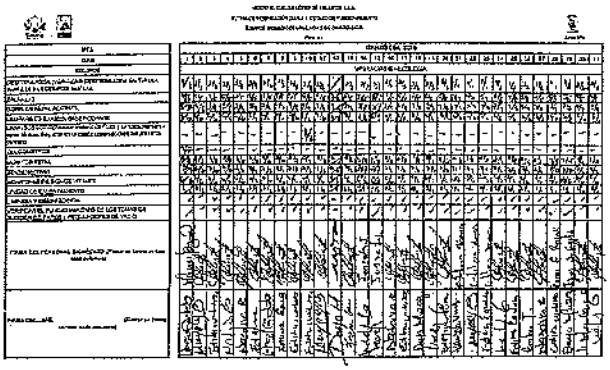

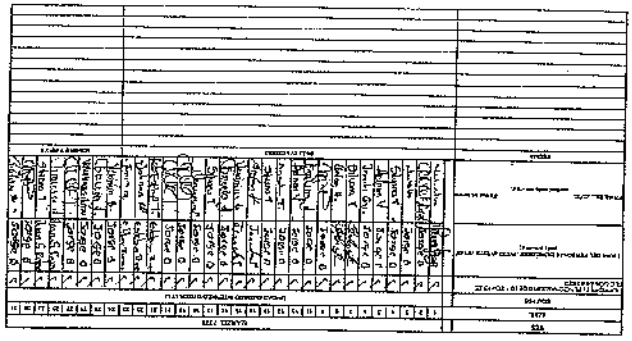


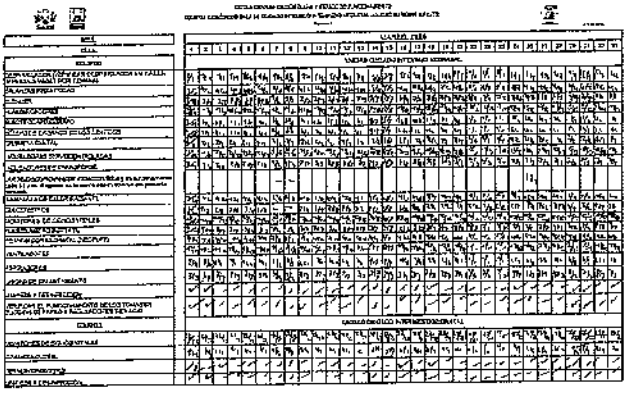



FECHA	OBSERVACIONES	NOMBRE Y FIRMA
30/03/26	[illegible] Quirófano 2 Falla. Se realiza	
[illegible]	cambio de módulo, se realizan pruebas funcionando	
[illegible]	correctamente serie de [illegible] [illegible]	[illegible]
[illegible]	Se realiza cambio del [illegible] quirófano 2, se [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	Se realiza cambio del sellado Quirófano 1	
[illegible]	Se realiza cambio del sellado Quirófano 1	
[illegible]	Se realiza cambio de cal sellado Quirófano 2	
[illegible]	Se realiza cambio del sellado Quirófano 1	
[illegible]	Se realiza cambio del sellado Quirófano 1	
30/03/26	Se realiza cambio del sellado Quirófano 2	
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		

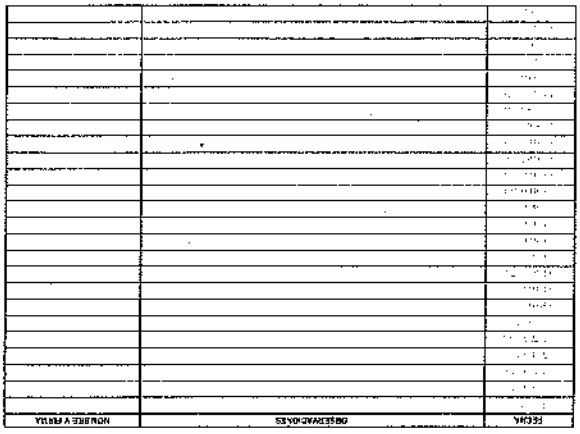


FECHA	OBSERVACIONES	NOMBRE Y FIRMA

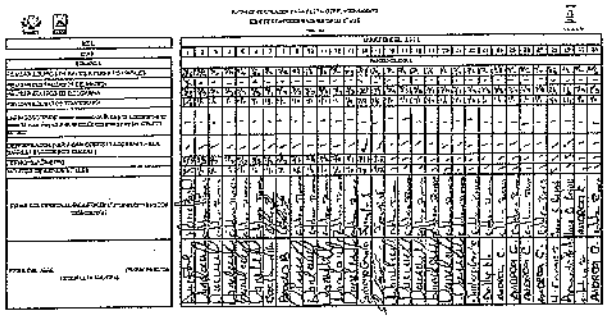


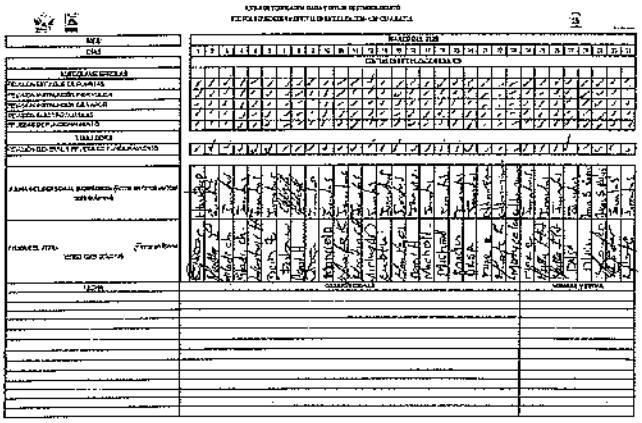


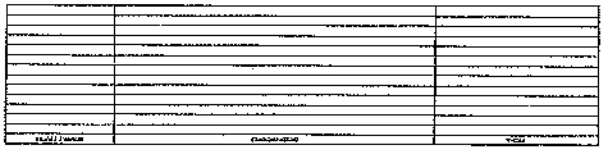


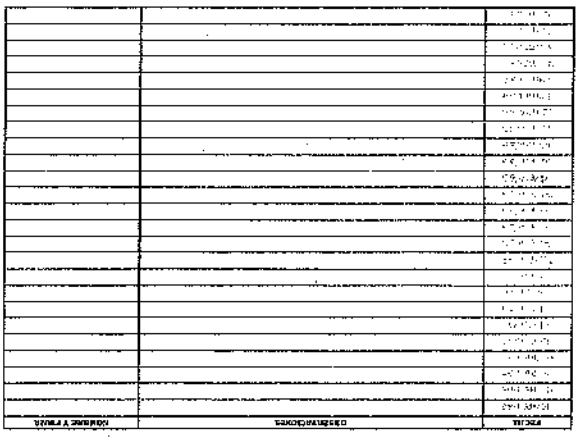



FECHA	OBSERVACIONES	NOMBRE Y FIRMA

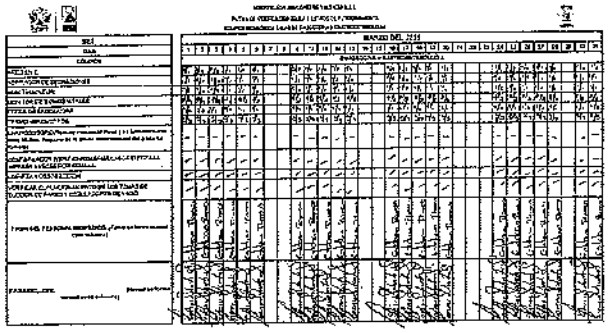


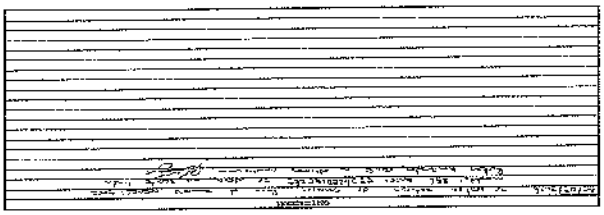


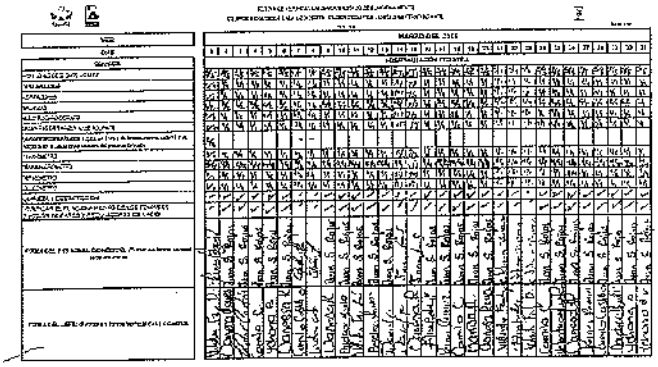


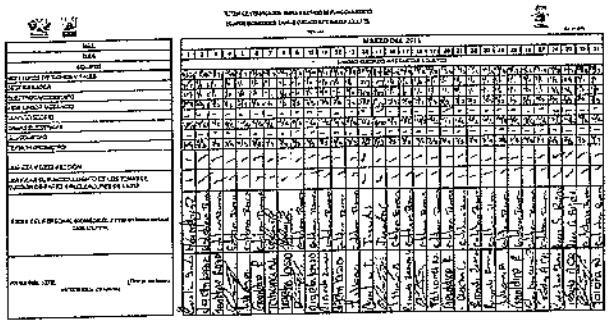

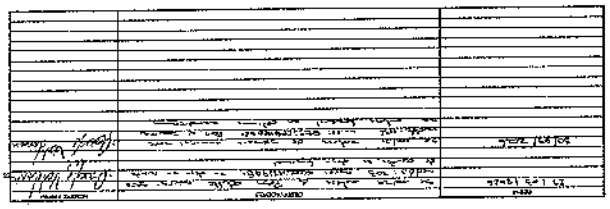


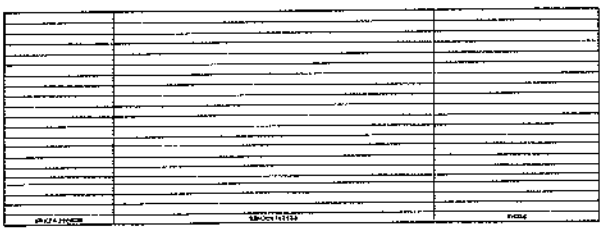


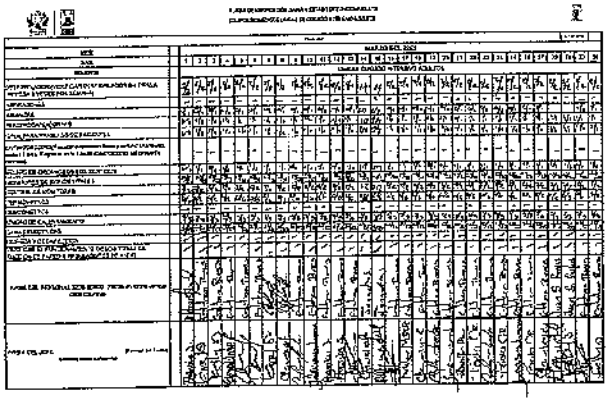


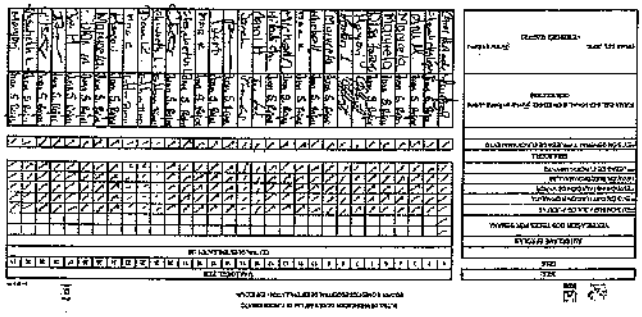



FECHA	OBSERVACIONES	NOMBRE Y FIRMA
01/05/2026	En Pandal de Juan y Pedro de Pamal mil y pico	Vda. Evarista Ruiz
	Grande funcionando correctamente. Ufff	Vda. Evarista Ruiz

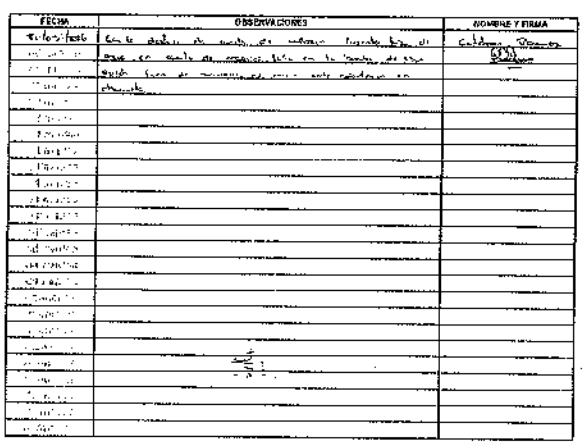


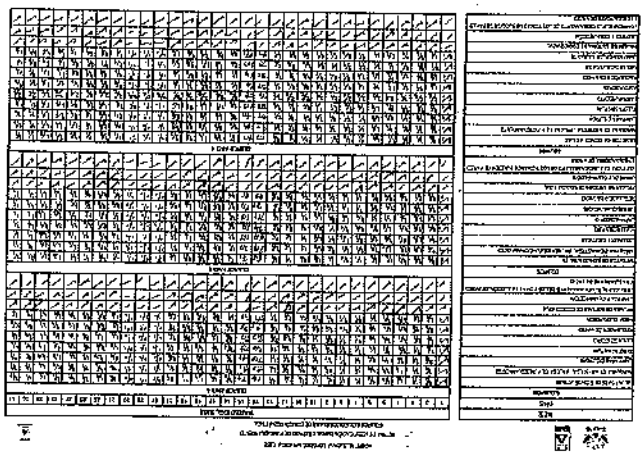


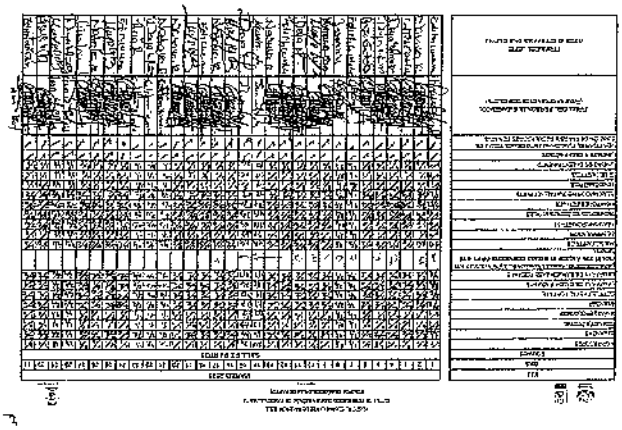


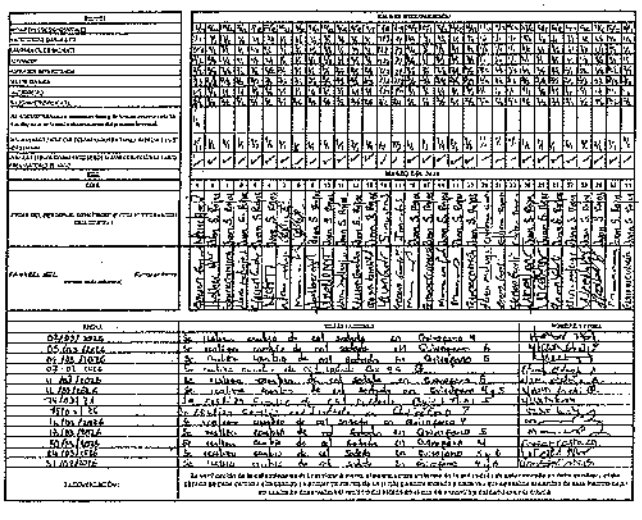


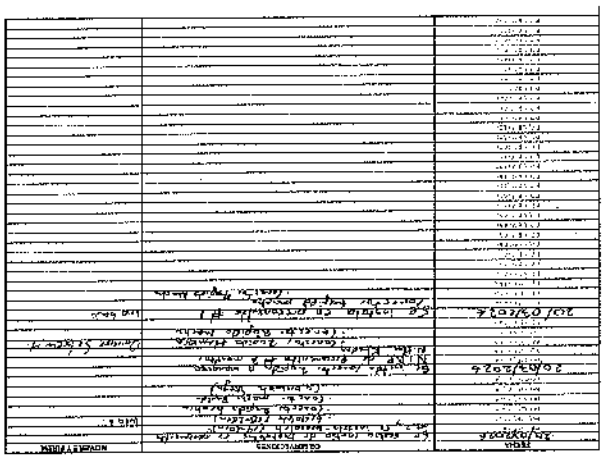


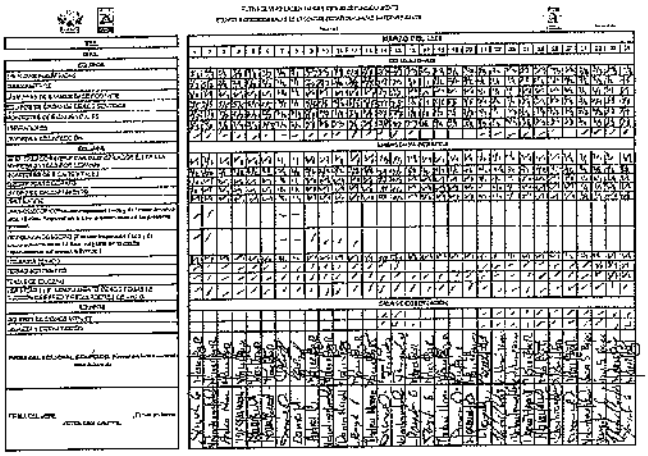


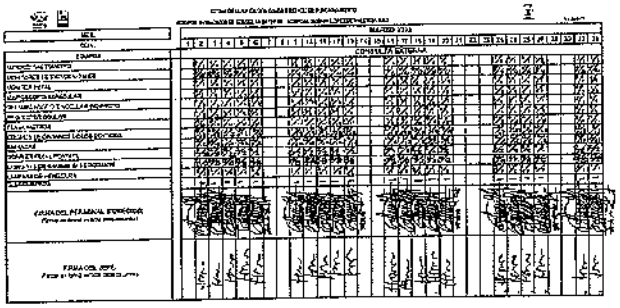

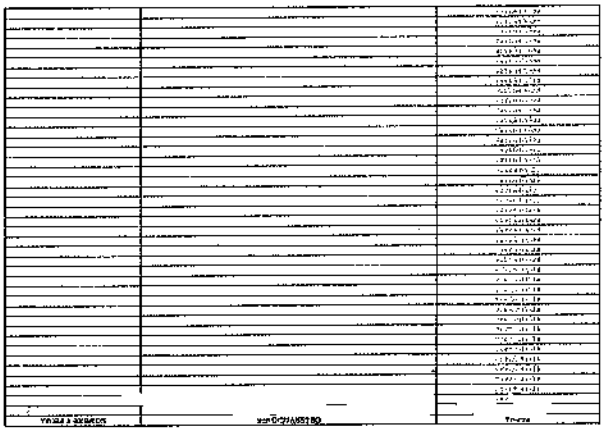


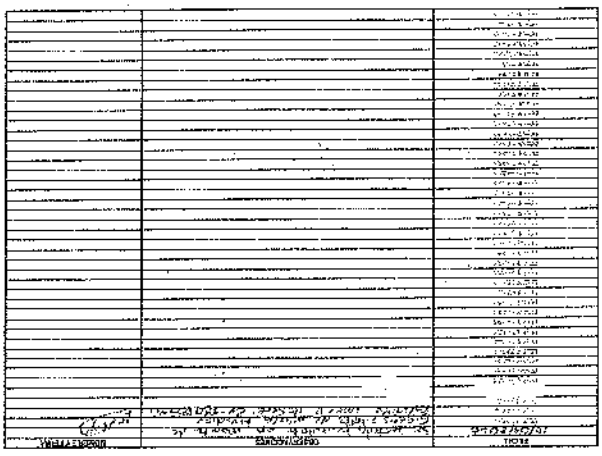

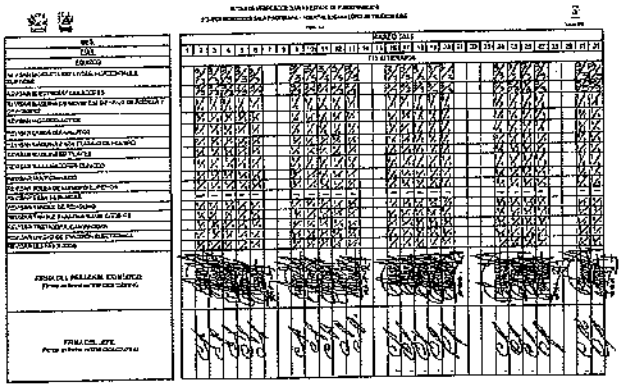


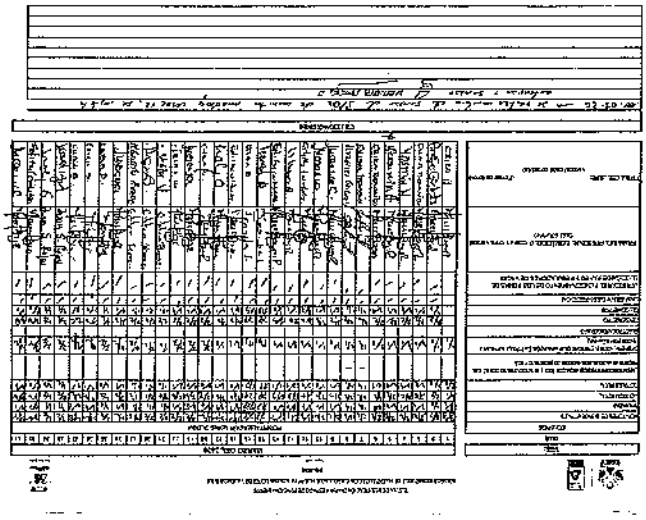


FECHA	OBSERVACIONES	NOMBRE Y FIRMA
17-03-2026	Se expone Tema: El cuidado de uno mismo 10 Minutos Aprox.	
	Usuario tenido del cuido, quedo Conforme.	
	Siguio bien durante el Tiempo Asignado.	
18-03-2026	Se entregan B. Complejos de 1200 Mg 17.26 cu/g	
19-03-2026	Se retira Inmunización y Medicamento el	
	paciente para Se Atiende Control del Joven Diego Fuentes	
	quedo Conformado Firma Retirado.	
30-03-2026	Se entregan 2 Cajas de Ampolla el Enfermo y con	
	Indicaciones Quedan Entendidas y Conformado.	

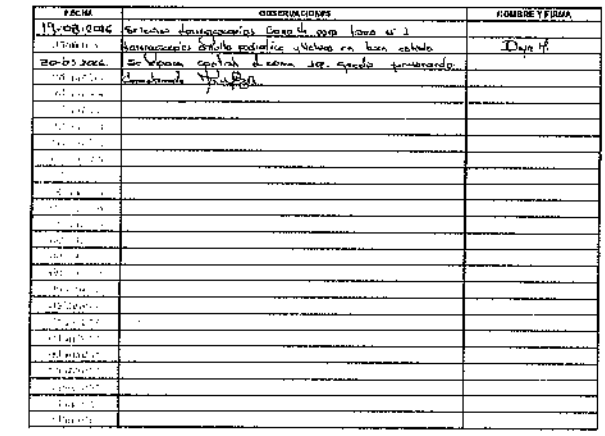

FECHA	OBSERVACIONES	NOMBRE Y FIRMA
19-03-2026	Se retira Inmunización Control de niño Joven 11	
	Inmunización Estado pediatrico y Velvas en buen estado	
20-03-2026	Se Vacuna contra el tetano 10 cc. Quedo Tranquilo.	
	Conforme	

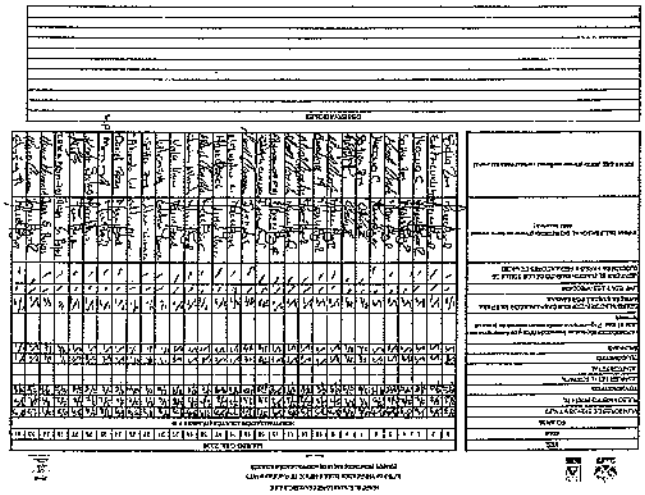

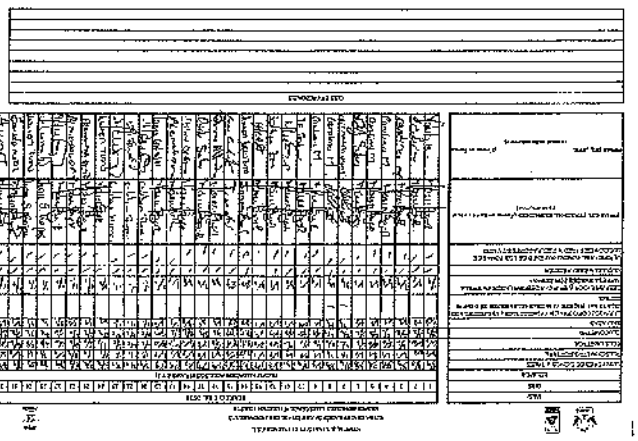



FECHA	OBSERVACIONES	NOMBRE Y FIRMA
06-03-2026	Se atiende paciente y control sin novedad, quedo	
	Funcionando Conforme	


FECHA	OBSERVACIONES	NOMBRE Y FIRMA
[illegible]	en donde se encontró [illegible] con la	
[illegible]	[illegible] que no [illegible] en movimiento. Se [illegible] los	
[illegible]	[illegible] quedo funcionando correctamente. [illegible]	
[illegible]-2026	Se realiza [illegible] del [illegible] de paso [illegible]. El	[illegible]
[illegible]	[illegible]	
[illegible]-08-2026	Se [illegible] control y [illegible] [illegible] quedo	
[illegible]	[illegible]	


FECHA	OBSERVACIONES	NOMBRE Y FIRMA
[illegible]	Se realizó [illegible] de [illegible] [illegible]	
	que el [illegible] de paso está [illegible] por	
	[illegible] [illegible] por parte de	
	la [illegible] Vanesa [illegible] [illegible]	
	[illegible] [illegible] y [illegible] en buen	
	estado, el [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible]	
	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]


FECHA	OBSERVACIONES	NOMBRE Y FIRMA

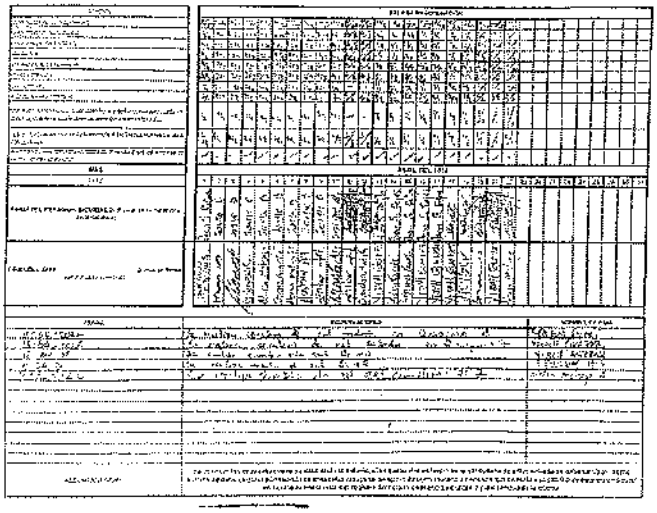


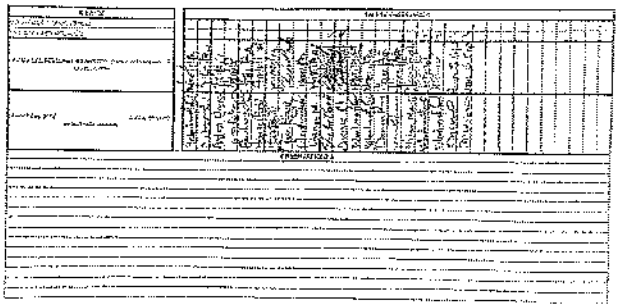


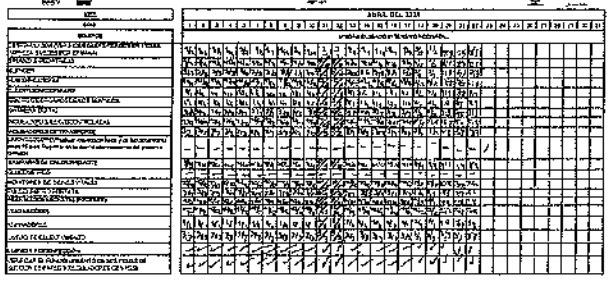


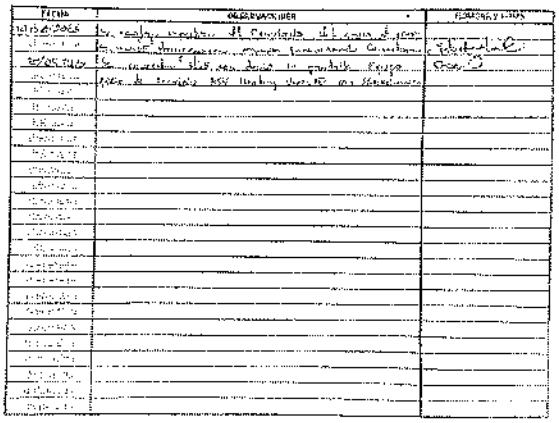

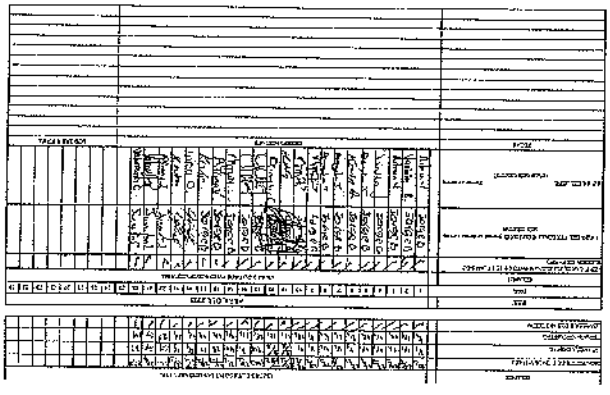


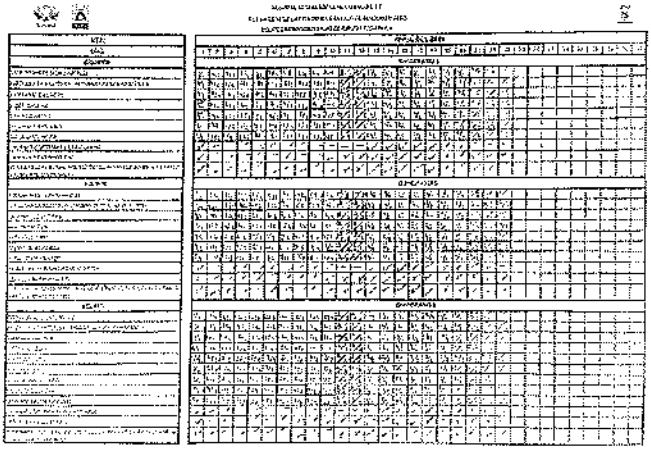


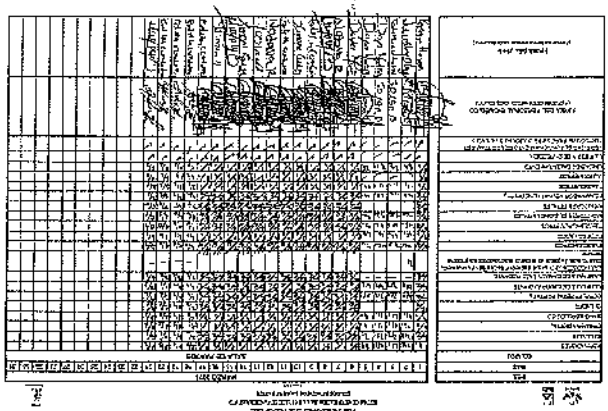

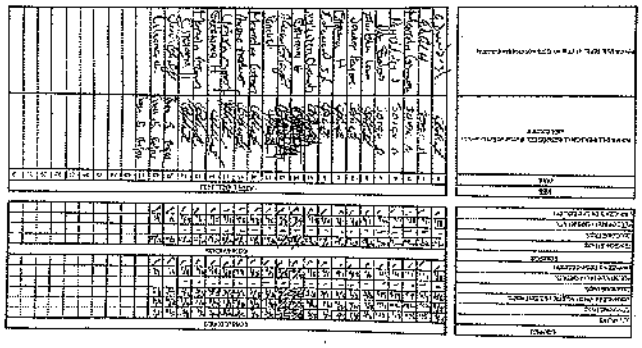

FECHA	OBSERVACIONES	NOMBRE Y FIRMA

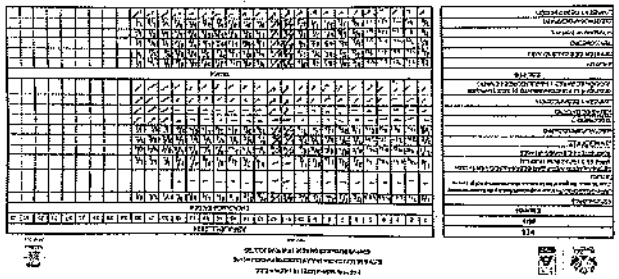

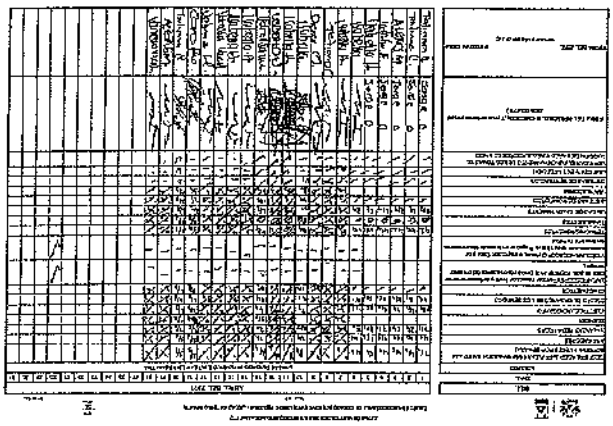


FECHA	OBSERVACIONES	NOMBRE Y FIRMA
16/Abril/2025	Se llevan mala terminación de pintura en algunas áreas especialmente en la parte superior de la pared, en la esquina de la entrada principal y en la parte posterior de la pared.	Esteban Acosta R.
16/Abril/2025	Se informa al servicio de jardinería de mantenimiento para que realice podas en los arbustos en la parte posterior de la zona.	

FECHA	OBSERVACIONES	NOMBRE Y FIRMA


FECHA	OBSERVACIONES	NOMBRE Y FIRMA
03/04/26	Se realizó cambio del [illegible]	
07/04/26	Se realizó [illegible]	
	[illegible]	
07/04/26	Se realizó cambio [illegible]	
08/04/26	Se realizó [illegible]	


FECHA	OBSERVACIONES	NOMBRE Y FIRMA
07-09-26	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	


FECHA	OBSERVACIONES	NOMBRE Y FIRMA
[illegible]	Se realizó [illegible]	

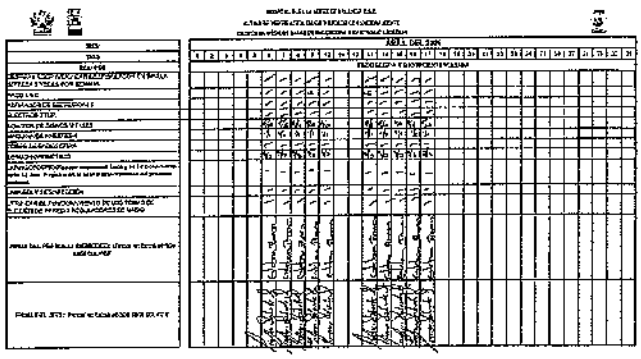


FECHA	OBSERVACIONES	NOMBRE Y FIRMA
23/04/26	Se realiza transferencia Quirófano 2 hia en hos	
[illegible]	Sale objeto transfer. se encuentra sin protocolo transfer	
24/04/26	Se realiza Cambio Sol Enfermo Quirófano 2 y 3	
24/04/26	Se realiza Cambio Tiempo de espera en quirófano	
[illegible]	723	
27/04/26	Se realiza verificación de funcionalidad mobiliario	
[illegible]	60 Días Funcionando Correctamente	
28/04/26	Se realiza traslado de Quirófano	
29/04/26	Se realiza revisión de mobiliario por	Heller Holy
[illegible]	material, equipo encontrando conforme	

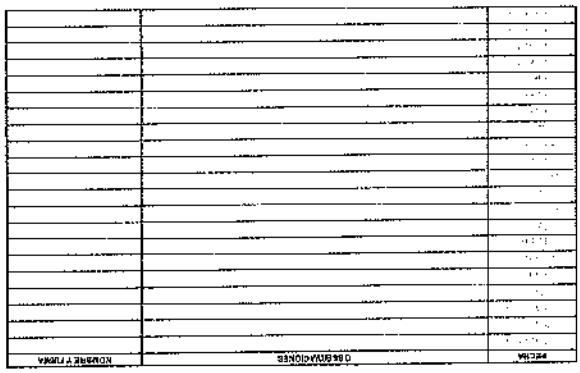


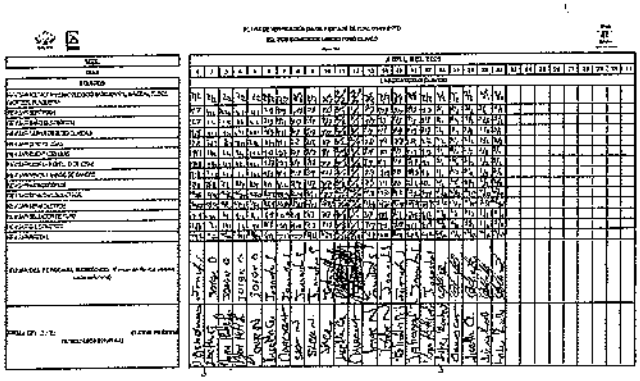


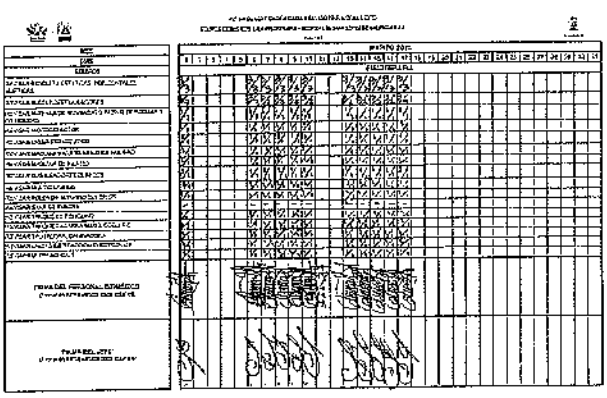


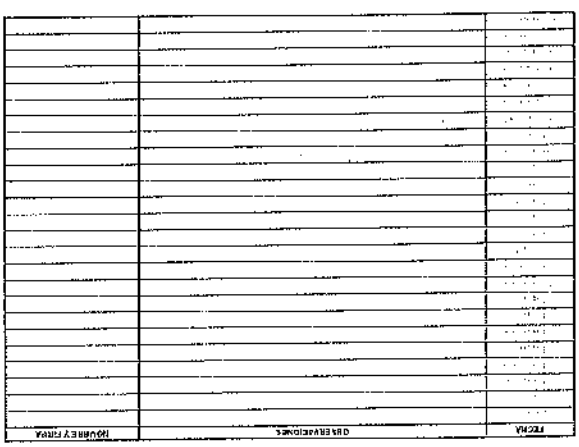



MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

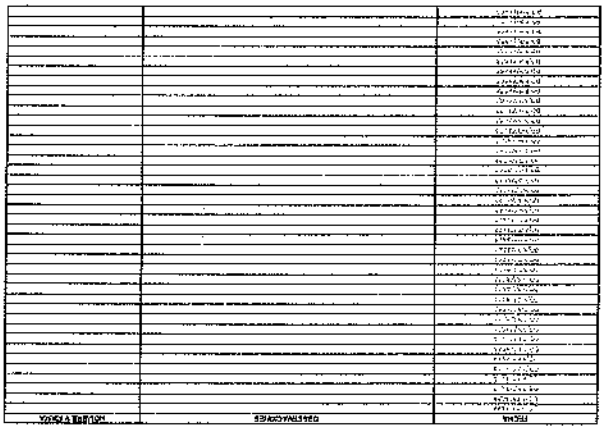


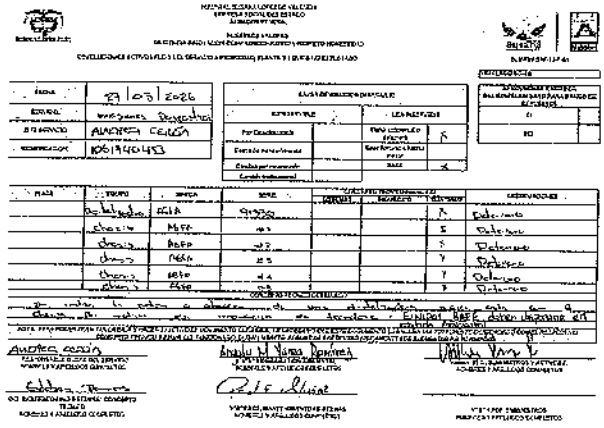


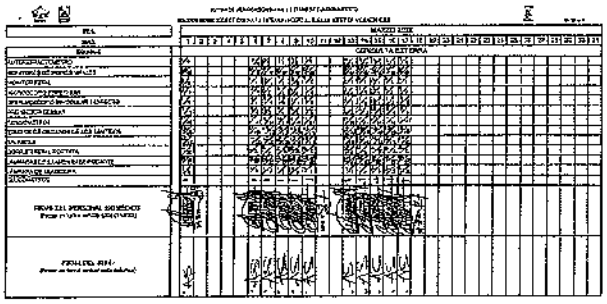


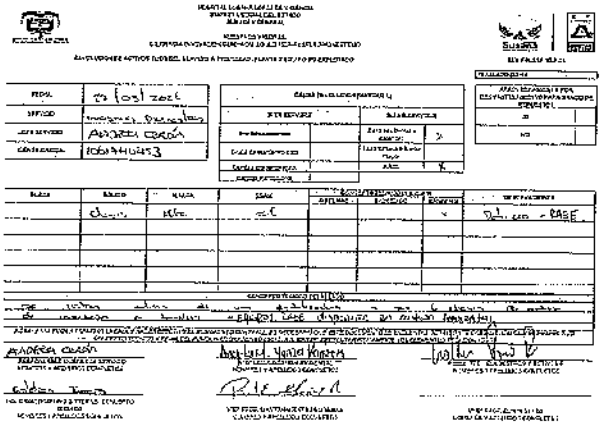


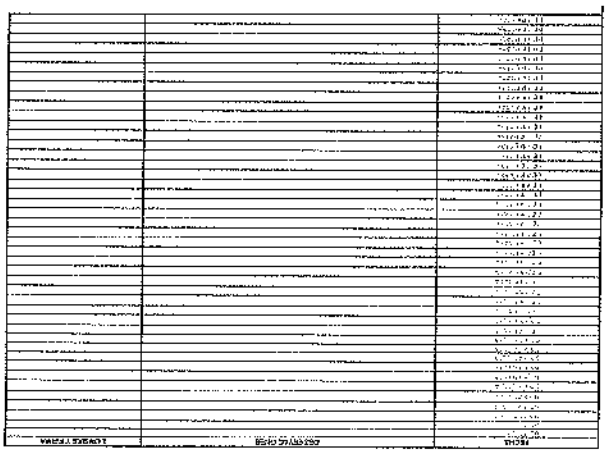


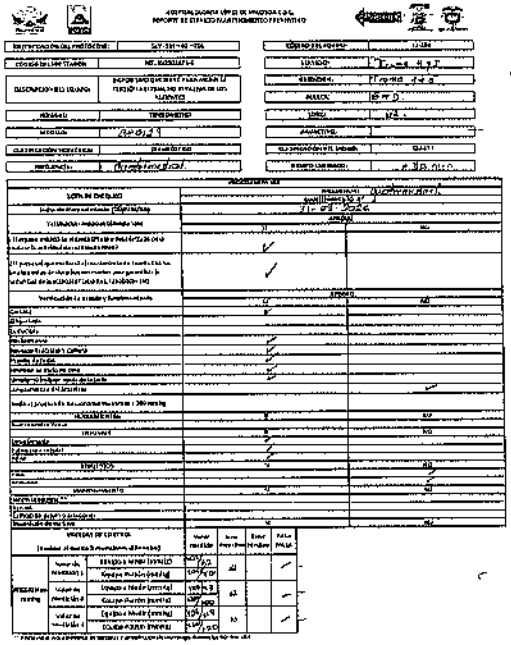


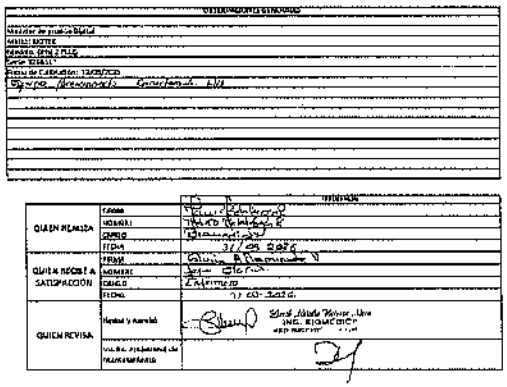


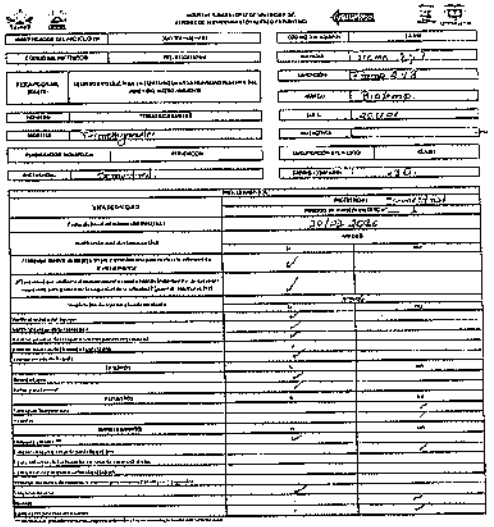


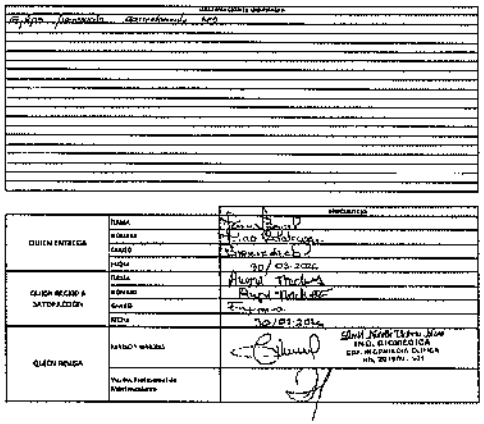


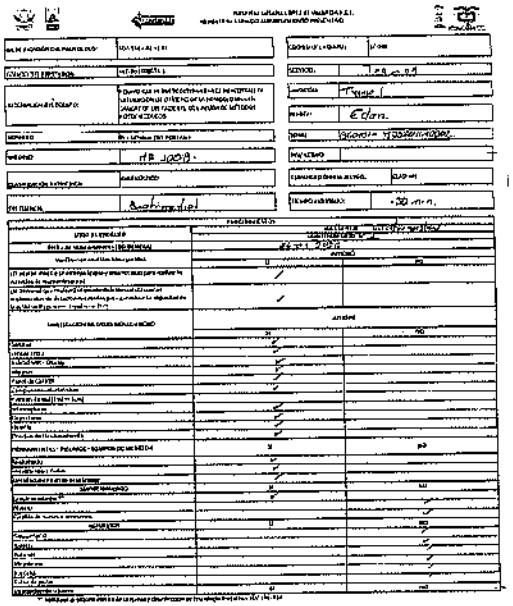


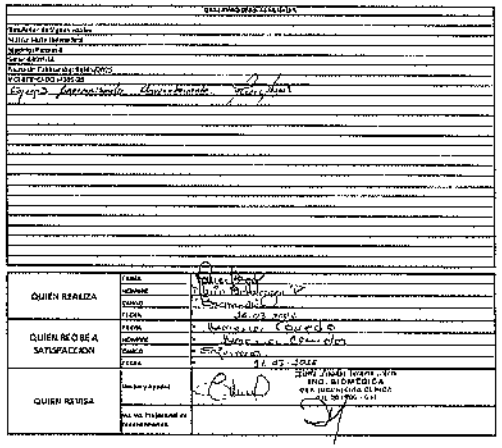


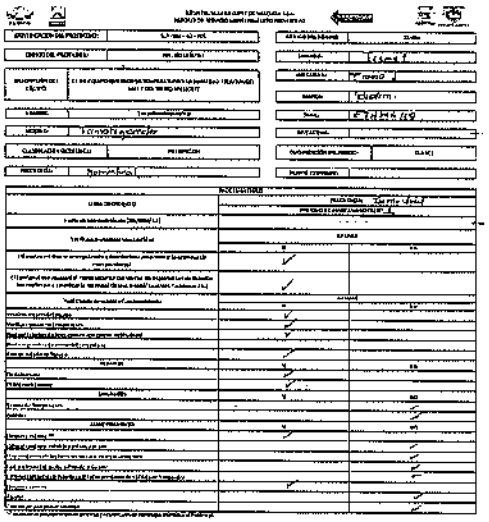


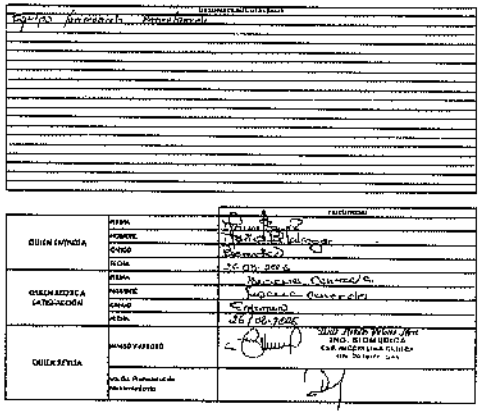


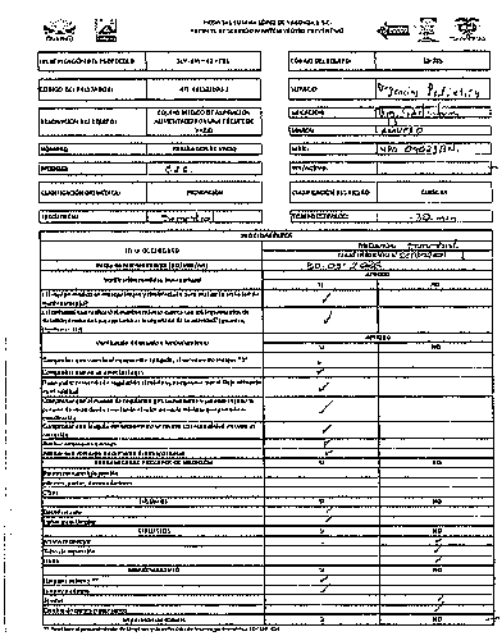


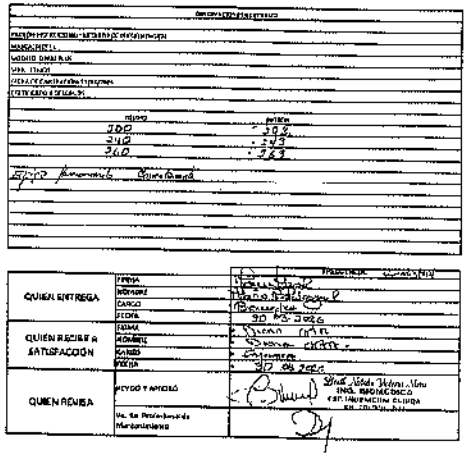


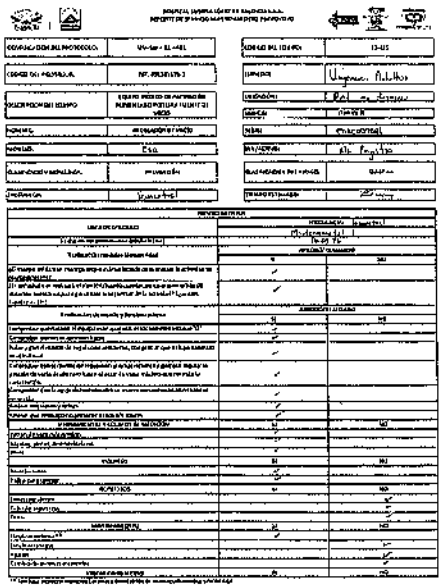


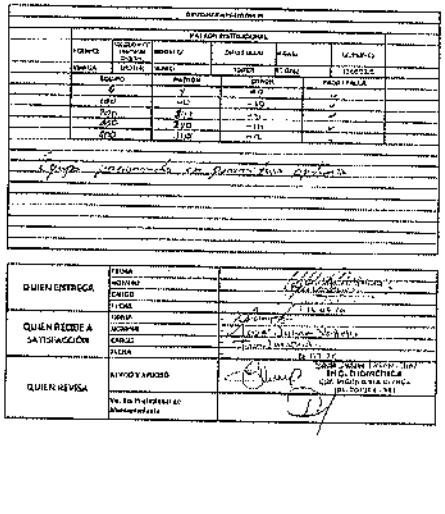


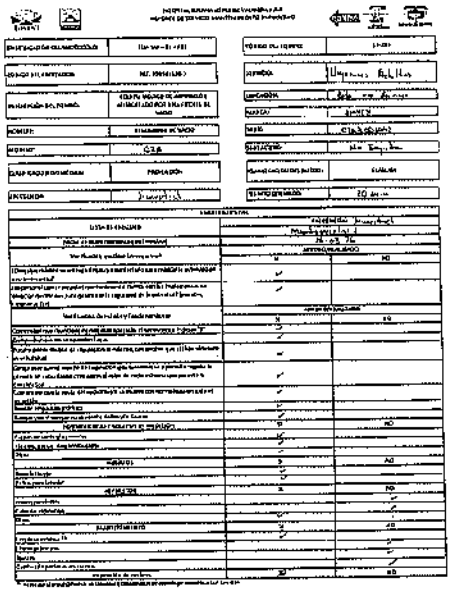


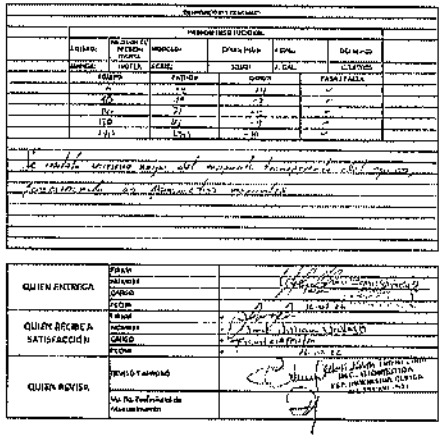


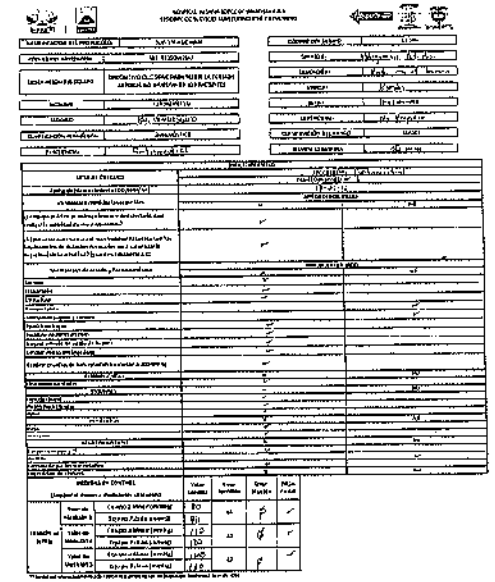


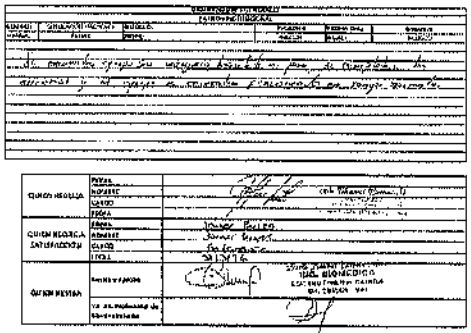


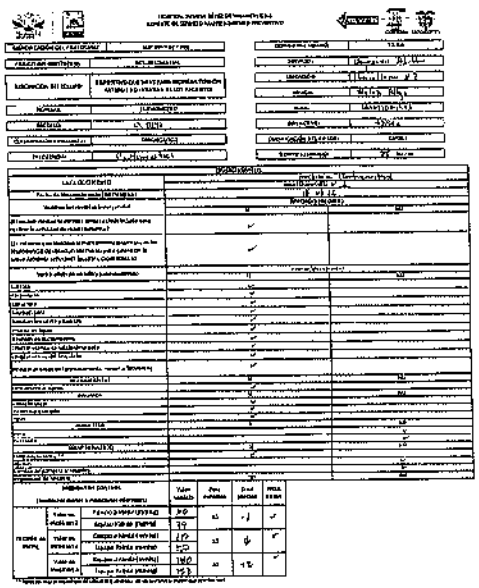


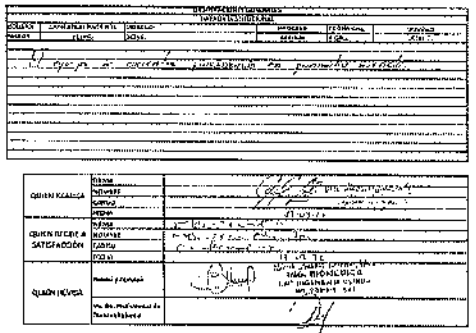


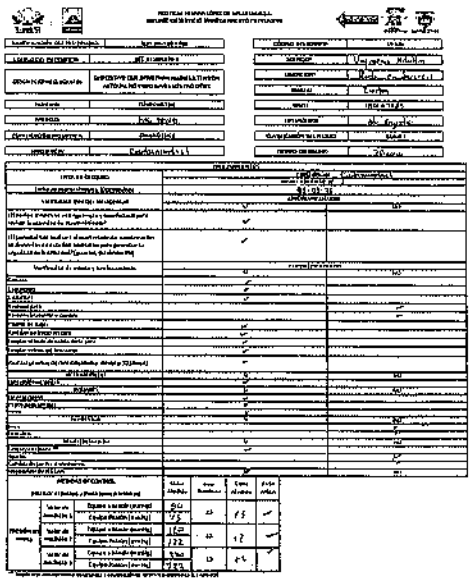


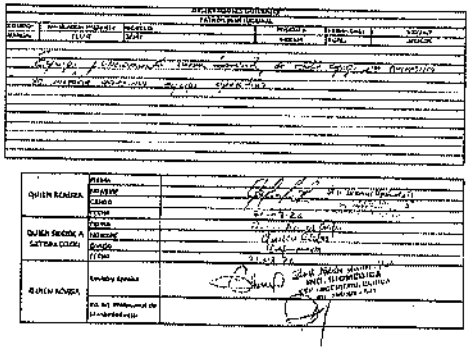


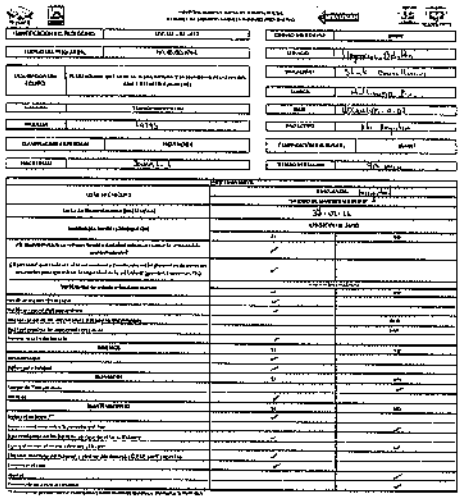


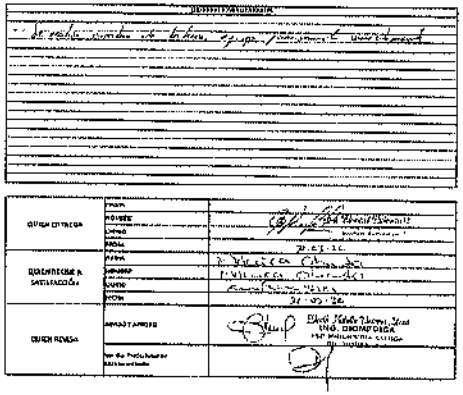


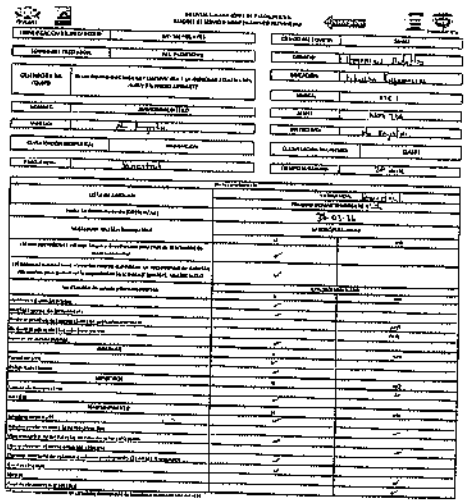


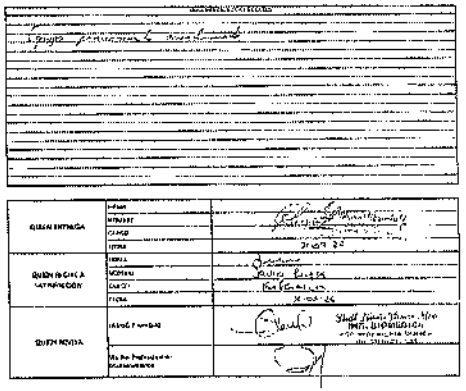


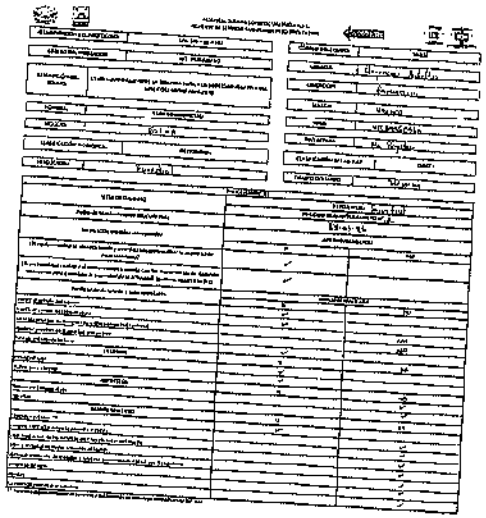


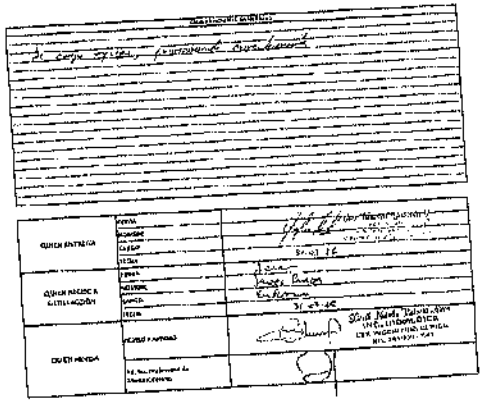


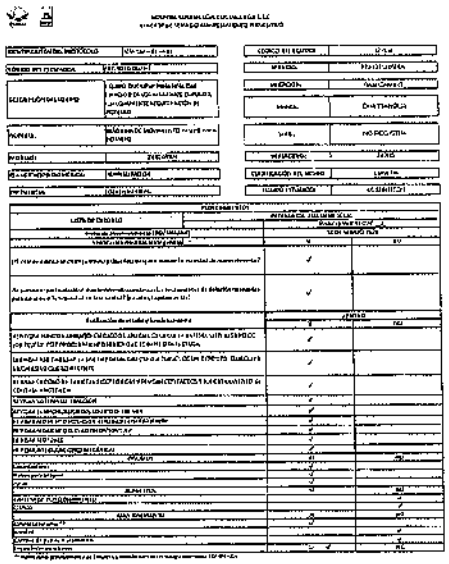


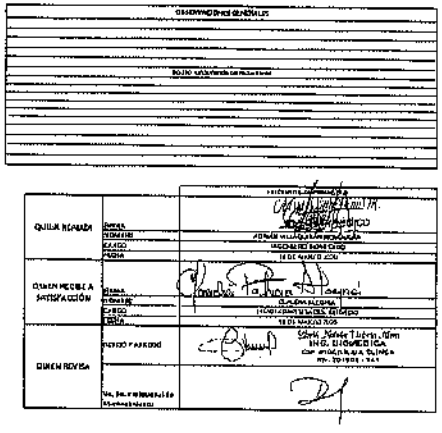


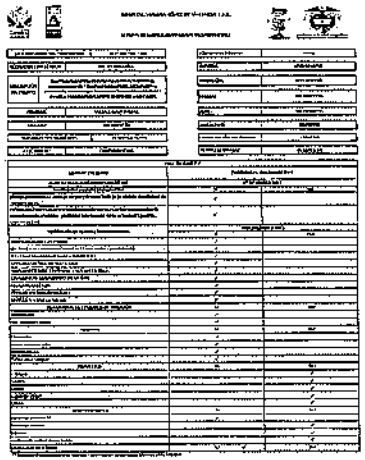


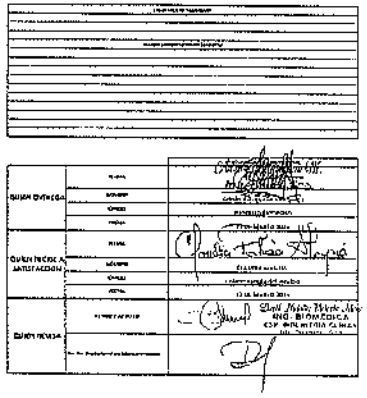


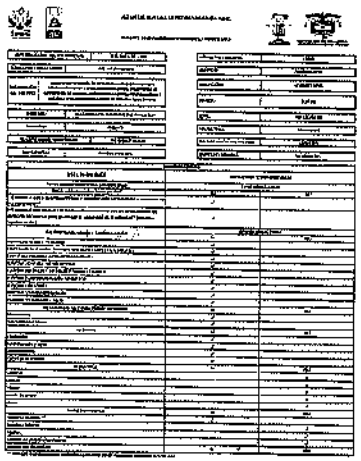


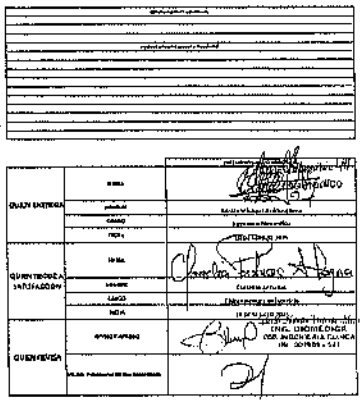


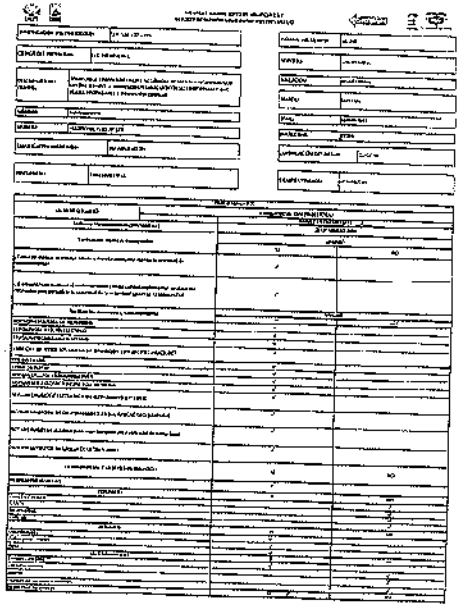


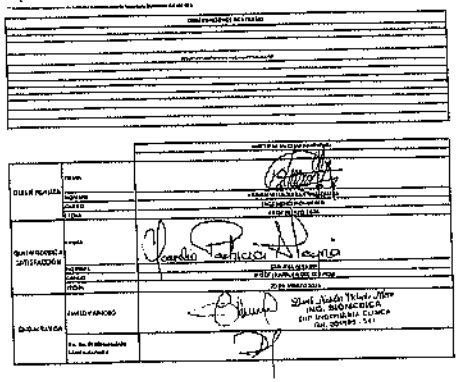


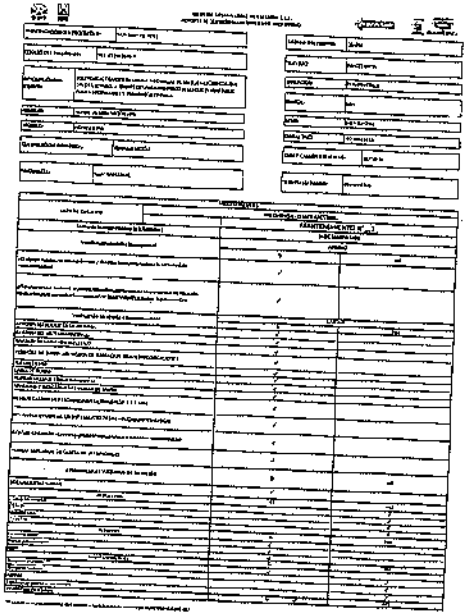


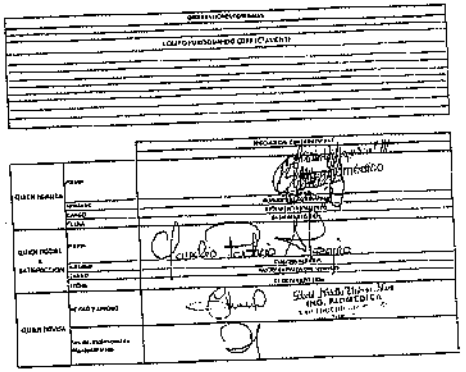


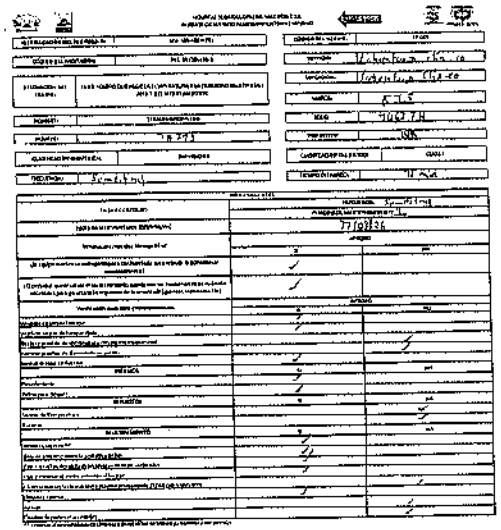


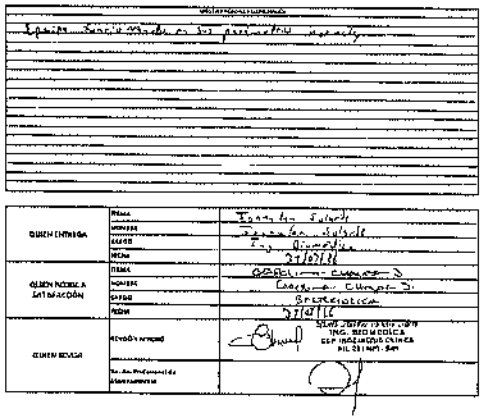


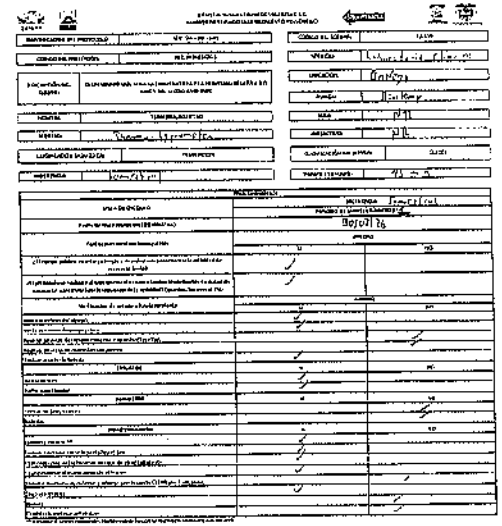


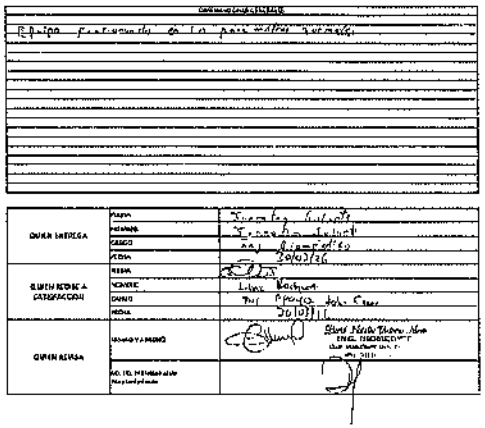


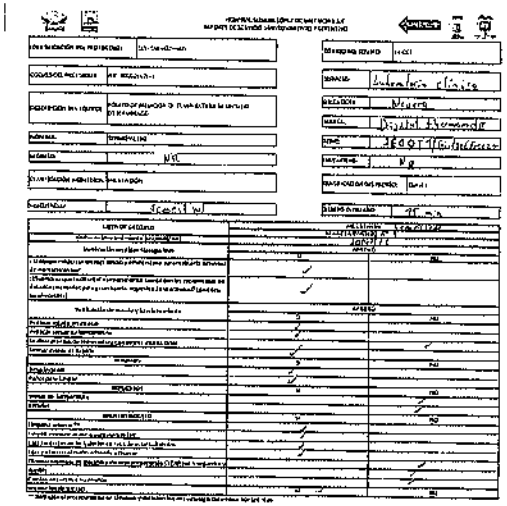

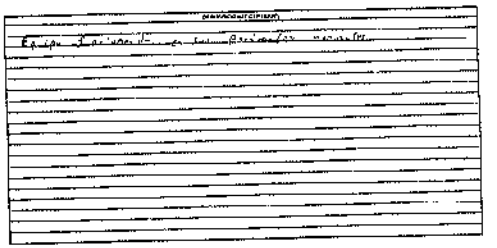


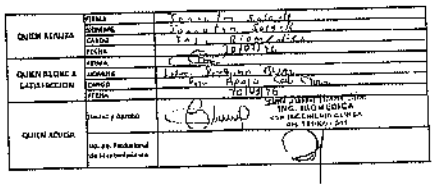


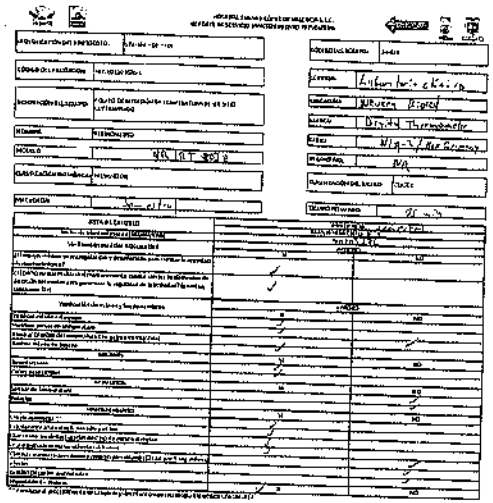

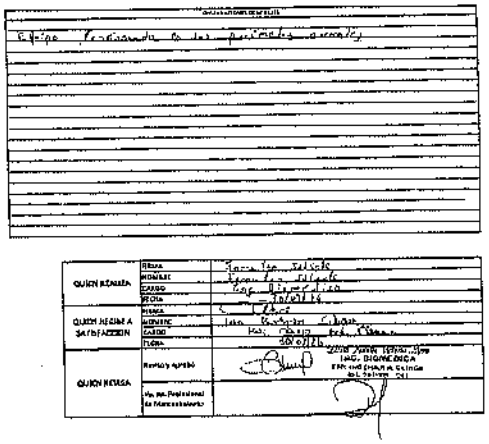



QUIEN REVISA	FIRMA	
	NOMBRE	Francisco Salcedo
	CARGO	Ing. Biomédico
	FECHA	24/07/21
QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA	
	NOMBRE	Juan Rodrigo Salazar
	CARGO	Mant. Equipo Biomédico
	FECHA	26/07/21
QUIEN REVISA	Revisó y Aprobó	ING. BIOMEDICA ESP. INGENIERIA CLINICA MAT. 25172504 CPI
	Vo. Bo. Profesional de Mantenimiento	

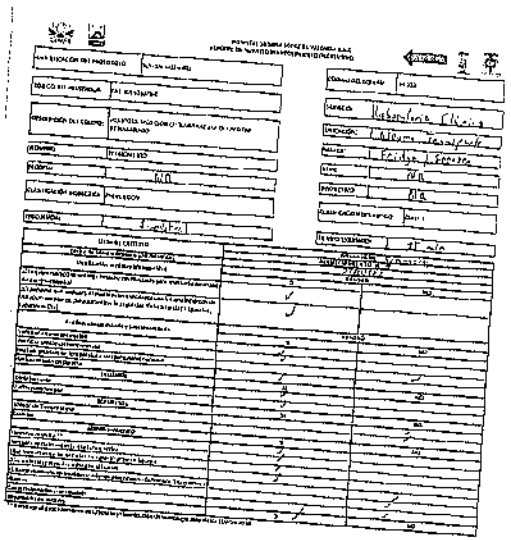

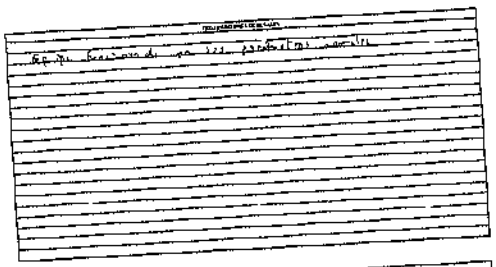

QUIEN REVISA	FIRMA	
	NOMBRE	Francisco Salcedo
	CARGO	Ing. Biomédico
	FECHA	24/07/21
QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA	
	NOMBRE	Cristian Camargo
	CARGO	Mantenimiento Clínico
	FECHA	27/07/21
QUIEN REVISA	Revisó y Aprobó	ING. BIOMEDICA ESP. INGENIERIA CLINICA MAT. 25172504 CPI
	Vo. Bo. Profesional de Mantenimiento	

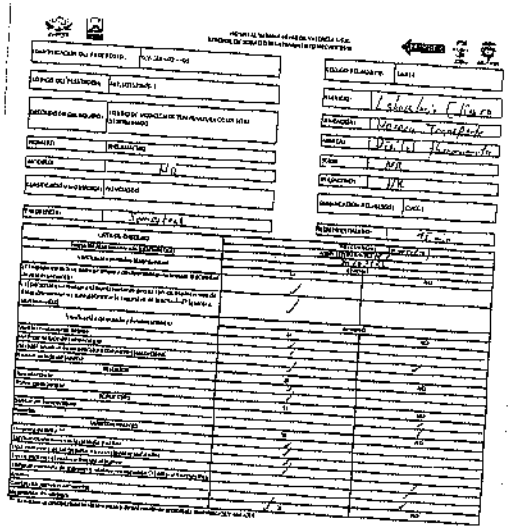

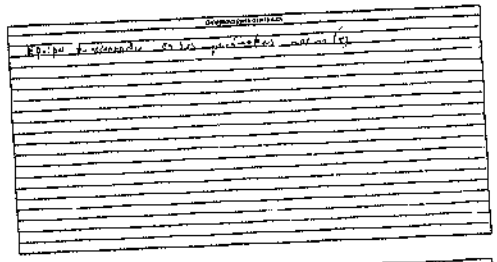

QUIEN REVISA	FIRMA	
	NOMBRE	Francisco Salcedo
	CARGO	Ing. Biomédico
	FECHA	24/07/21
QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA	
	NOMBRE	Juan Rodrigo Salazar
	CARGO	Mantenimiento Clínico
	FECHA	27/07/21
QUIEN REVISA	Revisó y Aprobó	ING. BIOMEDICA ESP. INGENIERIA CLINICA MAT. 25172504 CPI
	Vo. Bo. Profesional de Mantenimiento	

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
REGISTRO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO	SVE-004-102-ME
CÓDIGO DEL PROVEEDOR	10320
CÓDIGO DEL PREVENTIVO	ME-MANTENIMIENTO
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	BIOMICROSCOPIO DE ILUMINACIÓN ZONA DE ENFOQUE Y MOVIMIENTO DE LA MESA DE APOYO
UBICACIÓN	CONSULTORIO 4
MARCA	TOPCON
SERIE	7100
MODELO	SL-D7
PROCEDENCIA	JAPON
CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	CRITICO
PERIODICIDAD	SEMESTRAL
TIEMPO ESTIMADO	30 MIN

LISTA DE CHEQUEO	VERIFICACIÓN
Fecha de Mantenimiento (DD/MM/AA)	27/07/26
Mantenimiento realizado (marque con una x)	SI / NO
¿El equipo presenta daños físicos o fallas que impidan su normal funcionamiento?	NO
¿El personal que realiza el mantenimiento cuenta con la capacitación y el conocimiento técnico para operar el equipo?	SI
Verificaciones de seguridad y funcionamiento	SI / NO
Limpieza general del equipo	✓
Inspección de cables y conectores	✓
Verificación de conexiones eléctricas	✓
Prueba de luces	✓
Verificación de enfoque	✓
Ajuste de la altura de la mesa	✓
Verificación de movimientos de la mesa	✓
Revisión de lentes oculares	✓
Revisión de lentes objetivos	✓
Verificación de filtros	✓
Prueba de iluminación	✓
Verificación de fusibles	✓
Revisión de la base	✓
Limpieza de superficies externas	✓
Verificación de la estabilidad	✓
Prueba de funcionamiento general	✓
Observaciones	

Indicadores de Gestión		Valor Medido	Valor Permitido	Nivel Medido	Nivel Falla
Tiempo de Respuesta	Eficiencia (Tiempo de respuesta / Tiempo estimado)	1.00	≤1	1	No
Tiempo de Respuesta	Eficacia (Tiempo de respuesta / Tiempo estimado)	0.93	≤1	1	No
Tiempo de Respuesta	Desviación estándar (Tiempo de respuesta / Tiempo estimado)	0.00	≤1	1	No
Tiempo de Respuesta	Eficiencia (Tiempo de respuesta / Tiempo estimado)	1.00	≤1	1	No

QUIEN ENTREGA	NOMBRE	Yuranis Salcedo
	CARGO	Ing. Biomédica
	FECHA	27/07/26
QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	NOMBRE	Wilson Moreno
	CARGO	Celador
	FECHA	27/07/26
QUIEN REVISA	REVISÓ Y APROBÓ	Shirli Natalia Valencia Mora ING. BIOMÉDICA ESP. INGENIERÍA CLÍNICA
	No. de Profesional de Mantenimiento	

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
REGISTRO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO	SVE-004-102-ME
CÓDIGO DEL PROVEEDOR	LL-320
CÓDIGO DEL PREVENTIVO	ME-MANTENIMIENTO
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	EQUIPO MÓVIL DE ILUMINACIÓN AMBULATORIA CON CUATRO (4) RUEDAS
UBICACIÓN	CONSULTORIO 4
MARCA	WELCH ALLYN
MODELO	45200
SERIE	534Y000321
PROCEDENCIA	USA
CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	CRITICO
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CLASE IIB
TIEMPO ESTIMADO	30 MIN

LISTA DE CHEQUEO	VERIFICACIÓN
Fecha de Mantenimiento (DD/MM/AA)	27/07/26
Mantenimiento realizado (marque con una x)	SI / NO
¿El equipo presenta daños físicos o fallas que impidan su normal funcionamiento?	NO
¿El personal que realiza el mantenimiento cuenta con la capacitación y el conocimiento técnico para operar el equipo?	SI
Verificaciones de seguridad y funcionamiento	SI / NO
Limpieza general del equipo	✓
Inspección de cables y conectores	✓
Verificación de conexiones eléctricas	✓
Prueba de luces	✓
Verificación de enfoque	✓
Ajuste de la altura de la mesa	✓
Verificación de movimientos de la mesa	✓
Revisión de lentes oculares	✓
Revisión de lentes objetivos	✓
Verificación de filtros	✓
Prueba de funcionamiento	✓
Verificación de fusibles	✓
Revisión de la base	✓
Limpieza de superficies externas	✓
Verificación de la estabilidad	✓
Prueba de funcionamiento general	✓
Observaciones	

QUIEN ENTREGA	NOMBRE	Yuranis Salcedo
	CARGO	Ing. Biomédica
	FECHA	27/07/26
QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	NOMBRE	Wilson Moreno
	CARGO	Celador
	FECHA	27/07/26
QUIEN REVISA	REVISÓ Y APROBÓ	Shirli Natalia Valencia Mora ING. BIOMÉDICA ESP. INGENIERÍA CLÍNICA
	No. de Profesional de Mantenimiento	


QUIEN ENTREGA	NOMBRE	Yuranis Salcedo
	CARGO	Ing. Biomédica
	FECHA	27/07/26
QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	NOMBRE	Wilson Moreno
	CARGO	Celador
	FECHA	27/07/26
QUIEN REVISA	REVISÓ Y APROBÓ	Shirli Natalia Valencia Mora ING. BIOMÉDICA ESP. INGENIERÍA CLÍNICA
	No. de Profesional de Mantenimiento	


HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
REGISTRO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO


IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO	SVE-004-102-ME
CÓDIGO DEL PROVEEDOR	10320
CÓDIGO DEL PREVENTIVO	ME-MANTENIMIENTO
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	EQUIPO MÓVIL DE ILUMINACIÓN AMBULATORIA CON CUATRO (4) RUEDAS
UBICACIÓN	CONSULTORIO 4
MARCA	WELCH ALLYN
MODELO	45200
SERIE	534Y000321
PROCEDENCIA	USA
CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	CRITICO
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CLASE IIB
TIEMPO ESTIMADO	30 MIN


LISTA DE CHEQUEO	VERIFICACIÓN
Fecha de Mantenimiento (DD/MM/AA)	27/07/26
Mantenimiento realizado (marque con una x)	SI / NO
¿El equipo presenta daños físicos o fallas que impidan su normal funcionamiento?	NO
¿El personal que realiza el mantenimiento cuenta con la capacitación y el conocimiento técnico para operar el equipo?	SI
Verificaciones de seguridad y funcionamiento	SI / NO
Limpieza general del equipo	✓
Inspección de cables y conectores	✓
Verificación de conexiones eléctricas	✓
Prueba de luces	✓
Verificación de enfoque	✓
Ajuste de la altura de la mesa	✓
Verificación de movimientos de la mesa	✓
Revisión de lentes oculares	✓
Revisión de lentes objetivos	✓
Verificación de filtros	✓
Prueba de funcionamiento	✓
Verificación de fusibles	✓
Revisión de la base	✓
Limpieza de superficies externas	✓
Verificación de la estabilidad	✓
Prueba de funcionamiento general	✓
Observaciones	


QUIEN ENTREGA	NOMBRE	Yuranis Salcedo
	CARGO	Ing. Biomédica
	FECHA	27/07/26
QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	NOMBRE	Wilson Moreno
	CARGO	Celador
	FECHA	27/07/26
QUIEN REVISA	REVISÓ Y APROBÓ	Shirli Natalia Valencia Mora ING. BIOMÉDICA ESP. INGENIERÍA CLÍNICA
	No. de Profesional de Mantenimiento	

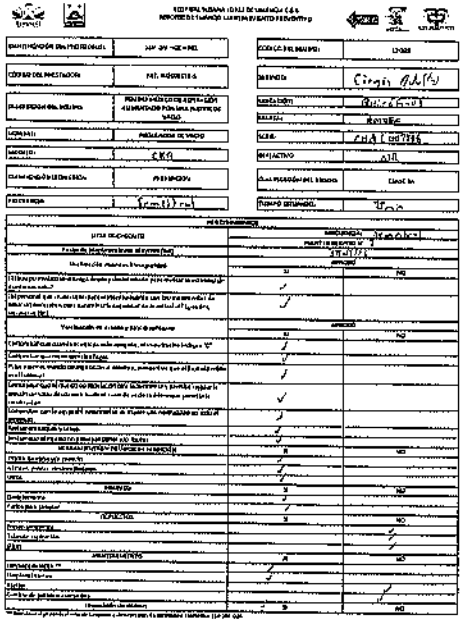


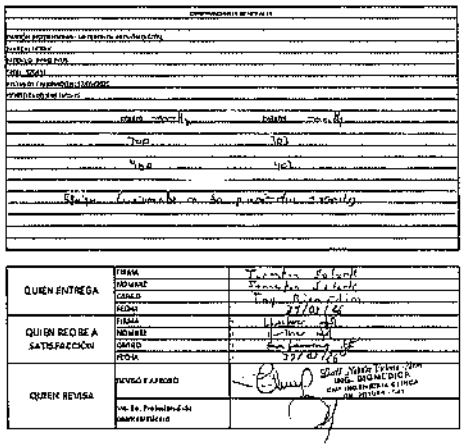


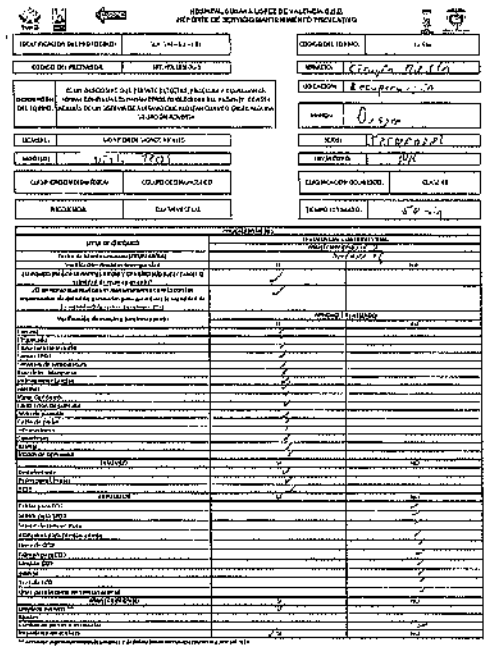

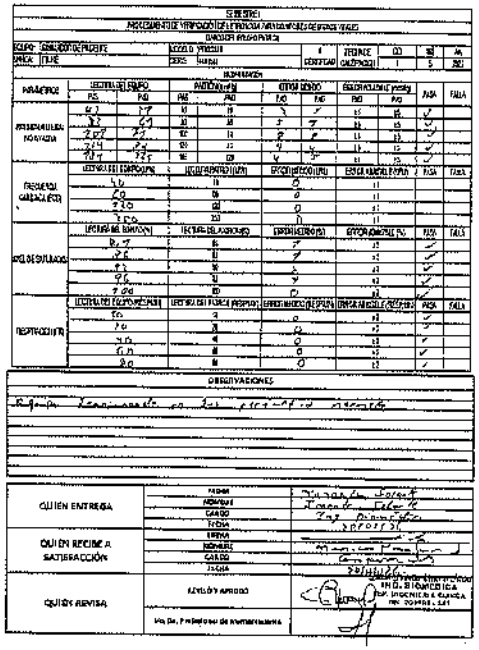

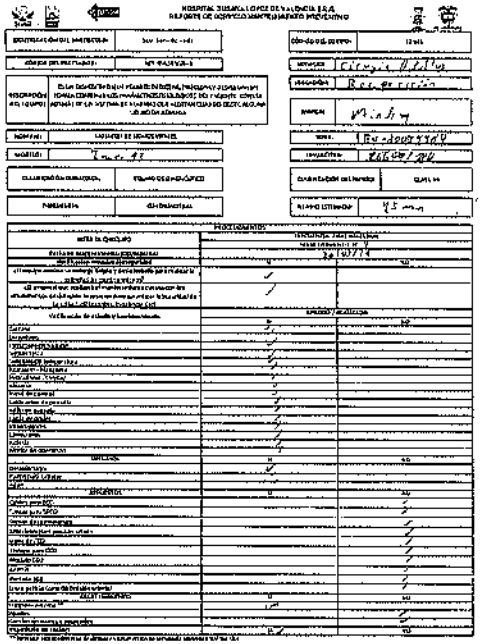

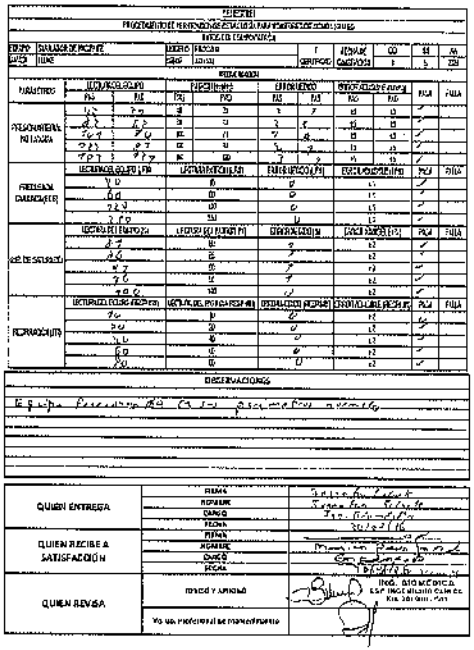

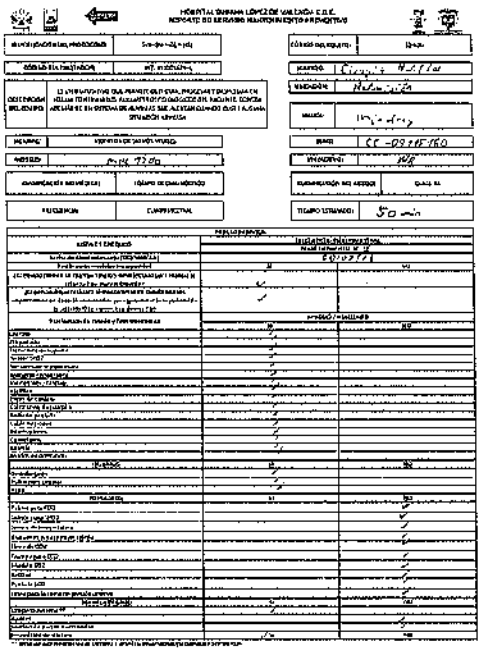

HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.
NORMATE DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y HOSPITALARIOS

Servicio de Atención, Hospitalización	Consulta Externa
Código del Paciente	12345
Apellidos y Nombres	Cruz Flores
Identificación	NT. 12345678
Procedencia	Valencia
Diagnóstico	La interconsulta cumple con el protocolo establecido en el hospital. Se solicita valoración por especialista.
Edad	34
Teléfono	300 456 7890
Acompañante	Ninguno
Parentesco	Ninguno
Acompañante del Acudiente	Igual
Clasificación del Acudiente	Clase A1
Tipo de Cama Asignada	Cama 12
Tiempo Estimado	30 min
Facturación	Particular

PERSONAL ENFERMERÍA

ASPECTOS EVALUADOS	Hospitalización Enfermería Piso 2
Fecha de Valoración	15/07/24
Hora de Valoración	10:30 a.m.
¿El paciente se encuentra en condiciones de ser trasladado?	Sí
¿Se realizó la valoración de enfermería antes del traslado?	Sí
¿Se verificó la identidad del paciente?	Sí
Observaciones de Enfermería	Paciente estable, sin novedad.

PERSONAL MÉDICO


ASPECTOS EVALUADOS	Dr. Andrés Felipe Mora
Nombre del Médico	Dr. Andrés Felipe Mora
Especialidad	Medicina Interna
¿Se realizó la valoración médica?	Sí
¿Se diligenció la historia clínica?	Sí
¿Se ordenaron los exámenes necesarios?	Sí
Observaciones Médicas	Se ordena hemograma y glucosa.

REQUISITOS

	Sí	No
Cédula de ciudadanía	✓	
Carné de afiliación	✓	
Remisión	✓	
Autorización	✓	
Historia clínica	✓	
Exámenes previos	✓	
Consentimiento informado	✓	
Acompañante	✓	
Ayudas diagnósticas	✓	
Medicamentos	✓	
Dieta especial	✓	
Oxígeno	✓	
Silla de ruedas	✓	
Camilla	✓	
Otros	✓	

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA	Nombre	Susana López
	Cargo	Enfermera Jefe
	Fecha	15/07/24
QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	Nombre	Dr. Andrés Mora
	Cargo	Médico
	Fecha	15/07/24
QUIEN REVISA	Nombre y Cargo	Auditor de Calidad
	Vo. Bo. Profesional de Mantenimiento	

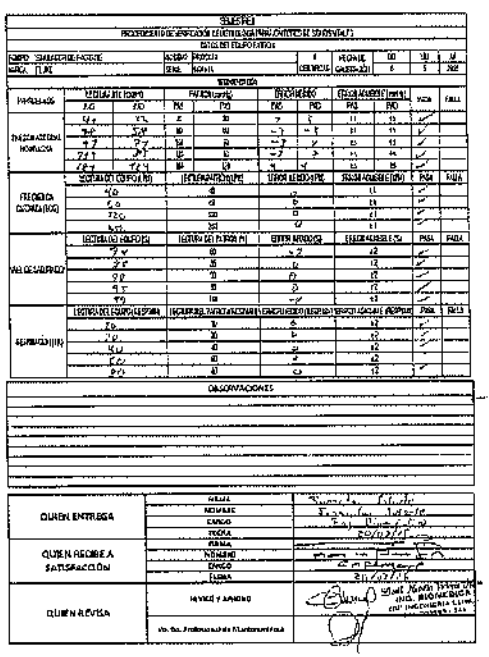

SUSEPRE
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE ESCALA DE VALORACIÓN DEL RIESGO DE CAÍDAS

DATOS DEL ESTUDIANTE


NOMBRE: SAMANTHA PATIÑO			ACUDIENTE:		# CELULAR:	REGIONAL:	DD	MM	AA
MATRÍCULA:			SEXO:	HOMBRE		CAUCASIA	6	5	2025

VALORACIÓN

PARÁMETROS	VALORACIÓN INGRESO		PRIMERA VALORACIÓN		SEGUNDA VALORACIÓN		CALIFICACIÓN FINAL		VISTO	FALLA
	SÍ	NO	PAC	PAD	PAC	PAD	PAC	PAD		
ENFERMEDAD INMINENTE	90	70	1	0	1	0	90	70	✓	
	85	65	1	0	1	0	85	65	✓	
	92	72	1	0	1	0	92	72	✓	
	88	68	1	0	1	0	88	68	✓	
	SUPERA LOS 60 KG (SÍ)		LEE EL PACIENTE		LEEN LOS DEMÁS		SUMA ACUMULADA (SÍ)		PASA	FALLA
FRECUENCIA CARDÍACA (FC)	40		0		0		40		✓	
	50		0		0		50		✓	
	45		0		0		45		✓	
	55		0		0		55		✓	
	LECTURA DEL CUERPO (SÍ)		LECTURA DEL PACIENTE (PC)		ESPERA MÁXIMO		FALLA ACUMULADA (SÍ)		PASA	FALLA
RAD DE SUAVIDAD	70		60		10		70		✓	
	80		70		10		80		✓	
	90		80		10		90		✓	
	85		75		10		85		✓	
	100		90		10		100		✓	
	LECTURA DEL ESPACIO (ESPERA)		LECTURA DEL PACIENTE (ESPERA)		ESPACIO LECTURA (ESPERA)		SUMA ACUMULADA (ESPERA)		PASA	FALLA
SEDENTARISMO	20		10		5		20		✓	
	30		20		5		30		✓	
	40		30		5		40		✓	
	50		40		5		50		✓	
	60		50		5		60		✓	

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA	Nombre	Susana López
	Cargo	Enfermera
	Fecha	15/07/24
QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	Nombre	Dr. Andrés Mora
	Cargo	Médico
	Fecha	15/07/24
QUIEN REVISA	Nombre y Cargo	Auditor de Calidad
	Vo. Bo. Profesional de Mantenimiento	

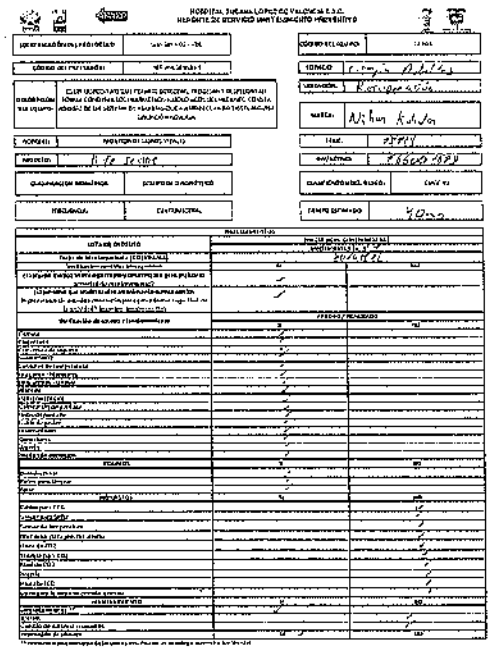

HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.
NORMATE DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y HOSPITALARIOS

Servicio de Atención, Hospitalización	Consulta Externa
Código del Paciente	12345
Apellidos y Nombres	Cruz Flores
Identificación	NT. 12345678
Procedencia	Valencia
Diagnóstico	La interconsulta cumple con el protocolo establecido en el hospital. Se solicita valoración por especialista.
Edad	34
Teléfono	300 456 7890
Acompañante	Ninguno
Parentesco	Ninguno
Acompañante del Acudiente	Igual
Clasificación del Acudiente	Clase A1
Tipo de Cama Asignada	Cama 12
Tiempo Estimado	30 min
Facturación	Particular

PERSONAL ENFERMERÍA

ASPECTOS EVALUADOS	Hospitalización Enfermería Piso 2
Fecha de Valoración	15/07/24
Hora de Valoración	10:30 a.m.
¿El paciente se encuentra en condiciones de ser trasladado?	Sí
¿Se realizó la valoración de enfermería antes del traslado?	Sí
¿Se verificó la identidad del paciente?	Sí
Observaciones de Enfermería	Paciente estable, sin novedad.

PERSONAL MÉDICO


ASPECTOS EVALUADOS	Dr. Andrés Felipe Mora
Nombre del Médico	Dr. Andrés Felipe Mora
Especialidad	Medicina Interna
¿Se realizó la valoración médica?	Sí
¿Se diligenció la historia clínica?	Sí
¿Se ordenaron los exámenes necesarios?	Sí
Observaciones Médicas	Se ordena hemograma y glucosa.

REQUISITOS

	Sí	No
Cédula de ciudadanía	✓	
Carné de afiliación	✓	
Remisión	✓	
Autorización	✓	
Historia clínica	✓	
Exámenes previos	✓	
Consentimiento informado	✓	
Acompañante	✓	
Ayudas diagnósticas	✓	
Medicamentos	✓	
Dieta especial	✓	
Oxígeno	✓	
Silla de ruedas	✓	
Camilla	✓	
Otros	✓	

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA	Nombre	Susana López
	Cargo	Enfermera
	Fecha	15/07/24
QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	Nombre	Dr. Andrés Mora
	Cargo	Médico
	Fecha	15/07/24
QUIEN REVISA	Nombre y Cargo	Auditor de Calidad
	Vo. Bo. Profesional de Mantenimiento	

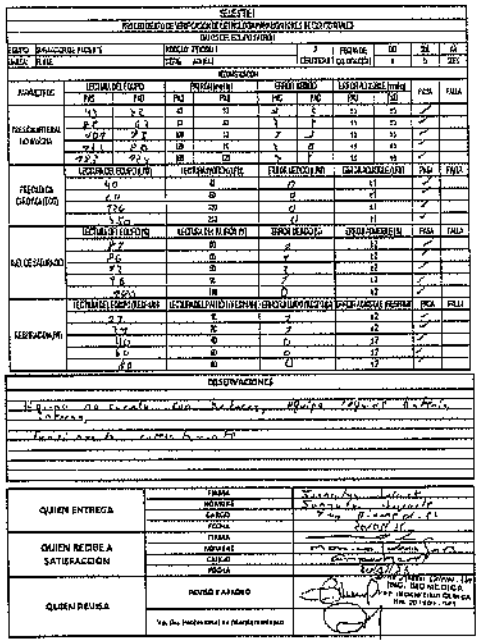

SUSEPRE
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE ESCALA DE VALORACIÓN DEL RIESGO DE CAÍDAS

DATOS DEL ESTUDIANTE


NOMBRE: SAMANTHA PATIÑO			ACUDIENTE:		# CELULAR:	REGIONAL:	DD	MM	AA
MATRÍCULA:			SEXO:	HOMBRE		CAUCASIA	6	5	2025


VALORACIÓN


PARÁMETROS	VALORACIÓN INGRESO		PRIMERA VALORACIÓN		SEGUNDA VALORACIÓN		CALIFICACIÓN FINAL		VISTO	FALLA
	SÍ	NO	PAC	PAD	PAC	PAD	PAC	PAD		
ENFERMEDAD INMINENTE	90	70	1	0	1	0	90	70	✓	
	85	65	1	0	1	0	85	65	✓	
	92	72	1	0	1	0	92	72	✓	
	88	68	1	0	1	0	88	68	✓	
	SUPERA LOS 60 KG (SÍ)		LEE EL PACIENTE		LEEN LOS DEMÁS		SUMA ACUMULADA (SÍ)		PASA	FALLA
FRECUENCIA CARDÍACA (FC)	40		0		0		40		✓	
	50		0		0		50		✓	
	45		0		0		45		✓	
	55		0		0		55		✓	
	LECTURA DEL CUERPO (SÍ)		LECTURA DEL PACIENTE (PC)		ESPERA MÁXIMO		FALLA ACUMULADA (SÍ)		PASA	FALLA
RAD DE SUAVIDAD	70		60		10		70		✓	
	80		70		10		80		✓	
	90		80		10		90		✓	
	85		75		10		85		✓	
	100		90		10		100		✓	
	LECTURA DEL ESPACIO (ESPERA)		LECTURA DEL PACIENTE (ESPERA)		ESPACIO LECTURA (ESPERA)		SUMA ACUMULADA (ESPERA)		PASA	FALLA
SEDENTARISMO	20		10		5		20		✓	
	30		20		5		30		✓	
	40		30		5		40		✓	
	50		40		5		50		✓	
	60		50		5		60		✓	


OBSERVACIONES


QUIEN ENTREGA	Nombre	Susana López
	Cargo	Enfermera
	Fecha	15/07/24
QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	Nombre	Dr. Andrés Mora
	Cargo	Médico
	Fecha	15/07/24
QUIEN REVISA	Nombre y Cargo	Auditor de Calidad
	Vo. Bo. Profesional de Mantenimiento	

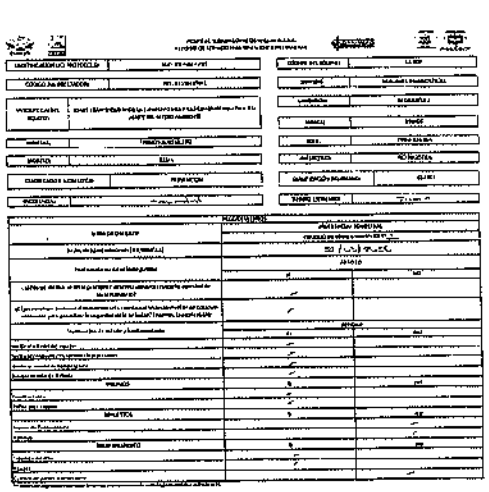


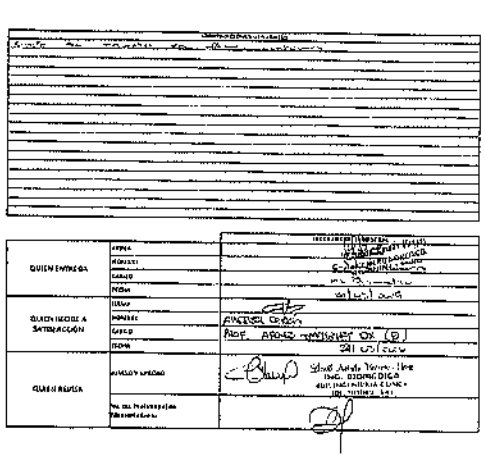


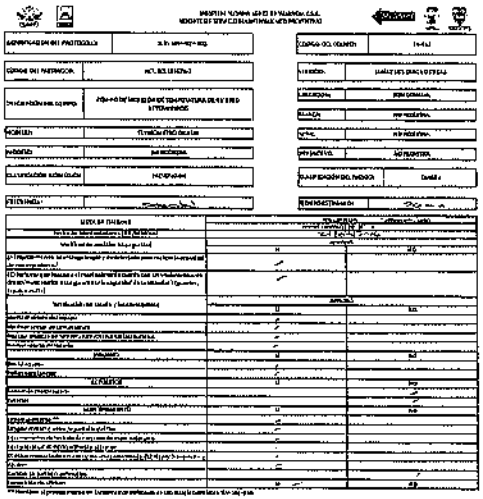


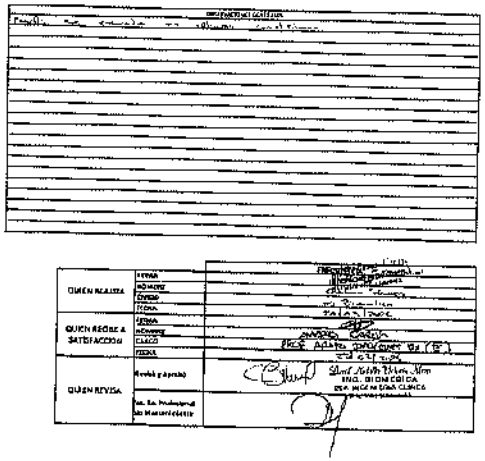


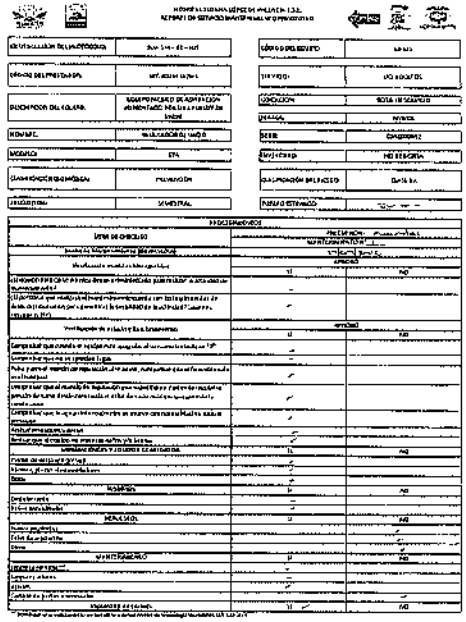


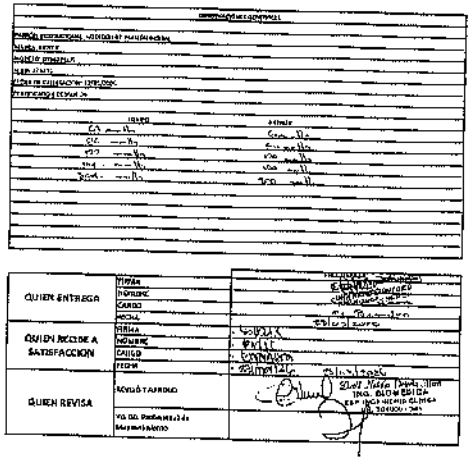


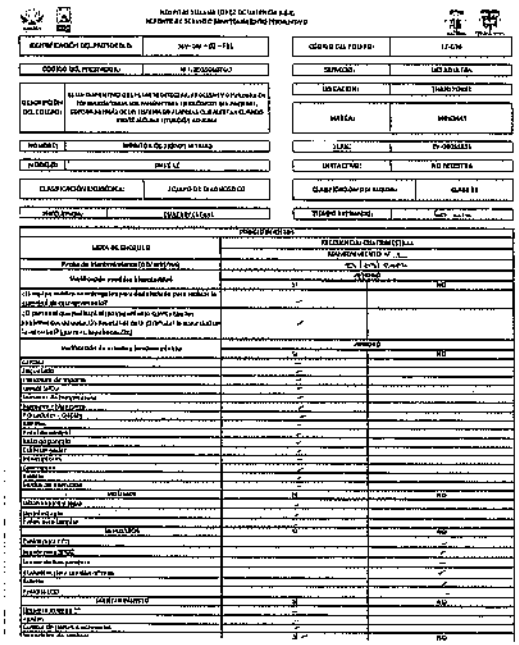


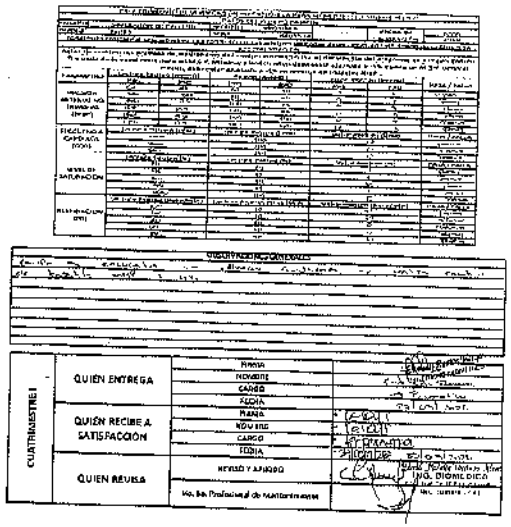


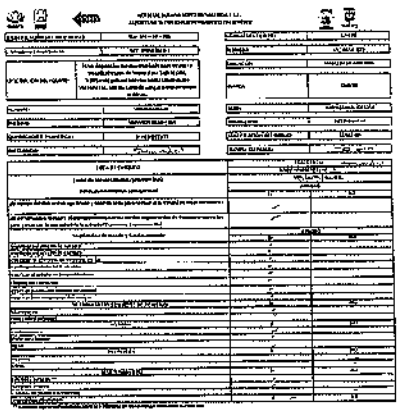


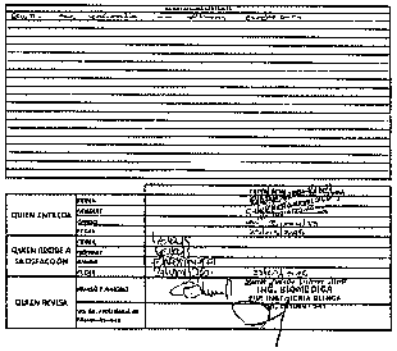


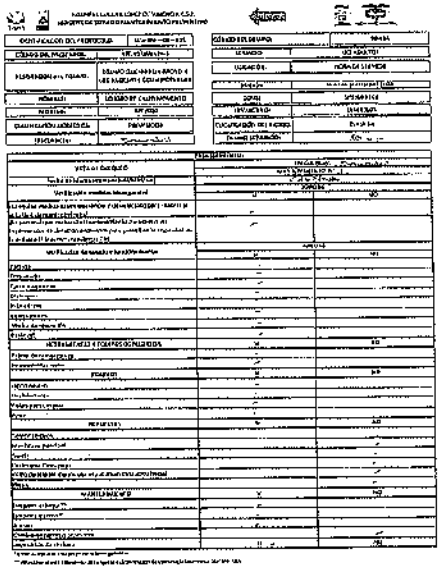


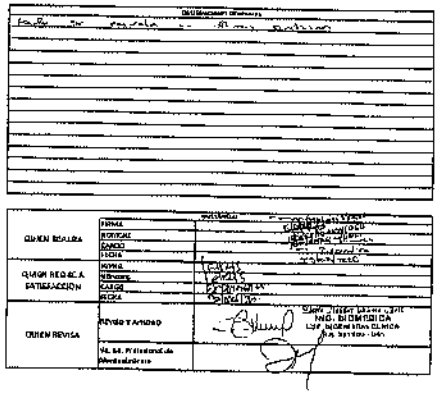


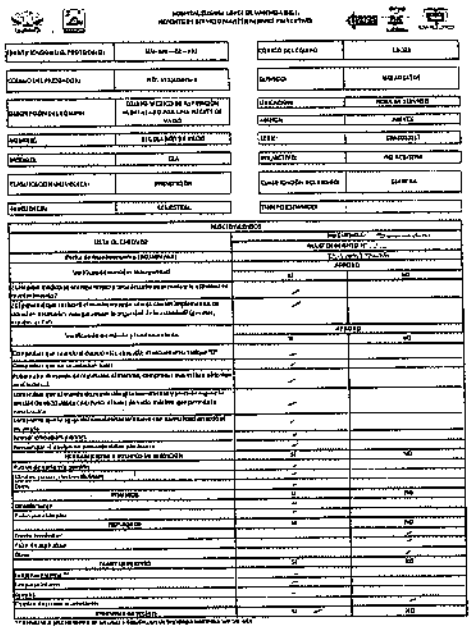


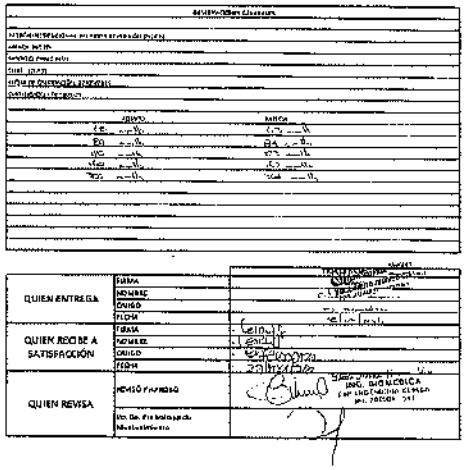


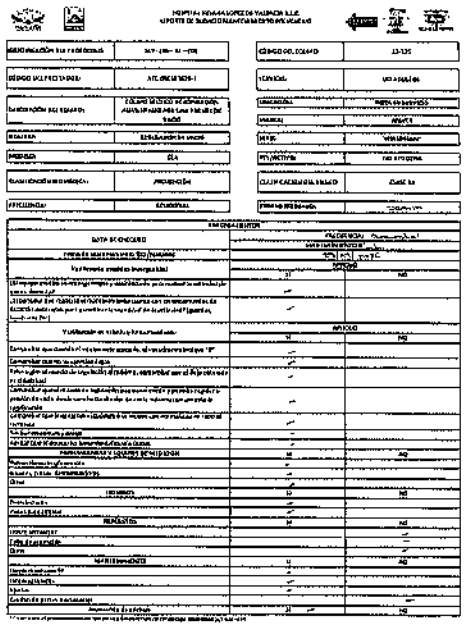


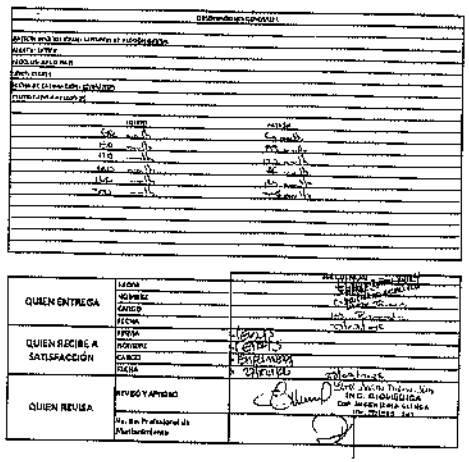


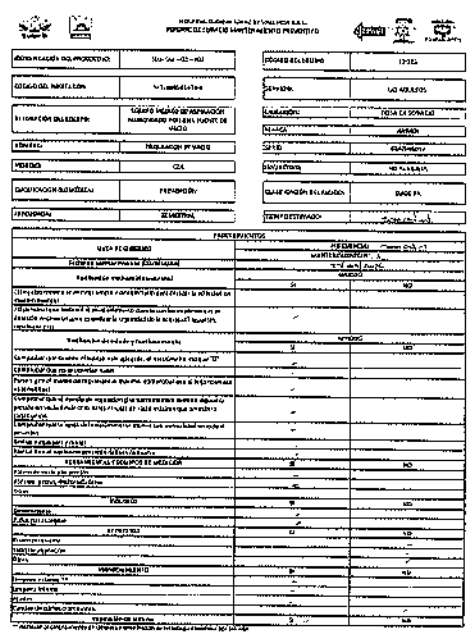


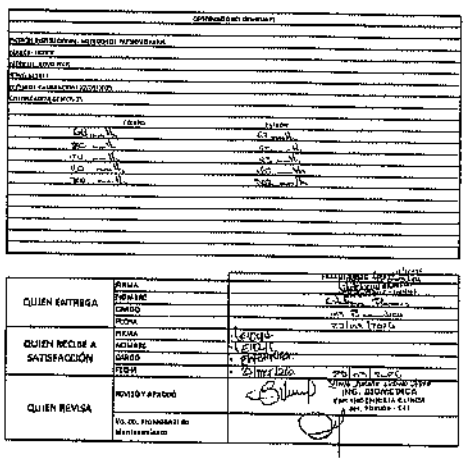


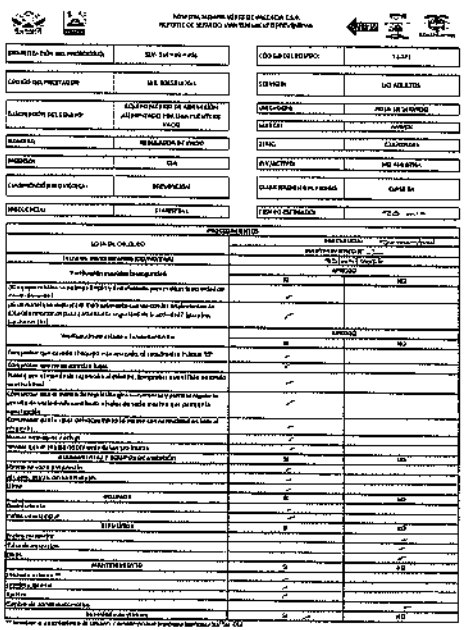


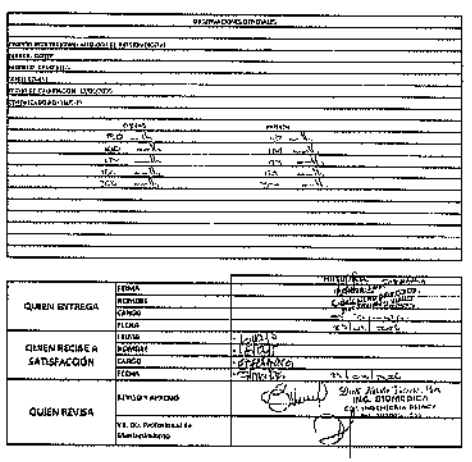


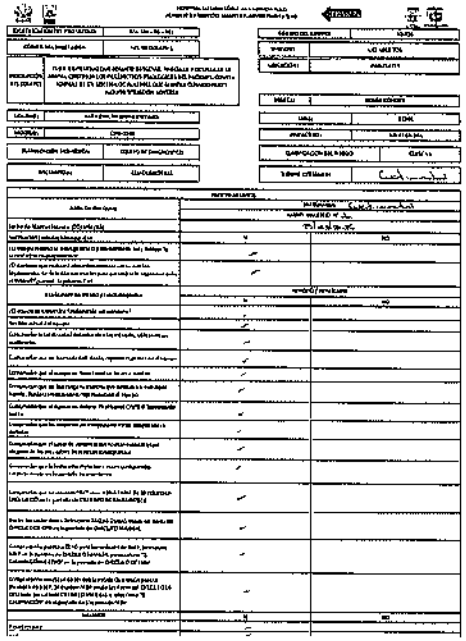


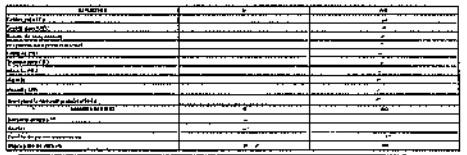


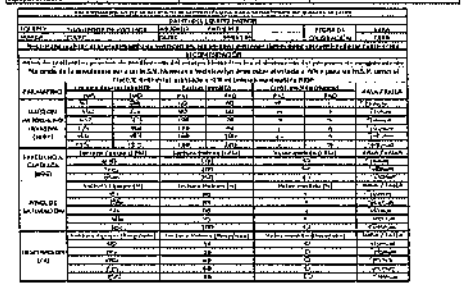


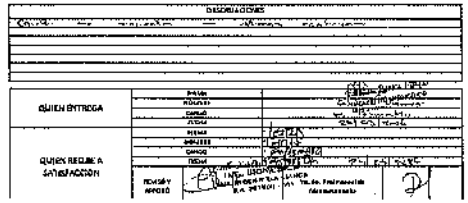


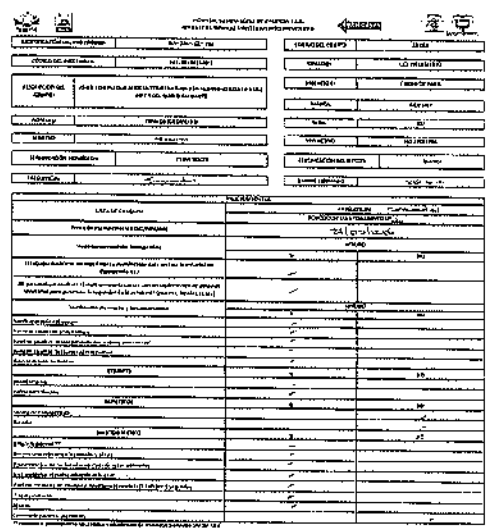


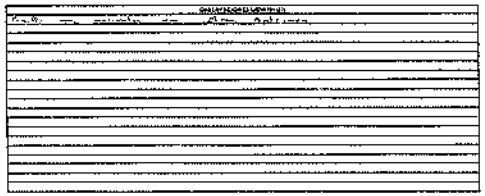


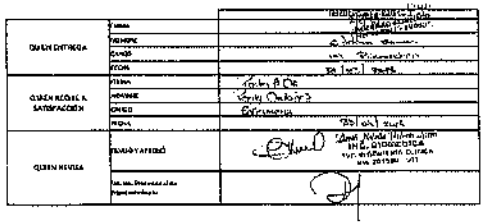


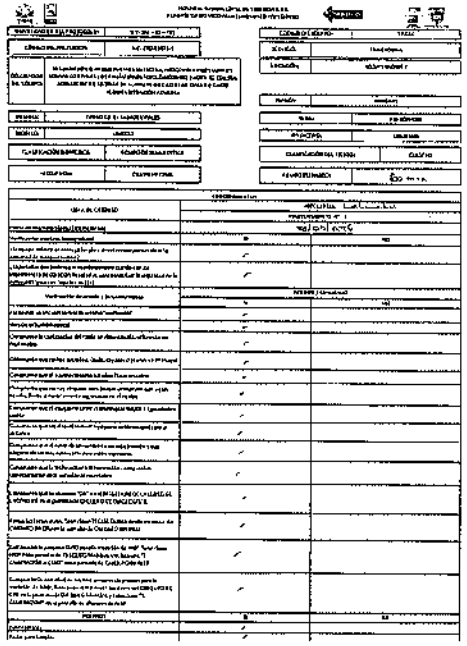


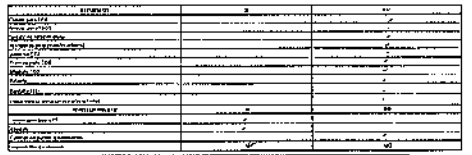


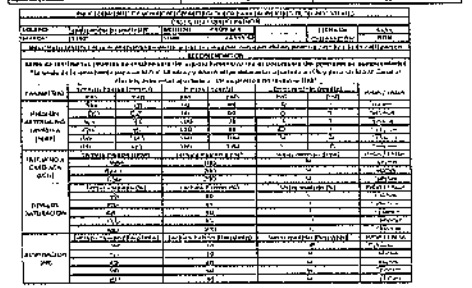


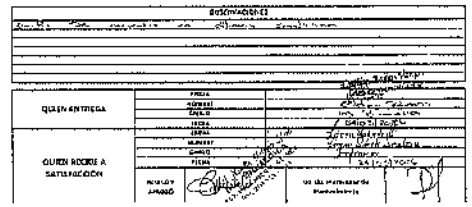


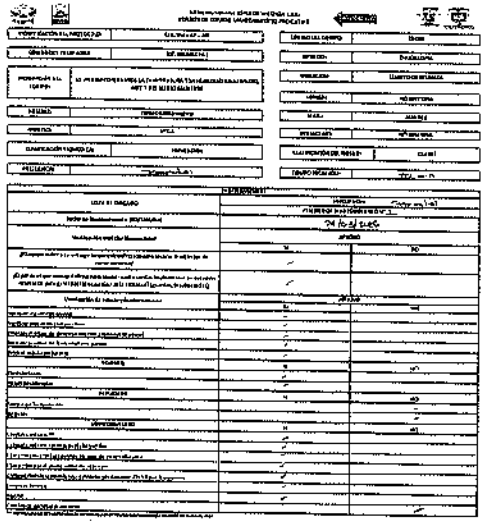


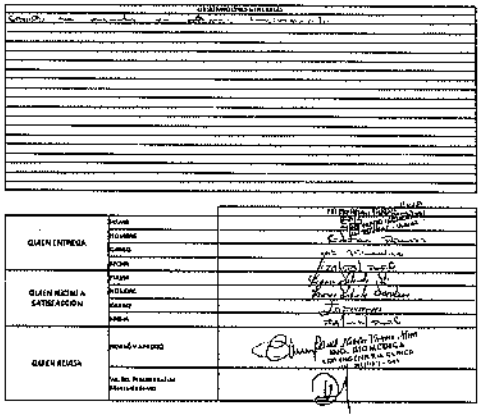


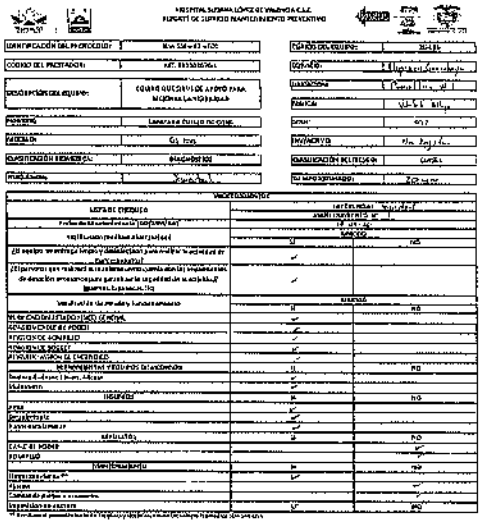


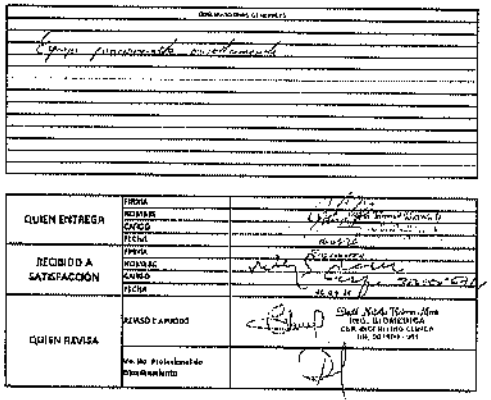


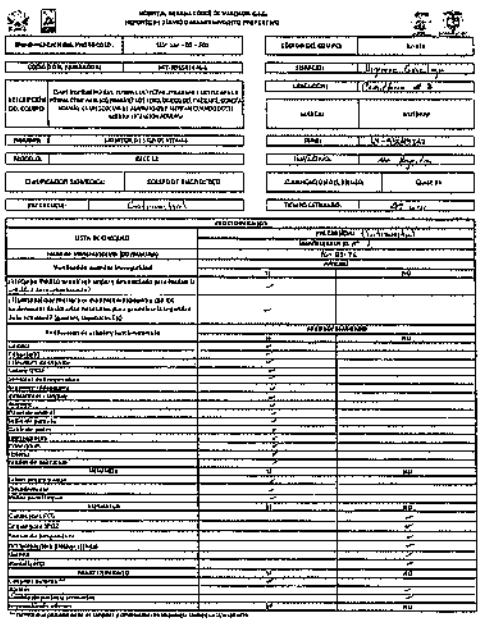


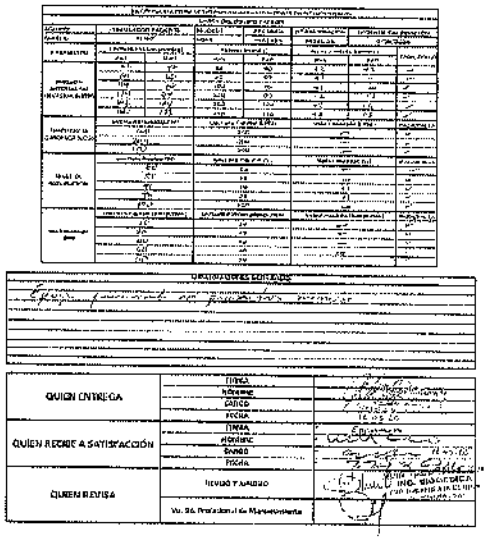


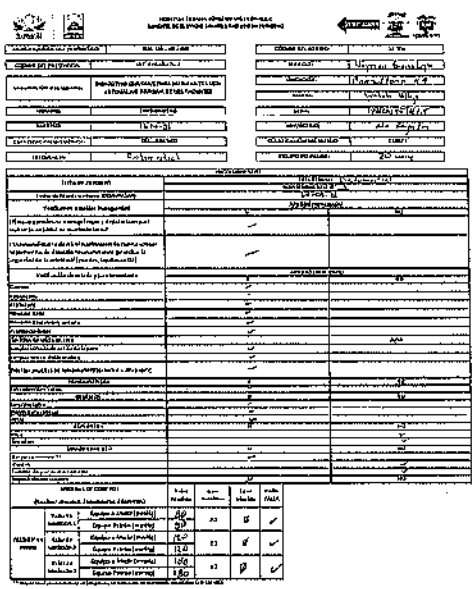


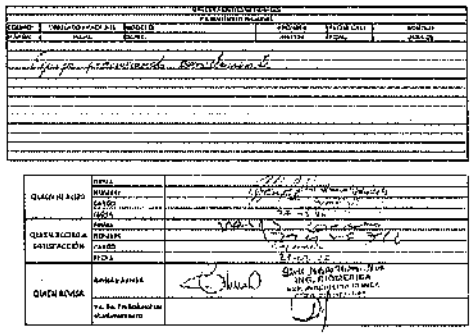


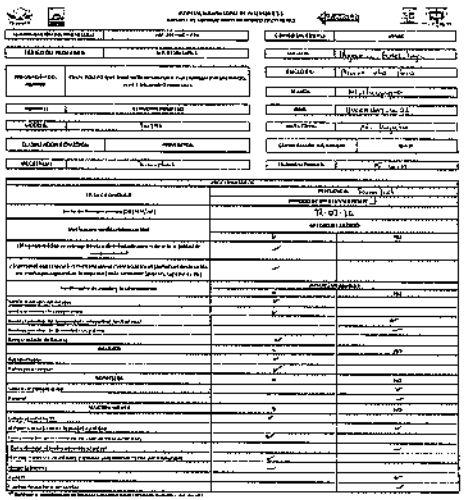


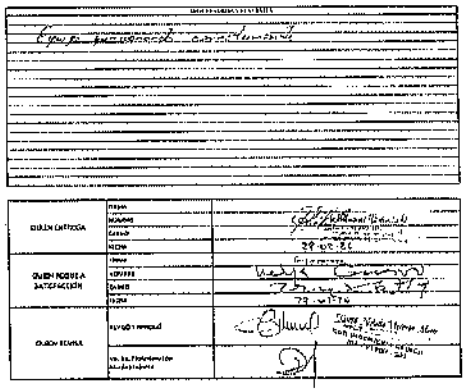


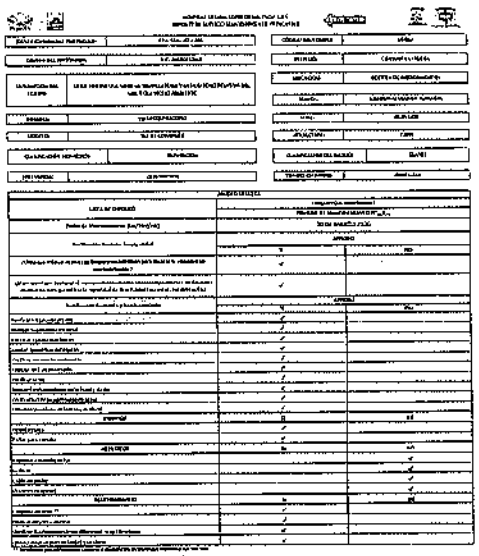

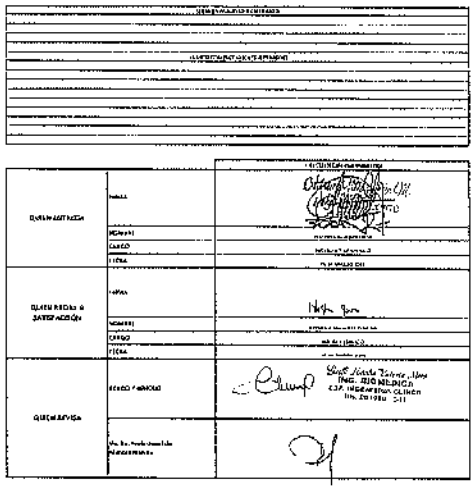

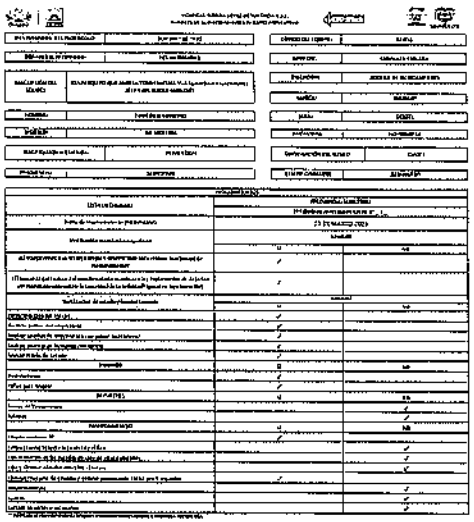


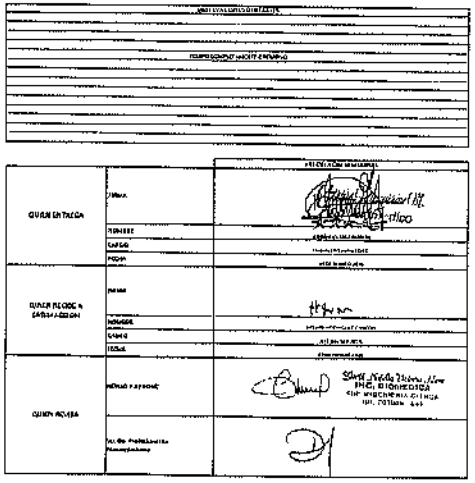


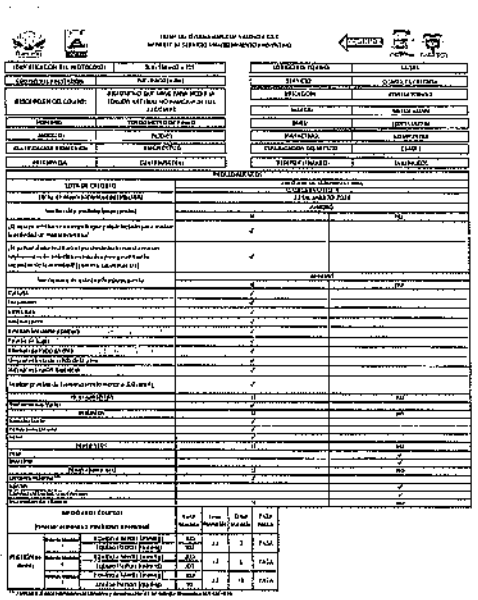



tensiometro de pared
Welch allyn
1107161627044

Consulta Externa
Consultorio 7.

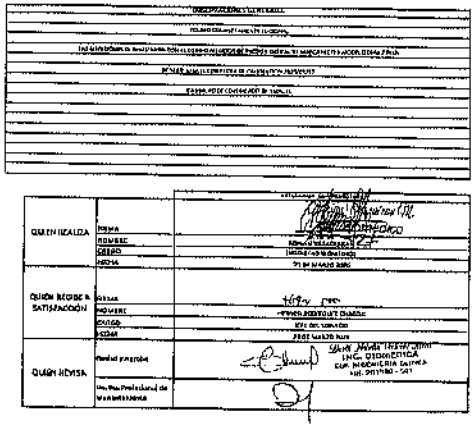





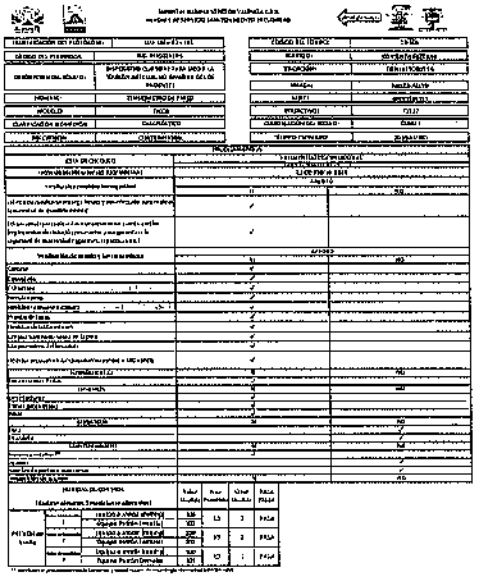


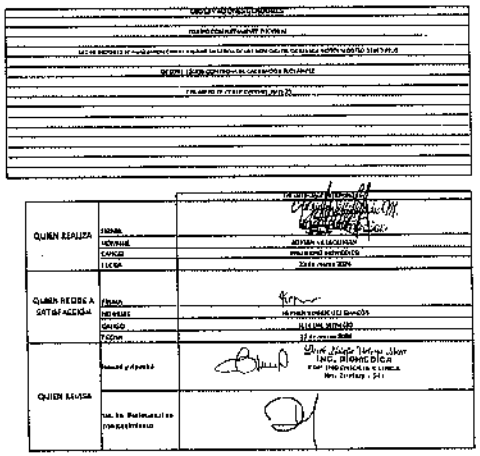


tensiometro de pared
Welch allyn
Tycos
6026910 1314



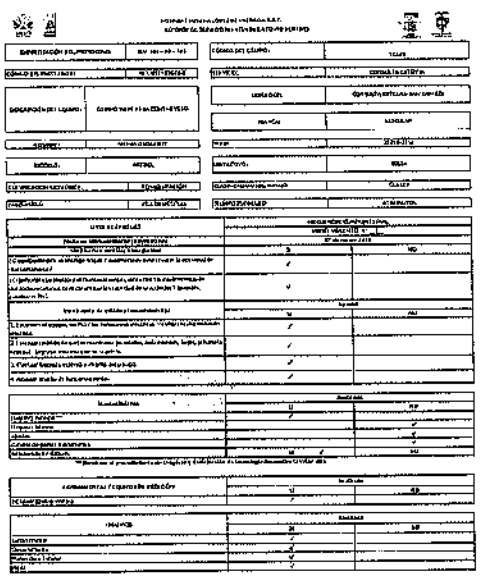



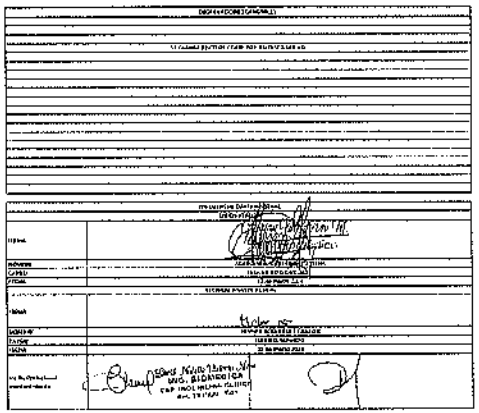

Monitor de Signos Vitales
marca: Drager
Modelo: Vista 120S
Serie: SN: S25Nf0725
Consulta externa

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN PARA MONITORES DE SIGNOS VITALES

DATOS DE EQUIPO PATRÓN

PARAMETROS	[illegible]				PASA / FALLA
PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (NIBP)	[illegible]				PASA
FRECUENCIA CARDIACA (ECG)	[illegible]				PASA
NIVEL DE SATURACIÓN (SPO2)	[illegible]				PASA
TEMPERATURA (TE)	[illegible]				PASA

OBSERVACIONES GENERALES

EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

QUIEN ENTREGA	FIRMA	
	NOMBRE	ADRIAN VELASQUEZ
	CARGO	INGENIERO BIOMEDICO
	FECHA	11 de MARZO 2024
QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	FIRMA	
	NOMBRE	[illegible]
	CARGO	JEFE ENFERMERÍA
	FECHA	[illegible]
QUIEN REVISA	REVISÓ Y APROBÓ	[illegible]
	Vo. Bo. Profesional de Mantenimiento	

HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.
REPORTE DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR	[illegible]	CÓDIGO DEL EQUIPO	[illegible]
CÓDIGO DEL PRESTADOR	[illegible]	SERVICIO	CONSULTA EXTERNA
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	[illegible]	UBICACIÓN	[illegible]
		MARCA	DRAGER
NOMBRE	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SERIE	[illegible]
MODELO	VISTA 120S	INVENTARIO	[illegible]
CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA	[illegible]	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	[illegible]
PROVEEDOR	[illegible]	TIEMPO EMPLEADO	[illegible]

PROCEDIMIENTOS

LISTA DE CHEQUEO

[illegible]

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN PARA MONITORES DE SIGNOS VITALES

DATOS DE EQUIPO PATRÓN

PARAMETROS	[illegible]	PASA / FALLA
PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (NIBP)	[illegible]	PASA
FRECUENCIA CARDIACA (ECG)	[illegible]	PASA
NIVEL DE SATURACIÓN (SPO2)	[illegible]	PASA
TEMPERATURA (TE)	[illegible]	PASA

OBSERVACIONES GENERALES

EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

QUIEN ENTREGA	FIRMA	
	NOMBRE	ADRIAN VELASQUEZ
	CARGO	INGENIERO BIOMEDICO
	FECHA	11 MARZO 2024
QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	FIRMA	
	NOMBRE	[illegible]
	CARGO	[illegible]
	FECHA	[illegible]
QUIEN REVISA	REVISÓ Y APROBÓ	[illegible]
	Vo. Bo. Profesional de Mantenimiento	

HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.
REPORTE DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

[illegible]

* Monitor de Signos Vitales
* MEC1200 — Serie CC-09115174 - Activo = 75938
* ~~[illegible]~~ [illegible]
* Consulta Externa

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN PARA MONITORES DE SIGNOS VITALES

DATOS DEL EQUIPO PATRÓN

PRESIÓN NO INVASIVA (mmHg)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PASA / FALLA
FRECUENCIA CARDIACA (LPM)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PASA / FALLA
NIVEL DE SATURACIÓN (SpO2)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PASA / FALLA
RESPIRACIÓN (rpm)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PASA / FALLA

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	No. CERTIFICADO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

VERIFICACIÓN DE VARIABLES

FRECUENCIA CARDIACA	PUNTO DE REFERENCIA	LECTURA EQUIPO	PASA / FALLA
	[illegible]	60	Pasa
	[illegible]	120	Pasa
	[illegible]	240	Pasa

OXIMETRÍA	PUNTO DE REFERENCIA	LECTURA EQUIPO	PASA / FALLA
	[illegible]	91	Pasa
	[illegible]	94	Pasa
	[illegible]	99	Pasa

OBSERVACIONES GENERALES

Equipo funcionando según especificaciones del fabricante. Se realiza ajuste de [illegible].

QUIEN REALIZA	FIRMA	Juan S. Rojas
	NOMBRE	[illegible]
	CARGO	ING. BIOMÉDICO
	FECHA	2013/[illegible]
QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	FIRMA	Yohana [illegible]
	NOMBRE	Yohana
	CARGO	Enf.
	FECHA	2013126
QUIEN REVISA	[illegible]	[signature] ING. BIOMÉDICA
	[illegible]	[signature]

[illegible form: hospital header; equipment identification; PROCEDIMIENTO; LISTA DE CHEQUEO with SI / NO checkmarks]

[illegible form: hospital header; equipment identification; PROCEDIMIENTO; LISTA DE CHEQUEO with SI / NO checkmarks]

ANALIZADOR UTILIZADO

[illegible]	MARCA	MODELO	SERIE	No. CERTIFICADO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]


VERIFICACIÓN DE VARIABLES


[illegible]	PUNTO DE REFERENCIA	LECTURA EQUIPO
[illegible]	[illegible]	348 mmHg


OBSERVACIONES GENERALES


Equipo funcionando según especificaciones del fabricante.


QUIEN ENTREGA	FIRMA	Juan S. Rojas
	NOMBRE	[illegible]
	CARGO	ING. BIOMÉDICO
	FECHA	[illegible]
QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	FIRMA	[illegible]
	NOMBRE	[illegible]
	CARGO	[illegible]
	FECHA	[illegible]
QUIEN REVISA	[illegible]	[signature]
	[illegible]	[signature]

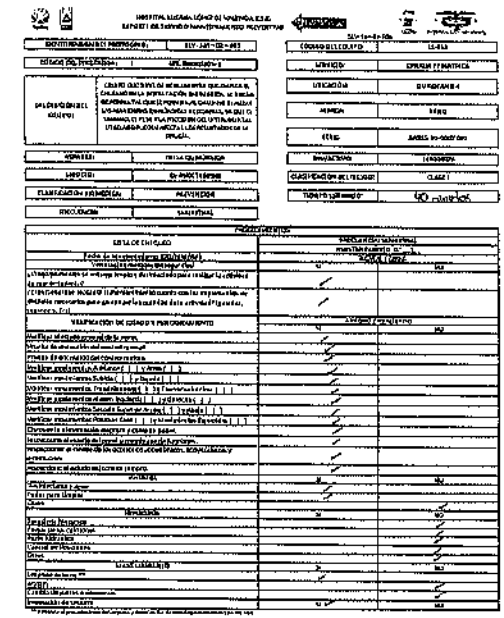


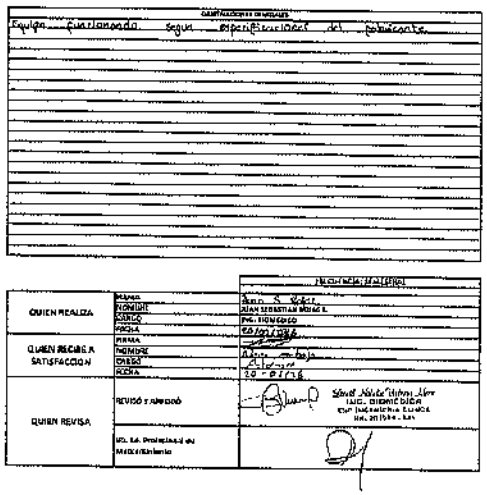


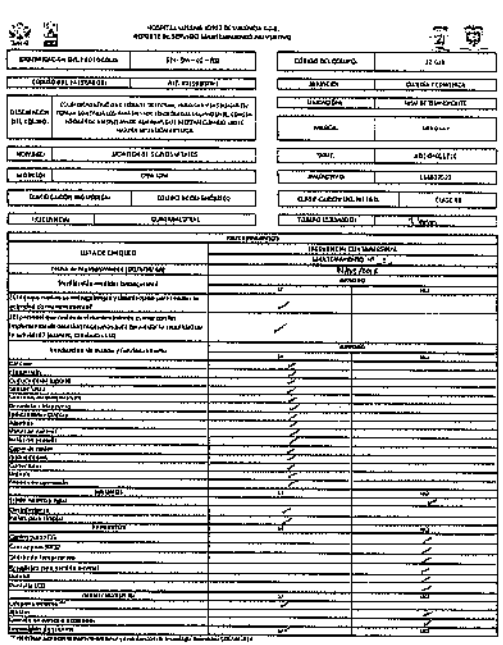

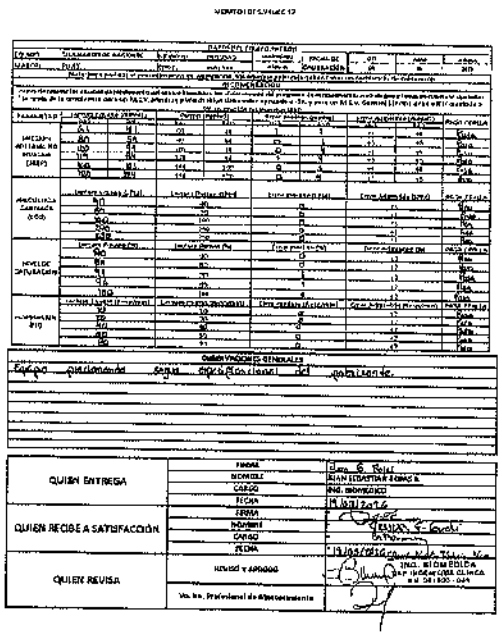


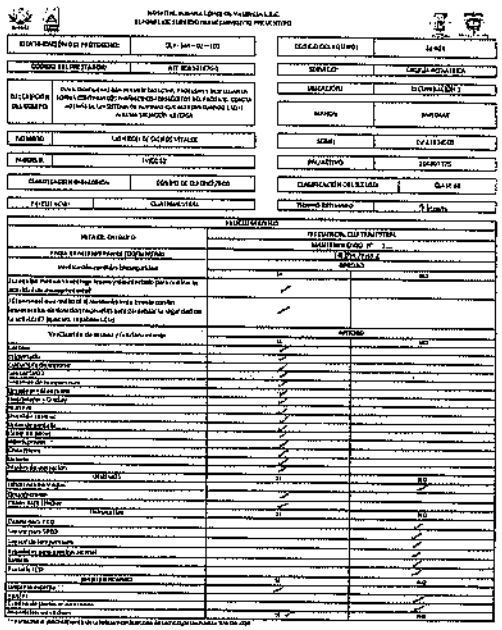

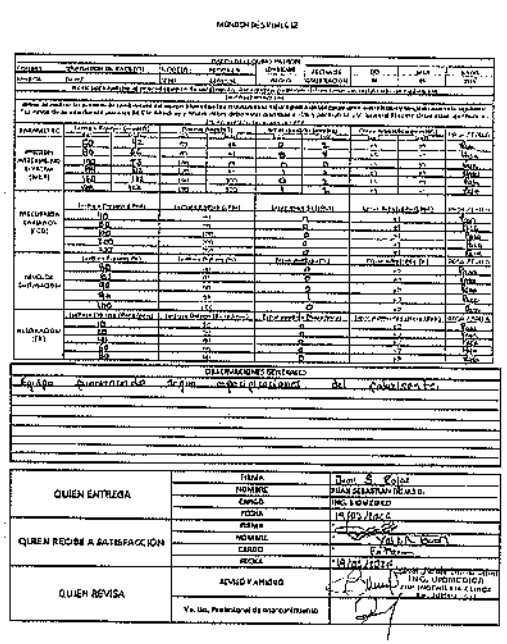


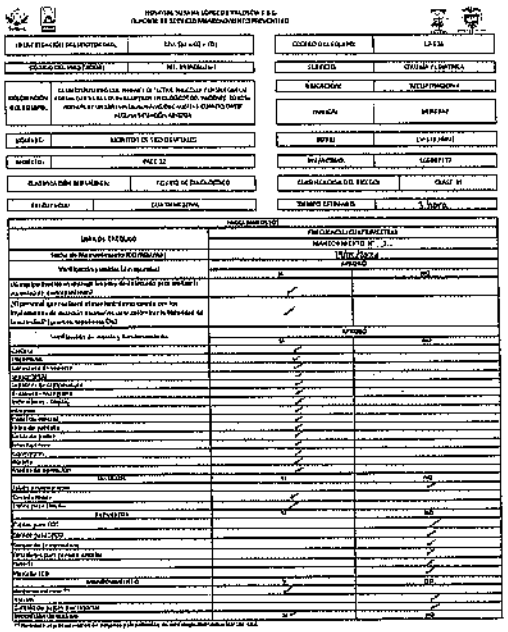


Página 3

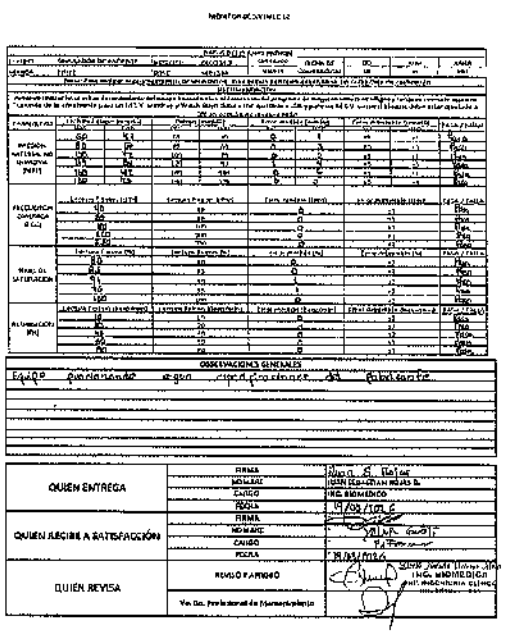


Página 3

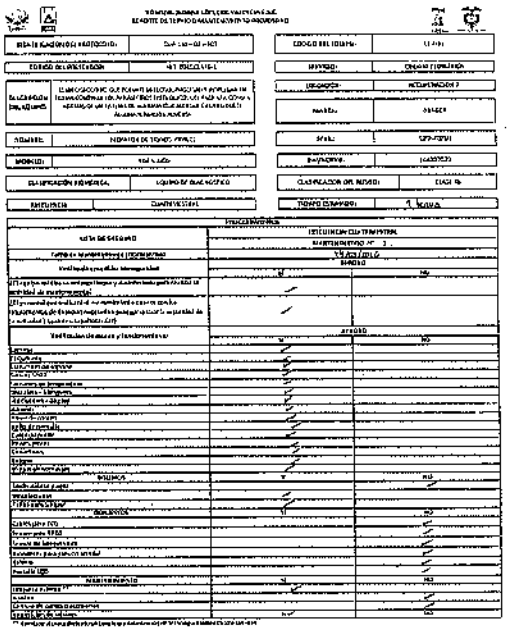



Página 1

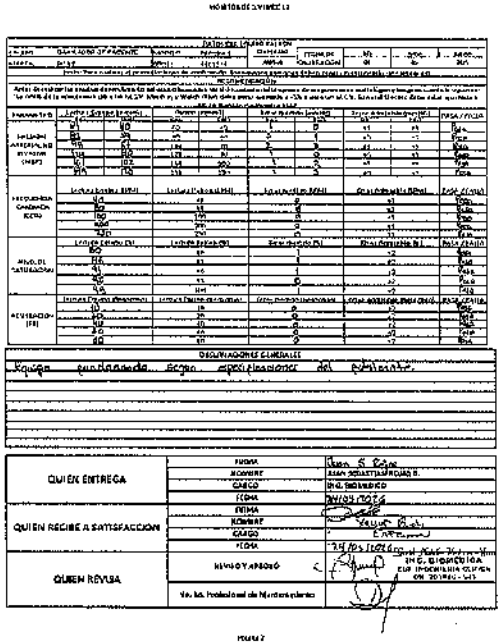



Página 2

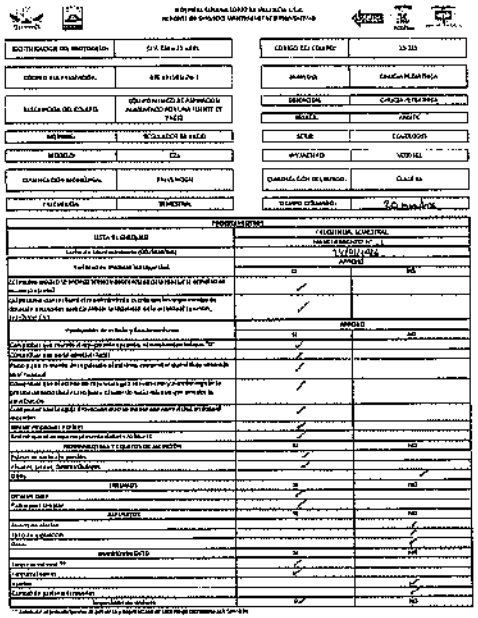


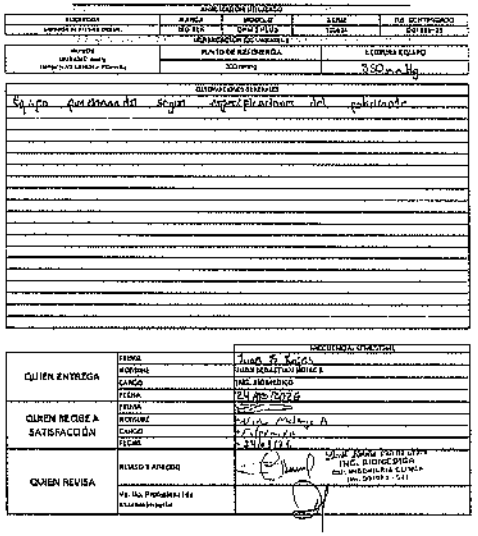


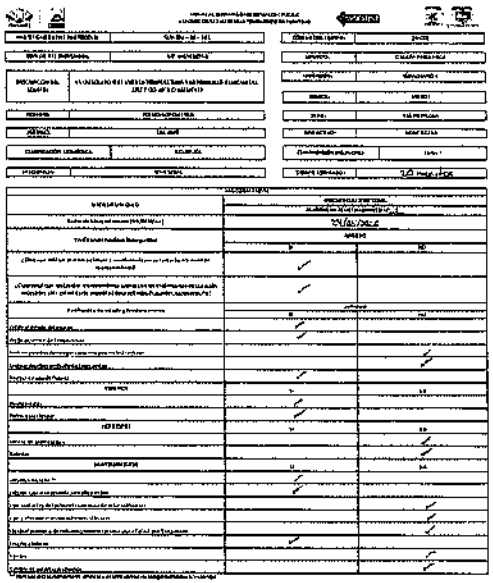


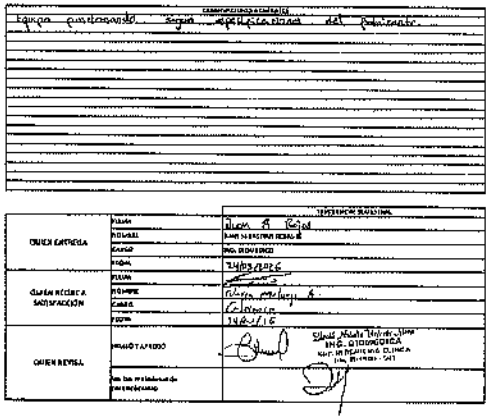


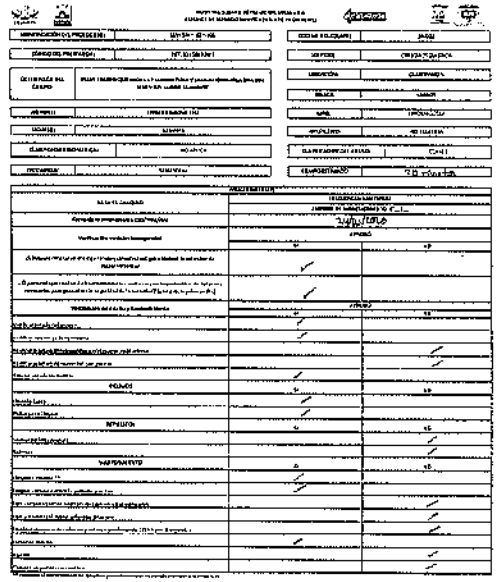

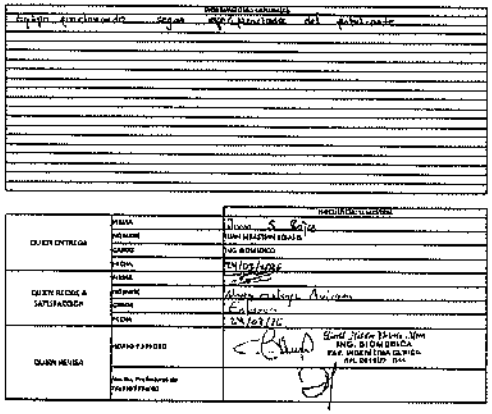


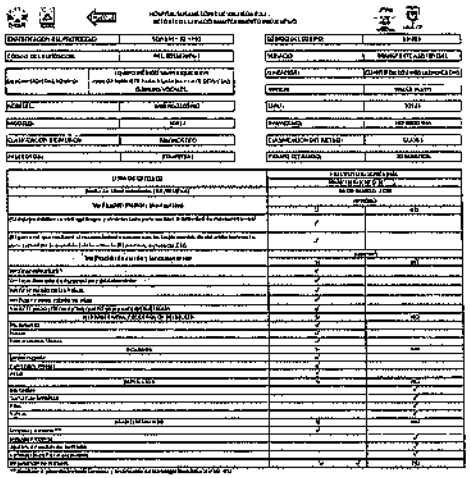


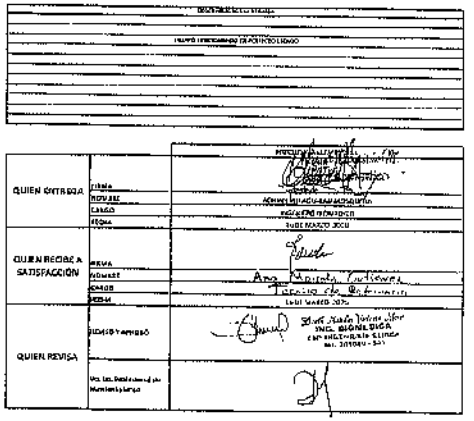


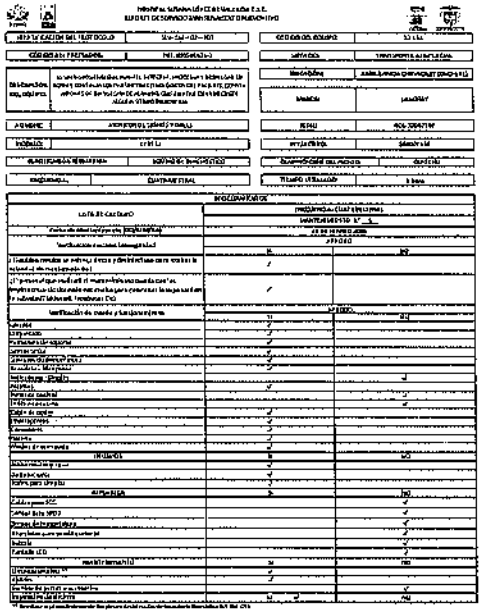


Ambulancia Chevrolet
Monitor de Signos
Mindray
ePM R
Ac6-32047197

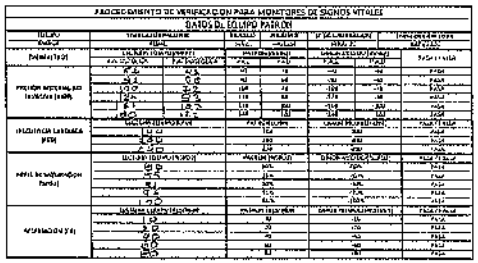

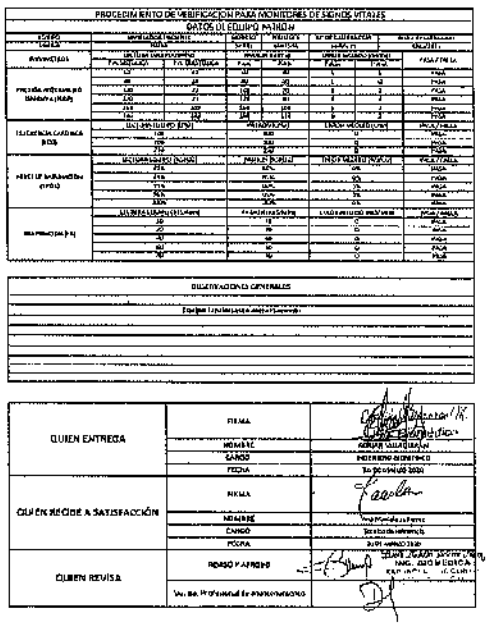

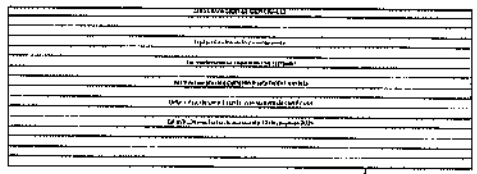

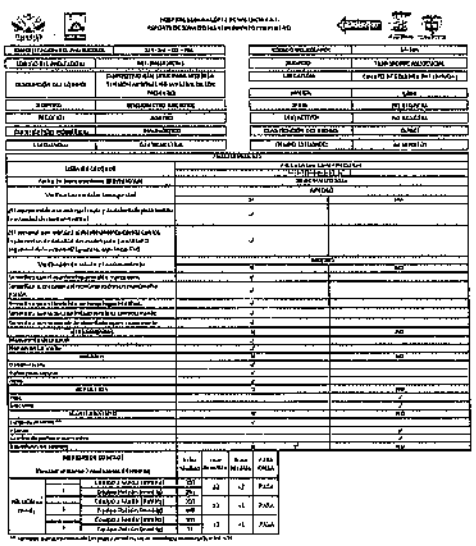

Tensiometro
Marca: GMD
Modelo: Adulto
Serie: No Registra
Cuarto de Referencia

150 + 152

Monitor de Signos
Marca: Contec
Modelo: CMS600
Serie: 2311040009[illegible]

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN PARA MONITORES DE SIGNOS VITALES


DATOS DE EQUIPO PATRÓN


[illegible]	[illegible]	[illegible]	PASA / FALLA
PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (PANI)	[illegible]	[illegible]	PASA
FRECUENCIA CARDIACA (LPM)	[illegible]	[illegible]	PASA
SATURACIÓN DE OXÍGENO (SpO_2)	[illegible]	[illegible]	PASA
RESPIRACIÓN	[illegible]	[illegible]	PASA


OBSERVACIONES GENERALES


Equipo funcionando correctamente


QUIEN ENTREGA	FIRMA	[illegible]
	NOMBRE	[illegible]
	CARGO	[illegible]
	FECHA	[illegible]
QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	FIRMA	[illegible]
	NOMBRE	[illegible]
	CARGO	[illegible]
	FECHA	[illegible]
QUIEN REVISA	REVISO Y APROBÓ	ING. BIOMEDICO [illegible]
	[illegible]	[illegible]

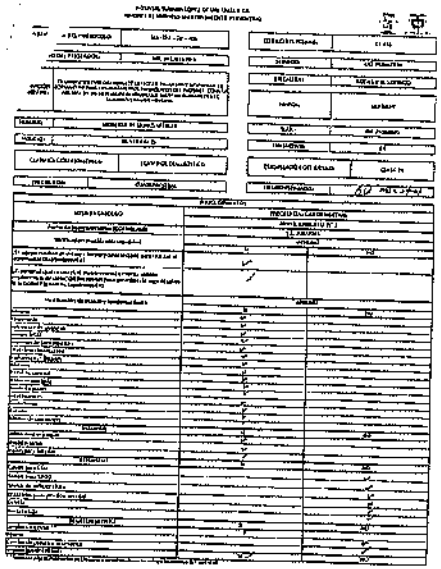


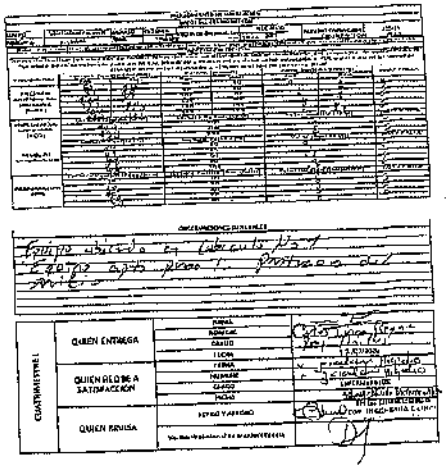


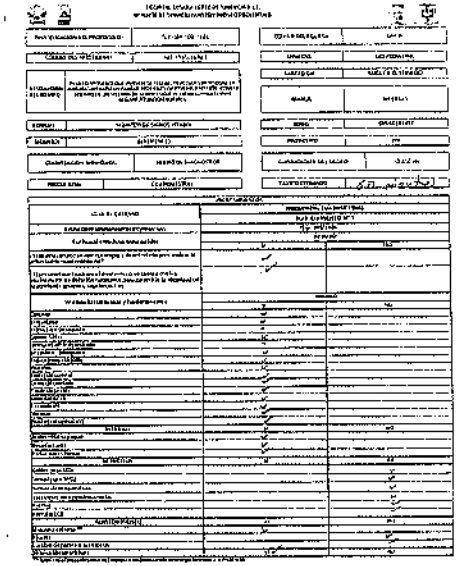


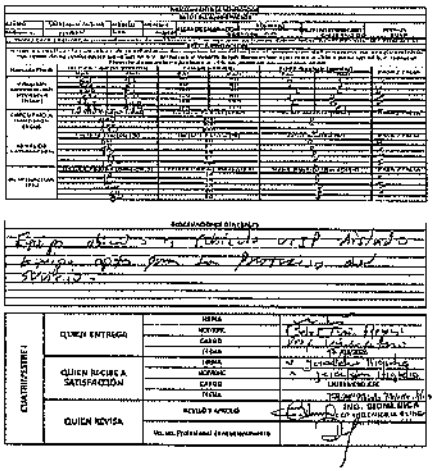


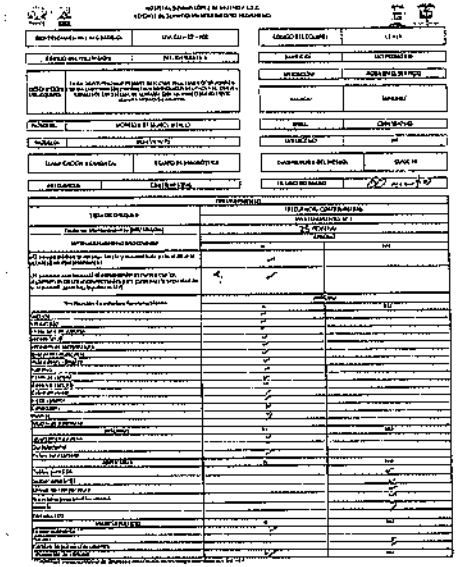


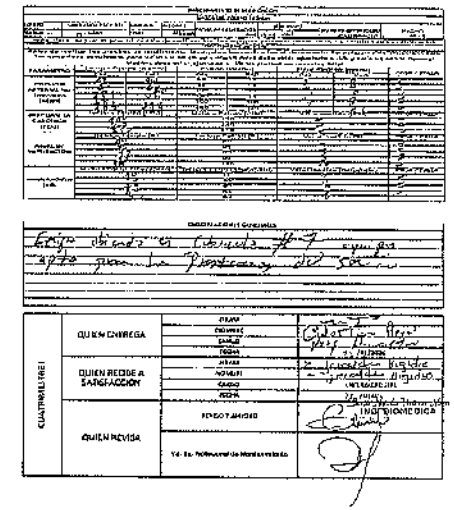


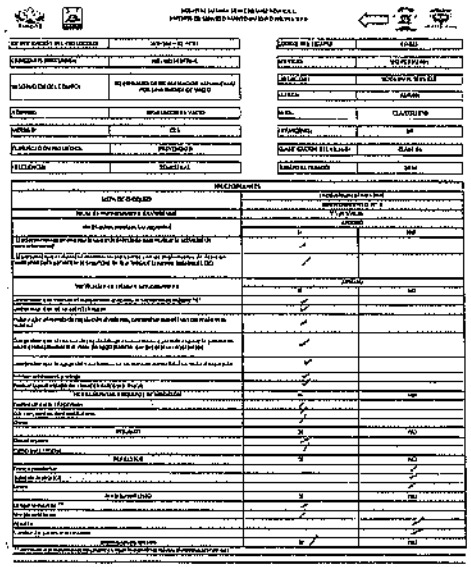


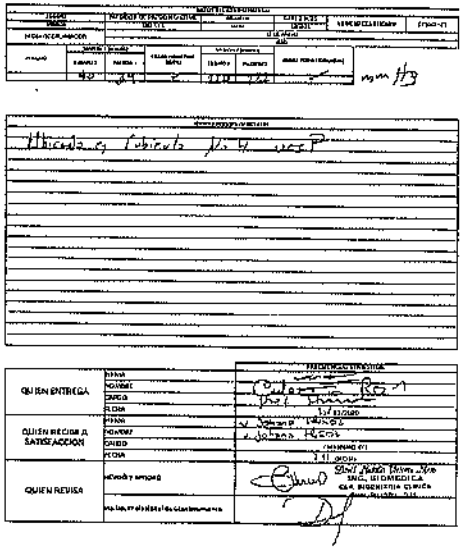


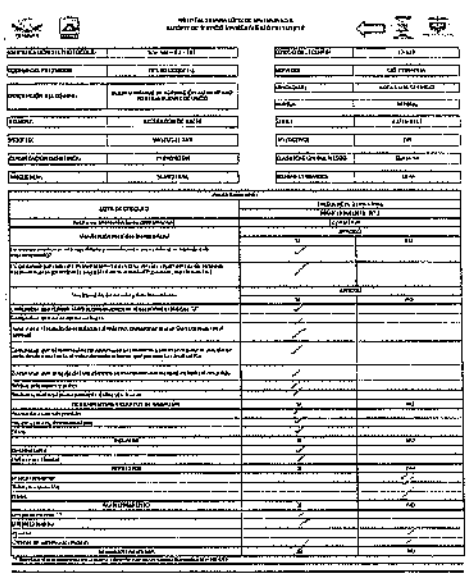





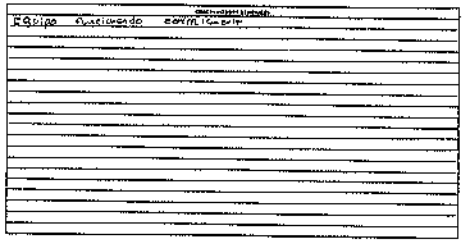


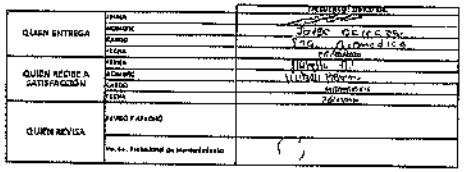


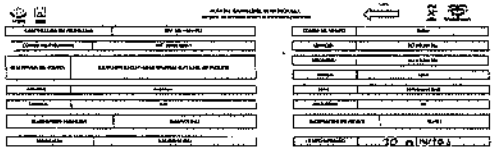


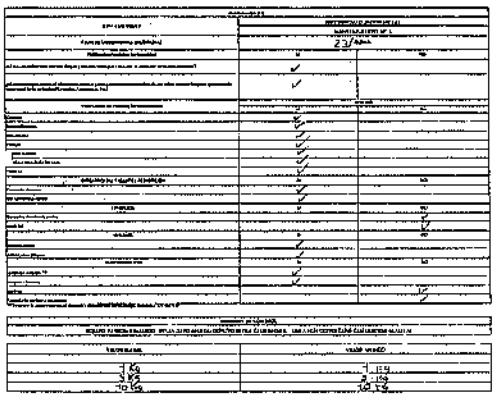


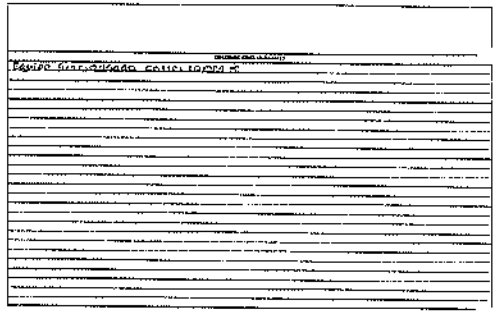


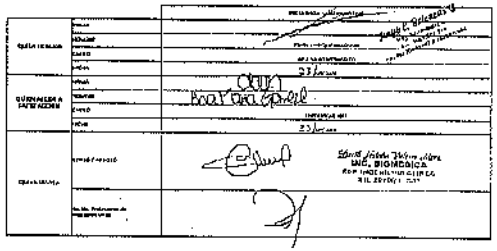


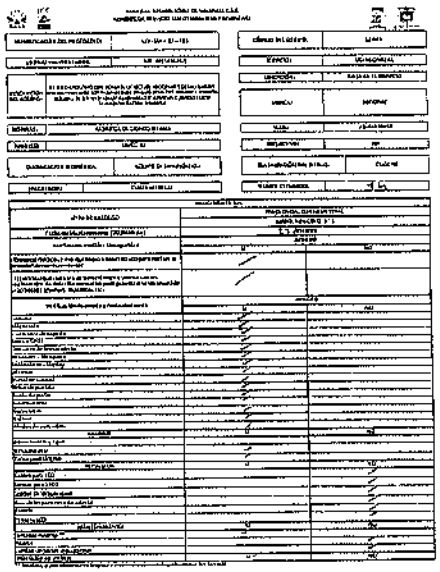


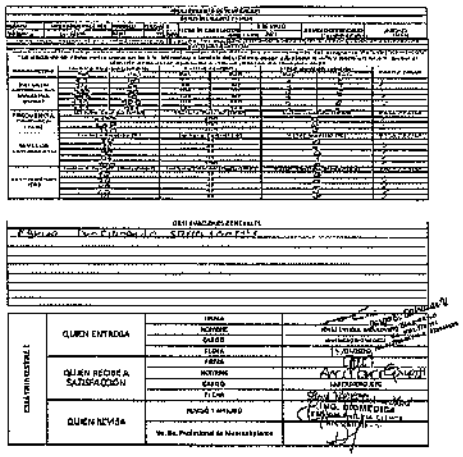


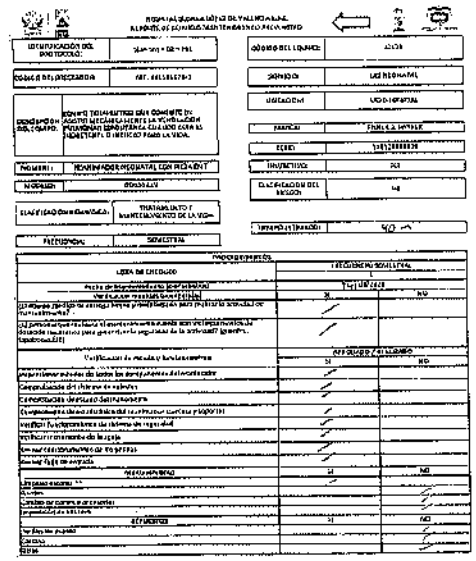


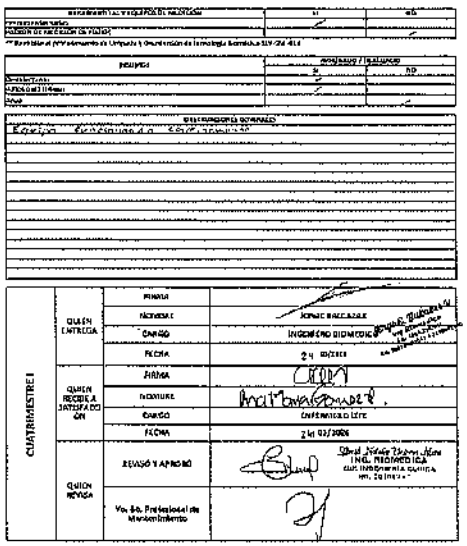


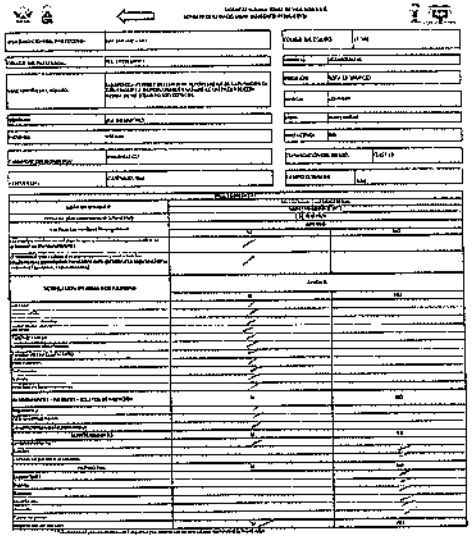


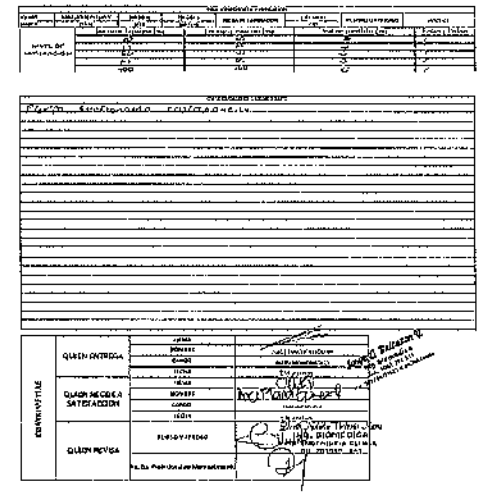


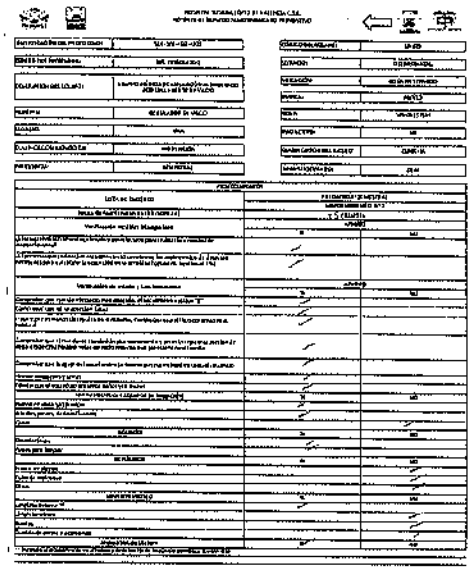


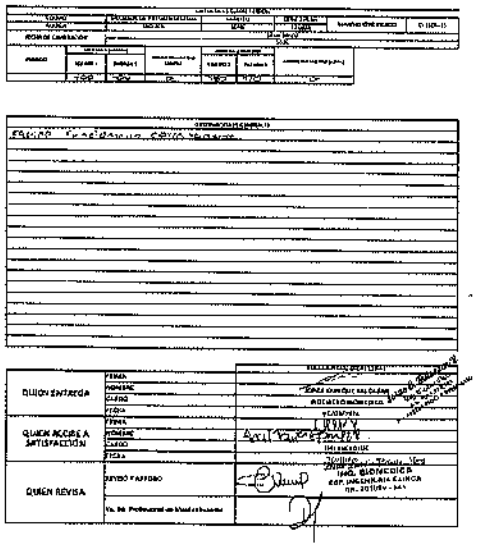


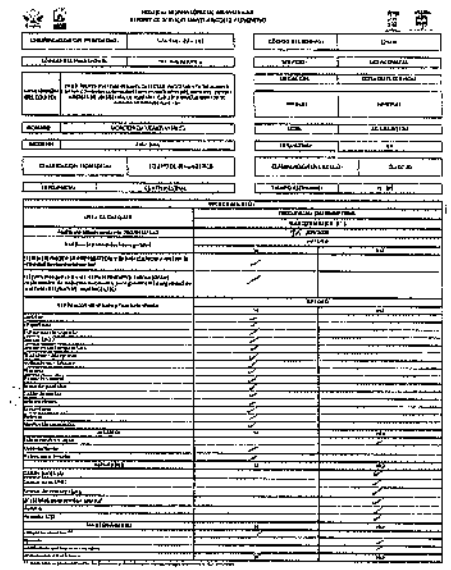


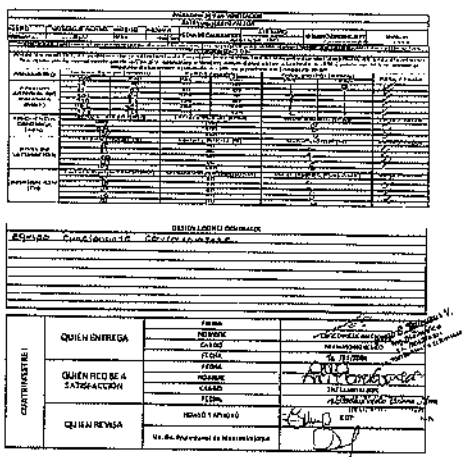


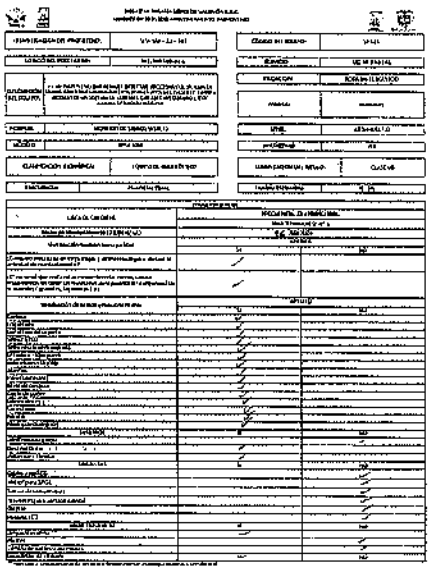


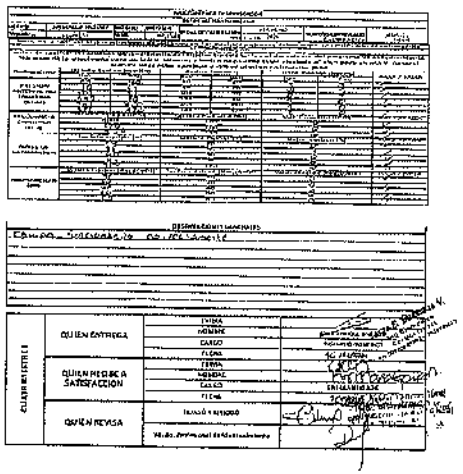


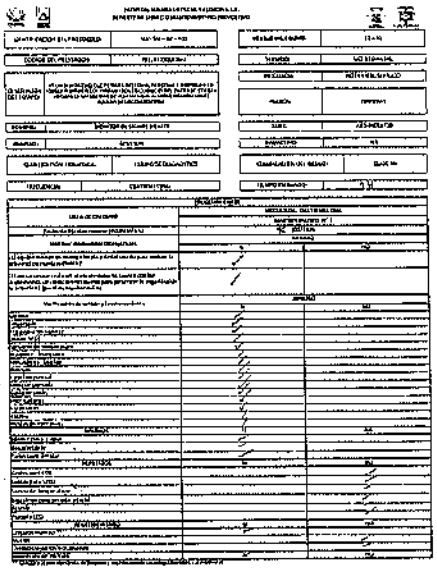


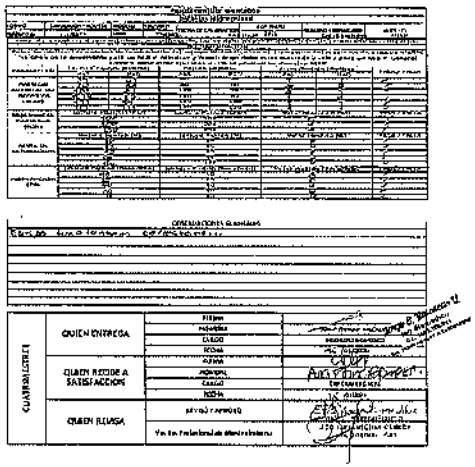


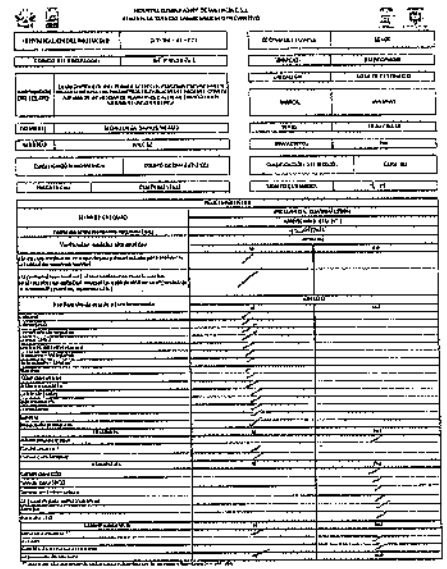


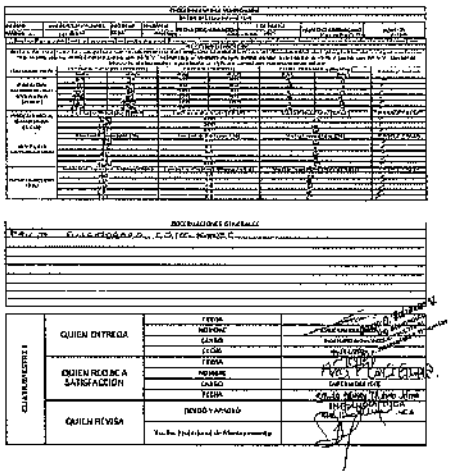


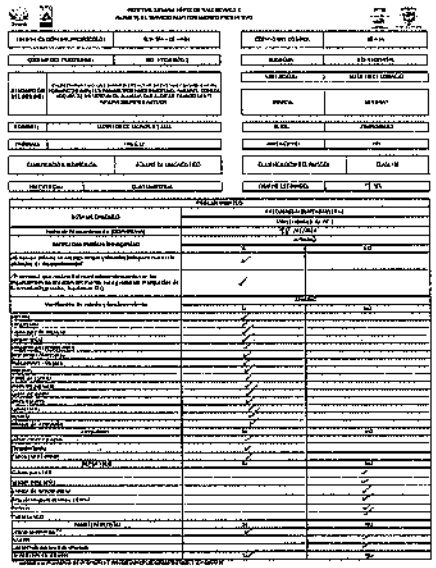


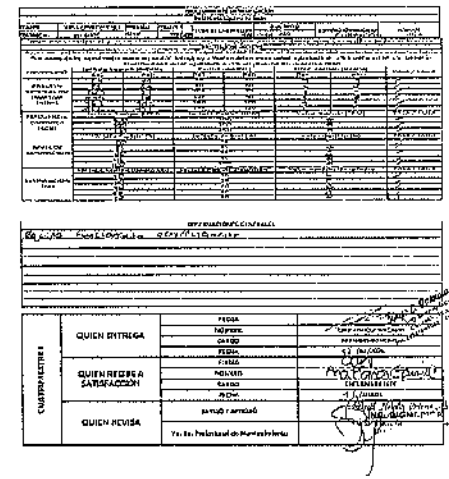


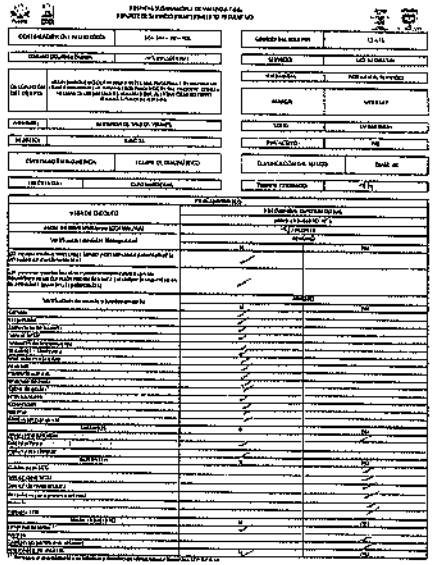


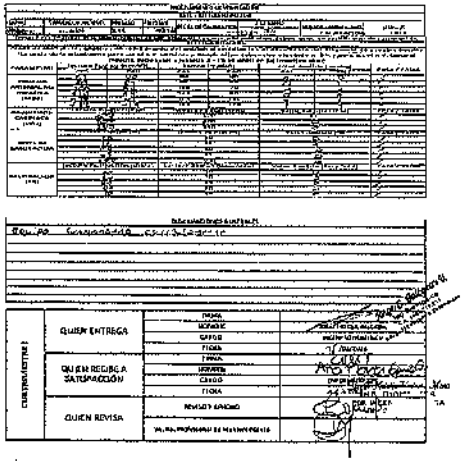

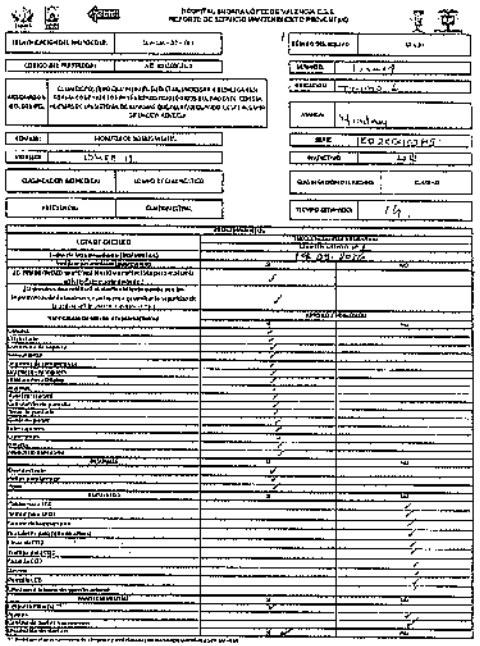

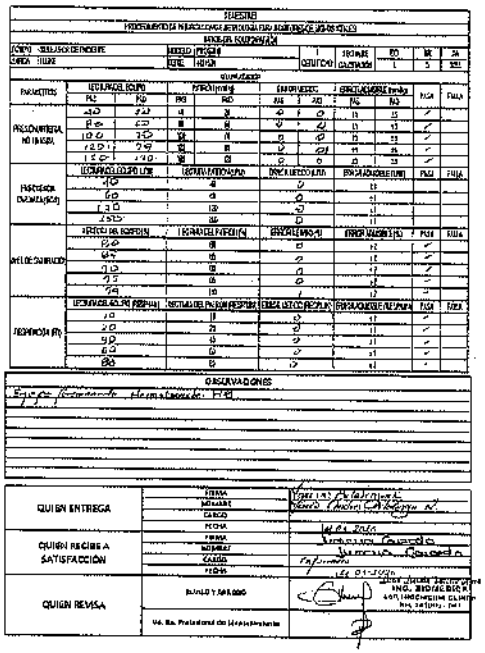

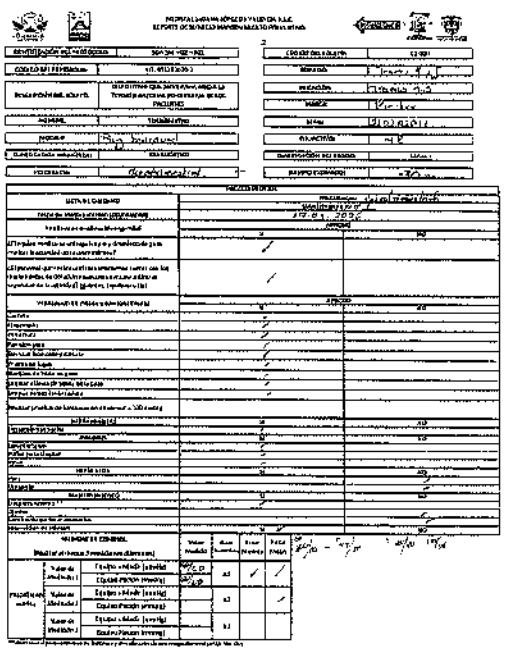

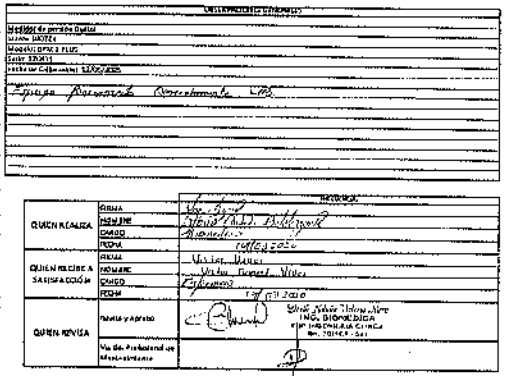

HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.
REPORTE DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

[illegible]

SEMESTRE I


PRESIÓN INTERNA	[illegible]									
FRECUENCIA CARDIACA	[illegible]									
[illegible]	[illegible]									


OBSERVACIONES


QUIEN ENTREGA	FIRMA / NOMBRE / CARGO / FECHA	[illegible]
QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	FIRMA / NOMBRE / CARGO / FECHA	[illegible]
QUIEN REVISA	REVISÓ Y APROBÓ	[illegible]


QUIEN REALIZA	FIRMA / NOMBRE / CARGO / FECHA	[illegible]
QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	FIRMA / NOMBRE / CARGO / FECHA	[illegible]
QUIEN REVISA	[illegible]	[illegible]


QUIEN ENTREGA	FIRMA / NOMBRE / CARGO / FECHA	[illegible]
QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	FIRMA / NOMBRE / CARGO / FECHA	[illegible]
QUIEN REVISA	[illegible]	[illegible]

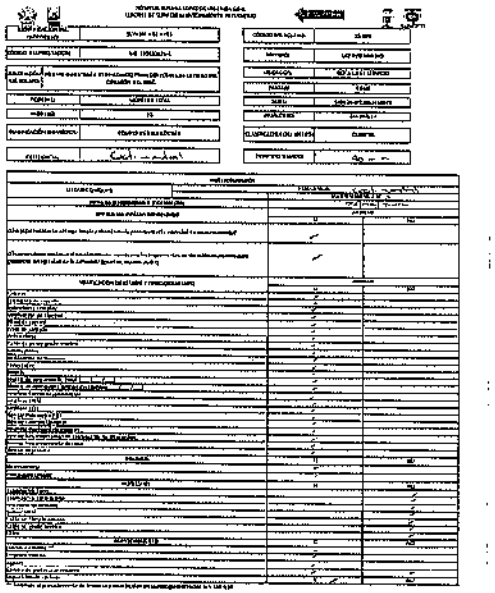


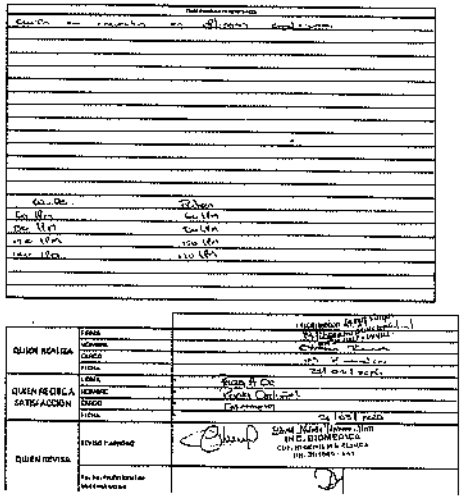


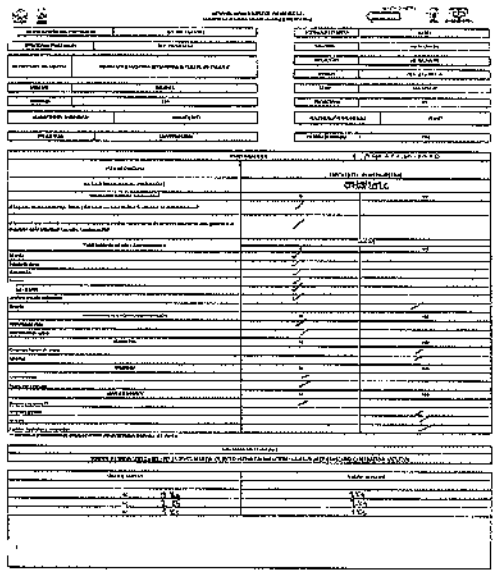


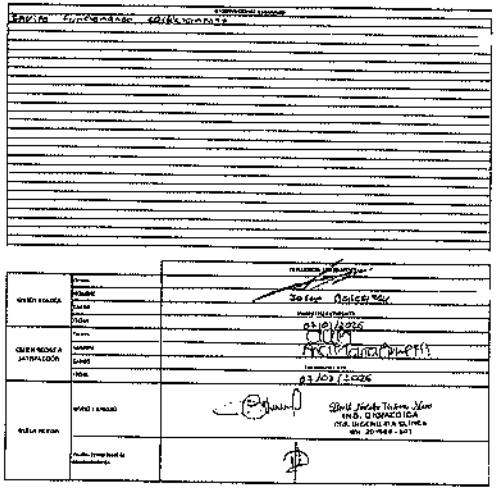

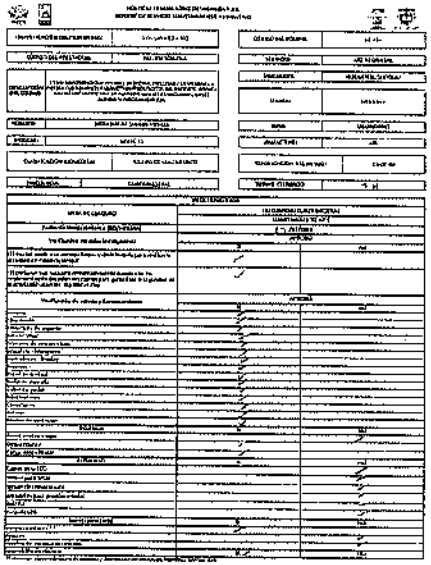


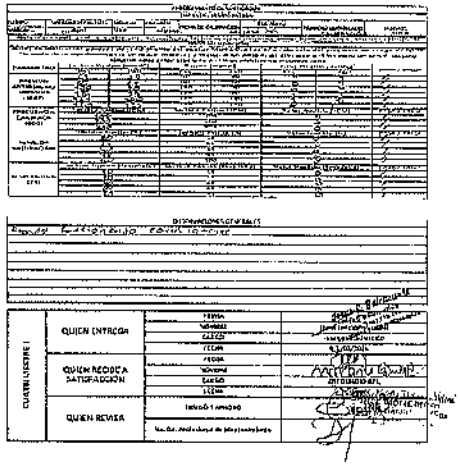


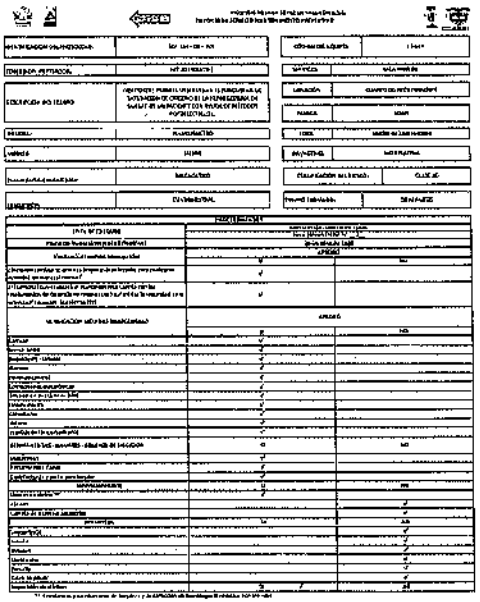


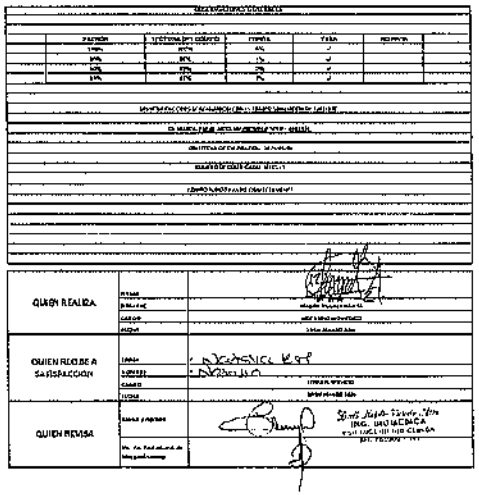



Polaroxímetro
EDAN
H100B
360101 – M23B0164K0004
Sala de partos

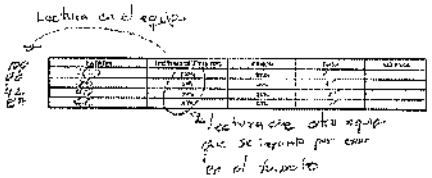


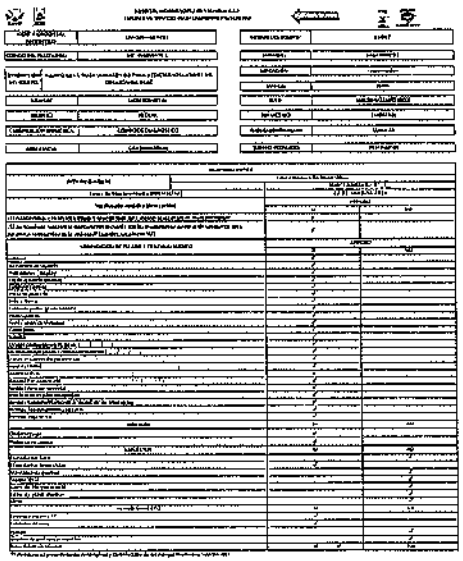


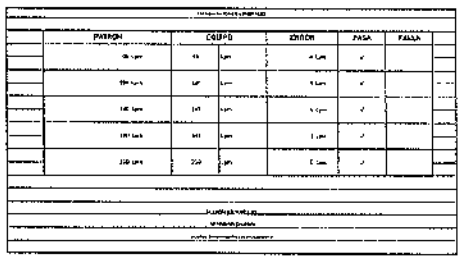


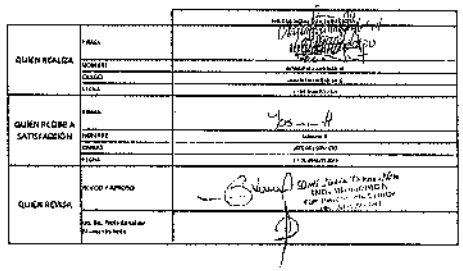


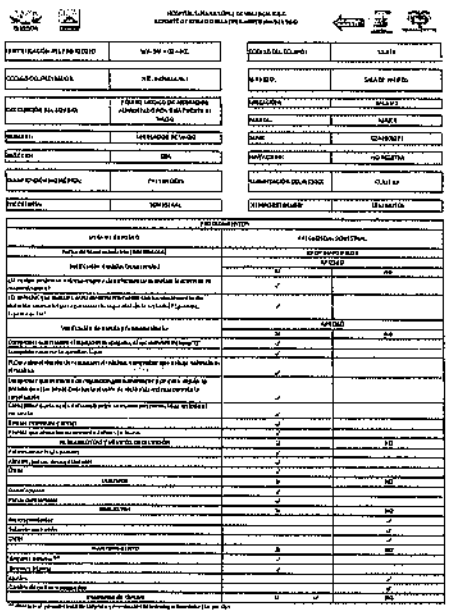


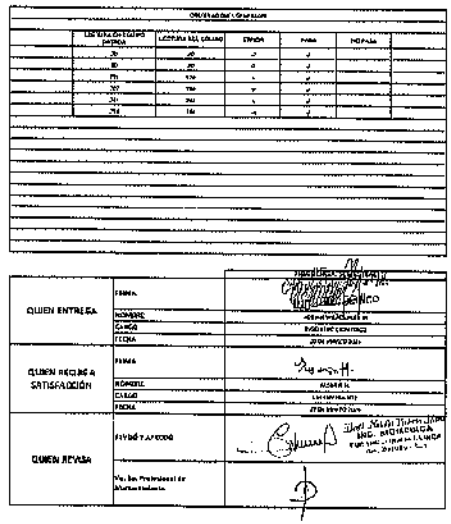


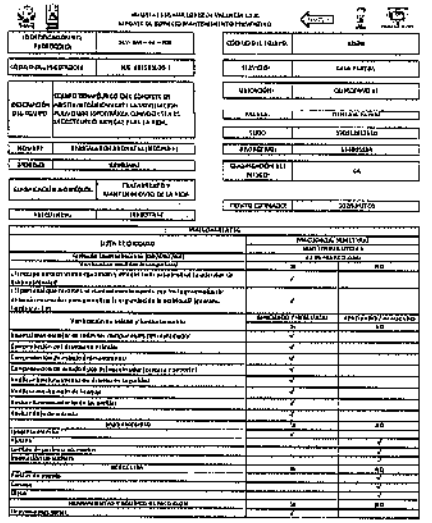


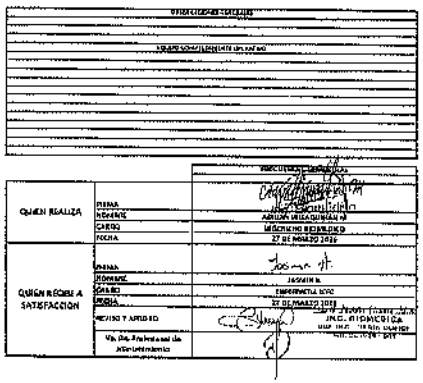


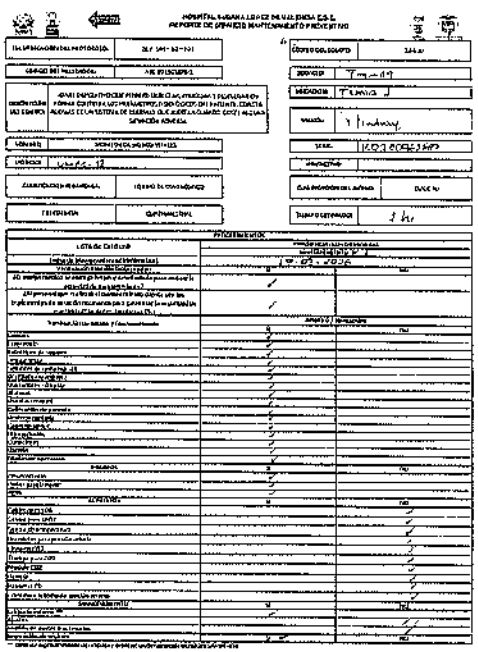


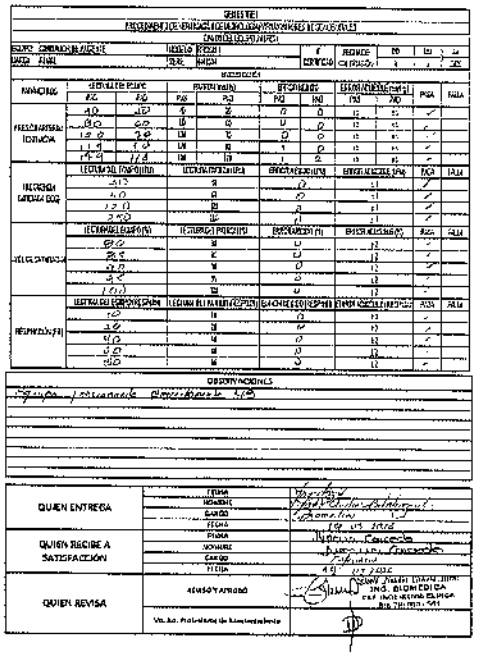


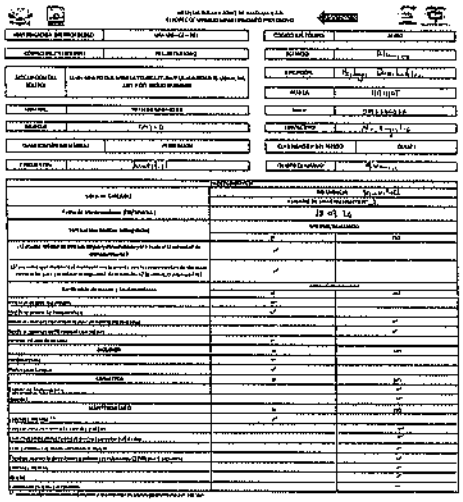


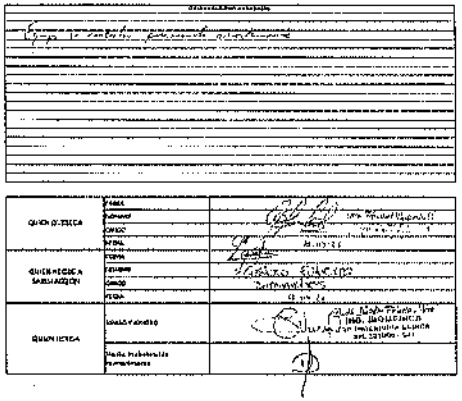


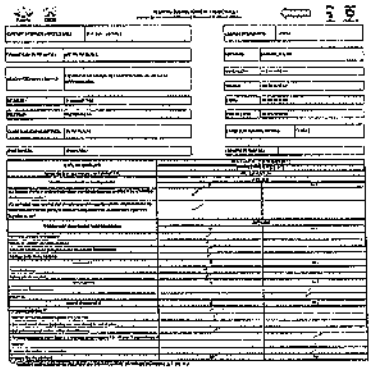


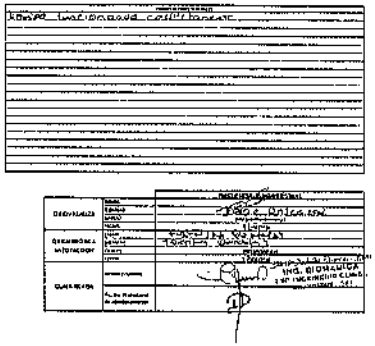


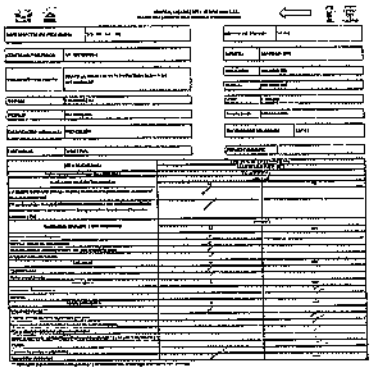


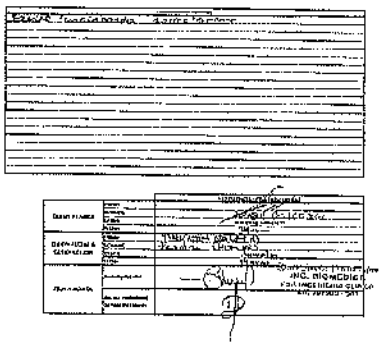


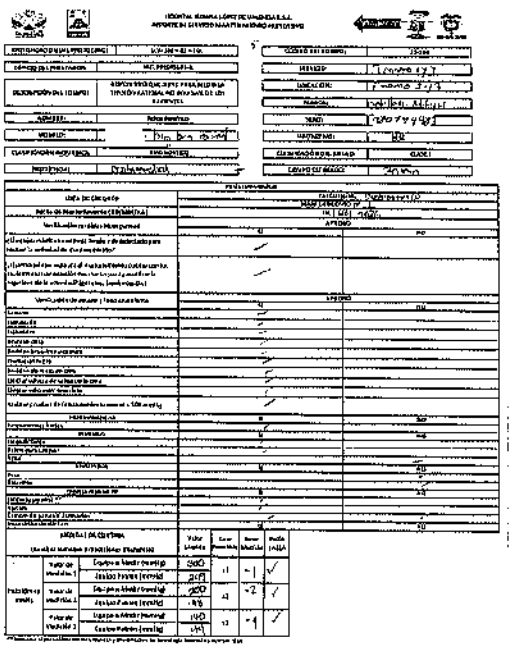


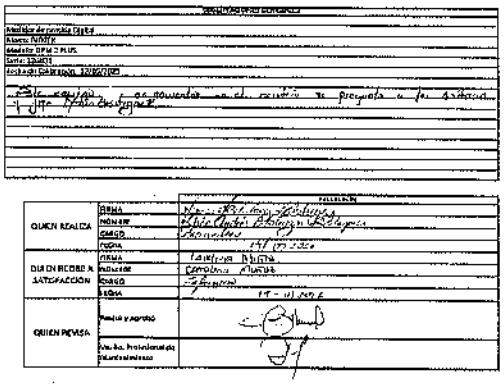


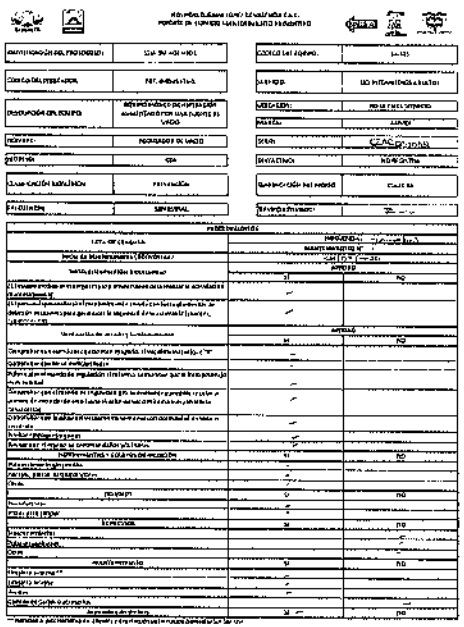


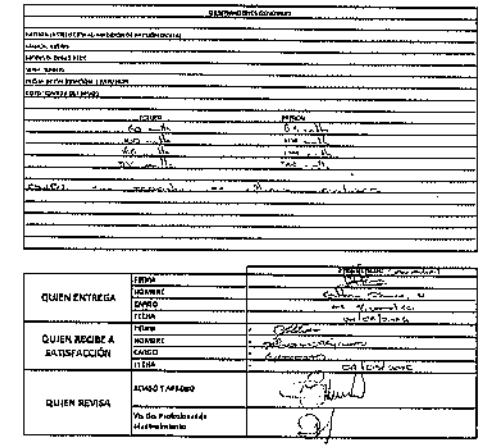


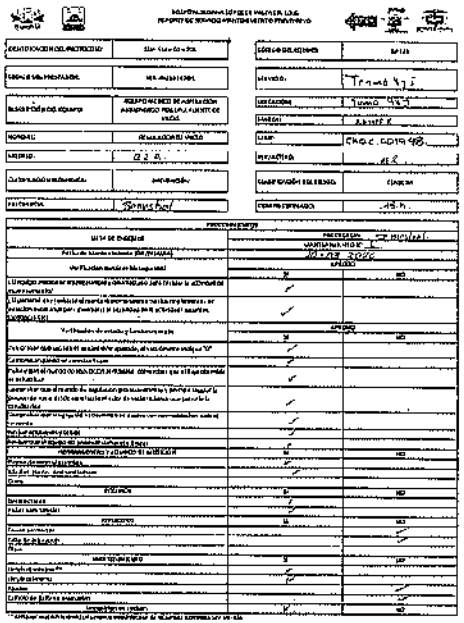


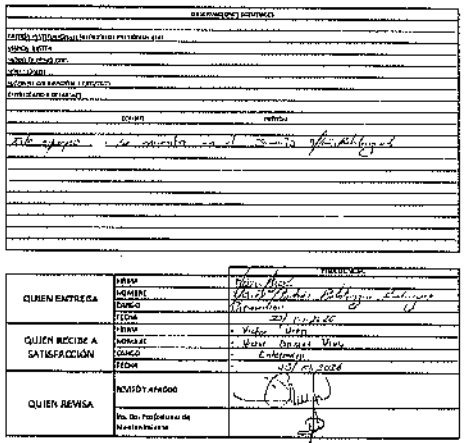


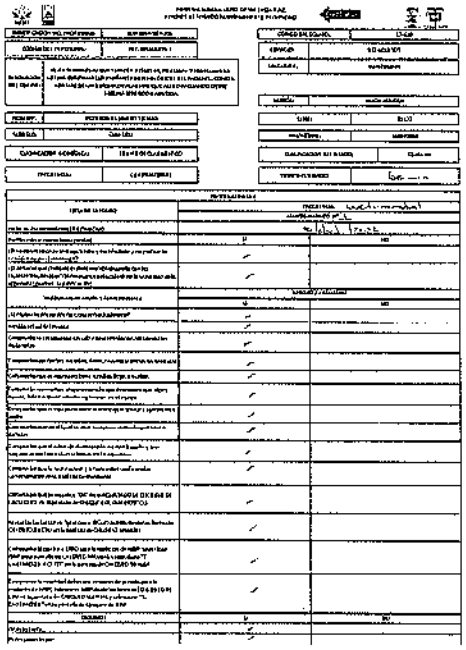


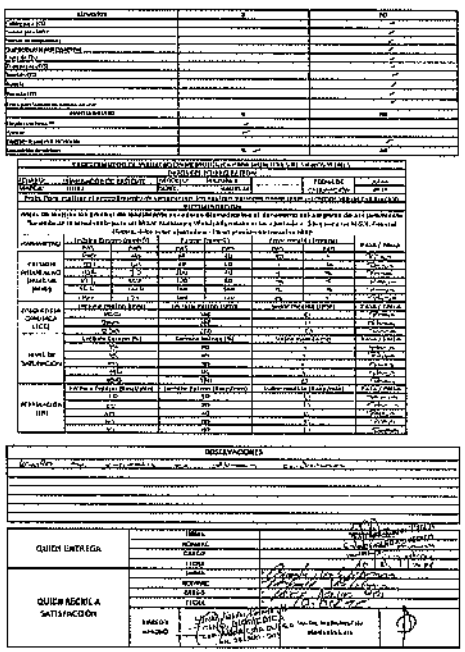


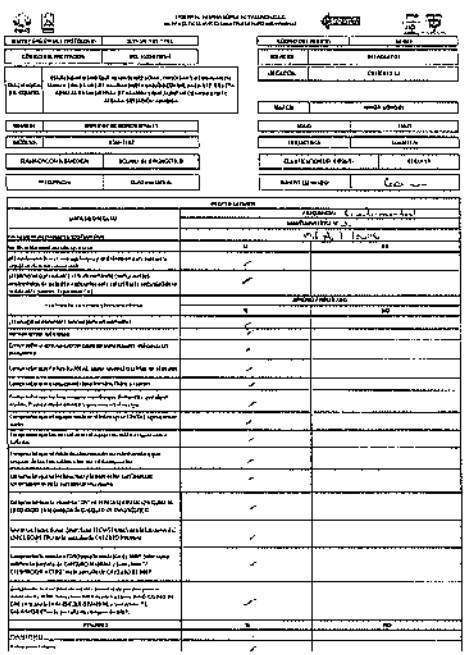


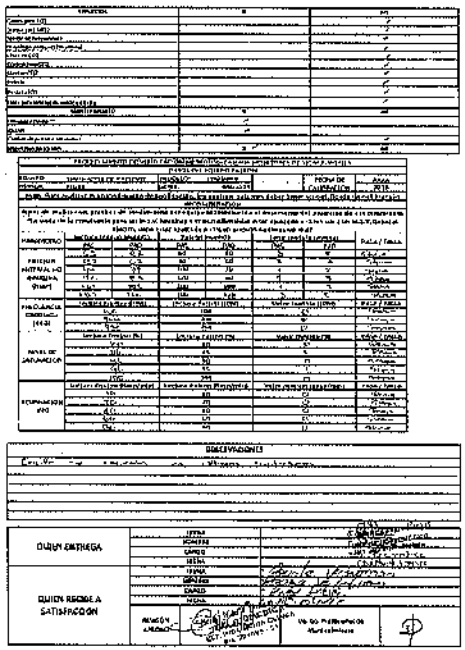


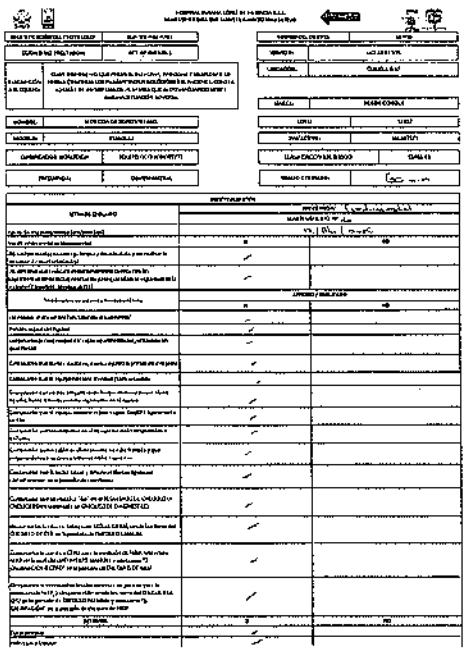


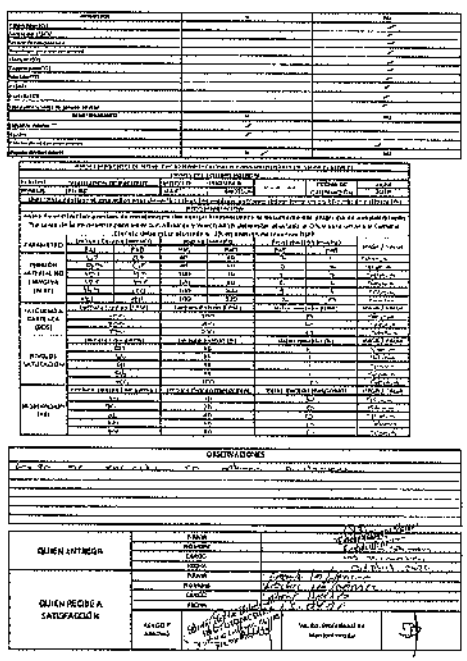


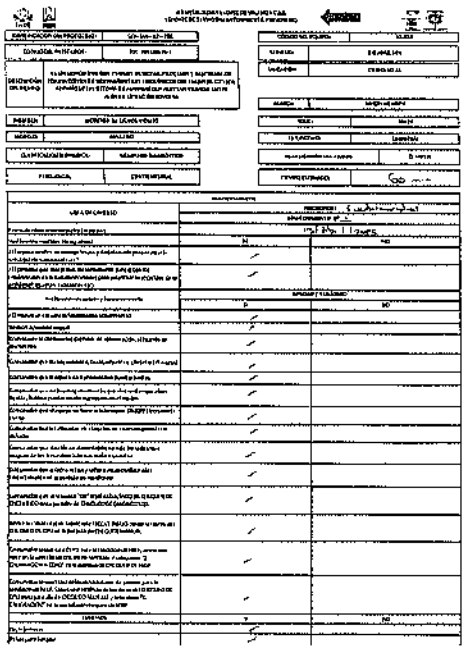


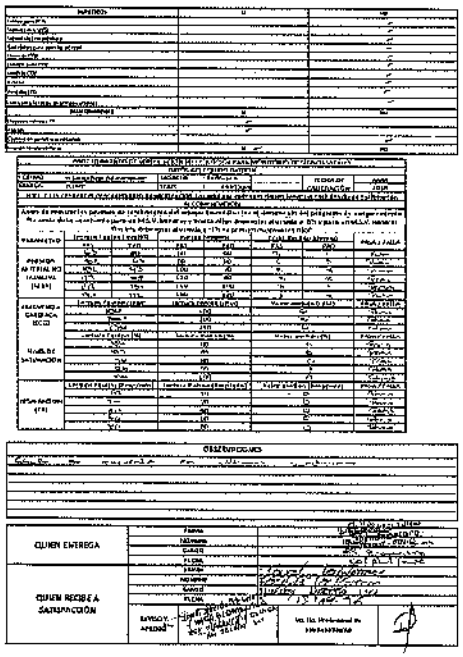


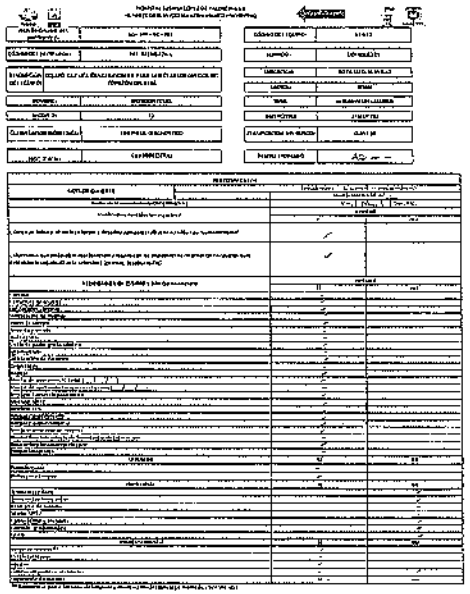


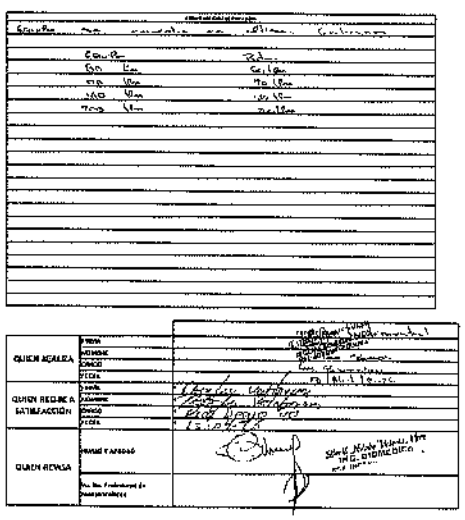


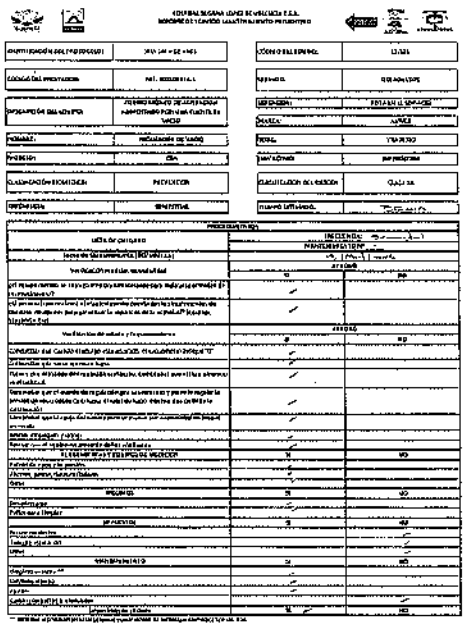


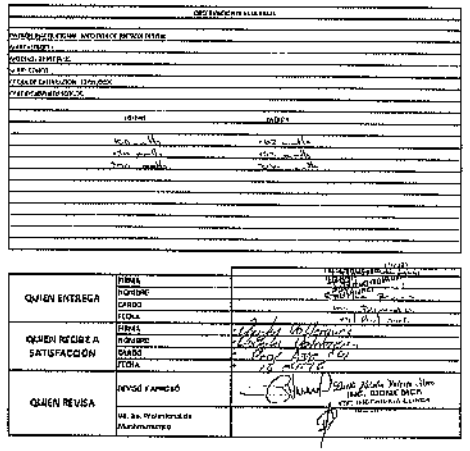


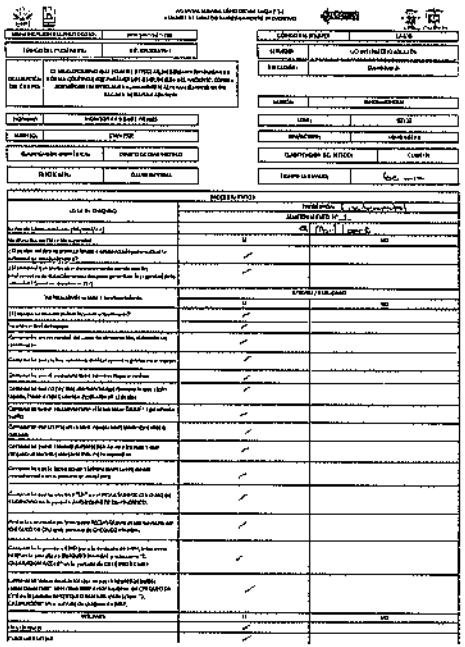


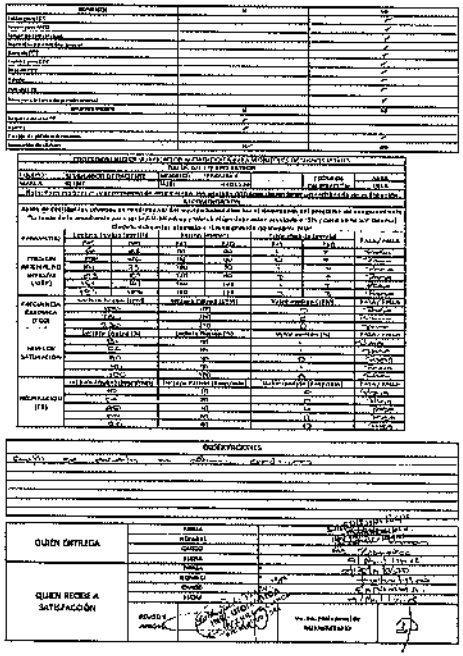


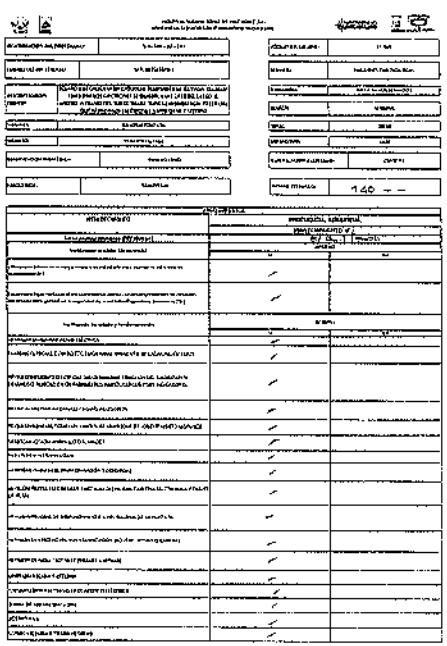


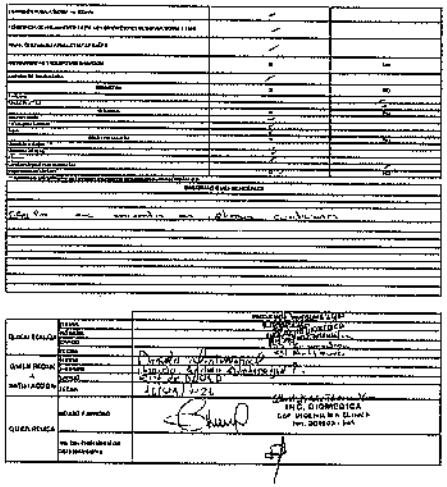


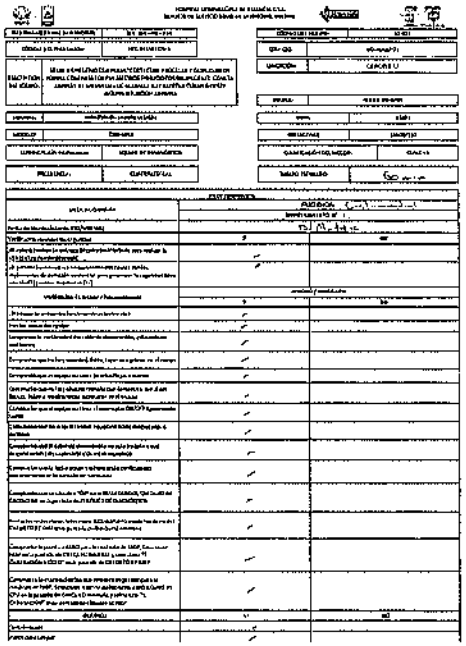


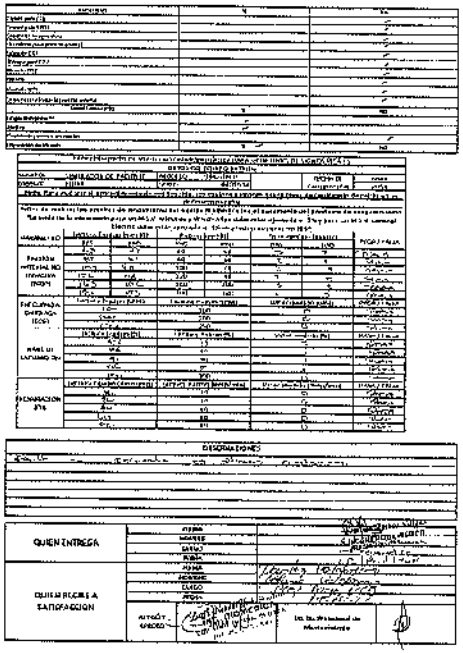


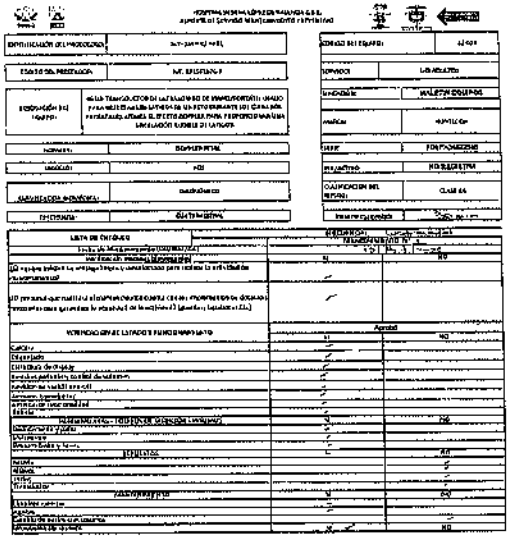


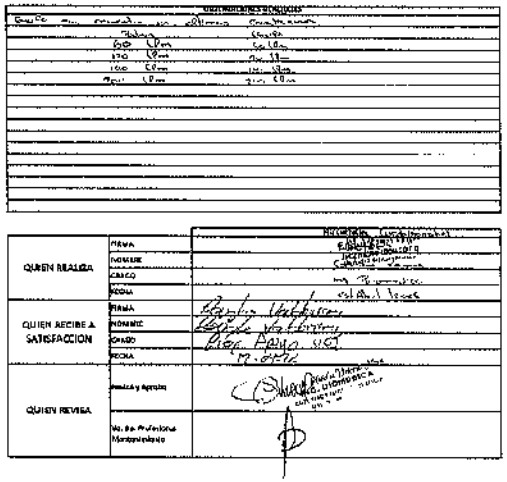


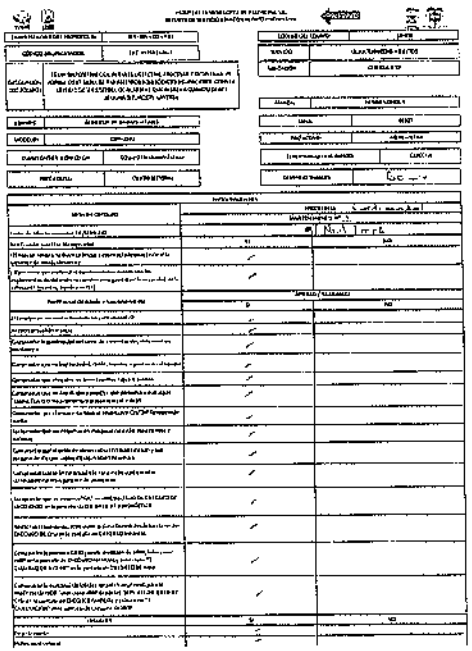

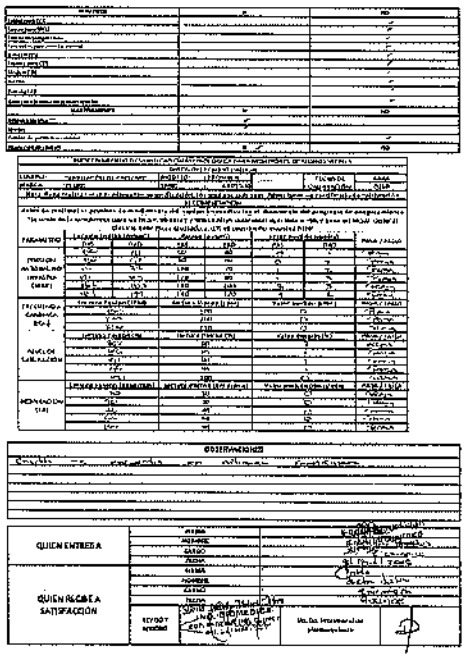

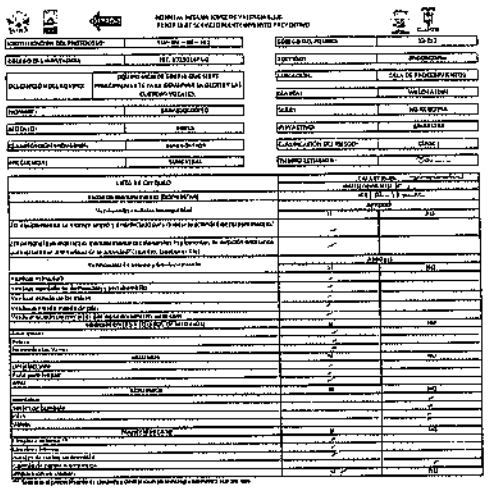

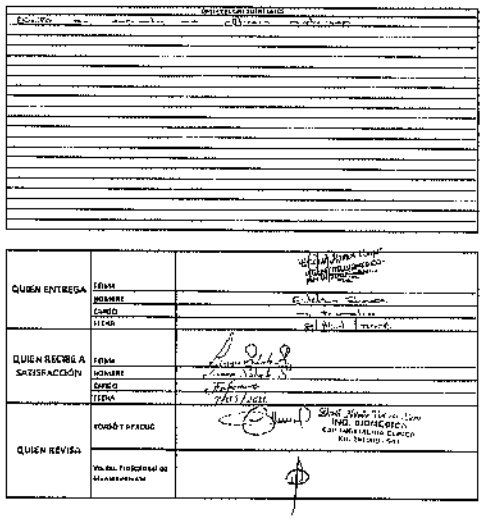

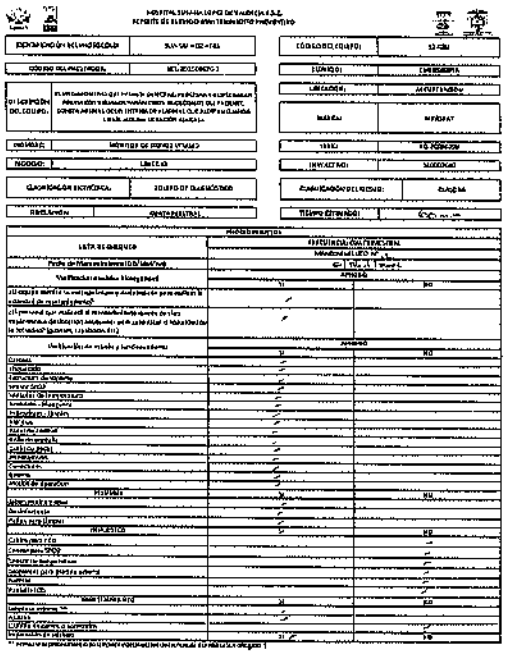


HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO E.S.E.
REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DEPENDENCIA DE MANTENIMIENTO:	SUB GERENCIA	CÓDIGO DEL EQUIPO:	12-HOM
CÓDIGO DEL MANTENIMIENTO:	MTTO-2020-0009-1	EQUIPO:	CAMA HOSPITAL
		UBICACIÓN:	HOSPITALIZACIÓN
		MARCA:	INTERPAT
MODELO:	MANUAL DE CAMAS ELECTRICAS	SERIE:	NO REGISTRA
INGRESO:	1 DE ENERO	INVENTARIO:	12-HOM
CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA:	EQUIPO DE CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO:	CLASE IIA
RIESGO:	MANTENIMIENTO	TIEMPO ESTIMADO:	60 min


LISTA DE CHEQUEO	PROCEDIMIENTOS
	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO
	Mantenimiento N° 1
Fecha de Mantenimiento (DD/MM/AA)	21/01/2020
Verificación de Estado Físico y Limpieza	APROBO
	SI / NO
¿El equipo cuenta con todos los componentes para cumplir la totalidad de su trabajo previsto?	
¿El personal que realizará el mantenimiento cuenta con los requerimientos de bioseguridad (guantes, respirador, etc.)?	
Verificación de estado y funcionamiento	APROBO
	SI / NO
Carcasa	
Tornillos	
Tapizados de colchón	
Ventilación	
Soldadura	
Ventilación Interna	
Bandeja - Mayorga	
Bandeja - Hules	
Rieles	
Manivelas	
Pedal de emergencia	
Cabecera Fijo	
Pedestales	
Conectores	
Cables	
Modos de operación	
PRUEBAS	SI / NO
Desplazamiento	
Desinfección	
Cama Trendelenburg	
PROTOCOLO	SI / NO
Cabeza arriba	
Cama arriba 90°C	
Cama en trendelenburg	
Cama en antitrendelenburg	
Pedestal	
Pedestal 180	
Mantenimiento Correctivo	SI / NO
Limpieza externa	
Limpieza interna	
Limpieza externa e interna	
Mantenimiento realizado	SI / NO


* Marcar con una (X) en la casilla correspondiente a la respuesta


QUIEN ENTREGA	FIRMA	
	NOMBRE	
	CARGO	
	FECHA	21/01/2020
QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA	
	NOMBRE	
	CARGO	
	FECHA	21/01/2020
QUIEN REVISA	Revisó y aprobó	
	Vo. Bo. Profesional de Mantenimiento	

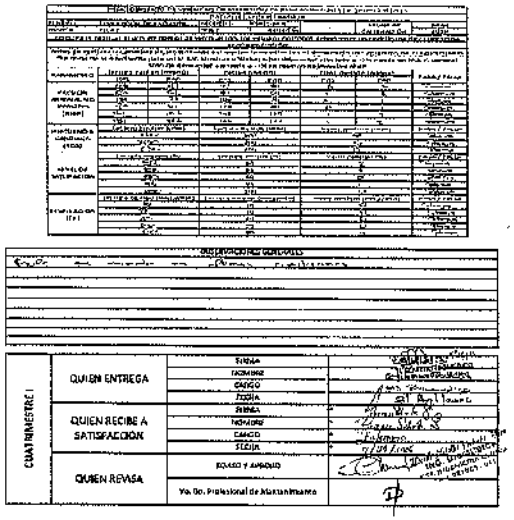



CUATRIMESTRE I	QUIEN ENTREGA	FIRMA
		NOMBRE
		CARGO
		FECHA
	QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA
		NOMBRE
		CARGO
		FECHA
	QUIEN REVISA	REVISO Y APROBO
		Vo. Bo. Profesional de Mantenimiento

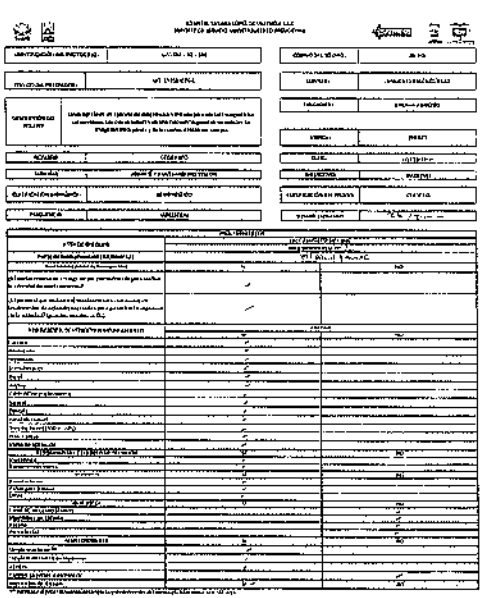


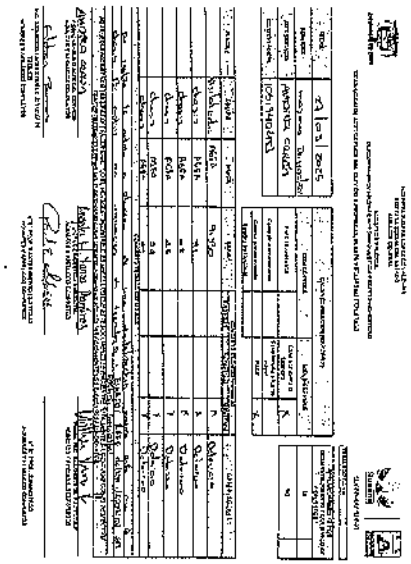


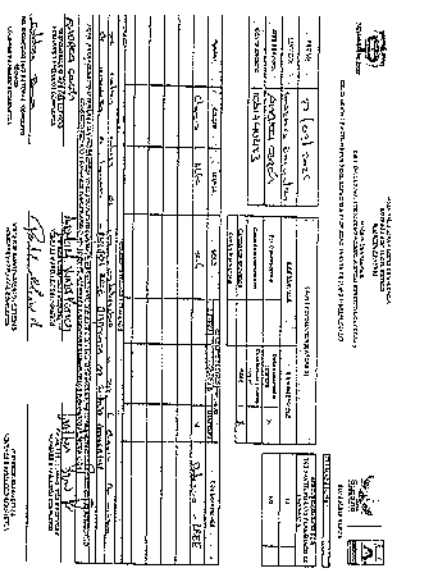


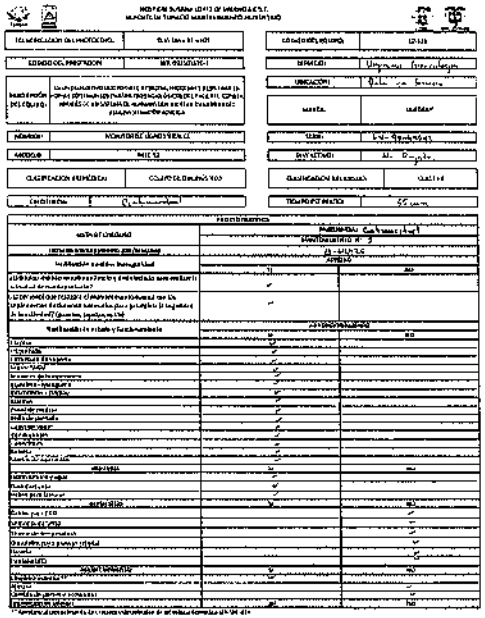


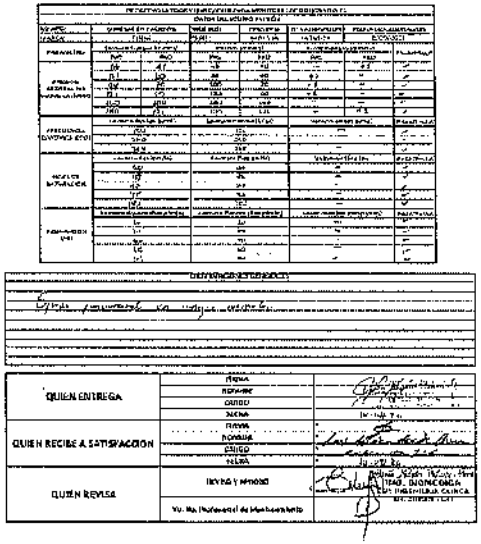


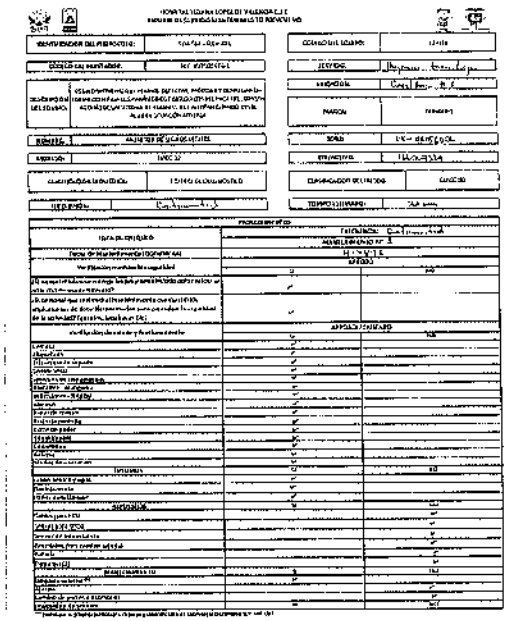


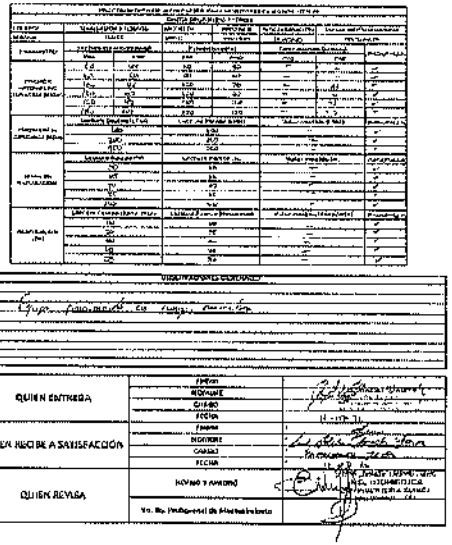


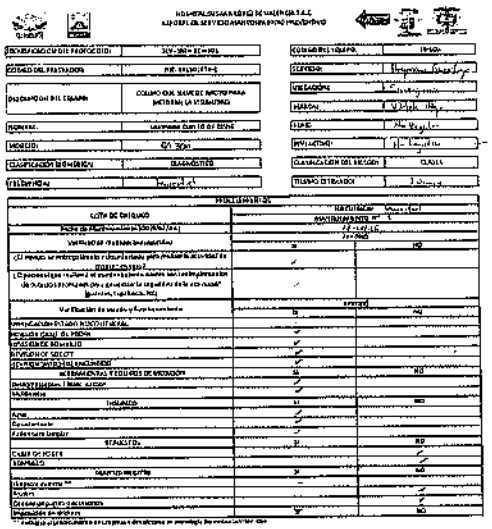


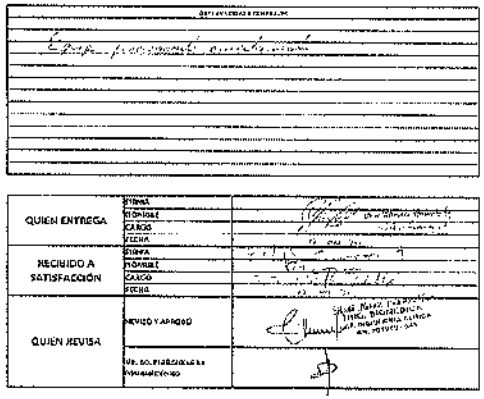


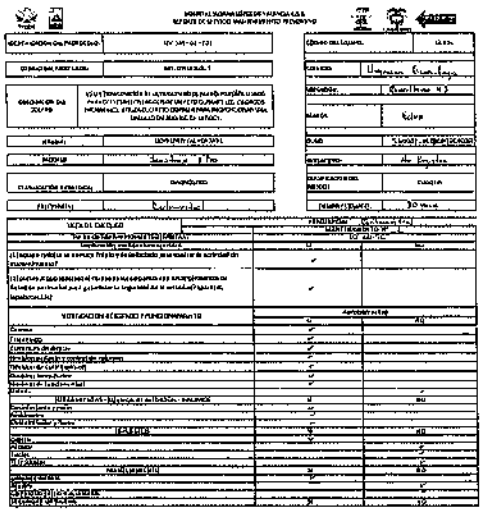


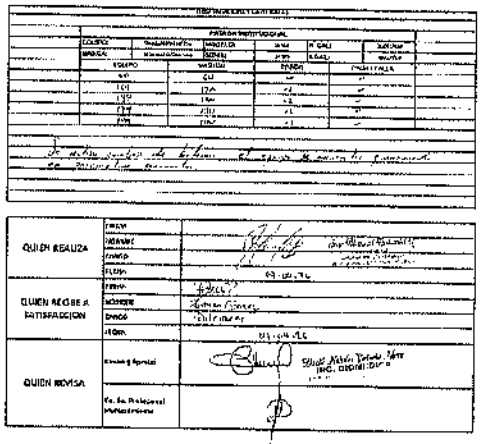


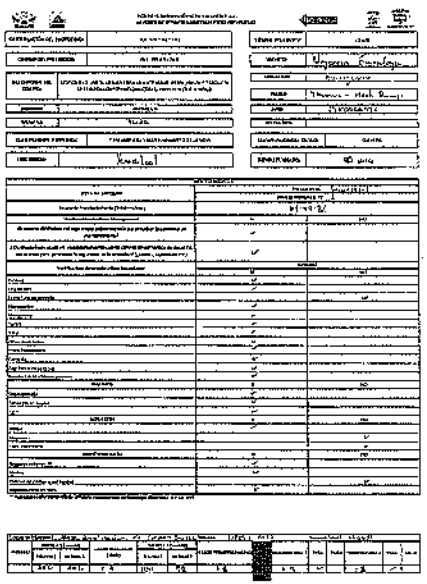


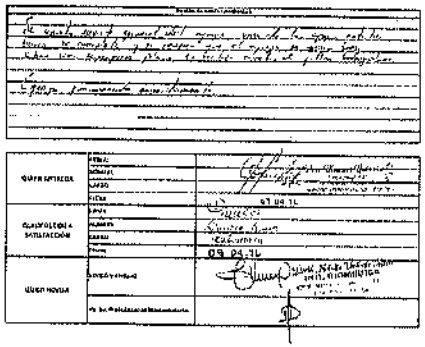


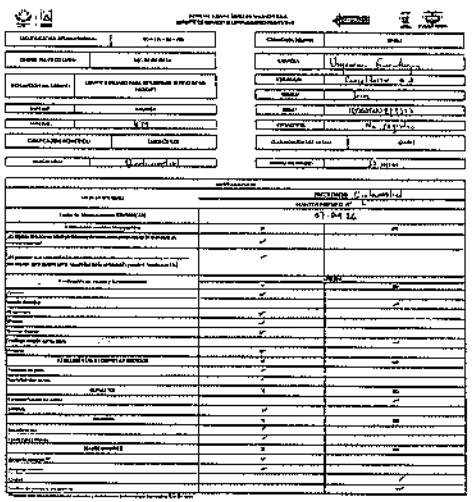


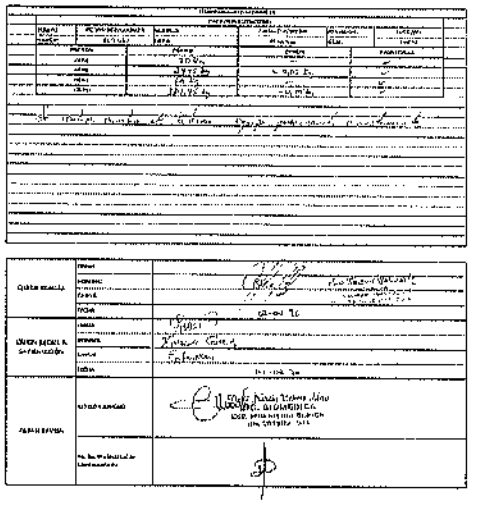


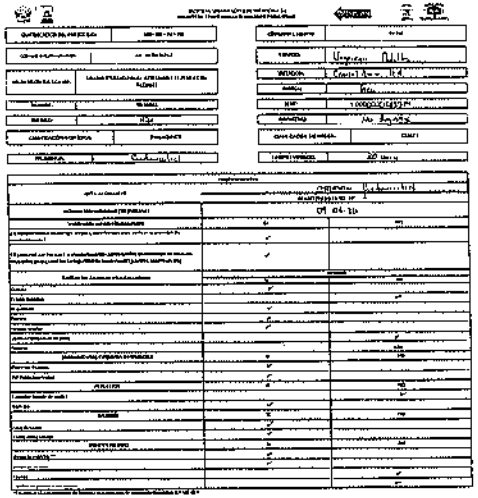


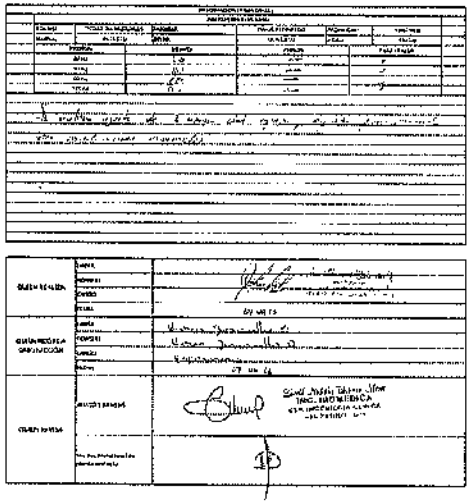


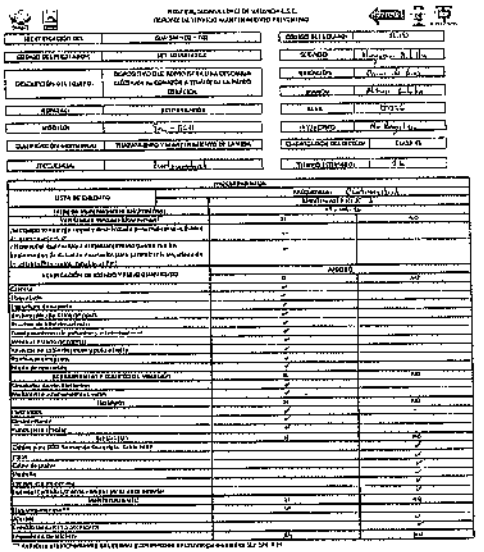


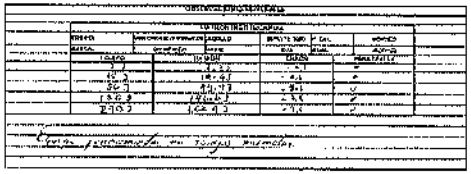





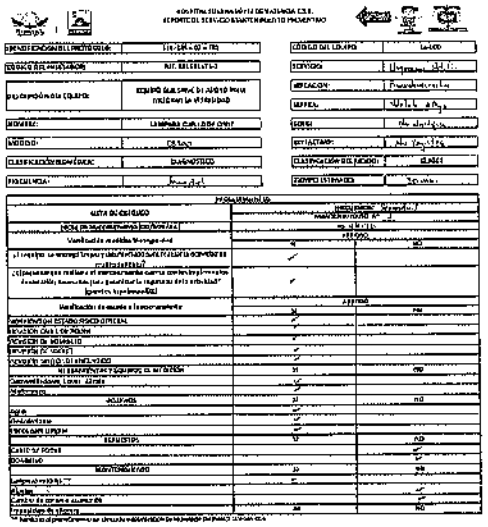


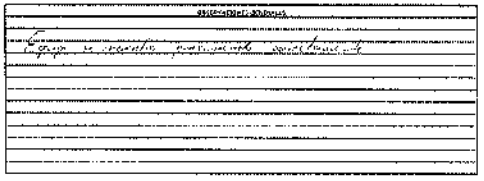


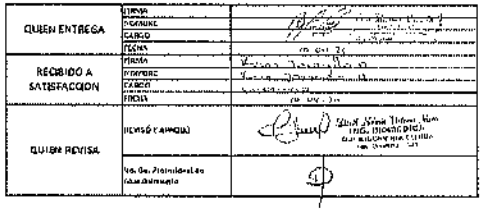


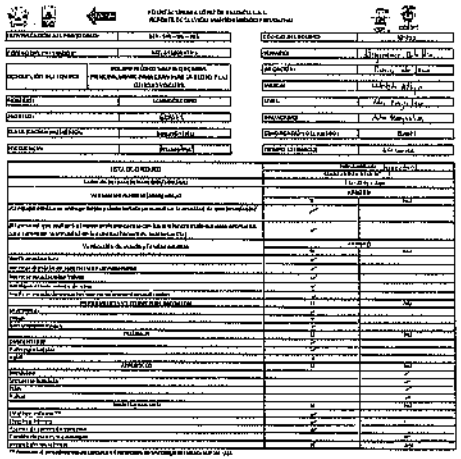


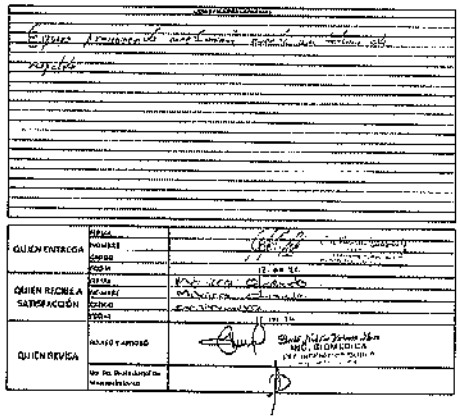


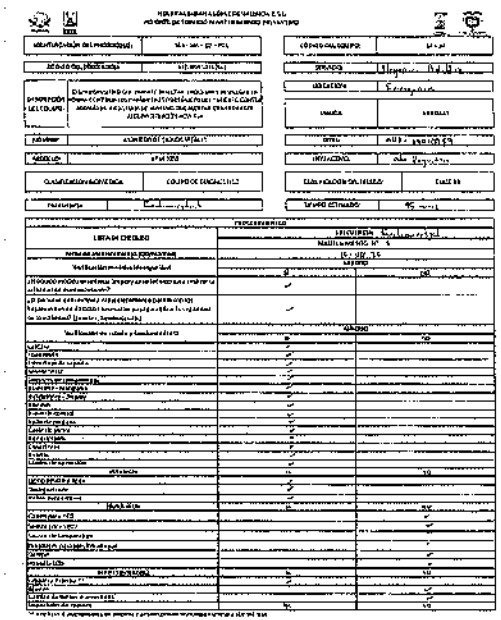


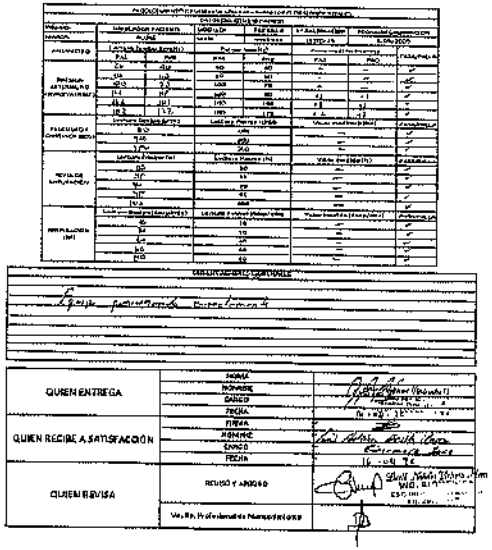


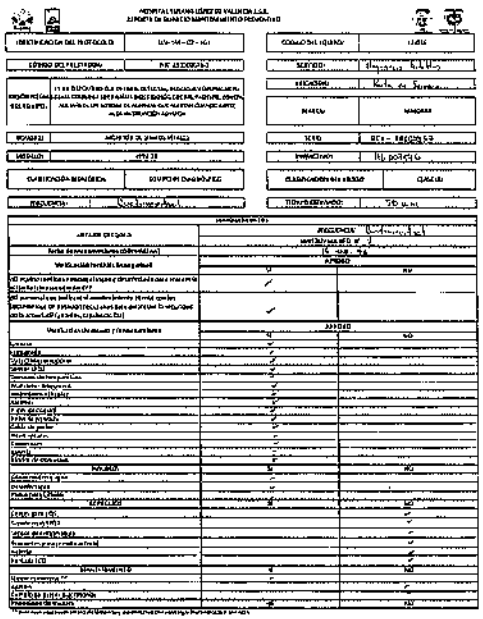


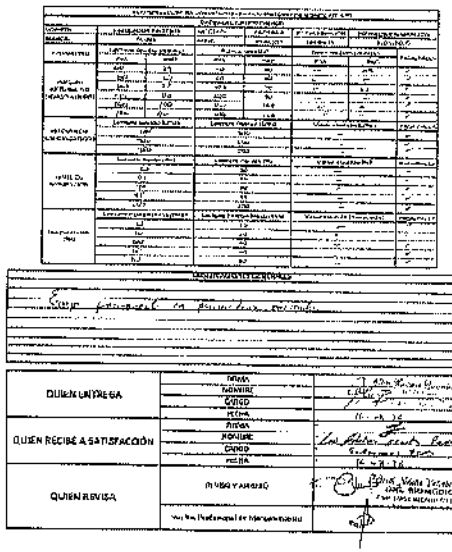


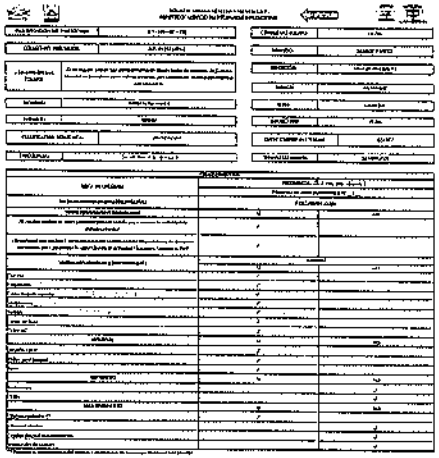


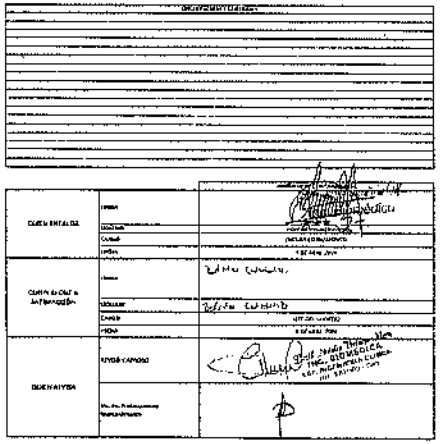

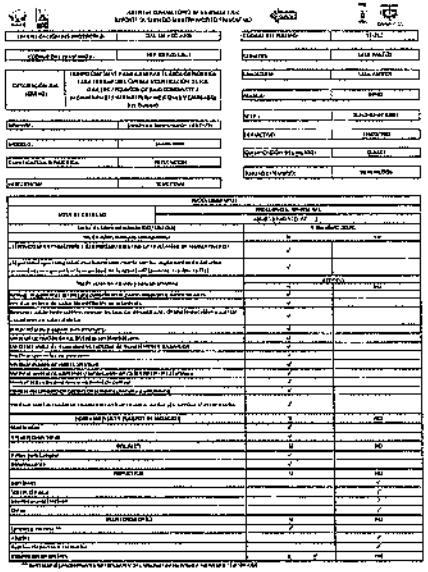

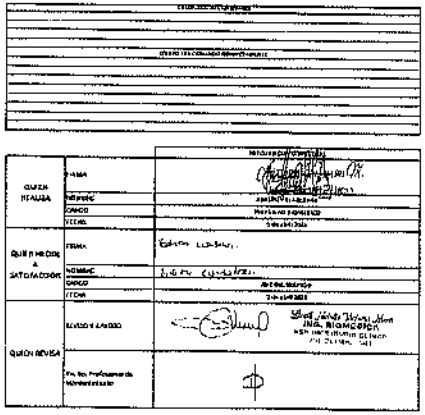

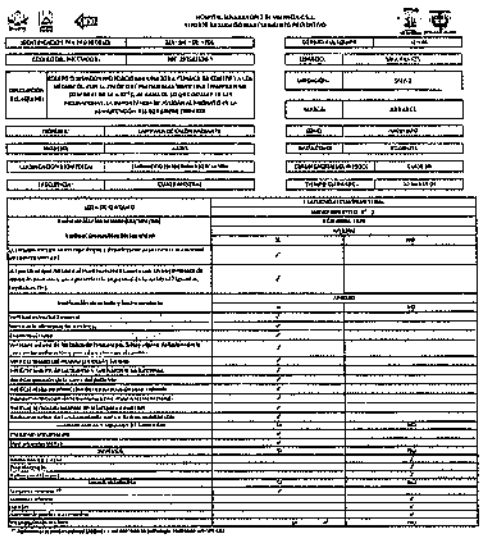

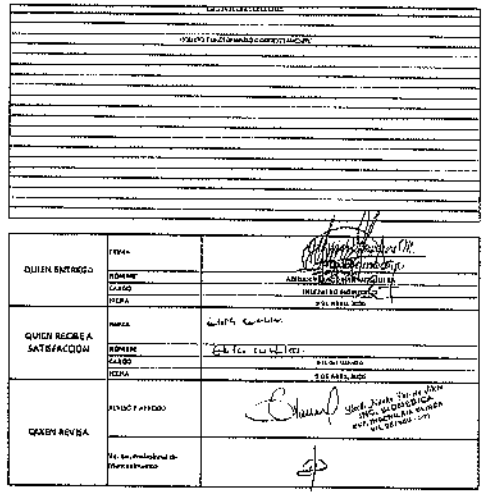

Monitor [illegible] de signos
Mindray
IMEC 12
EV-18048541
Sala partos

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION PARA MONITORES DE SIGNOS VITALES

DATOS DL EQUIPO PATRON

PRESION ARTERIAL NO INVASIVA (mmHg)

NIVEL DE SATURACION (SpO2)

OBSERVACIONES GENERALES

QUIEN ENTREGA	FIRMA	
	NOMBRE	[illegible]
	CARGO	[illegible]
	FECHA	[illegible]
QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA	[illegible]
	NOMBRE	[illegible]
	CARGO	[illegible]
	FECHA	[illegible]
QUIEN REVISA	REVISÓ Y APROBÓ	
	[illegible]	

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION PARA MONITORES DE SIGNOS VITALES


DATOS DL EQUIPO PATRON


PATRON	EQUIPO	TIEMPO	PASA	FALLA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓	


QUIEN REALIZA	FIRMA	
	NOMBRE	[illegible]
	CARGO	[illegible]
	FECHA	[illegible]
QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA	[illegible]
	NOMBRE	[illegible]
	CARGO	[illegible]
	FECHA	[illegible]
QUIEN REVISA	REVISO Y APROBO	
	[illegible]	


Monitor fetal
EDAN
F3 Dual
5620054-M1911032600094


PATRON	EQUIPO		ERROR	FASA	FALLA
60 bpm	60	bpm		✓	
120 bpm	123	bpm		✓	
140 bpm	140	bpm		✓	
180 bpm	180	bpm		✓	
200 bpm	201	bpm		✓	

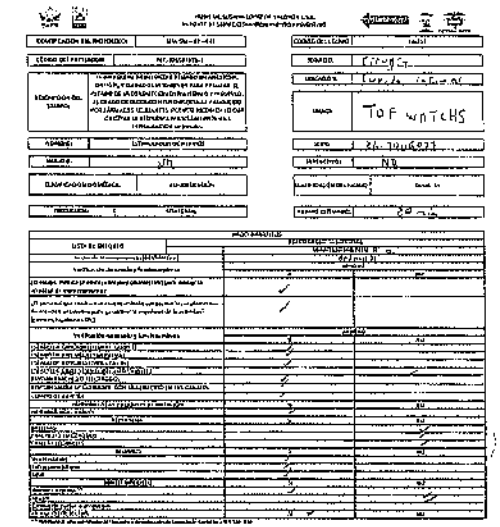


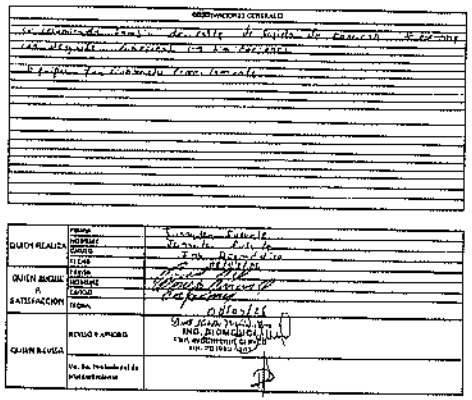


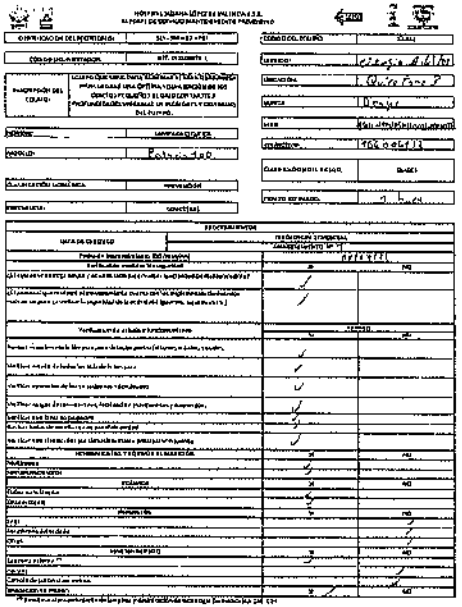


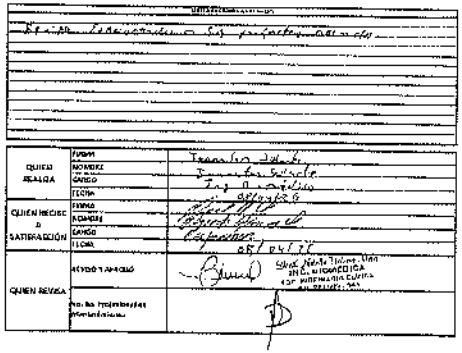


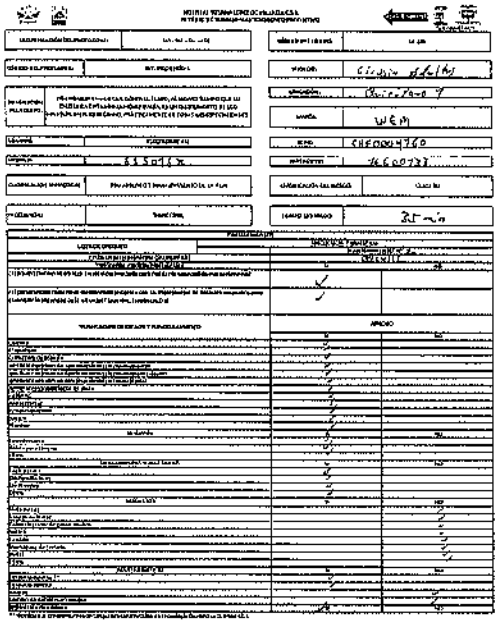


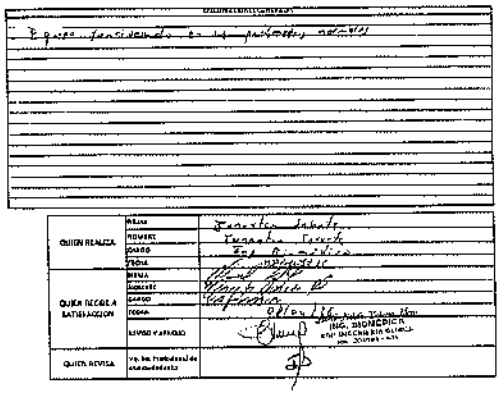


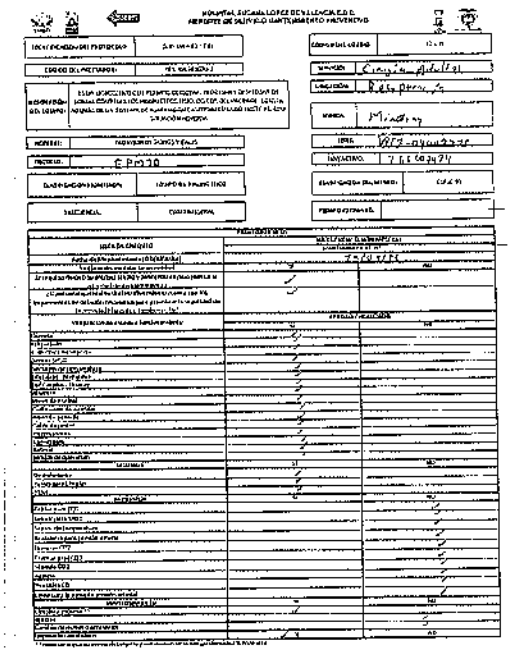

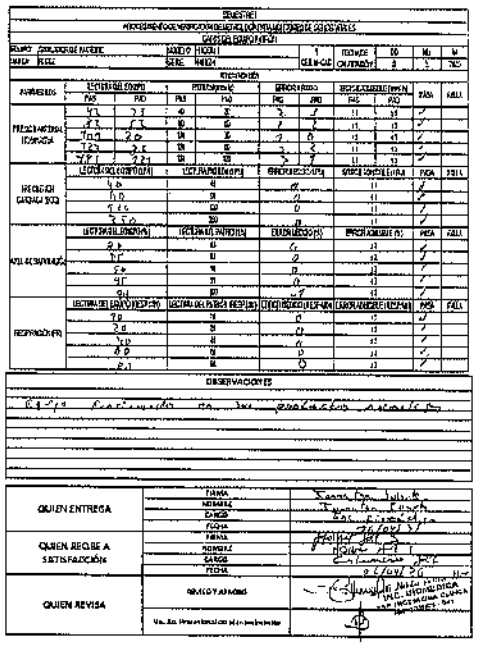

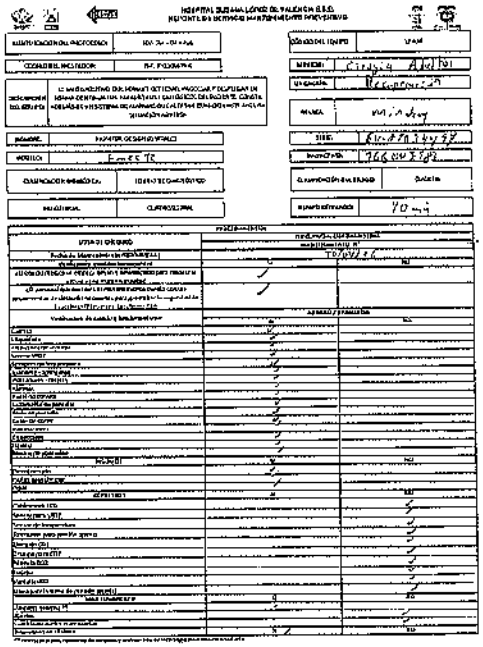

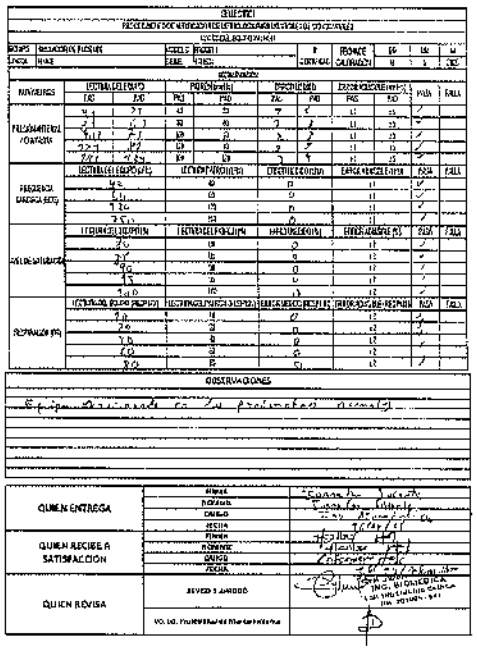


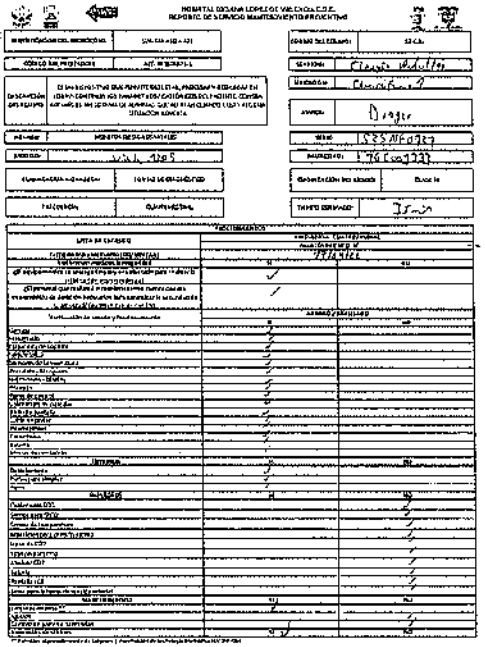

HOSPITAL REGIONAL LORENZO GUERRERO E.S.E.
REPORTE DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO	SIN CÓDIGO
SERVICIO	Cirugía Adultos
UBICACIÓN	Quirófano 2
MARCA	Dräger
SERIE	1585 MFA 0927
MODELO	Vista 120
INVENTARIO	1.76 Cirugía 2222
CLASIFICACIÓN DEL EQUIPO	Clase IIa
FRECUENCIA	CUATRIMESTRAL
TIEMPO ESTIMADO	2 hrs

LISTA DE CHEQUEO	MANTENIMIENTO (Marque con una X)
	Inicial / Siguiente M. / Correctivo
	7/Enero/26
¿El equipo cuenta con el manual de usuario en español para el servicio?	✓
¿El personal que utiliza el equipo tiene el entrenamiento necesario para su correcto uso?	✓
Verificación de cables y mangueras	**Antes / Después**
Cables	✓
Mangueras	✓
Conectores	✓
Fusibles	✓
Baterías	✓
Limpieza	
Exterior	✓
Interior	✓
Filtros	✓
Calibración	
Presión	✓
Flujo	✓
Volumen	✓
Pruebas de funcionamiento	
Encendido	✓
Alarmas	✓
Ventilación	✓
Monitoreo	✓
Documentación	
Hoja de vida actualizada	✓
Registro de mantenimiento	✓
Observaciones	

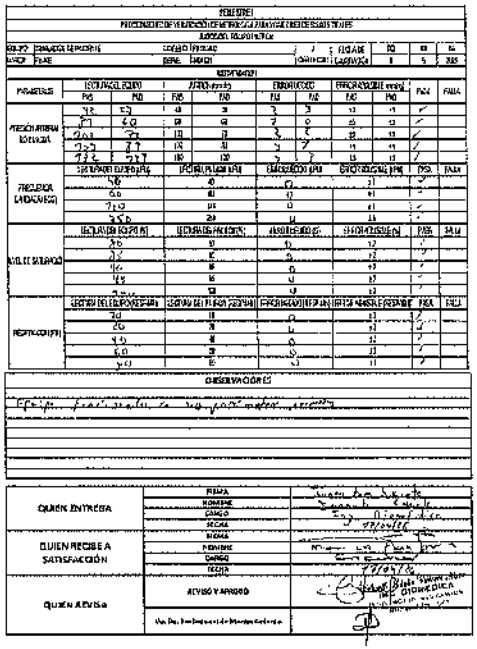

SERVICIO
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE METROLOGÍA BIOMÉDICA EQUIPOS ELECTROMÉDICOS
ELEMENTOS REQUERIDOS


EQUIPO	Simulador de presión	CÓDIGO			EXCELENTE	BUENO	MALO
MARCA	Fluke	SERIE	1585MFA0927	CALIFICACIÓN	3	5	7

PARÁMETROS		ESTÁNDAR (ESPERADO)		VALOR (medido)		ERROR (%)		ERROR ACEPTABLE (máx)		PASA	FALLA
		PAS	PAD	PAS	PAD	PAS	PAD	PAS	PAD		
PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA	1	120	80	118	78	1.7	2.5	±3	±3	✓	
	2	160	100	158	98	1.3	2.0	±3	±3	✓	
	3	200	120	196	118	2.0	1.7	±3	±3	✓	
	4	240	140	236	138	1.7	1.4	±3	±3	✓	
		LECTURA ESPERADA		LECTURA REGISTRADA		ERROR (%)		ERROR ACEPTABLE (máx)		PASA	FALLA
FRECUENCIA CARDIACA	1	60		60		0		±2		✓	
	2	90		90		0		±2		✓	
	3	120		120		0		±2		✓	
	4	150		150		0		±2		✓	
		LECTURA ESPERADA		LECTURA REGISTRADA		ERROR (%)		ERROR ACEPTABLE (máx)		PASA	FALLA
NIVEL DE SATURACIÓN	1	95		95		0		±2		✓	
	2	97		97		0		±2		✓	
	3	98		98		0		±2		✓	
	4	99		99		0		±2		✓	
		LECTURA ESPERADA		LECTURA REGISTRADA		ERROR (%)		ERROR ACEPTABLE (máx)		PASA	FALLA
RESPIRACIÓN	1	20		19		5.0		±2		✓	
	2	30		30		0		±2		✓	
	3	40		39		2.5		±2		✓	
	4	50		49		2.0		±2		✓	
	5	60		59		1.7		±2		✓	

OBSERVACIONES


Equipo funcionando correctamente sin novedades.

QUIEN ENTREGA	FIRMA	
	NOMBRE	Juan David Rojas
	CARGO	Ing. Biomédico
	FECHA	7/Enero/26
QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	FIRMA	
	NOMBRE	Dra. Laura Mendoza
	CARGO	Jefe de Cirugía
	FECHA	7/Enero/26
QUIEN AVISA	AVISO Y APROBÓ	Ing. Biomédica Clínica
	Vto. Bno. Responsable de Mantenimiento	

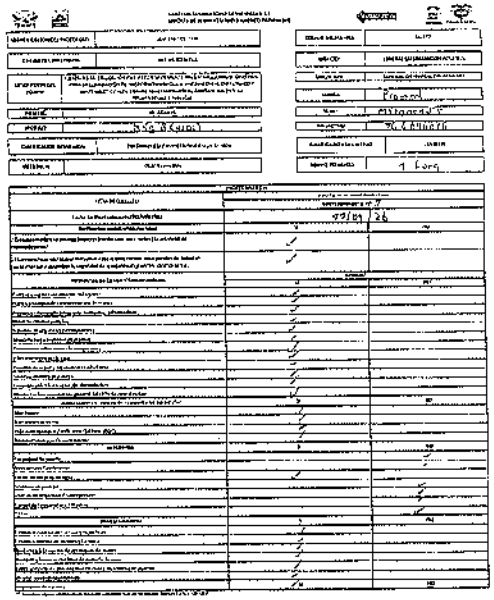

UNIDAD FUNCIONAL	Cirugía
SERVICIO	Quirófano 2
EQUIPO	Ventilador de anestesia
MARCA	Dräger
MODELO	Vista 120
SERIE	MFA 0927
INVENTARIO	1.76 Cirugía 2222
UBICACIÓN	Bloque B
TIEMPO ESTIMADO	2 hrs

ÍTEM DE CHEQUEO	MANTENIMIENTO (Marque con una X)
	Inicial / Siguiente M. / Correctivo
	7/Enero/26
¿El equipo cuenta con el manual de usuario en español para el servicio?	✓
¿El personal que utiliza el equipo tiene el entrenamiento necesario para su correcto uso?	✓
Verificación de cables y mangueras	**Antes / Después**
Cables	✓
Mangueras	✓
Conectores	✓
Fusibles	✓
Baterías	✓
Limpieza	
Exterior	✓
Interior	✓
Filtros	✓
Calibración	
Presión	✓
Flujo	✓
Volumen	✓
Pruebas de funcionamiento	
Encendido	✓
Alarmas	✓
Ventilación	✓
Monitoreo	✓
Documentación	
Hoja de vida actualizada	✓
Registro de mantenimiento	✓
Observaciones	

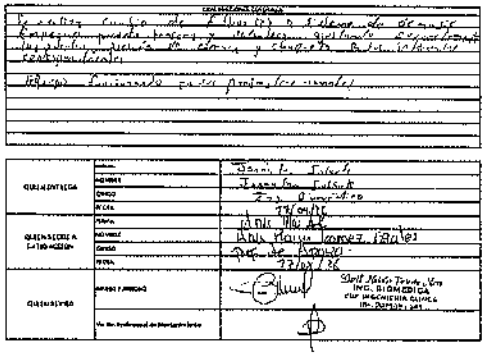


OBSERVACIONES

Equipo funcionando correctamente. Se realiza limpieza de filtros y verificación de alarmas. Se recomienda cambio de manguera paciente en próximo mantenimiento preventivo.

Repuesto: Manguera paciente adulto


QUIEN ENTREGA	NOMBRE	Juan D. Rojas
	CARGO	Ing. Biomédico
	FECHA	7/Enero/26
QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	NOMBRE	Dra. Ana María Gómez
	CARGO	Jefe de Cirugía
	FECHA	7/Enero/26
QUIEN AVISA	AVISO Y APROBÓ	Ing. Biomédica Clínica Mat. 25202-247
	Vto. Bno. Responsable de Mantenimiento	

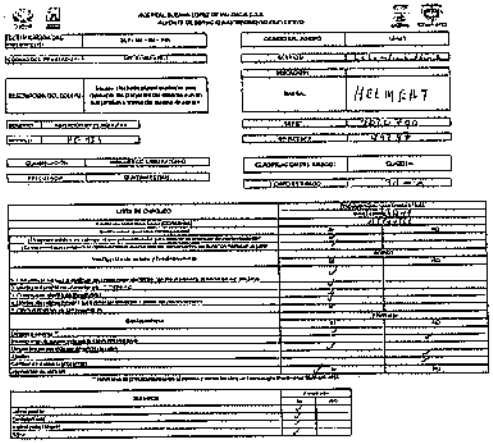

HOSPITAL REGIONAL LORENZO GUERRERO E.S.E.
REPORTE DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO	3474-00-00-0001
SERVICIO	Urgencias
UBICACIÓN	Sala de Reanimación
MARCA	Hill-Rom
SERIE	2210-1490
MODELO	P.C. 751
INVENTARIO	1.76 Urgencias 0187
CLASIFICACIÓN DEL EQUIPO	Clase IIb
FRECUENCIA	SEMESTRAL
TIEMPO ESTIMADO	1 hr

LISTA DE CHEQUEO	MANTENIMIENTO (Marque con una X)
	Inicial / Siguiente M. / Correctivo
	7/Enero/26
¿El equipo cuenta con el manual de usuario en español para el servicio?	✓
¿El personal que utiliza el equipo tiene el entrenamiento necesario para su correcto uso?	✓
Verificación de cables y mangueras	**Antes / Después**
Cables	✓
Mangueras	✓
Conectores	✓
Fusibles	✓
Baterías	✓
Limpieza	
Exterior	✓
Interior	✓
Filtros	✓
Calibración	
Presión	✓
Flujo	✓
Volumen	✓
Pruebas de funcionamiento	
Encendido	✓
Alarmas	✓
Ventilación	✓
Monitoreo	✓
Documentación	
Hoja de vida actualizada	✓
Registro de mantenimiento	✓
Observaciones	

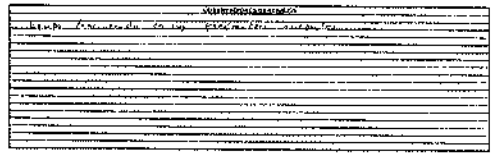



OBSERVACIONES


Equipo funcionando correctamente. Se realiza limpieza de filtros y verificación de alarmas. Se recomienda cambio de manguera paciente en próximo mantenimiento preventivo.


Repuesto: Manguera paciente adulto


QUIEN REALIZA	NOMBRE	Juan D. Rojas
	CARGO	Ing. Biomédico
	FECHA	7/Enero/26
RECIBIDO A SATISFACCIÓN	NOMBRE	Dra. Ana María Gómez
	CARGO	Jefe de Cirugía
	FECHA	7/Enero/26
QUIEN REVISA	AVISO Y APROBÓ	Ing. Biomédica Clínica Mat. 25202-247
	Vto. Bno. Responsable de Mantenimiento	

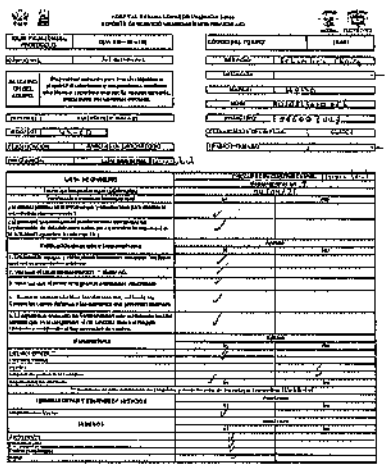


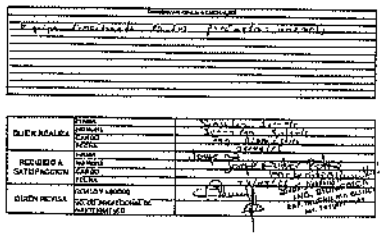


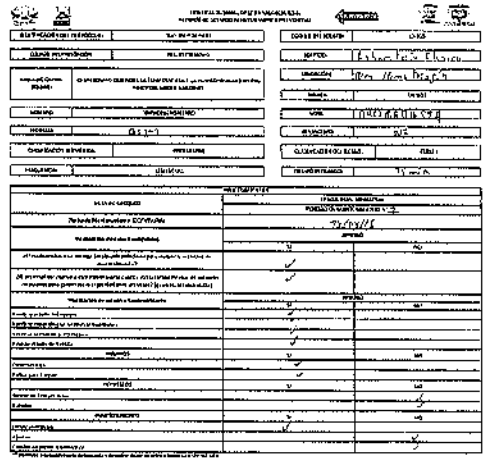


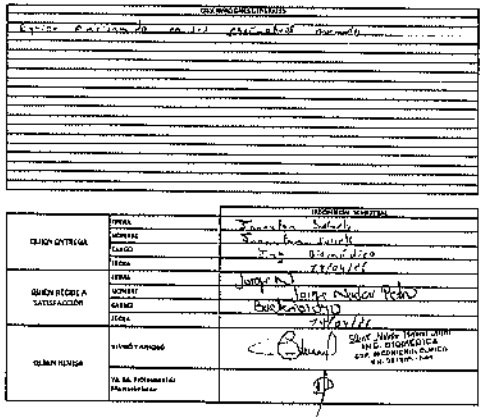


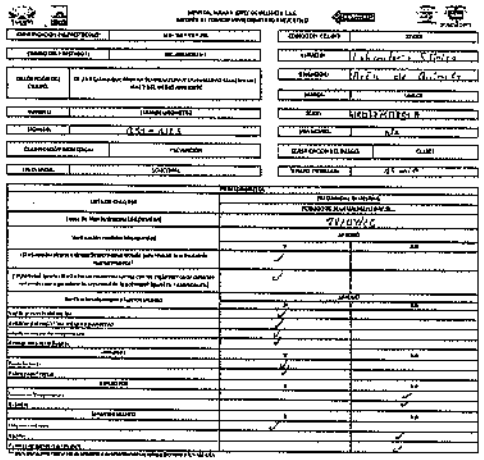


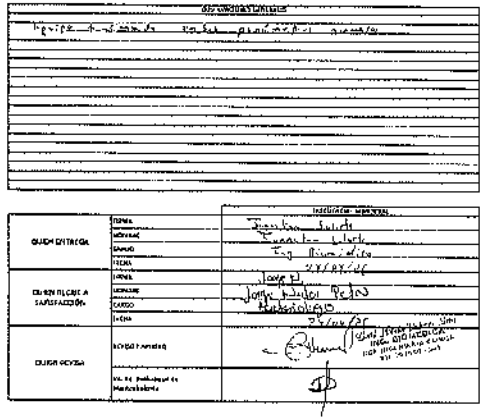


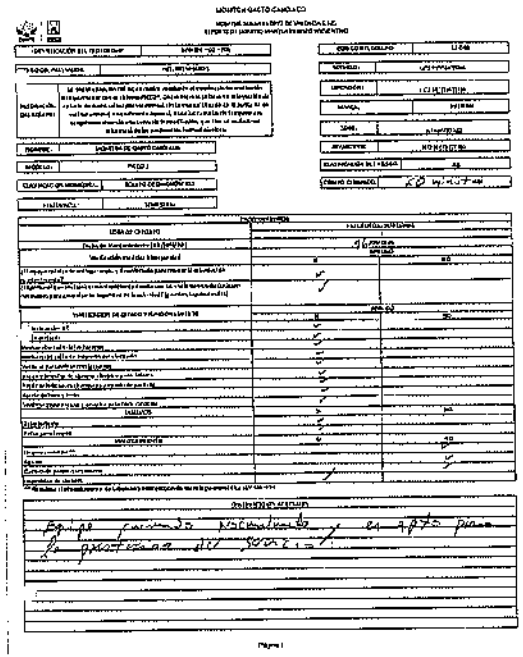


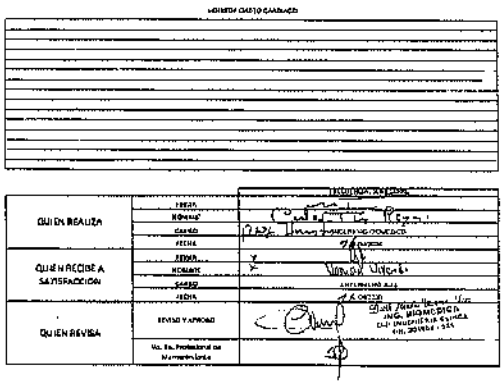


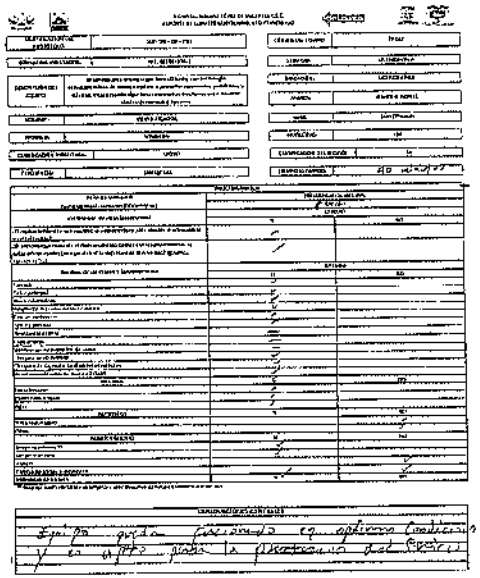


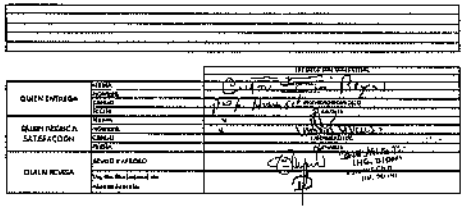


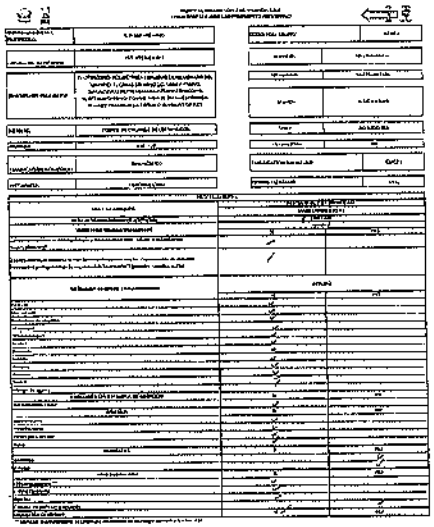


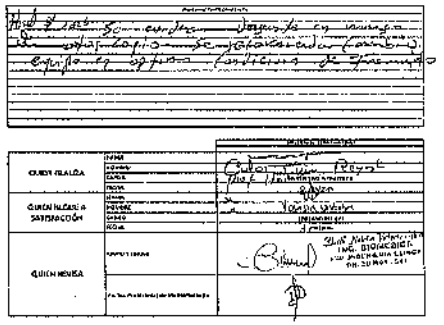


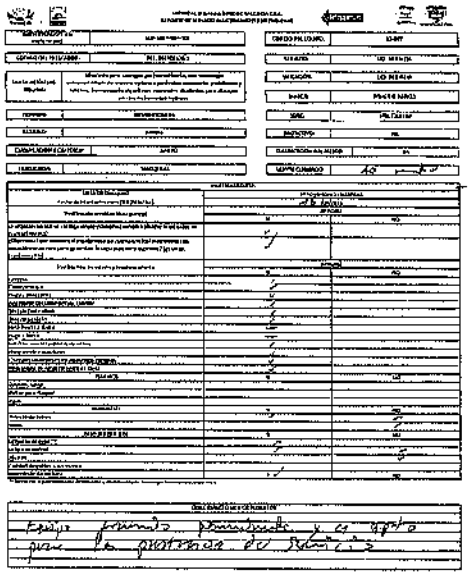


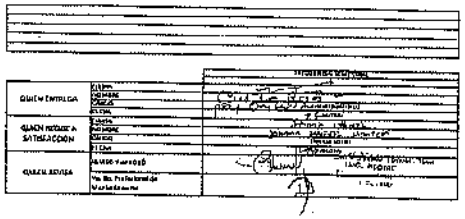


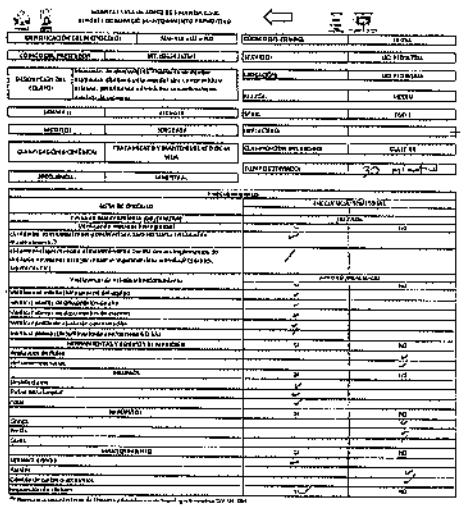


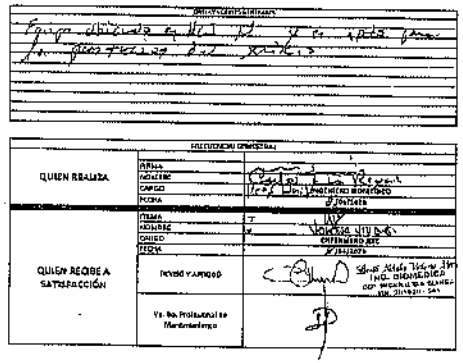


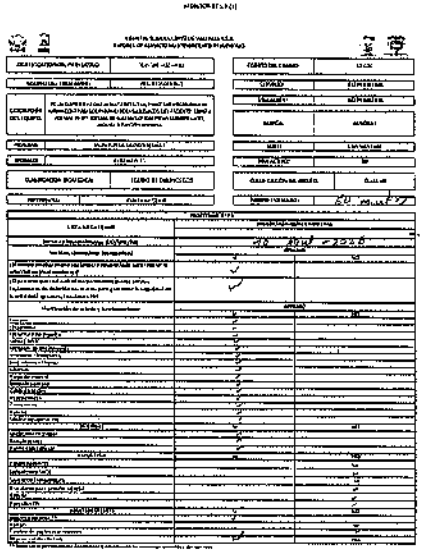


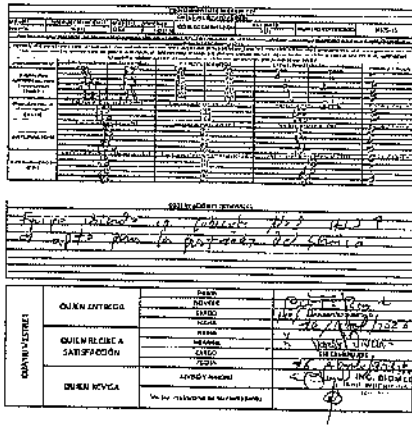


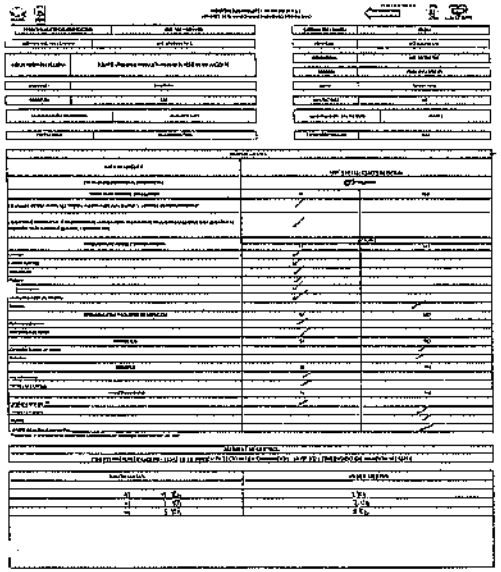


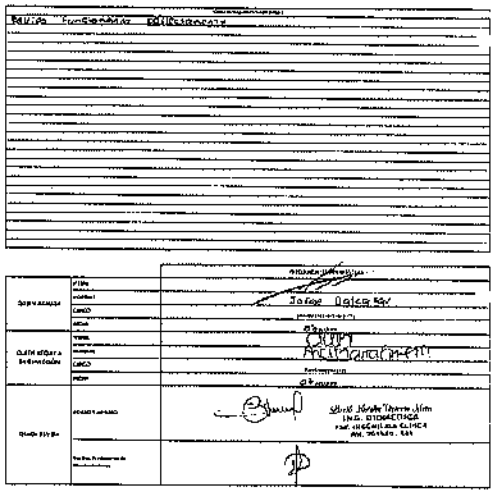


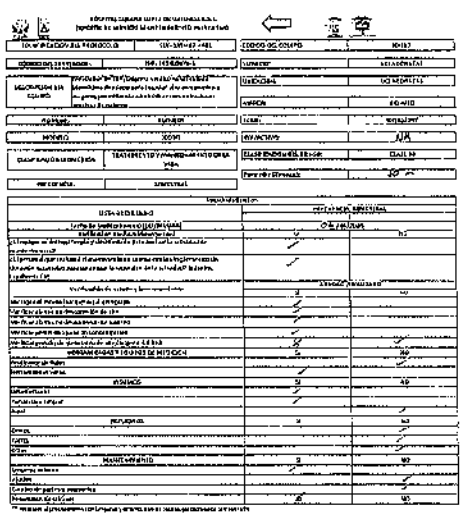


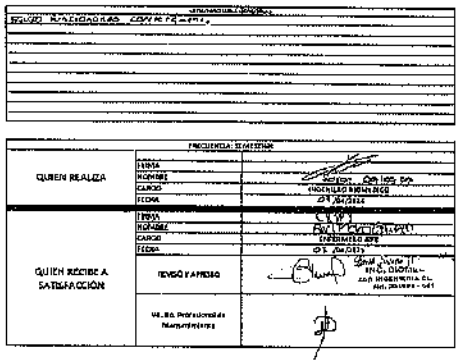


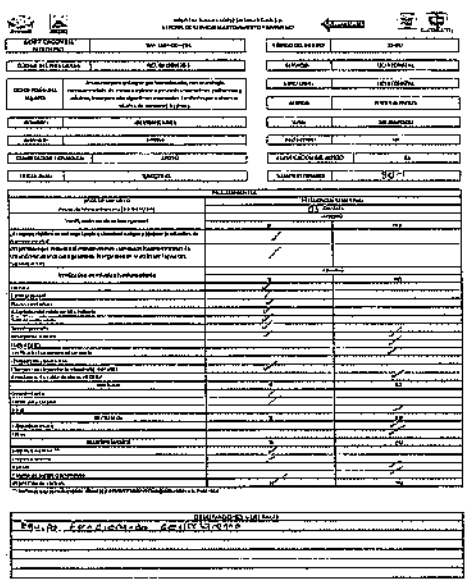


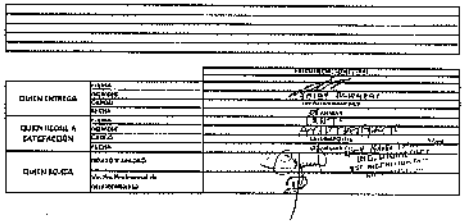


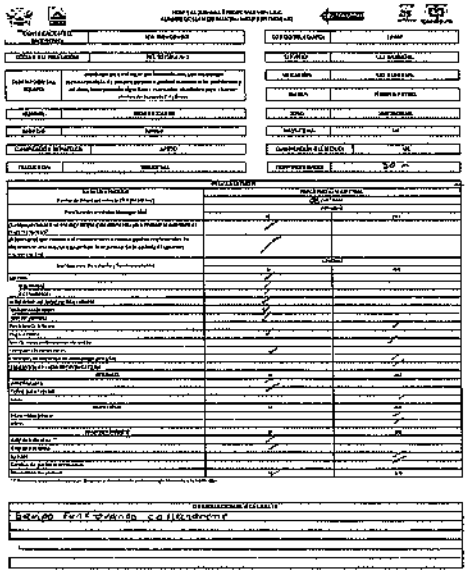


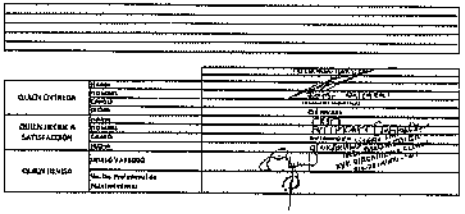


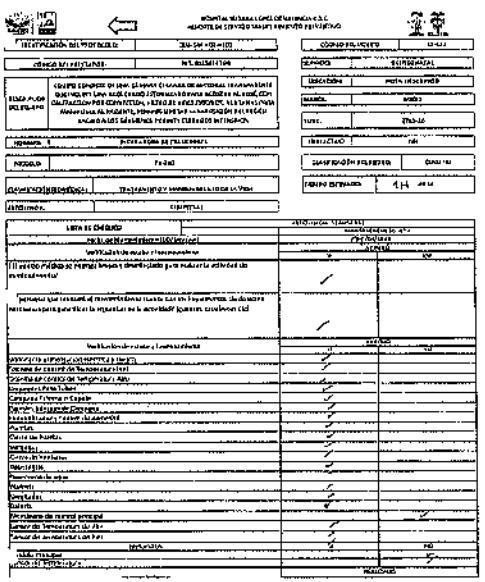


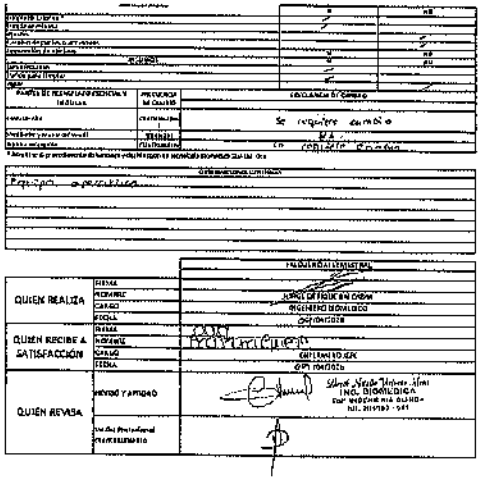


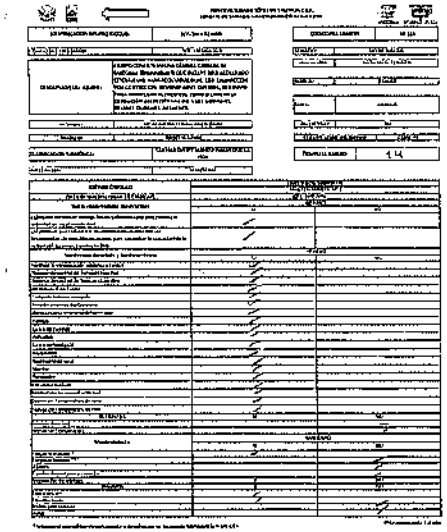


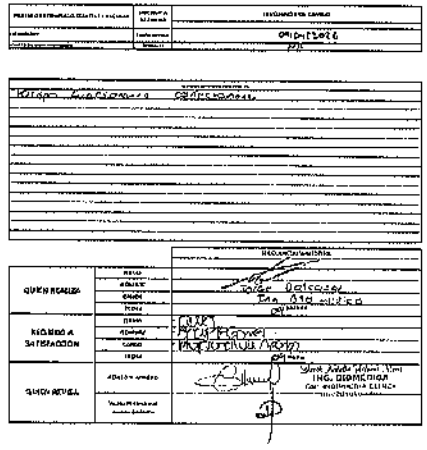


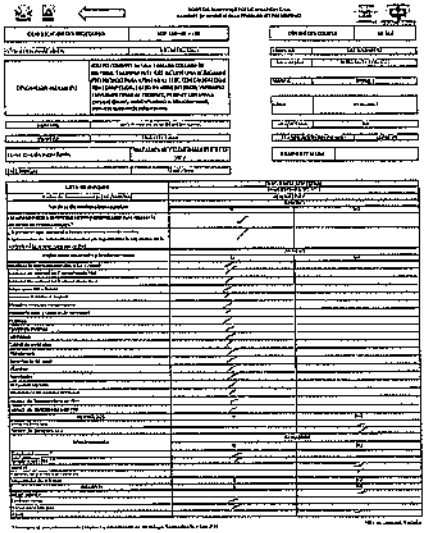


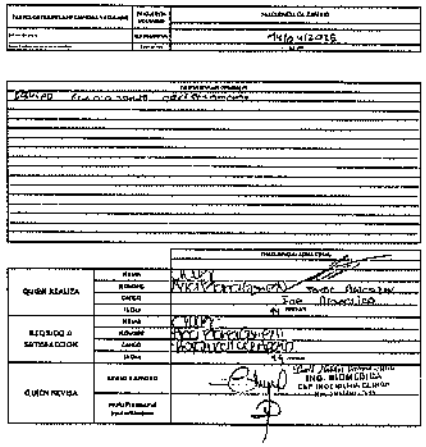


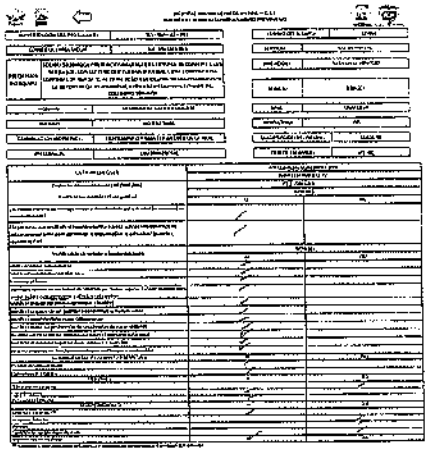


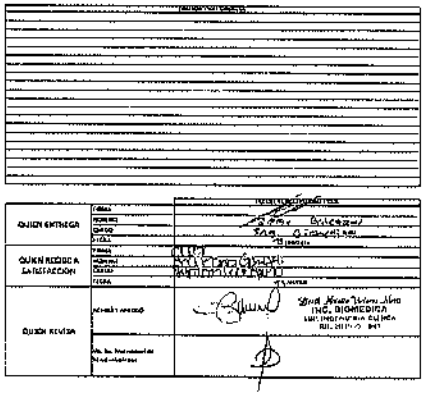


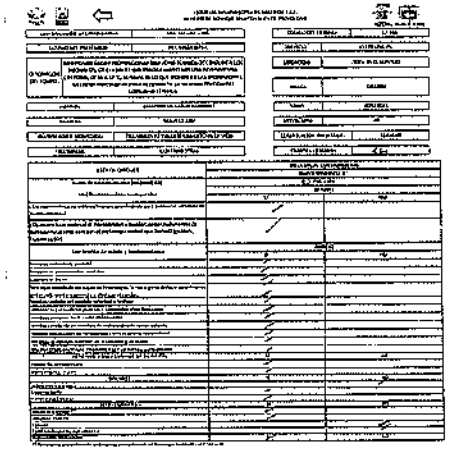


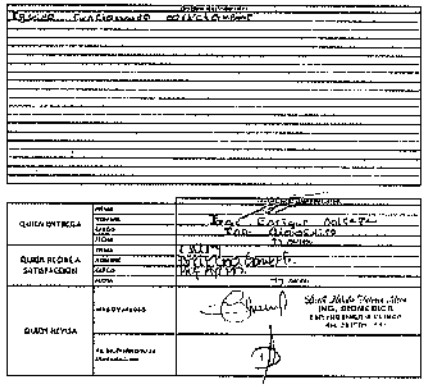


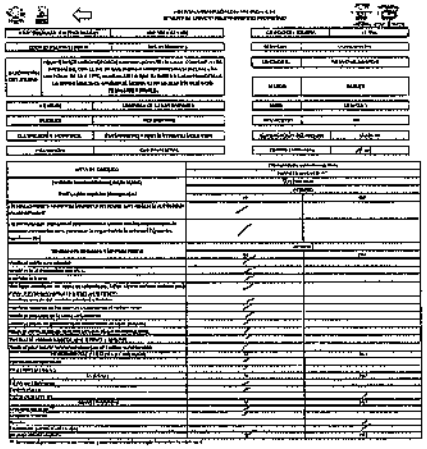


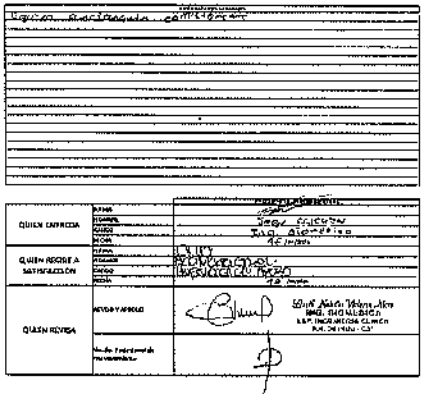


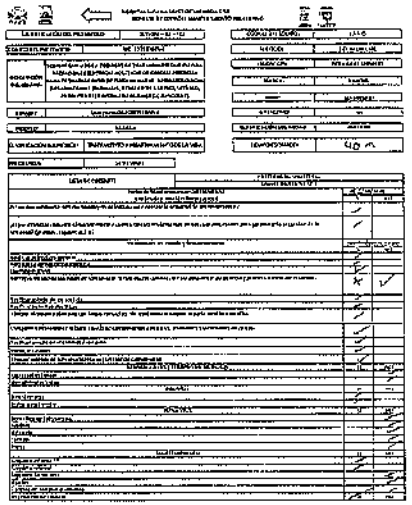


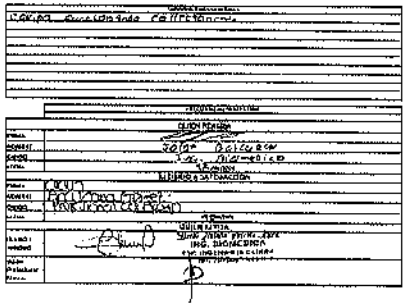


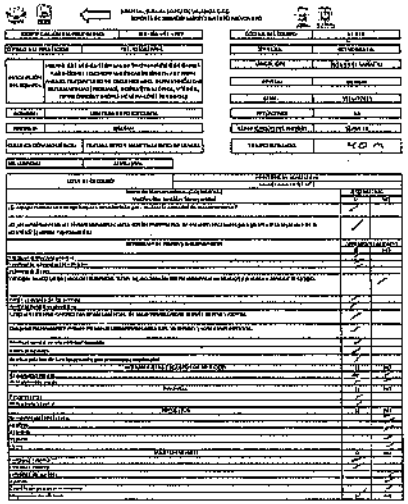


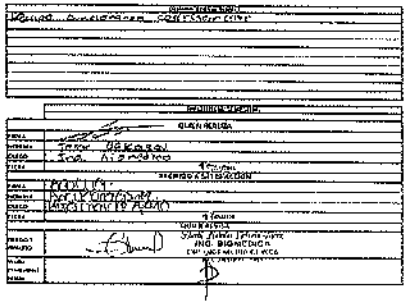


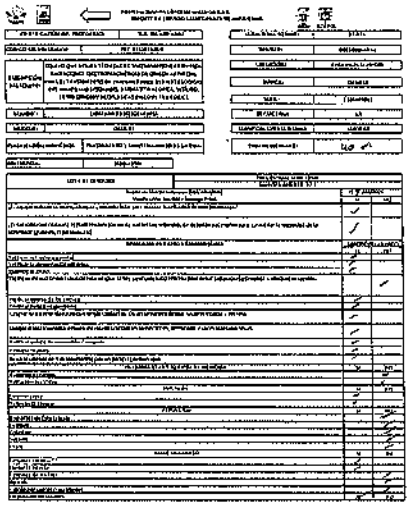


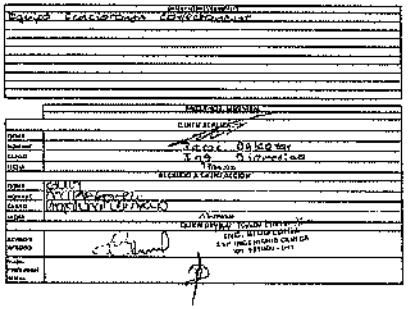


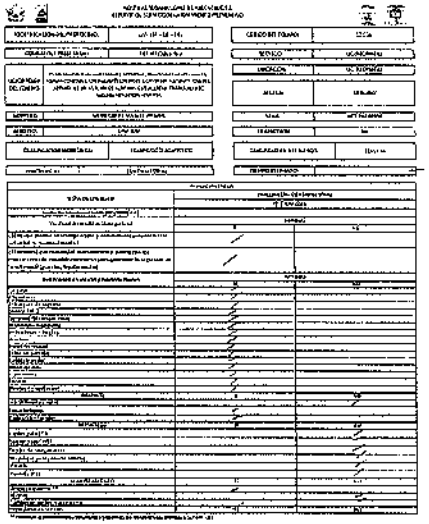


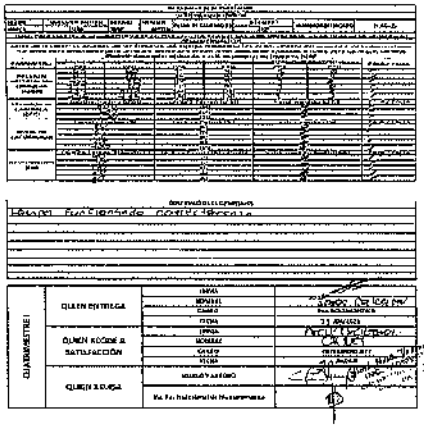


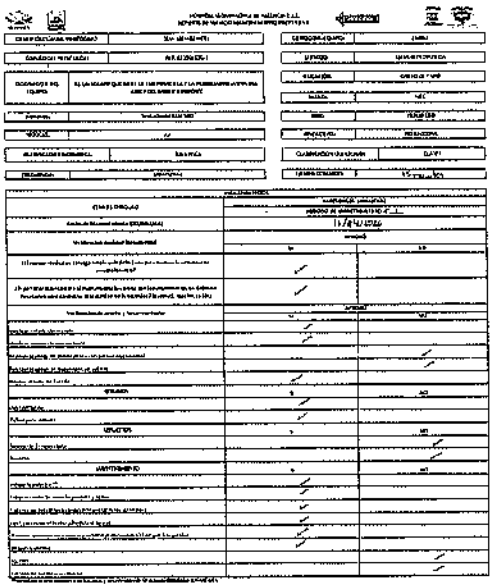


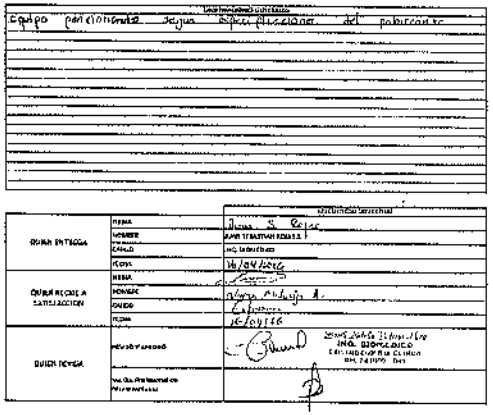


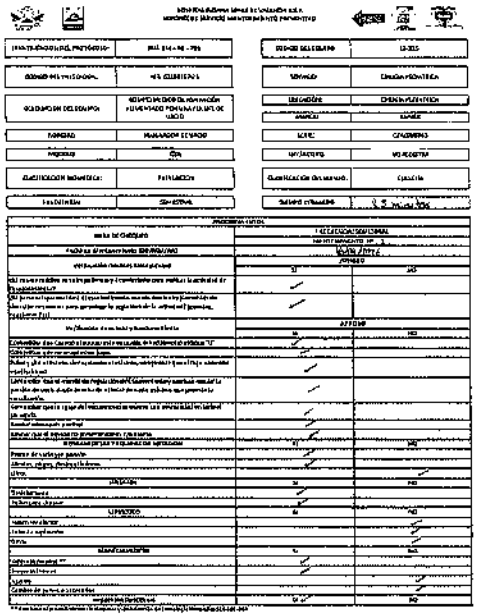


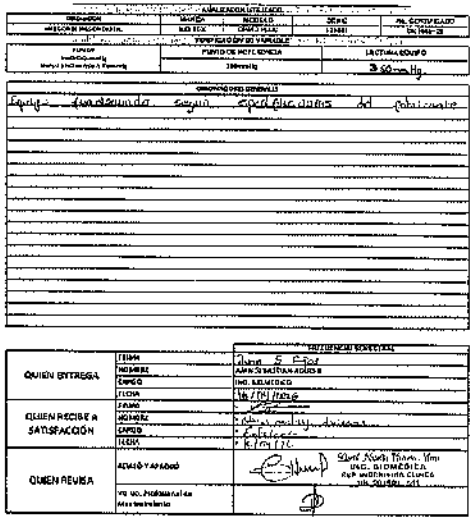


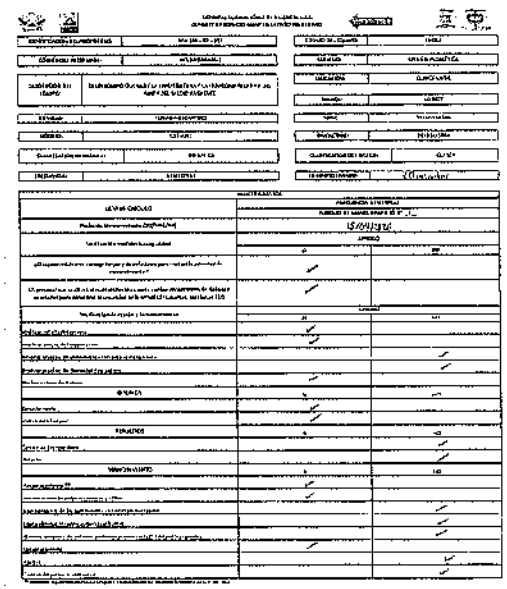


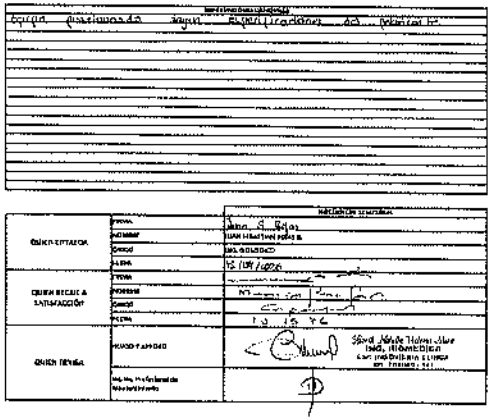


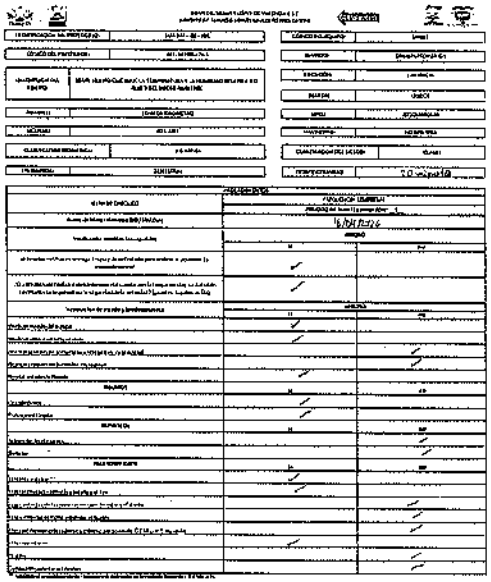


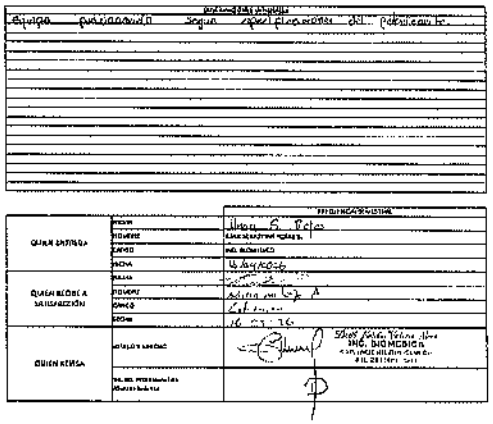


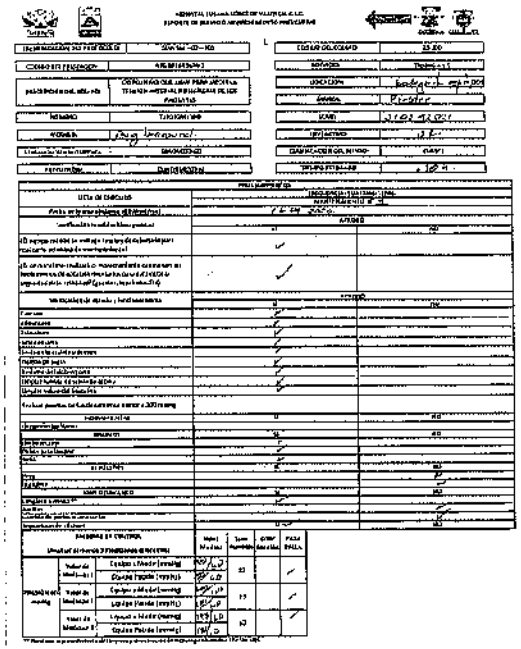


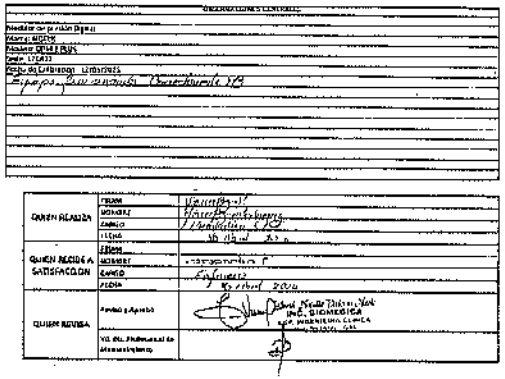


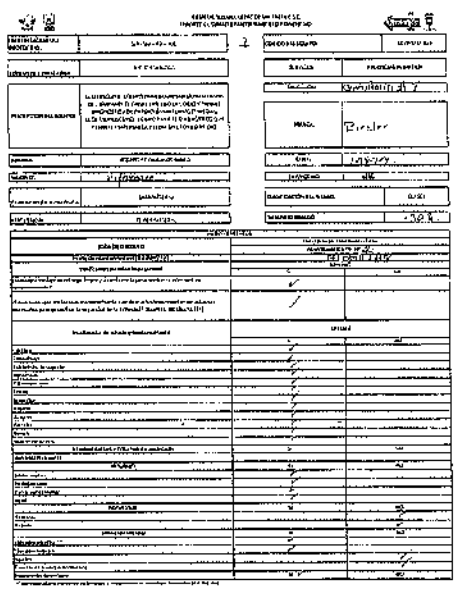


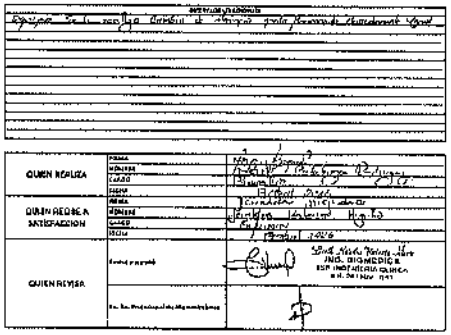


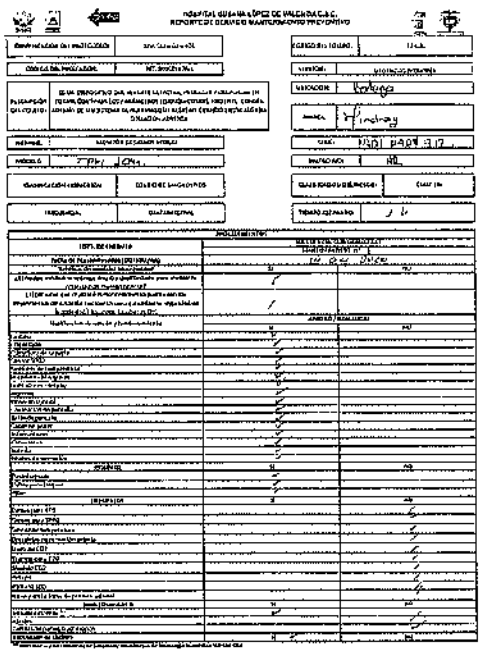


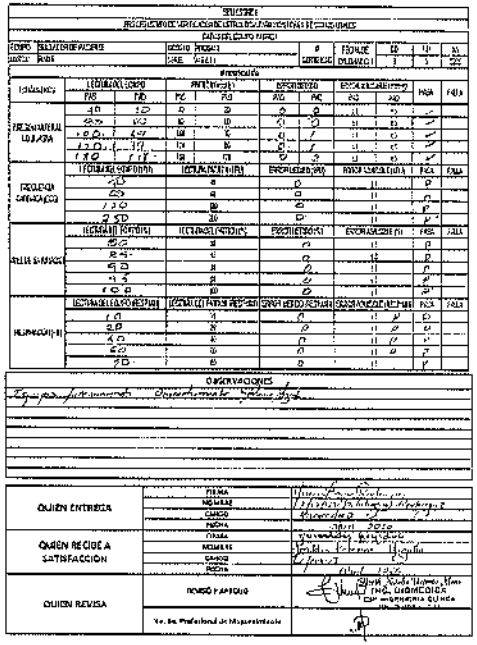


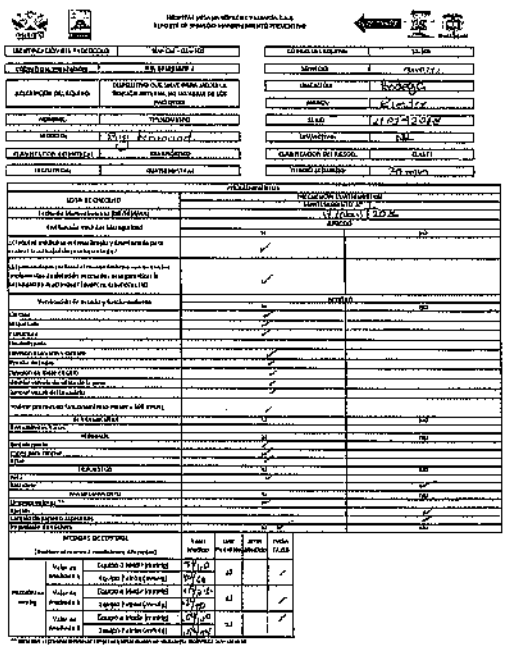


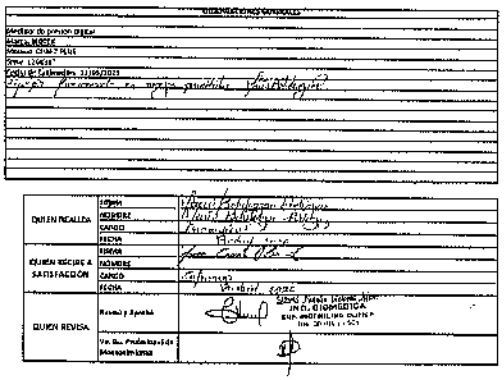


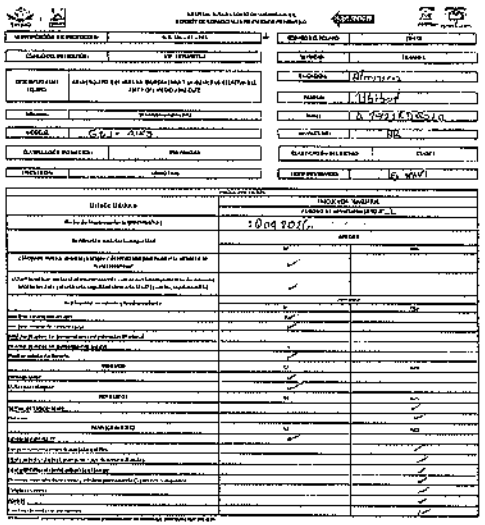


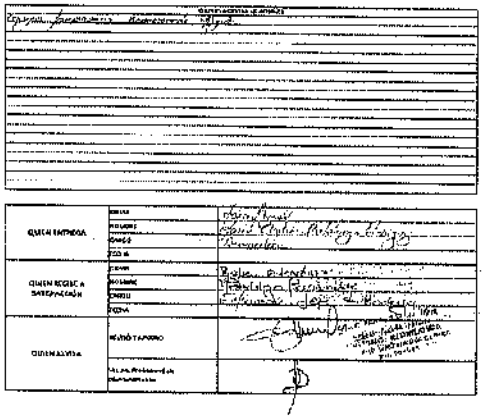


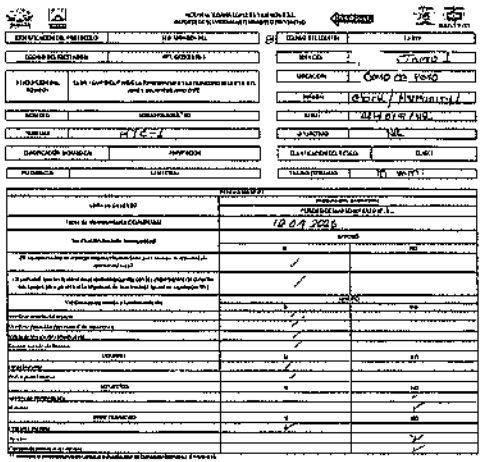


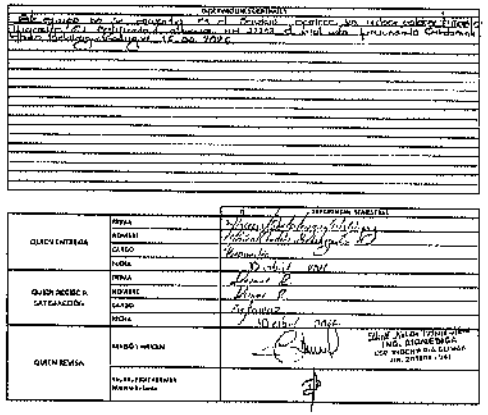


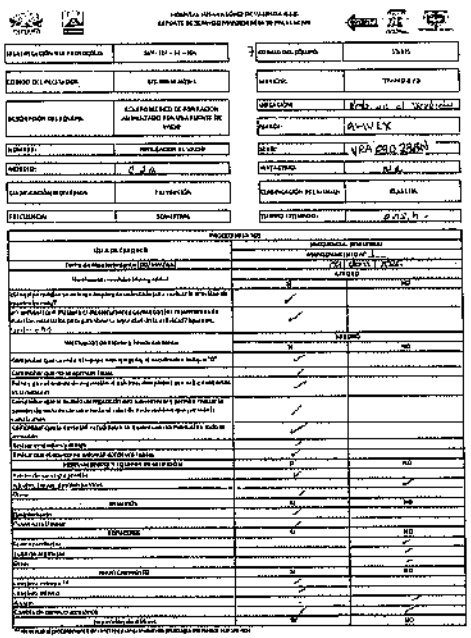


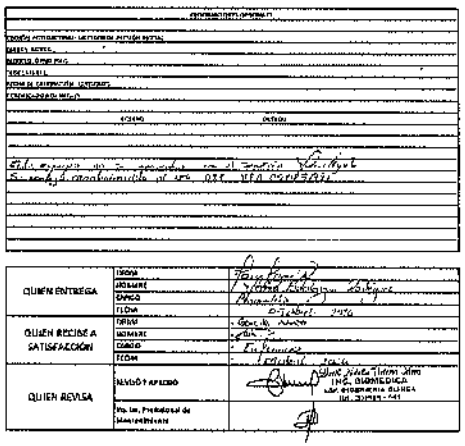


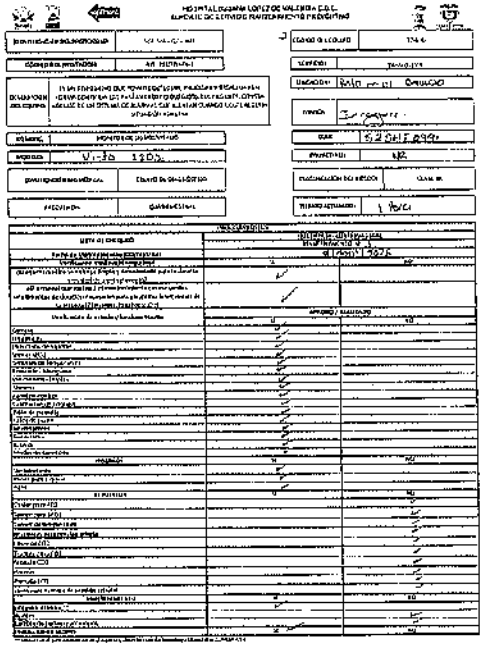


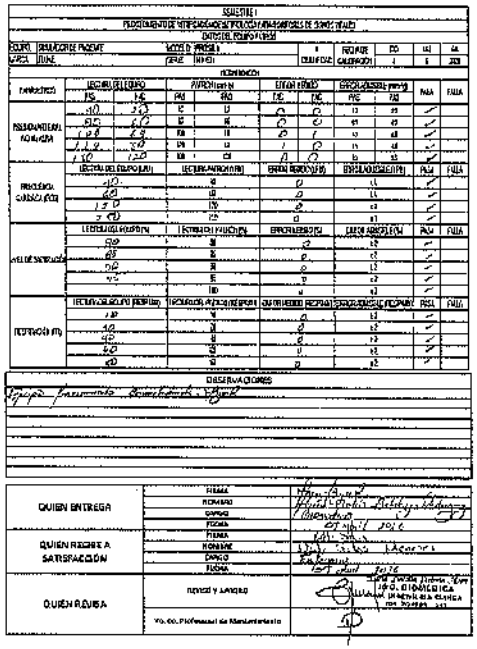


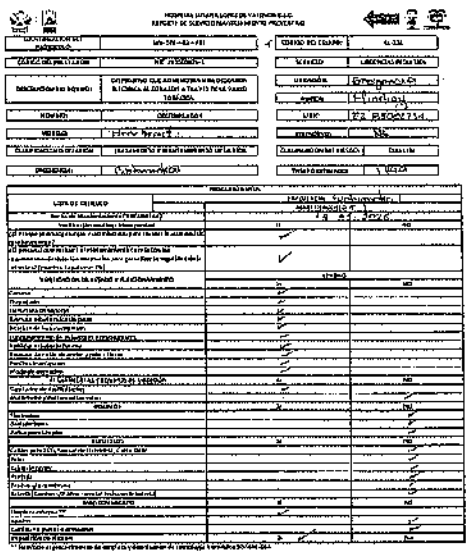


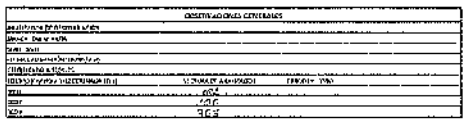





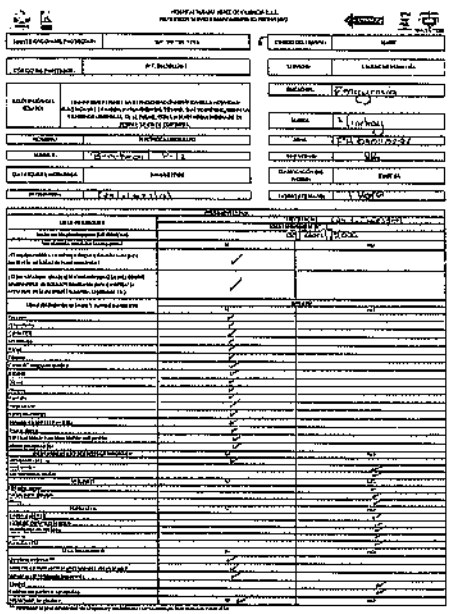


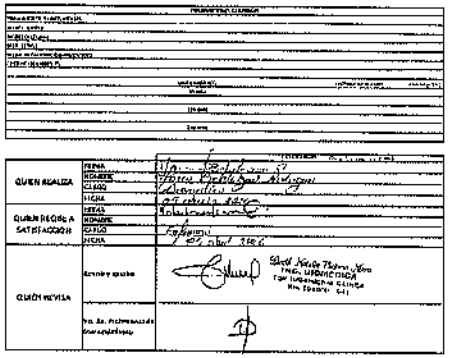


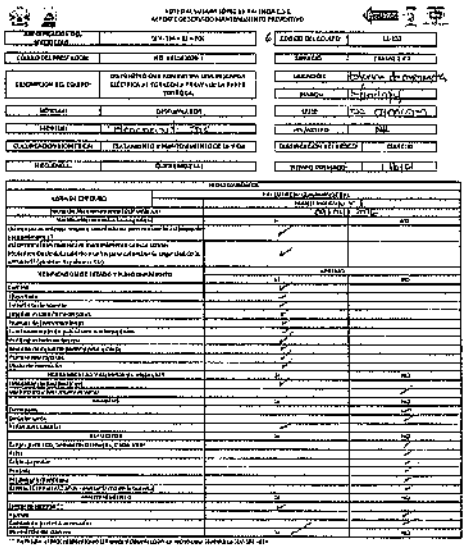


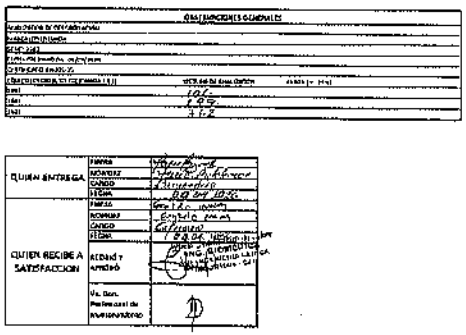


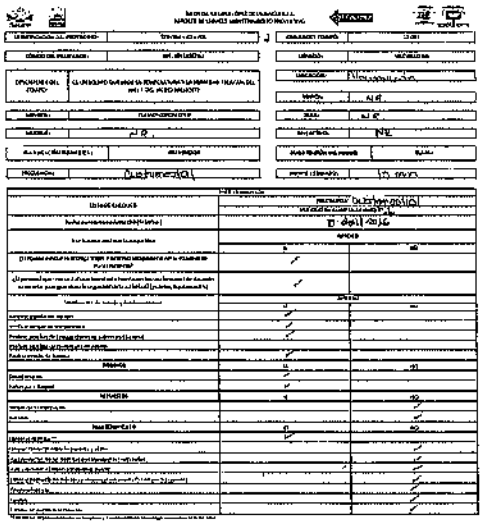


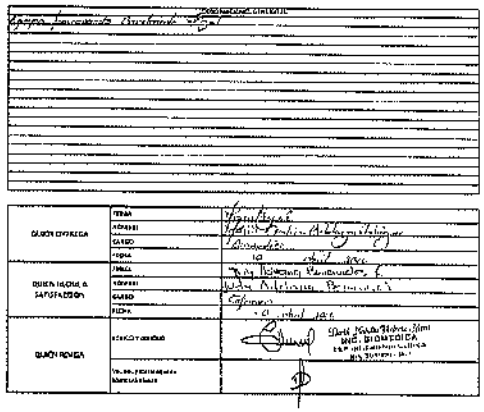


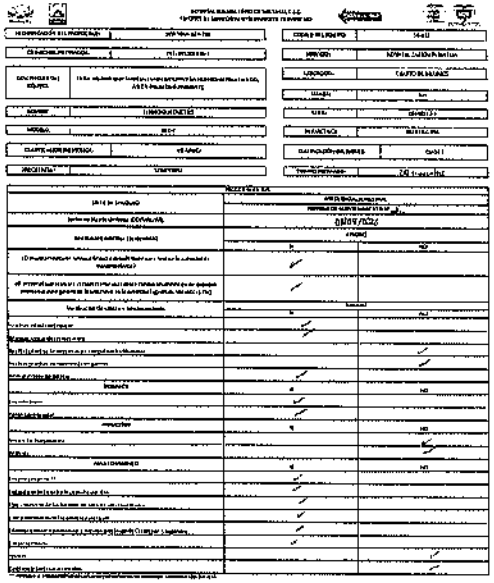


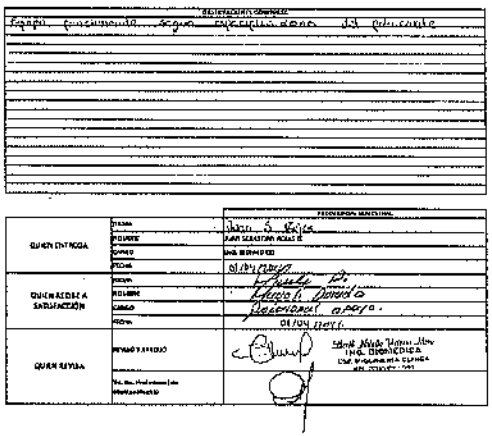


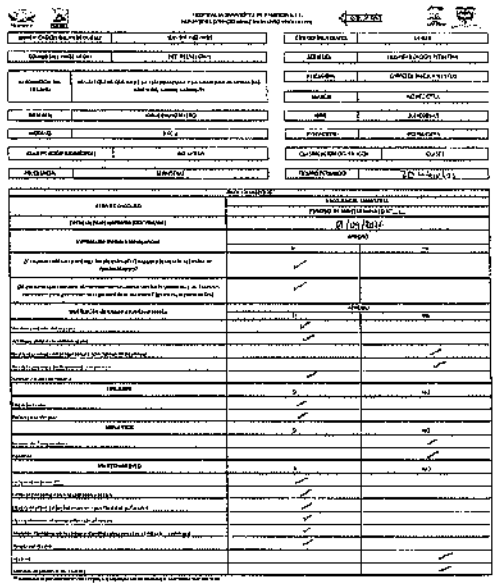

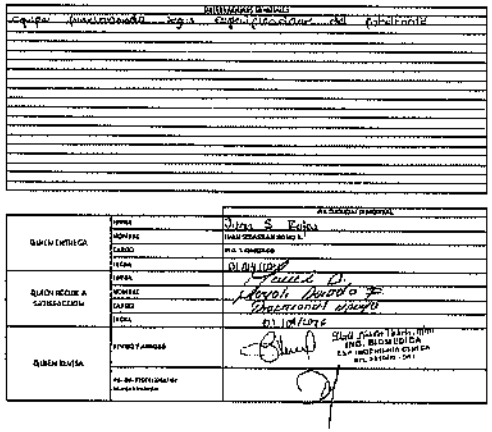


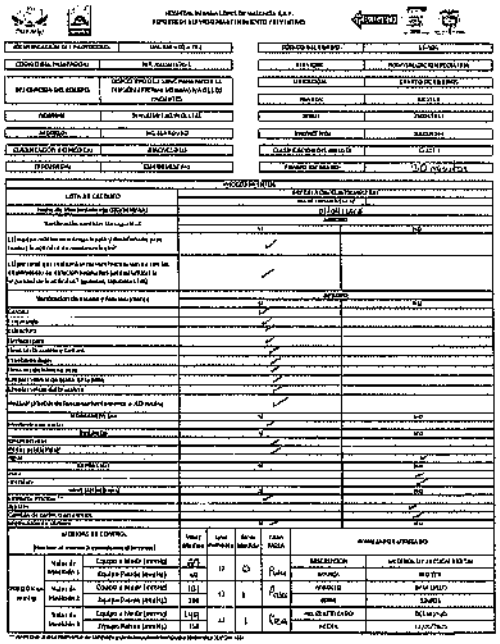

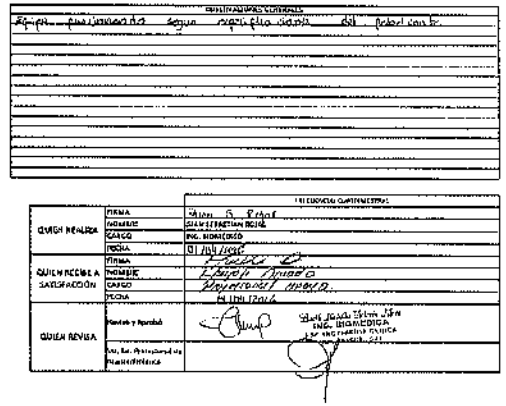


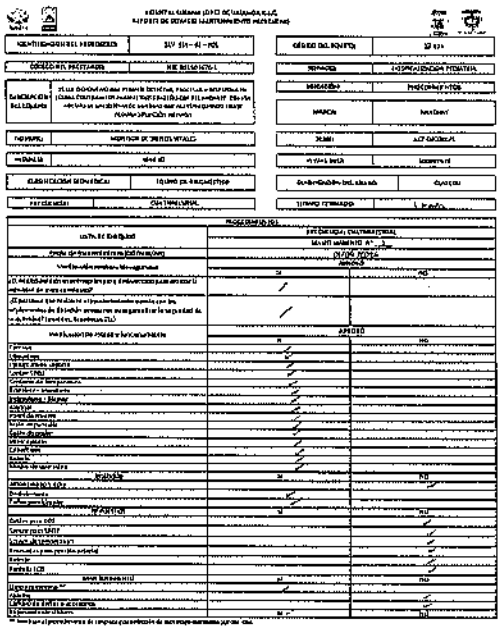



Página 1

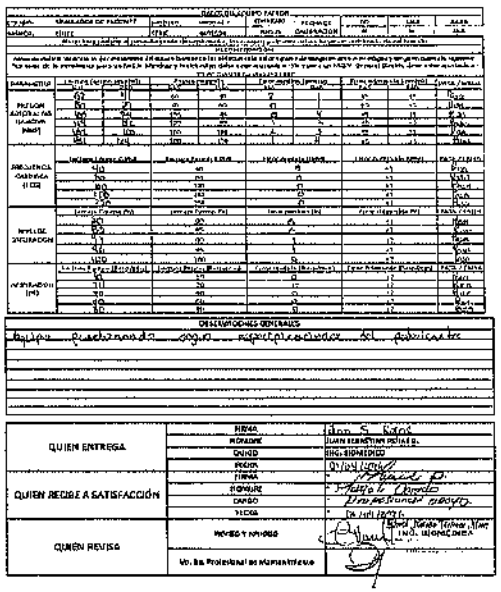



Página 2

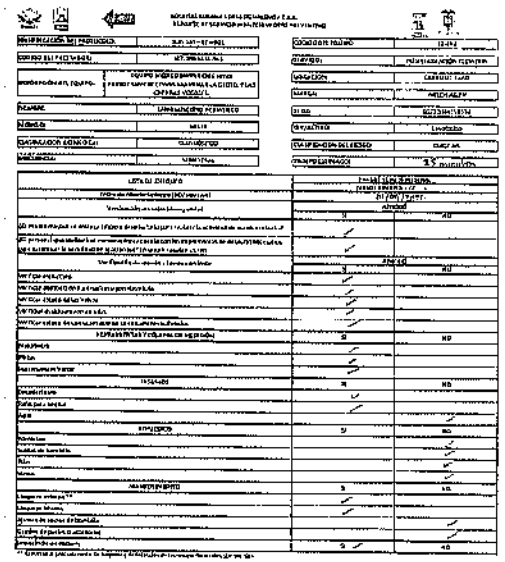


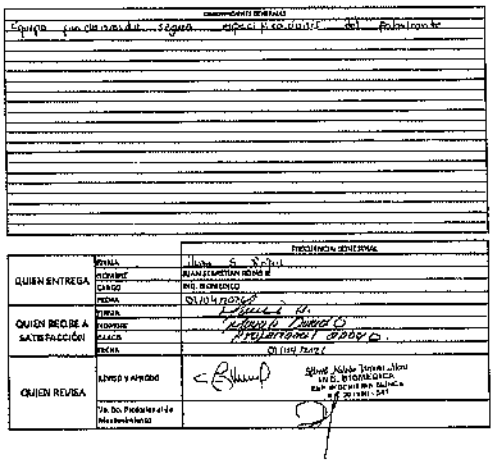


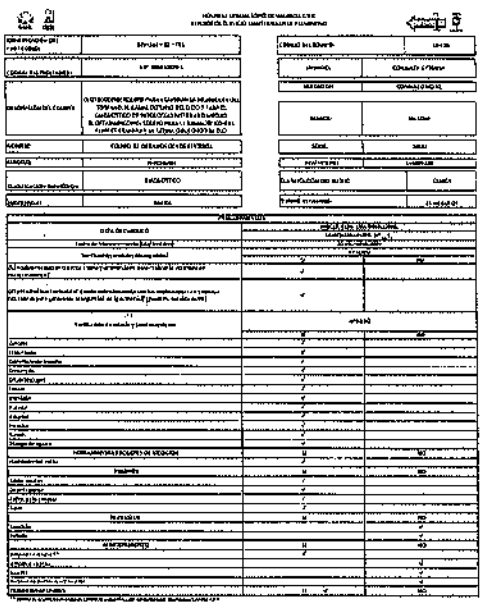


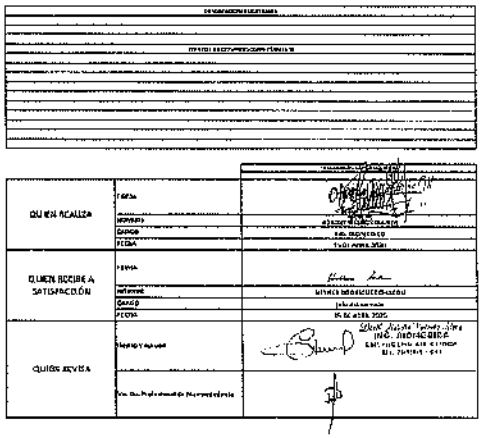


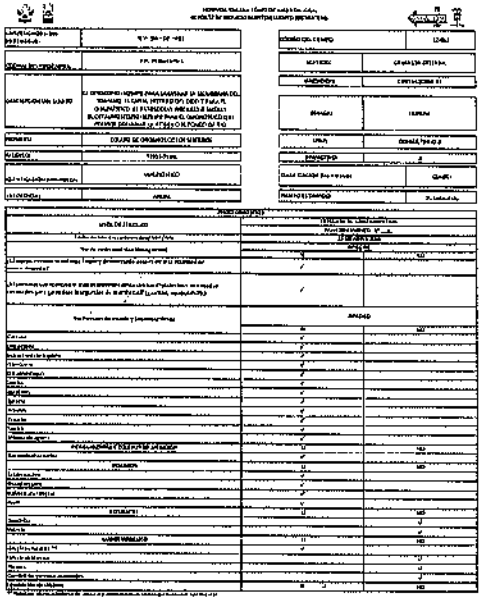


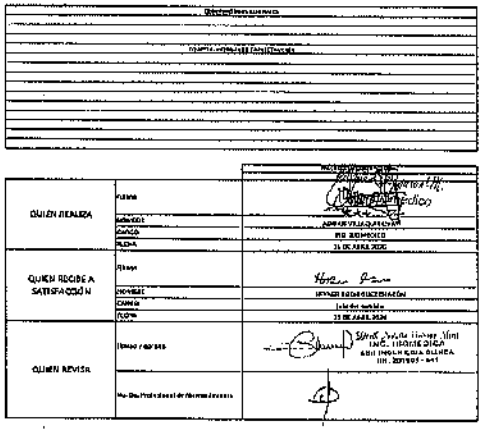


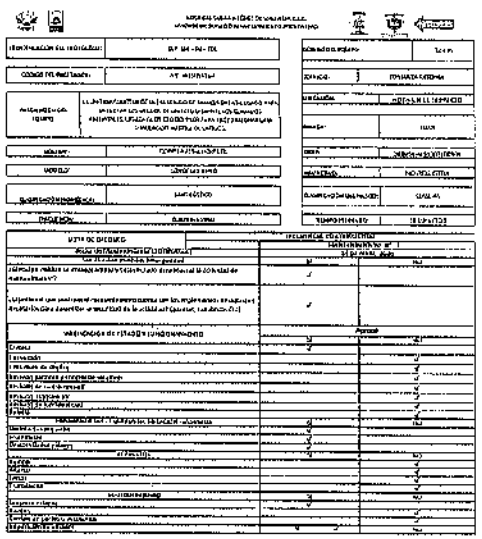


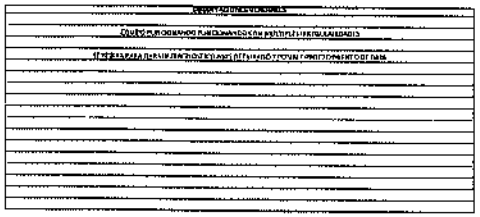


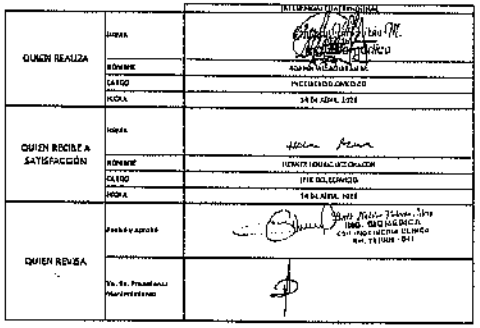


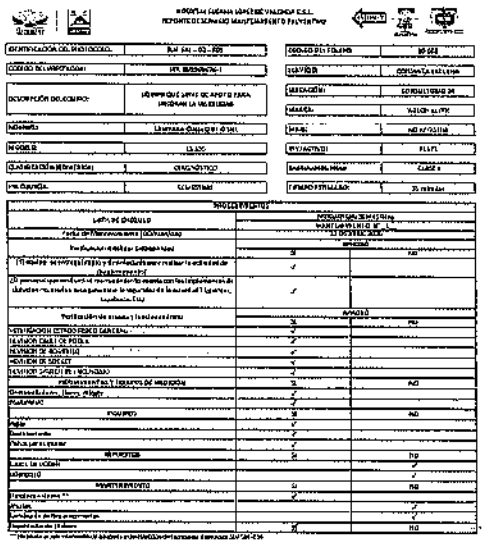


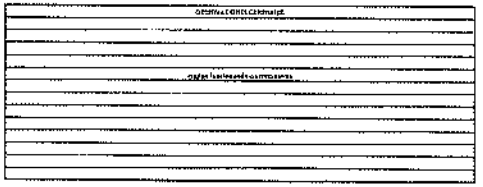


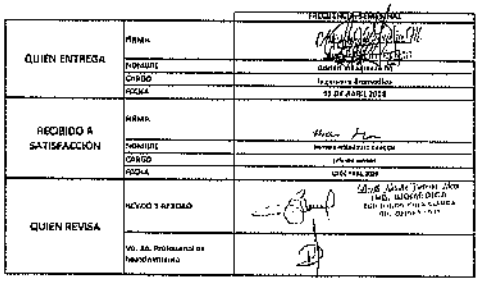


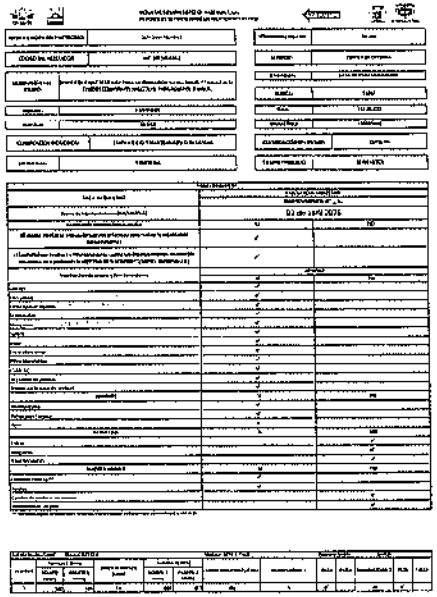


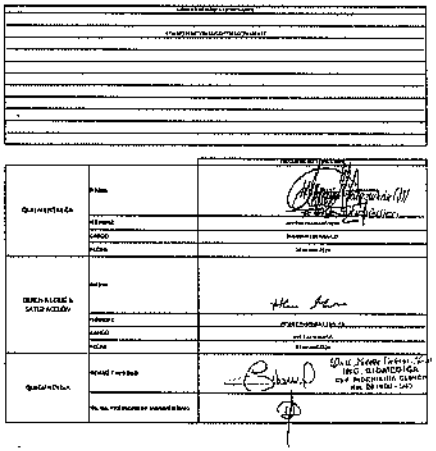


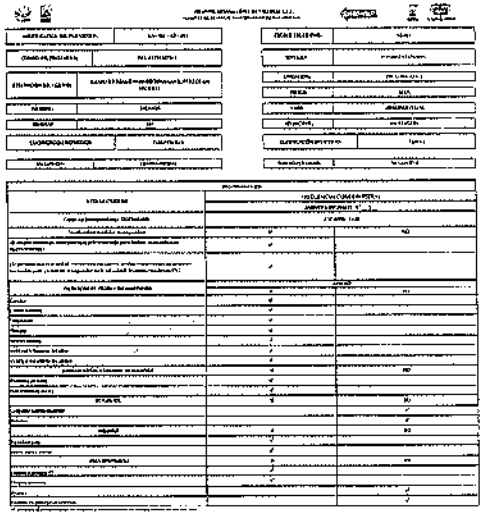


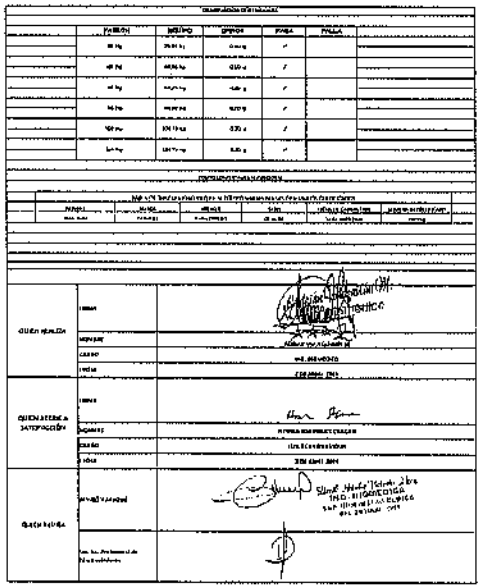


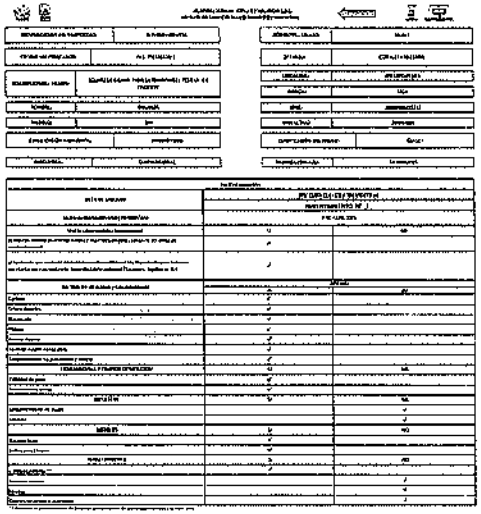


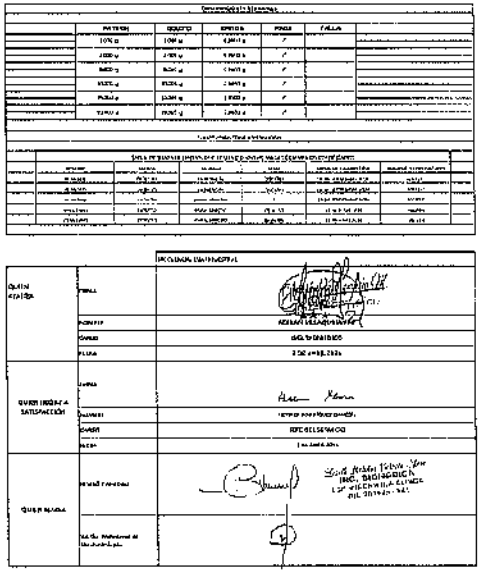


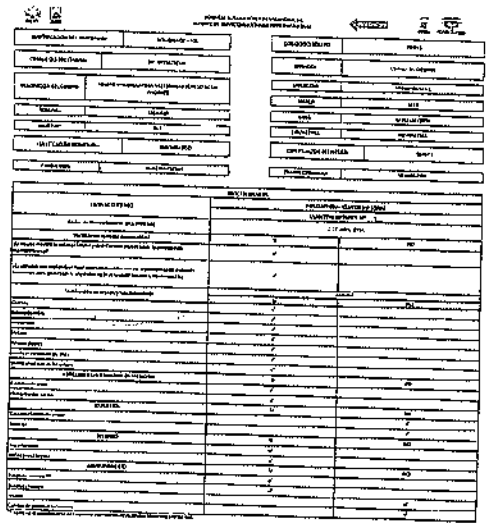


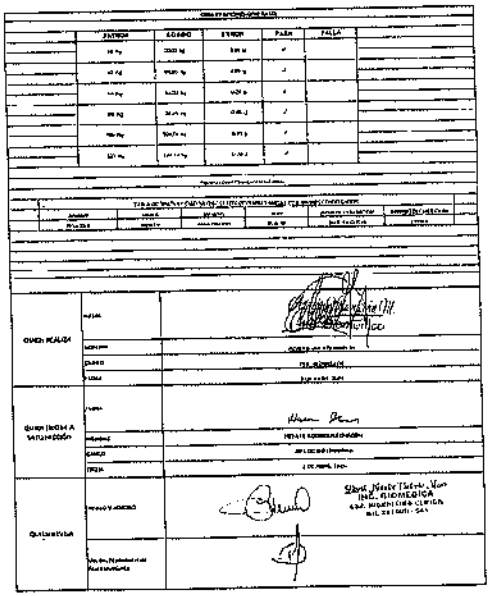


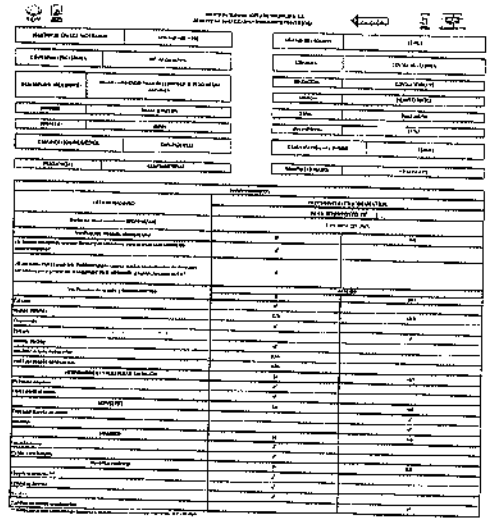


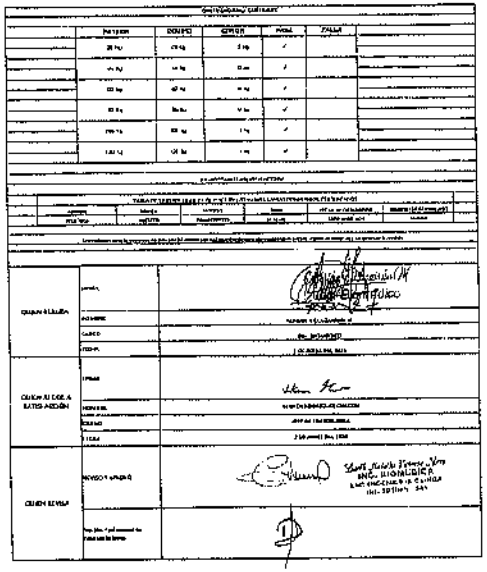


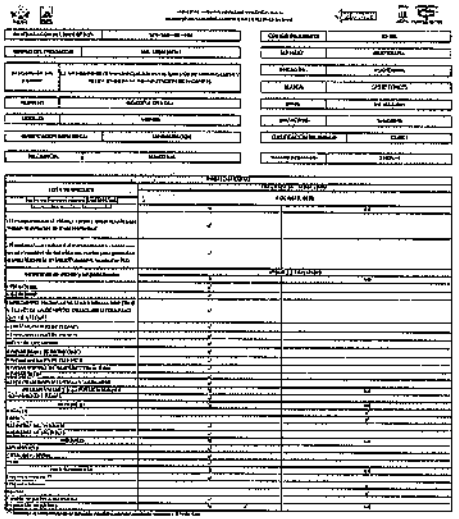


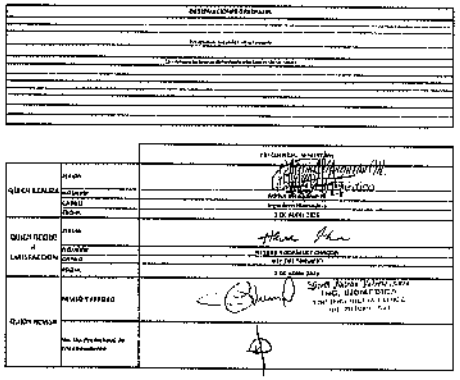


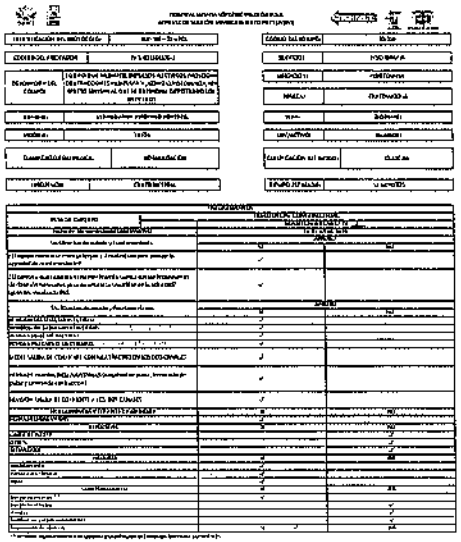


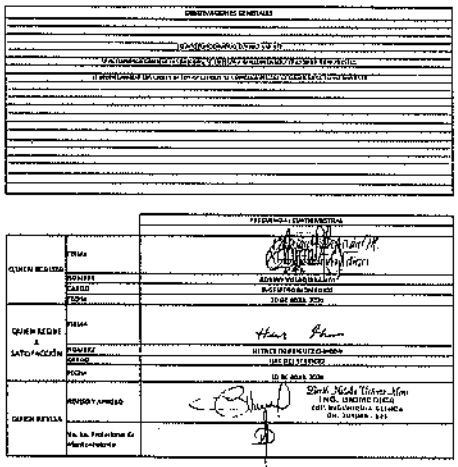


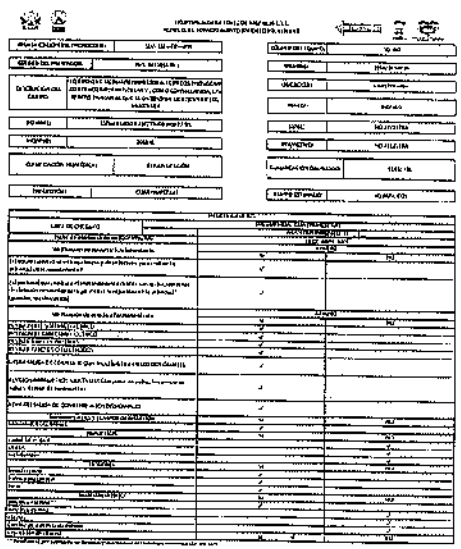


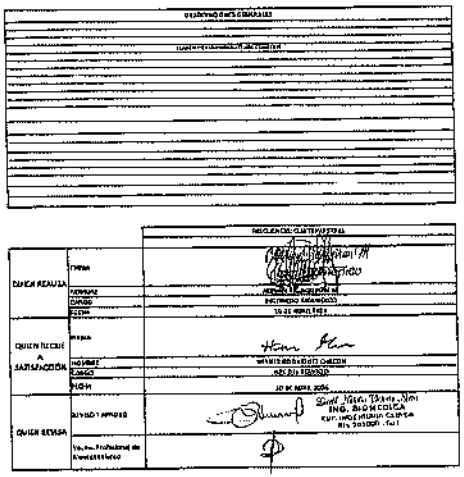


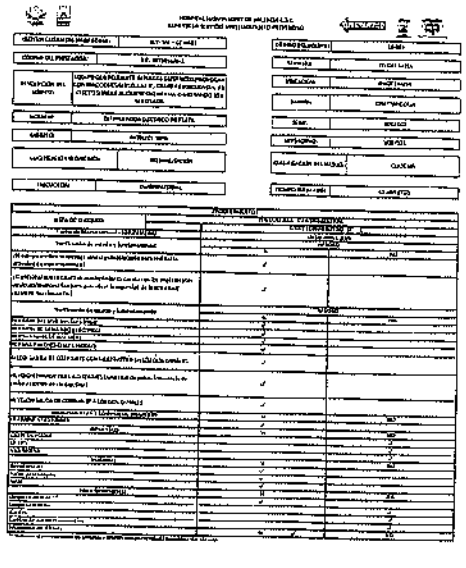


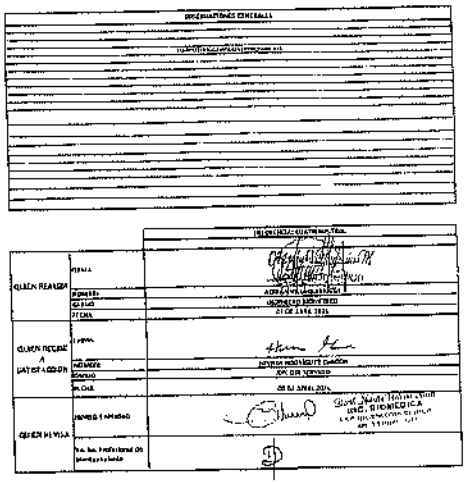


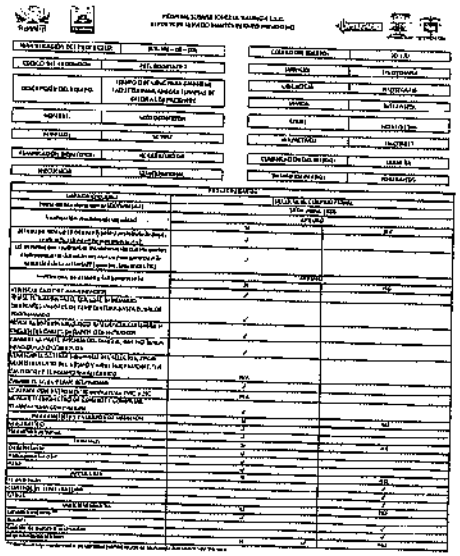


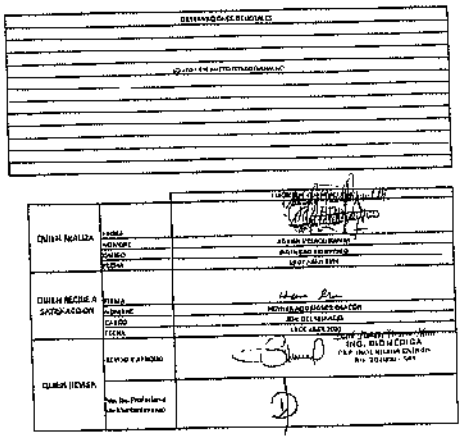


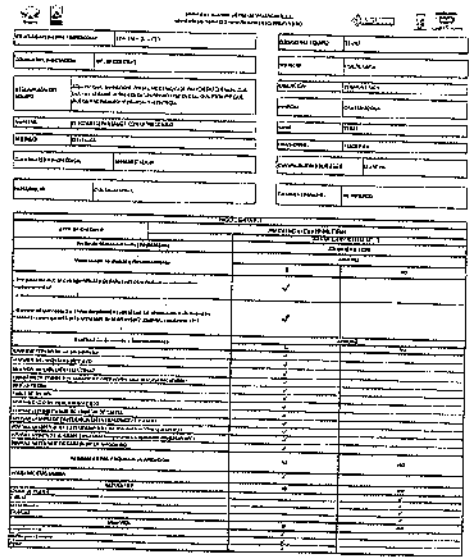


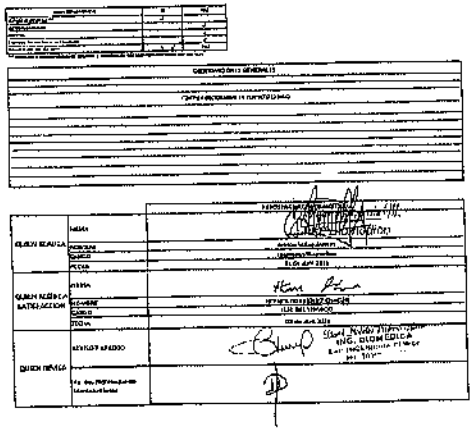


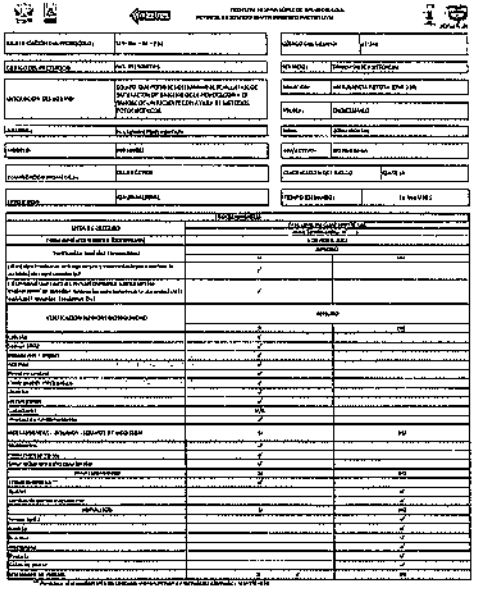


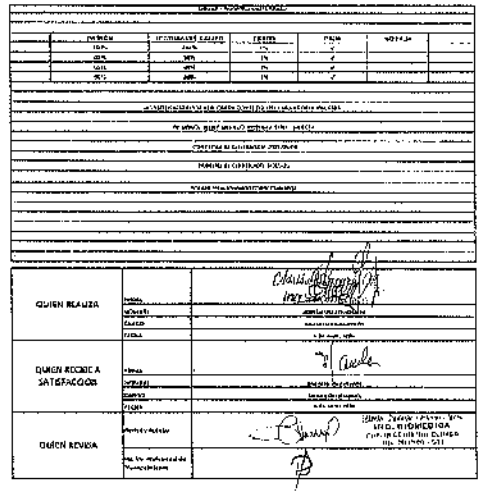


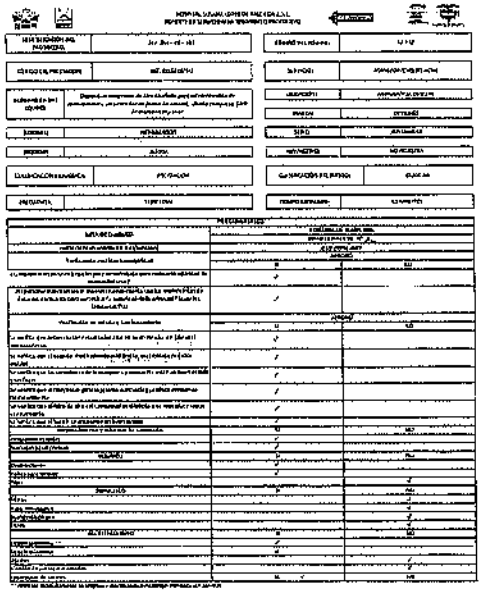


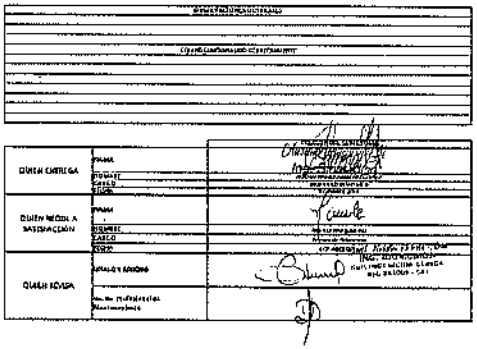

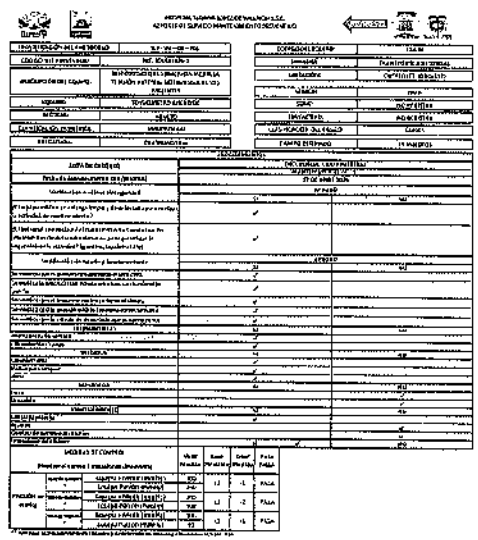


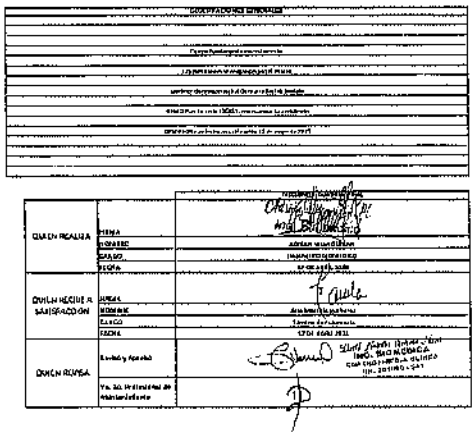

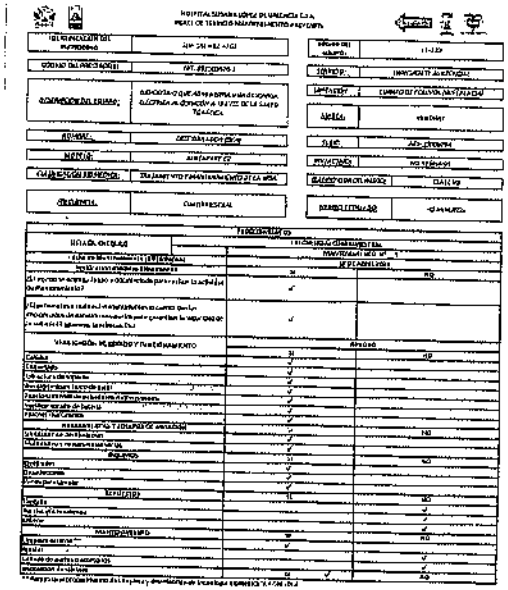

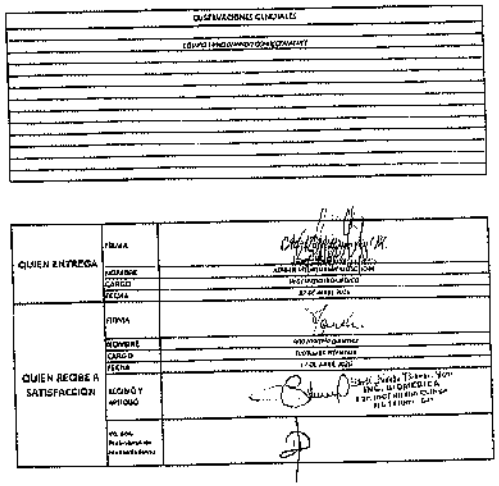

REPUESTOS

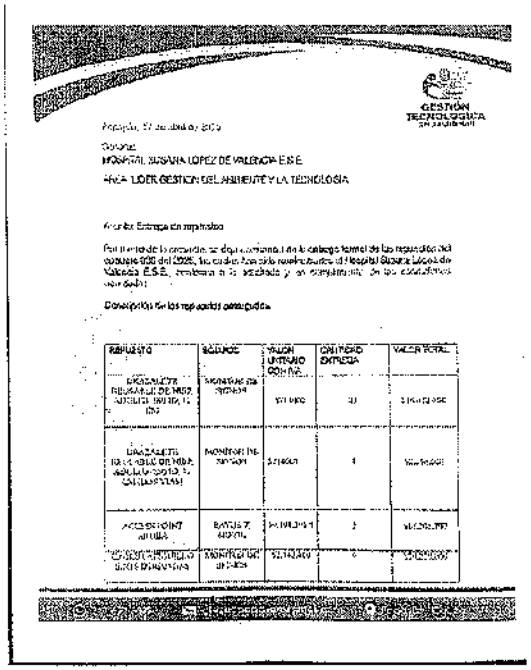

GESTIÓN TECNOLÓGICA

Popayán, 27 de abril de 2026


Señores
HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.
ÁREA LÍDER GESTIÓN DEL AMBIENTE Y LA TECNOLOGÍA

Asunto: Entrega de repuestos

Por medio de la presente se deja conformidad de la entrega formal de los repuestos del contrato 038 del 2026, los cuales fueron suministrados al Hospital Susana López de Valencia E.S.E., mediante la orden de pedido y en cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Descripción de los repuestos entregados:

REPUESTO	MODELO	VALOR UNITARIO COP $	CANTIDAD ENTREGA	VALOR TOTAL
BATERIA DE MONITOR DE SIGNOS VITALES	MONITOR DE SIGNOS	971.000	20	$19.420.000
BATERIA DE MONITOR DE SIGNOS VITALES	MONITOR DE SIGNOS	$ 71.600	4	$286.400
ACCESORIO DE ANTENA	BATAS Y ASEO	$ 1.910.714	3	$5.732.142
CONECTOR UNIVERSAL PARA OXIMETRIA	MONITOR DE SIGNOS	$ 214.400	6	$1.286.400

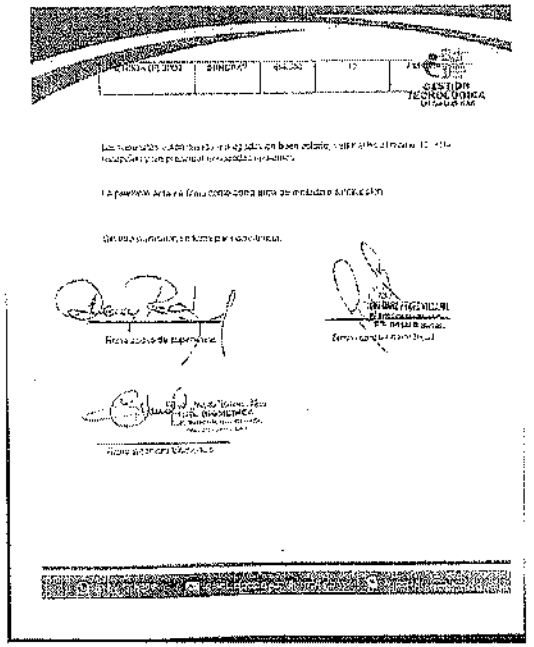

GESTIÓN TECNOLÓGICA

Las [illegible] cabal manera y en el estado en que se [illegible] el día [illegible] de [illegible] de [illegible] a satisfacción por parte del proveedor [illegible].

La garantía de la [illegible] cubre cualquier falla de material o fabricación.


Cordialmente, se firma en constancia.

Firma autorizada del supervisor


[illegible]

Firma del proveedor



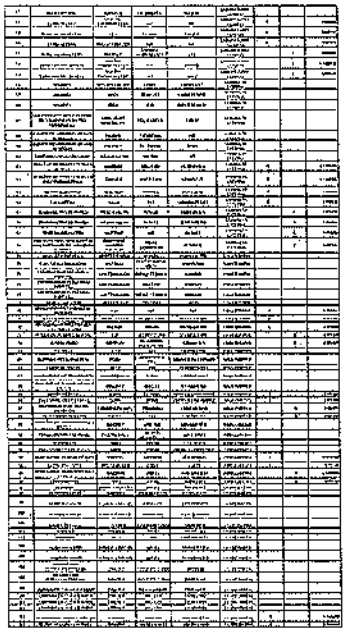



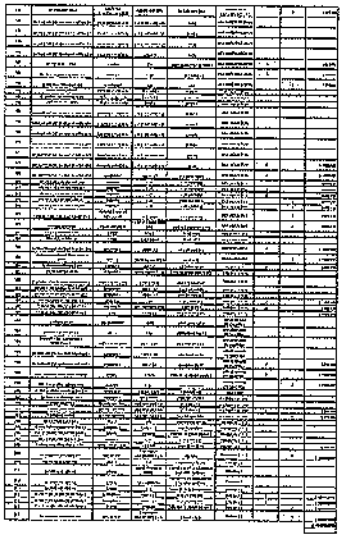

SOLICITUDES

HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.

Reporte de Solicitudes Filtradas

Fecha: 21/04/2026 12:00 p. m.

Filtros Aplicados

Área: BIOMÉDICA | Mes: Abril | Estado: COMPLETADA

Total de solicitudes en este reporte: 68

Resumen Estadístico

Total: 68	Pendientes: 0	En Proceso: 0
Completadas: 68	Críticas: 0	Sin Asignar: 0

Detalle de Solicitudes

#	ID	Fecha	Área	Equipo	Ubicación	Estado	Prior.	Asignado
1	SOL-2026-0041	01/04/2026	Biomédica	Bomba de infusión	UCI Adultos	COMPLETADA	Alta	Carlos Mendoza
2	SOL-2026-0042	01/04/2026	Biomédica	Monitor de signos vitales	Urgencias	COMPLETADA	Media	Andrés Ruiz
3	SOL-2026-0043	02/04/2026	Biomédica	Ventilador mecánico	UCI Adultos	COMPLETADA	Crítica	Carlos Mendoza
4	SOL-2026-0044	02/04/2026	Biomédica	Electrocardiógrafo	Consulta Externa	COMPLETADA	Baja	Juan Herrera
5	SOL-2026-0045	03/04/2026	Biomédica	Desfibrilador	Urgencias	COMPLETADA	Alta	Andrés Ruiz
6	SOL-2026-0046	03/04/2026	Biomédica	Incubadora neonatal	Neonatología	COMPLETADA	Media	Carlos Mendoza
7	SOL-2026-0047	04/04/2026	Biomédica	Bomba de infusión	Hospitalización	COMPLETADA	Media	Juan Herrera
8	SOL-2026-0048	04/04/2026	Biomédica	Negatoscopio	Consulta Externa	COMPLETADA	Baja	Andrés Ruiz
9	SOL-2026-0049	04/04/2026	Biomédica	Monitor de signos vitales	Hospitalización	COMPLETADA	Media	Carlos Mendoza
10	SOL-2026-0050	05/04/2026	Biomédica	Cama hospitalaria	Hospitalización	COMPLETADA	Baja	Juan Herrera
11	SOL-2026-0051	05/04/2026	Biomédica	Ventilador mecánico	UCI Adultos	COMPLETADA	Crítica	Carlos Mendoza
12	SOL-2026-0052	06/04/2026	Biomédica	Electrocardiógrafo	Urgencias	COMPLETADA	Alta	Andrés Ruiz
13	SOL-2026-0053	06/04/2026	Biomédica	Bomba de infusión	Hospitalización	COMPLETADA	Media	Juan Herrera
14	SOL-2026-0054	07/04/2026	Biomédica	Desfibrilador	Urgencias	COMPLETADA	Alta	Carlos Mendoza
15	SOL-2026-0055	07/04/2026	Biomédica	Monitor de signos vitales	Urgencias	COMPLETADA	Media	Andrés Ruiz
16	SOL-2026-0056	08/04/2026	Biomédica	Incubadora neonatal	Neonatología	COMPLETADA	Media	Carlos Mendoza
17	SOL-2026-0057	08/04/2026	Biomédica	Bomba de infusión	UCI Adultos	COMPLETADA	Crítica	Juan Herrera
18	SOL-2026-0058	09/04/2026	Biomédica	Negatoscopio	Consulta Externa	COMPLETADA	Baja	Andrés Ruiz
19	SOL-2026-0059	09/04/2026	Biomédica	Ventilador mecánico	UCI Adultos	COMPLETADA	Crítica	Carlos Mendoza
20	SOL-2026-0060	10/04/2026	Biomédica	Electrocardiógrafo	Urgencias	COMPLETADA	Alta	Juan Herrera
21	SOL-2026-0061	10/04/2026	Biomédica	Monitor de signos vitales	Hospitalización	COMPLETADA	Media	Andrés Ruiz
22	SOL-2026-0062	11/04/2026	Biomédica	Cama hospitalaria	Hospitalización	COMPLETADA	Baja	Carlos Mendoza
23	SOL-2026-0063	11/04/2026	Biomédica	Desfibrilador	Urgencias	COMPLETADA	Alta	Juan Herrera
24	SOL-2026-0064	12/04/2026	Biomédica	Bomba de infusión	Hospitalización	COMPLETADA	Media	Andrés Ruiz
25	SOL-2026-0065	12/04/2026	Biomédica	Incubadora neonatal	Neonatología	COMPLETADA	Media	Carlos Mendoza
26	SOL-2026-0066	13/04/2026	Biomédica	Ventilador mecánico	UCI Adultos	COMPLETADA	Crítica	Juan Herrera
27	SOL-2026-0067	13/04/2026	Biomédica	Monitor de signos vitales	Urgencias	COMPLETADA	Alta	Andrés Ruiz
28	SOL-2026-0068	14/04/2026	Biomédica	Electrocardiógrafo	Consulta Externa	COMPLETADA	Baja	Carlos Mendoza

HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.

Reporte de Solicitudes Filtradas

Fecha: 21/04/2026 12:00 p. m.

Filtros Aplicados


Área: BIOMÉDICA | Mes: Marzo | Estado: COMPLETADA


Total de solicitudes en este reporte: 154


Resumen Estadístico


Total: 154	Pendientes: 0	En Proceso: 0
Completadas: 154	Críticas: 0	Sin Asignar: 0


Detalle de Solicitudes

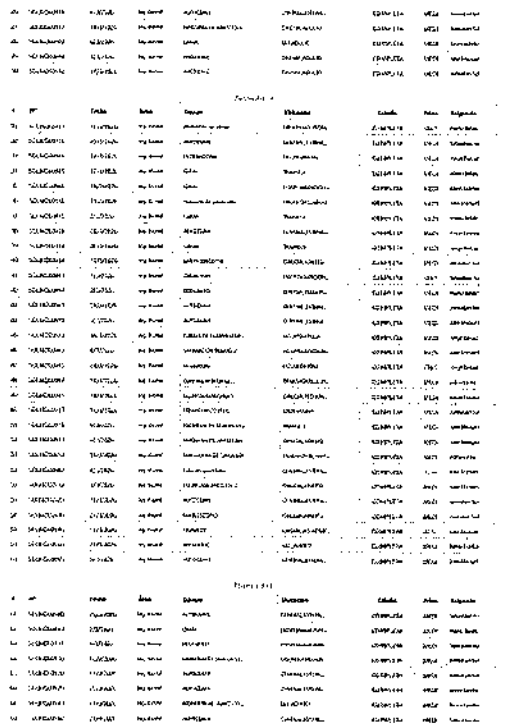

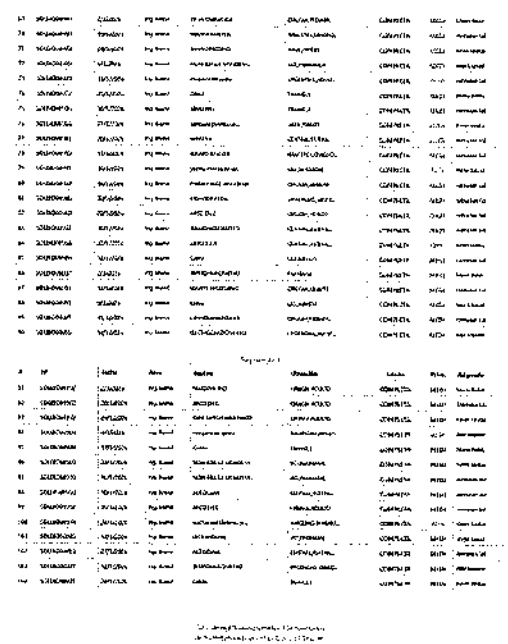

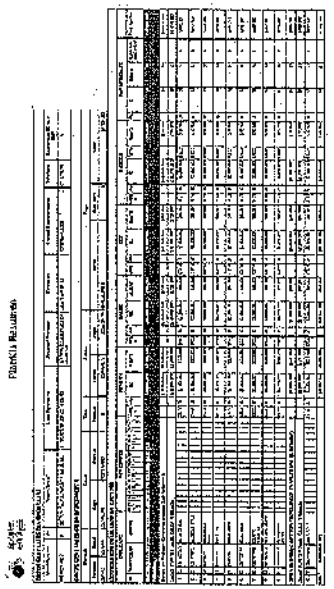

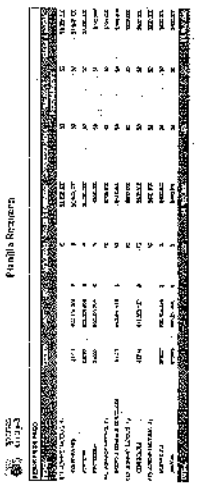

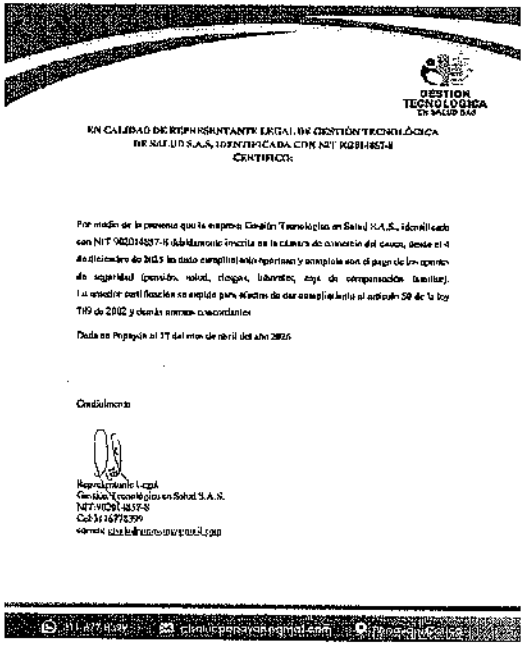

GESTIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD SAS

EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SALUD S.A.S, IDENTIFICADA CON NIT 901145837-8

CERTIFICA:

Por medio de la presente que la empresa Gestión Tecnológica en Salud S.A.S., identificada con NIT 901145837-8 debidamente inscrita en la cámara de comercio del Cauca, desde el 4 de diciembre de 2015 los datos cumplimentados aportados y cumplidos son el pago de los aportes de seguridad (pensión, salud, riesgos, laborales, caja de compensación familiar), tal y cuando cual fiscales se exigido para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas concordantes

Dada en Popayán el 17 del mes de abril del año 2025

Cordialmente

Representante Legal
Gestión Tecnológica en Salud S.A.S.
NIT: 901145837-8
Cel: 3166776399
correo: gestiontecnologicasas@gmail.com

