INFORMACIÓN BÁSICA

LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO
Servicios de Salud UAS – Timbiquí	16 03 2026	4:00 PM

TIPO DE REUNIÓN

Señale con una "x" el tipo de reunión:

Consejo de Gobierno	
Comité Coordinador de Control Interno	
Comité Técnico	
Reuniones	**X**
Asistencia Técnica	

Elaborada Por:
Maria Fernanda Ordoñez A – Profesional De Apoyo Dirección Técnica de Integración Territorial

CONTROL DE ASISTENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCION	CARGO
Adriana Liceth Garcia Alomia	ESE OCCIDENTE	Líder de Calidad
Maira Ocoro Cuenu	ESE OCCIDENTE	Líder de Almacén
María Fernanda Ordoñez	Secretaría de Salud del Cauca - Ing. Biomédica – Dirección Técnica de integración Territorial.	Ing. Biomédica

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. CONFIRMACIÓN DE LOS ASISTENTES

Siendo las 4:00 PM se da inicio a la reunión en la sede de la UAS Timbiquí, se verifica nombres y cargos de los asistentes, se realiza lectura de la dotación objeto del convenio, se plantea el recorrido por las áreas asistenciales de acuerdo a la ubicación de la dotación iniciando por la dotación hospitalaria asignada para la UAS Timbiquí (72 equipos) y la dotación hospitalaria asignada para la UAS López de Micay (7 equipos) durante el día 16 de marzo de 2026 se inicia con la revisión de la dotación de consulta externa a partir delas 4:00 pm , se continua el día 17 de marzo de 2026 a partir de las 8:00 am hasta las 3:30 pm y se finaliza con la lectura y cierre del acta de seguimiento el día 18 de marzo de 2026 a las 9:10 am .

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Convenio interadministrativo No. 3819- 2025 celebrado entre el Departamento del Cauca y la Empresa Social del Estado ESE OCCIDENTE 1- Dotación asignada para UAS Timbiquí y UAS López de Micay.

Scanned with CamScanner

3. DESARROLLO DE LA REUNION

Revisión general objeto y cláusulas del Convenio Interadministrativo:

CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE LÓPEZ DE MICAY Y TIMBIQUÍ DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LAS UNIDADES DE ATENCIÓN EN SALUD DE LÓPEZ DE MICAY Y TIMBIQUÍ. CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) OBLIGACIONES DE LA E.S.E.: 1. Certificar la incorporación en el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos aportados por el Departamento.2. Realizar el proceso de selección para la compra de los equipos biomédicos y mobiliario hospitalario para la atención en salud, con los recursos del convenio aportados de acuerdo a las especificaciones técnicas referidas en el anexo 1. 3. Constituir una cuenta de ahorros exclusiva para manejar los recursos del mismo, previa incorporación presupuestal.4. Acatar para la contratación de los recursos del convenio lo dispuesto en el art. 95 de la Ley 1474 de 2011, el estatuto de contratación de la ESE, la Resolución No 5185 de 2013 y Resolución 1440 de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social, el Art 13 de la Ley 1150 de 2007, y aquellas que las modifiquen, sustituyan o adicionen. 5. Realizar previamente a la contratación, los estudios de mercado correspondientes con el objeto de evitar sobrecostos o detrimento en el patrimonio público.

Si durante la ejecución de los contratos se detecta un posible sobrecosto, deberá realizar el respectivo ajuste y/o descuento en la liquidación de los contratos. 6. Los equipos biomédicos adquiridos deberán contar con permiso de comercialización, registro sanitario INVIMA (Según aplique) y Manual en español según lo dispuesto en el Decreto 4725 de 2005.7. Los equipos biomédicos emisores de radiaciones ionizantes deberán contar con todo lo reglamentado de acuerdo a la Resolución 482 de 2018 para su puesta en funcionamiento y respectivo trámite de licencia de práctica médica, para lo cual se otorga un plazo de 120 días. 8. Garantizar que cuenta con recursos propios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos y equipos industriales de uso médico. Para el efecto deberá suscribir una carta de compromiso, la cual hará parte integral del presente convenio y mediante la cual se obliga a realizar dicho mantenimiento por todo el tiempo de vida útil de los mencionados equipos biomédicos y mobiliario hospitalario, de conformidad con las normas legales vigentes sobre la materia. 9. Realizar la supervisión de los contratos que celebre en virtud de la ejecución del presente convenio.

0. Reintegrar al Departamento del Cauca, el monto dinerario que resultare excedente derivado del presente convenio.11. Reintegrar al Departamento del Cauca, los rendimientos financieros que se generen por concepto del primer desembolso (Anticipo). B) OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA: 1. Aportar los recursos a su cargo, mencionados en el costeo o presupuesto del convenio, recursos que se desembolsarán en la cuenta que se constituya para el efecto por la Empresa Social del Estado OCCIDENTE E.S.E., de conformidad con los parámetros del convenio. 2. Realizar la supervisión del presente convenio. CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONVENIO Y DESEMBOLSO DE LOS APORTES: El valor del convenio es de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 300.000.000), determinado por el estudio de mercado presentado por la Empresa Social del Estado OCCIDENTE ESE, que se destinarán para la Adquisición de equipos biomédicos y mobiliario hospitalario para el fortalecimiento de la atención hospitalaria.

Con el propósito de verificar el cumplimiento de los lineamientos técnicos, las especificaciones mínimas y los alcances definidos en el Convenio No. 3819 de 2025, se realizó una visita de inspección técnica

Scanned with CamScanner

en sitio en la UAS Timbiquí así como la dotación asignada para la UAS de López de Micay la cual se encontraba en custodia en el área de almacén de la UAS Timbiquí informando que estaban a espera de recibir visita de la SDSC para el acto protocolario de entrega y posterior a ella se realizara su ubicación definitiva de la dotación biomédica y mobiliario hospitalario adquirida en el marco del referido convenio.

Durante la visita se efectuó la identificación y verificación de cada uno de los equipos biomédicos objeto del convenio. Así mismo, se realizaron pruebas físicas y funcionales de carácter operativo, orientadas a constatar el estado general de los equipos y su correspondencia con las especificaciones técnicas mínimas previamente viabilizadas y aprobadas.

De manera complementaria, se llevó a cabo la verificación de los accesorios asociados a cada equipo biomédico, revisando su adquisición, disponibilidad y concordancia en cantidad y características técnicas con lo establecido en los requerimientos del convenio, necesarios para su correcta operación y uso clínico.

Para cada equipo inspeccionado se realizó el registro de la información técnica de identificación, incluyendo marca, modelo y número de serie, así como la toma de registro fotográfico, el cual se incorpora como soporte documental del proceso en el acta de verificación técnica.

Como resultado de la visita de inspección técnica, se identificó la dotación biomédica instalada en la Unidad de Atención en Salud (UAS) Timbiquí, correspondiente a un total de setenta y dos (72) equipos biomédicos y los siete (7) equipos médicos asignados a la UAS López de Micay, cuya información técnica se relaciona a continuación.

SERVICIO - UBICACIÓN	NOMBRE DE LA DOTACION	MIN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
UAS Timbiquí - Odontología	Escaler ultrasónico	1. Scaler Ultrasonico	WOODPECKER	USD-A LED	S2590381AL	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Odontología	Escaler ultrasónico	2. Voltaje de Entrada 24V – 50Hz/60Hz 1.3A	WOODPECKER	USD-A LED	S2590386AL	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Odontología	Escaler ultrasónico	3. Frecuencia Oscilación 28kHz +- 3kHz	WOODPECKER	USD-A LED	S2590382AL	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Odontología	Escaler ultrasónico	4. Presión de Agua 0.1bar ~ 5bar (0.01MPa ~0.5MPa)	WOODPECKER	USD-A LED	S2590383AL	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Odontología	Escaler ultrasónico	5. Potencia 3w – 20w	WOODPECKER	USD-A LED	S2590384AL	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Odontología	Escaler ultrasónico	6. Pieza de mano desmontable, autoclavable a 134-135 5°C a .022MPa.	WOODPECKER	USD-A LED	S2590385AL	FUNCIONANDO
		7. programas de uso para profilaxis y tratamientos de periodoncia				FUNCIONANDO

Scanned with CamScanner

UAS Timbiquí - Odontología	Lámpara de foto curado	1. Voltaje de entrada: AC100V – 240V~50Hz/60Hz	WOODPECKER	B-CURE	L2580199BC	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Odontología	Lámpara de foto curado	2. Varios modos de trabajo	WOODPECKER	B-CURE	L2580214BC	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Odontología	Lámpara de foto curado	3. Longitud de Onda: 385~515nm	WOODPECKER	B-CURE	L2580221BC	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Odontología	Lámpara de foto curado	4. Efecto solidificación menor o igual a 3 segundos	WOODPECKER	B-CURE	L2580231BC	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Odontología	Lámpara de foto curado	5. Batería de Litio recargable	WOODPECKER	B-CURE	L2580236BC	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Odontología	Lámpara de foto curado	6. Fibra óptica Autoclavable	WOODPECKER	B-CURE	L2580243BC	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Odontología	Kit odontológico	1. una pieza de alta	APPLEDENTAL / NSK	Modelo L / PANA-MAX2R B2	Contraángulo: L2510141755 Miromotor : AM2510141755 Recta: SH2510141755 Alta : NSK :A2530086	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Odontología	Kit odontológico	2. micro motor	APPLEDENTAL / NSK	Modelo L / PANA-MAX2R B2	Contra Angulo: :L2510141756 Miromotor : AM2510141756 Recta: SH2510141756 Alta : NSK :A2530085	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Odontología	Kit odontológico	3. contra Angulo	APPLEDENTAL / NSK	Modelo L / PANA-MAX2R B2	Contra Angulo: L2510171757 Miromotor : AM2510141757 Recta: SH2510141757	FUNCIONANDO

Scanned with CamScanner

					Alta : NSK :A2530089	
UAS Timbiquí - Odontología	Kit odontológico	4. cabeza de contra ángulo	APPLEDENTAL / NSK	Modelo L / PANA-MAX2R B2	Contra Angulo: L2510141758 Miromotor : AM2510141758 Recta: SH2510141758 Alta : NSK :A2530087	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Odontología	Kit odontológico	5. Pieza Recta	APPLEDENTAL / NSK	Modelo L / PANA-MAX2R B2	Contra Angulo :L2510141759 Miromotor : AM2510141759 Recta: SH2510141759 Alta : NSK :A2530088	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Odontología	Kit odontológico		APPLEDENTAL / NSK	Modelo L / PANA-MAX2R B2	Contraangulo: L2510141760 Miromotor : AM2510141760 Recta: SH2510141760 Alta : NSK :A2530090	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Odontología	Unidad odontológica portátil	1. Modulo montado en la caja plástica resistente de alto impacto	TROPHY	PORTATIL	4678	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Odontología	Unidad odontológica portátil	2. Sillón plegable	TROPHY	PORTATIL	4677	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Odontología	Unidad odontológica portátil	3. Motor libre de aceite	TROPHY	PORTATIL	4679	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Odontología	Unidad odontológica portátil	4. Modulo piezas de mano y otro para el Micro Motor.	TROPHY	PORTATIL	4662	FUNCIONANDO

Scanned with CamScanner

UAS Timbiquí - Odontología	Unidad odontológica portátil	5. Jeringa Triple	TROPHY	PORTATIL	4661	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Odontología	Unidad odontológica portátil	6. Activado por Pedal Eléctrico. 7. Escupidera en policarbonato o acero inoxidable 8. Bandeja para instrumental 9 Butaco plegable 10. Lámpara Led 11. Voltaje: de 100 v a 120 v	TROPHY	PORTATIL	4658	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Urgencias	Monitor fetal	1. Pantalla LCD o TFT mínimo de 5" 2. Detector de movimientos fetales 3. Impresora térmica incluida 4. Tiempo de trabajo hasta 5 horas 5. Dos (2) Transductores de fetocardia (HFR) 6. Un (1) Toco transductor y Un (1) Detector o marcador de eventos 7. Alarmas visuales y sonoras: frecuencia cardiaca (altas y bajas). 8. Capacidad de almacenamiento de datos.	EDAN	F3	560034-M2551243004 4	FUNCIONANDO Toco transductor Serie: H25402350119 Serie toco No 2: H25402350098

Scanned with CamScanner

		9. Fuente de alimentación 100V/240V /60HZ 10. superior a 3 Modos 11. Rango de medición FC 30bpm -240 bpm				
UAS Timbiquí - Urgencias	Oxímetro de pulso	1. Uso adulto , pediátrico y neonatal	MINDRAY	PM-60	CR-54288050	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Urgencias	Oxímetro de pulso	2. Rango de Medición 0-99%	MINDRAY	PM-60	CR-54288048	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Urgencias	Oxímetro de pulso	3. Frecuencia del pulso : 30 -254lpm	MINDRAY	PM-60	CR-54288049	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Urgencias	Oxímetro de pulso	4. Precisión +- 2%	MINDRAY	PM-60	CR-54288032	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Urgencias	Oxímetro de pulso	5. Resolución 1%	MINDRAY	PM-60	CR-54288035	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Urgencias	Oxímetro de pulso	6. Alarma sonoras y visibles 7.Soporte para recargar	MINDRAY	PM-60	CR-54288051	FUNCIONANDO FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Urgencias	Bomba de infusión	1. Bomba de infusión volumétrica o con ajuste de volumen	MEDCAPTAIN	MP-60	6052507000428	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Urgencias	Bomba de infusión	2. Con un peso menor a 3 Kg 3. Rango de ajuste de volumen u objetivo de volumen a infundir de 0.1 a 9,999 ml 4. Exactitud o error de precisión que se encuentre dentro del rango entre -5% y 5% 5 Rango de configuración de infusión o rango de flujos entre 0.1 ml/h a 1200 ml/h	MEDCAPTAIN	MP-60	6052507000342	FUNCIONANDO

Scanned with CamScanner

		6. Sensor de burbujas de aire con sensibilidad mayor a 0.025ml				
		7. Con biblioteca o librería de fármacos o librería				
		8. Sistema de alarma de oclusión.				
		9. Sistema de detección de dosis incorrecta o no goteo.				
		10. Sistema de anti caída de flujo libre o cambio de flujo en tiempo real				
		11. Requerimiento eléctrico 110V(+/-10%)/60 Hz.				
		12. Pinza de soporte o estación de trabajo.				
		13. Pantalla a color de 2 pulgadas mínimo con tecnología TFT				
		14. Batería de Ion litio recargable con autonomía mínima de 5 horas.				
UAS Timbiquí - Consulta externa	Tallímetro análogo para adultos	1. Rango de medición: */-14 – 205 cm.	CHARDER	HM200P	C25022203	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Consulta externa	Tallímetro análogo para adultos	2 División: 1 mm / 1/8"	CHARDER	HM200P	C25022204	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Consulta externa	Tallímetro análogo para adultos	3. Portable, fácil de instalar , con maletín de transporte	CHARDER	HM200P	C25022761	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Consulta externa	Tallímetro análogo para adultos		CHARDER	HM200P	C25022762	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Consulta externa	Tallímetro análogo para adultos	4. Con base de piso	CHARDER	HM200P	C25022759	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Consulta externa	Tallímetro análogo para adultos		CHARDER	HM200P	C25022760	FUNCIONANDO

Scanned with CamScanner

UAS Timbiquí - Consulta externa Cons No 5	Infantómetro	1. Plegable	HEALTH O METER	280HR	NO REGISTRA	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Consulta externa Cons No 4	Infantómetro	2. Alcance de medición: 10 – 100 cm,	HEALTH O METER	280HR	NO REGISTRA	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Consulta externa Cons No	Infantómetro	3. División : menor o igual a 5mm	HEALTH O METER	280HR	NO REGISTRA	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Consulta externa	Infantómetro	4 Peso: 1.6 kg / 3.5 lbs	HEALTH O METER	280HR	NO REGISTRA	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Consulta externa	Infantómetro	5. incluye maletín	HEALTH O METER	280HR	NO REGISTRA	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Consulta externa	Infantómetro		HEALTH O METER	280HR	NO REGISTRA	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Consulta externa	Equipo de órganos portátil	1. Equipo Manual con estuche	GMD	LOS-2TF-100	NO Registro - ACTIVI FIJO: 1098	FUNCIONANDO
		2. Tipo de iluminación otoscopio : Fibra Óptica				
		3. Aumento de imagen 3x				
UAS Timbiquí - Consulta externa	Equipo de órganos portátil	4. Alimentación con Baterías AA	GMD	LOS-2TF-100	NO REGISTRA-ACTIVI FIJO 1099	FUNCIONANDO
		5. Luz LED Oftalmoscopio				
UAS Timbiquí - Consulta externa	Equipo de órganos portátil	6. Luz LED Otoscopio	GMD	LOS-2TF-100	NO REGISTRA -ACTIVO FIJO 1100	FUNCIONANDO
		7. Bases independientes				
		8. Aperturas diferentes igual o mayor a 5				
UAS Timbiquí - Consulta externa	Báscula grado médico	1. Capacidad de pesaje mayor o igual 200 Kg o superior.	SECA	874+	10000001870 477	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Consulta externa	Báscula grado médico	2. Funcionamiento con baterías y adaptador de voltaje	SECA	874+	10000001870 474	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Consulta externa	Báscula grado médico	3. Función de pesaje madre /hijo	SECA	874+	10000001870 470	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Consulta externa	Báscula grado médico	4. Pantalla visualización de datos.	SECA	874+	10000001870 481	FUNCIONANDO

Scanned with CamScanner

UAS Timbiquí - Consulta externa	Báscula grado médico	5. Tara	SECA	874+	10000001870479	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Consulta externa	Báscula grado médico	6. Retención en pantalla de datos y borrado	SECA	874+	10000001870471	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Consulta externa	Báscula pediátrica	1. Pesa bebe electrónica o digital	SECA	354	8354329230720	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Consulta externa	Báscula pediátrica	2. Con pantalla de lectura o indicador incrustado	SECA	354	8354237230099	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Consulta externa	Báscula pediátrica	3. Capacidad de 20kg o superior.	SECA	354	8354168251014	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Consulta externa	Báscula pediátrica	4. Escala de peso graduada en kilos y libras	SECA	354	8354168250911	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Consulta externa	Báscula pediátrica	5. Función de Tara , auto Hold	SECA	354	8354168251184	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Consulta externa	Báscula pediátrica	6. Alimentación con batería	SECA	354	8354168251185	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Consulta externa	Tensiómetro	1. Tensiómetro con brazalete adulto	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS44-11C	25071515213429	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Consulta externa	Tensiómetro	2. Rango : 0 -300 Mmhg	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS44-11C	2507151664718	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Consulta externa	Tensiómetro	3. Intervalos : 10 Mmhg	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS44-11C	2507151221708	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Consulta externa	Tensiómetro	4. Resolución : 2 Mmhg	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS44-11C	2507151211257	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Consulta externa	Tensiómetro	5. carcasa de protección	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS44-11C	250716000948	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Consulta externa	Tensiómetro	6. exactitud +/- 3 Mmhg	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS44-11C	2507152324337	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Consulta externa	Doppler fetal	1. Pantalla OLED o LCD o TFT	EDAN	SD3 PRO	560027-M25911480002	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Consulta externa	Doppler fetal	2. Rango de latidos cardíacos fetales: +/- 60 - 210 o mayor lpm.	EDAN	SD3 PRO	560027-M25911480004	FUNCIONANDO

Scanned with CamScanner

UAS Timbiquí - Consulta externa	Doppler fetal	3. Rango de potencia de salida de audio: 0,5W - 2W 4. Frecuencia mínima de 2MHz. 5. Batería	EDAN	SD3 PRO	560027-M25B17110009	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Laboratorio clínico	Centrífuga de 8 tubos	1. Centrifuga Digital	INDULAB	035A	17813	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Laboratorio clínico	Centrífuga de 8 tubos	2. Temporizador entre 0- 99 minutos	INDULAB	035A	17814	FUNCIONANDO
UAS Timbiquí - Laboratorio clínico	Centrífuga de 8 tubos	3. Rango de velocidad entre 1000 - 3500 rpm 4. Fuente de Alimentación 110V/220V 5. Capacidad Total 8 tubos	INDULAB	035A	17812	FUNCIONANDO
UAS López de Micay - Urgencias	Monitor fetal	1. Pantalla LCD o TFT mínimo de 5" 2. Detector de movimientos fetales 3. Impresora térmica incluida 4. Tiempo de trabajo hasta 5 horas 5. Dos (2) Transductores de fetocardia (HFR) 6. Un (1) Toco transductor y Un (1) Detector o marcador de eventos 7. Alarmas visuales y sonoras: frecuencia cardiaca (altas y bajas). 8. Capacidad de almacenamiento de datos. 9. Fuente de alimentación 100V/240V /60HZ 10. superior a 3 Modos 11. Rango de medición FC 30bpm -240 bpm	EDAN	F3	560034-M25512430044	FUNCIONANDO Toco transductor Serie: H25402350098 Serie toco No 2: H25402350119

Scanned with CamScanner

UAS López de Micay - Urgencias	Monitor de signos vitales	1. Pantalla TFT , LED o LCD de 7" o superior 2. Opción para tomar la presión de manera manual y automático 3. Batería recargable 4 Cable ECG de 3 o 5 derivaciones 5 Medición de Saturación de oxígeno: 0 100%, 6 Rango de Frecuencia respiratoria: 0 120 rpm en adulto y 0 150 rpm en paciente pediátrico / neonatal 7 Rango de Frecuencia cardíaca: 25 -250 rpm, con resolución mínima de ± 1 lpm	EDAN	X12	261594-M25B18540027	FUNCIONANDO
UAS López de Micay - Urgencias	Monitor de signos vitales	8. Rango de Temperatura corporal: 0 50°C 9 Rango de medición de Presión no invasiva: Adulto 40 o menor a 260mmHg o mayor, Pediátrico 40 o menor a 230mmHg o mayor 10. Indicador de alarmas 11. Voltaje de alimentación: 100 240V 50/60 Hz.	EDAN	X12	261594-M25B18440067	FUNCIONANDO
UAS López de Micay - Urgencias	Monitor de signos vitales	12. Accesorios para: Monitoreo de ECG, Saturación de oxígeno x2 (SpO2) uno adulto y uno pediátrico, Presión no invasiva (NIBP) manguera x1 y brazaletes x2 (uno adulto y uno	EDAN	X12	261594-M25B18440074	FUNCIONANDO

Scanned with CamScanner

		pediátrico), Sensor de Temperatura corporal de piel x 2. 13. Carro de trasporte				
UAS López de Micay - Urgencias	Nebulizador	Flujo De Aire mayor o igual a 9 Lpm	DEVILBISS	5650D	D7012253	FUNCIONANDO
UAS López de Micay - Urgencias	Nebulizador	Nivel De Sonido menor o igual a 57 Dba Condiciones Eléctricas: 110 a 115v	DEVILBISS	5650D	D7008934	FUNCIONANDO
UAS López de Micay - Urgencias	Nebulizador	Presión Máxima Del Compresor mayor a igual a 11 Psi	DEVILBISS	5650D	D7012216	FUNCIONANDO

Se verifica y adjunta la siguiente documentación:

- Entrada o Ingreso a almacén de la dotación en cada UAS
- Actas de entrega y/o Instalación
- Cronograma de mantenimiento
- Garantía de los equipos
- Permisos de comercialización de los equipos que aplica
- Registros INVIMA de los equipos Biomédicos
- Registros de importación
- Contrato de compraventa
- Hojas de vida
- Capacitación en el uso y manejo de la dotación (adjuntar lista de asistencia)
- Garantía de los equipos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -

Se adjunta acta Técnica de verificación.

Scanned with CamScanner

4. COMPROMISOS

RESPONSABLE(S)	ACTIVIDAD (Indicar si la actividad tiene prioridad Alta (A), Media (M) o Baja (B))				FECHA LIMITE dd-mm-aaaa
	DESCRIPCIÓN	A	M	B	
No Aplica	No Aplica				No Aplica

5. DECISIONES

DESCRIPCION
Finalizada la visita de seguimiento y verificación, se deja constancia que los setenta y nueve (79) equipos biomédicos correspondientes al convenio No. 3819 de 2025 de los cuales setenta y dos (72) de ellos asignados para la UAS Timbiquí y siete (7) equipos para la UAS López de Micay cumplen con las especificaciones técnicas contractuales y se encuentran en condiciones adecuadas de funcionamiento, según lo evidenciado durante la inspección realizada.

Sin más compromisos se da por terminada la reunión.

6. PRÓXIMA REUNIÓN

LUGAR	FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA DE INICIO (a.m.-p.m.)
NA	NA	NA

7. FIN DE LA REUNIÓN

Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión

HORA (a.m.-p.m.)
9:10 AM

8. REGISTRO DE APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA

NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCION	FIRMA
Adriana Liceth Garcia Alomia	ESE OCCIDENTE	
Maira Ocoro Cuenu	ESE OCCIDENTE	
María Fernanda Ordoñez	Secretaría de Salud del Cauca - Ing. Biomédica – Dirección Técnica de integración Territorial.	

Scanned with CamScanner

SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA

DIRECCION TECNICA DE INTEGRACION TERRITORIAL

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO A EJECUCION DE PROYECTOS DE DOTACION HOSPITALARIA EN LA RED PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

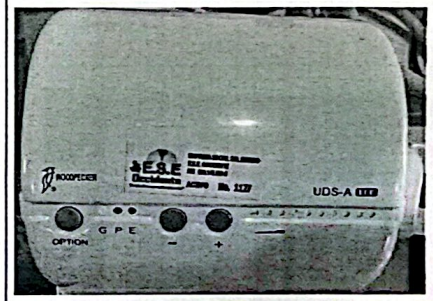
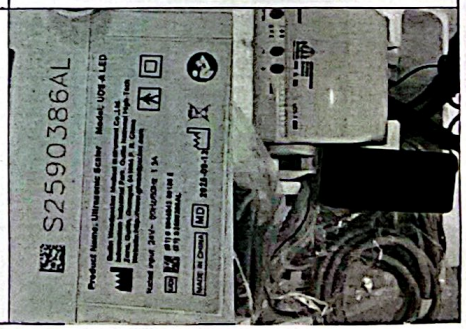
INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO			
E.S.E o Prestador verificado	**E.S.E OCCIDENTE**	**N° de Convenio**	**3819-2025**
Objeto del convenio:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE LÓPEZ DE MICAY Y TIMBIQUÍ DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LAS UNIDADES DE ATENCIÓN EN SALUD DE LÓPEZ DE MICAY Y TIMBIQUÍ.		
UAS sujeta a verificacion			

ACTIVIDAD A DESARROLLAR

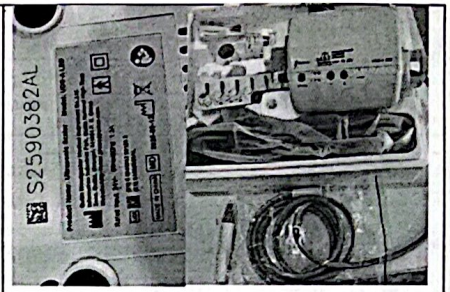
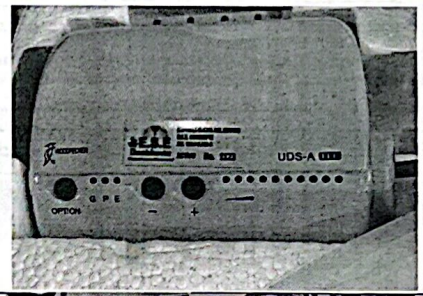
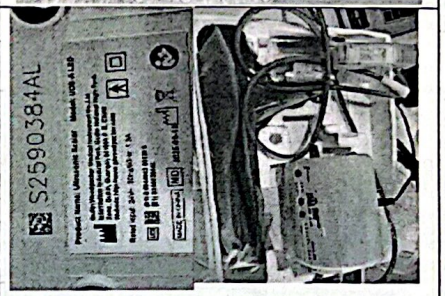
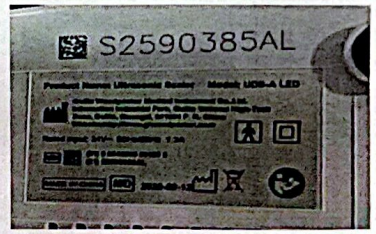
Se realiza visita de verificacion a la ejecucion del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO. 3819- 2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E OCCIDENTE. Con el objetivo de validar que la dotacion adquirida sea acorde a los lineamientos técnicos establecidos en el convenio y se verifique que la dotacion adquirida se encuentra destinada a la UNIDADES DE ATENCIÓN EN SALUD LOPEZ DE MICAY Y TIMBIQUI

VERIFICACION DE ASPECTOS TECNICOS DE DOTACION HOSPITALARIA

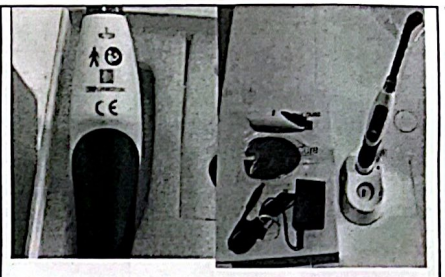
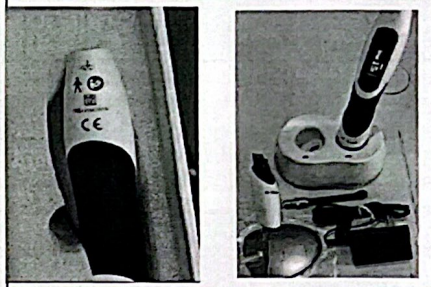
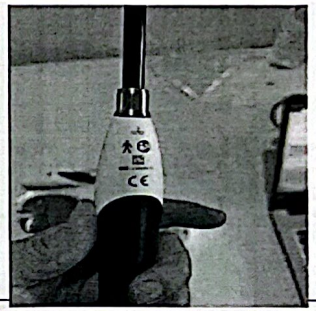
1. EVALUACION DE DOTACION HOSPITALARIA - ESPECIFICACIONES TECNICAS

SERVICIO - UBICACIÓN	NOMBRE DE LA DOTACION	MIN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
UAS Timbiquí - Odontologia	Escaler ultrasónico	1. Scaler Ultrasonico	WOODPECKER	USD-A LED	S2590381AL	FUNCIONANDO	
UAS Timbiquí - Odontologia	Escaler ultrasónico	2. Voltaje de Entrada 24V – 50Hz/60Hz 1.3A	WOODPECKER	USD-A LED	S2590386AL	FUNCIONANDO	

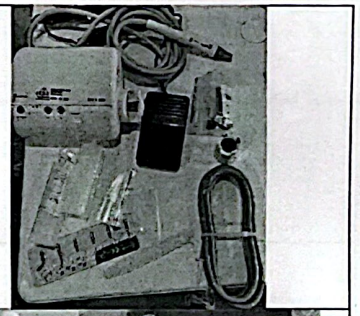
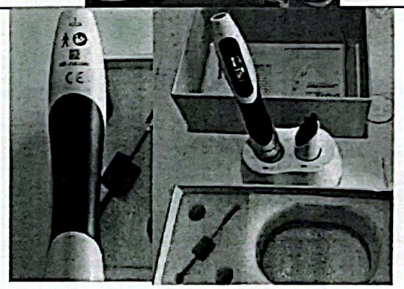
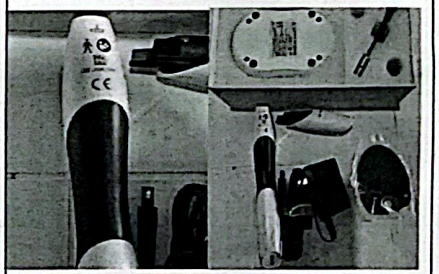
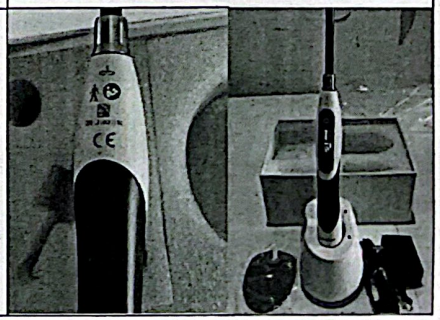
Scanned with CamScanner

UAS Timbiquí - Odontologia	Escaler ultrasónico	3. Frecuencia Oscilación 28kHz +- 3kHz	WOODPECKER	USD-A LED	S2590382AL	FUNCIONANDO	
UAS Timbiquí - Odontologia	Escaler ultrasónico	4. Presión de Agua 0.1bar ~ 5bar (0.01MPa ~0.5MPa)	WOODPECKER	USD-A LED	S2590383AL	FUNCIONANDO	
UAS Timbiquí - Odontologia	Escaler ultrasónico	5. Potencia 3w – 20w	WOODPECKER	USD-A LED	S2590384AL	FUNCIONANDO	
UAS Timbiquí - Odontologia	Escaler ultrasónico	6. Pieza de mano desmontable, autoclavable a 134- 135 5°C a .022MPa.	WOODPECKER	USD-A LED	S2590385AL	FUNCIONANDO	

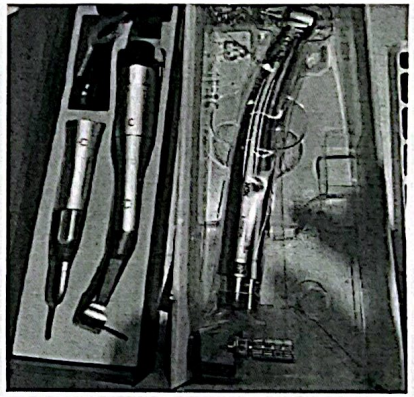
Scanned with CamScanner

UAS Timbiquí - Odontología	Lámpara de fotocurado	4. Efecto solidificación menor o igual a 3 segundos	WOODPECKER	B-CURE	L2580231BC	FUNCIONANDO	
UAS Timbiquí - Odontología	Lámpara de fotocurado	5. Batería de Litio recargable	WOODPECKER	B-CURE	L2580236BC	FUNCIONANDO	
UAS Timbiquí - Odontología	Lámpara de fotocurado	6. Fibra óptica Autoclavable	WOODPECKER	B-CURE	L2580243BC	FUNCIONANDO	
UAS Timbiquí - Odontología	Kit odontológico	1. una pieza de alta	APPLEDENTAL / NSK	Model L / PANA-MAX2R B2	Contraángulo:L2510141755 Miromotor : AM2510141755 Recta: SH2510141755 Alta : NSK :A2530086	FUNCIONANDO	

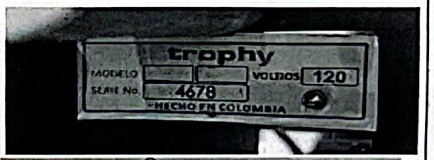
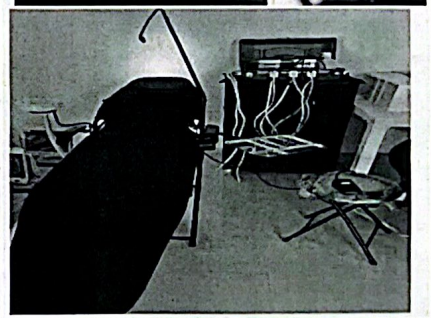
Scanned with CamScanner

		7. programas de uso para profilaxis y tratamientos de periodoncia				FUNCIONANDO	
UAS Timbiquí - Odontologia	Lámpara de fotocurado	1. Voltaje de entrada: AC100V – 240V~50Hz/60Hz	WOODPECKER	B-CURE	L2580199BC	FUNCIONANDO	
UAS Timbiquí - Odontologia	Lámpara de fotocurado	2. Varios modos de trabajo	WOODPECKER	B-CURE	L2580214BC	FUNCIONANDO	
UAS Timbiquí - Odontologia	Lámpara de fotocurado	3. Longitud de Onda: 385~515nm	WOODPECKER	B-CURE	L2580221BC	FUNCIONANDO	

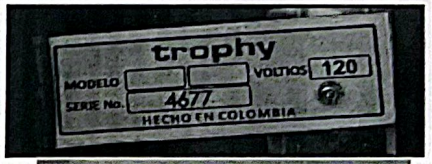
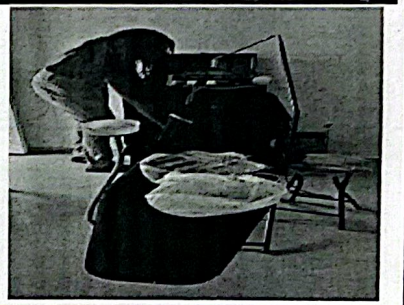
Scanned with CamScanner

UAS Timbiquí - Odontologia	Kit odontológico	2. micromotor	APPLEDENTAL / NSK	Model L / PANA-MAX2R B2	Contraangulo: :L2510141756 Miromotor : AM2510141756 Recta: SH2510141756 Alta : NSK :A2530085	FUNCIONANDO	
UAS Timbiquí - Odontologia	Kit odontológico	3. contraangulo	APPLEDENTAL / NSK	Model L / PANA-MAX2R B2	Contraangulo: L2510171757 Miromotor : AM2510141757 Recta: SH2510141757 Alta : NSK :A2530089	FUNCIONANDO	
UAS Timbiquí - Odontologia	Kit odontológico	4. cabeza de contrangulo	APPLEDENTAL / NSK	Model L / PANA-MAX2R B2	Contraangulo: L2510141758 Miromotor : AM2510141758 Recta: SH2510141758 Alta : NSK :A2530087	FUNCIONANDO	

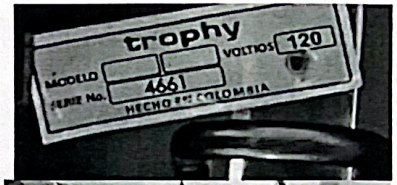
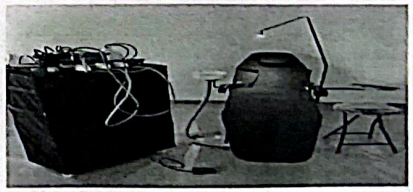
Scanned with CamScanner

UAS Timbiquí - Odontología	Kit odontológico	5. Pieza Recta	APPLEDENTAL / NSK	Model L / PANA-MAX2R B2	Contraangulo :L2510141759 Miromotor : AM2510141759 Recta: SH2510141759 Alta : NSK :A2530088	FUNCIONANDO	
UAS Timbiquí - Odontología	Kit odontológico		APPLEDENTAL / NSK	Model L / PANA-MAX2R B2	Contraangulo:L2510141760 Miromotor : AM2510141760 Recta: SH2510141760 Alta : NSK :A2530090	FUNCIONANDO	
UAS Timbiquí - Odontología	Unidad odontológica portátil	1. Modulo montado en la caja plástica resistente de alto impacto	TROPHY	PORTATIL	4678	FUNCIONANDO	 

Scanned with CamScanner

UAS Timbiquí - Odontología	Unidad odontológica portátil	2. Sillon plegable	TROPHY	PORTATIL	4677	FUNCIONANDO	 
UAS Timbiquí - Odontología	Unidad odontológica portátil	3. Motor libre de aceite	TROPHY	PORTATIL	4679	FUNCIONANDO	 

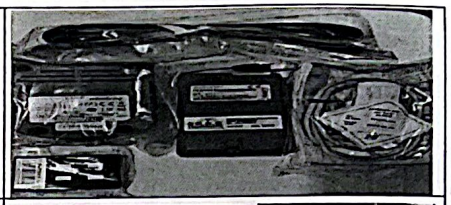
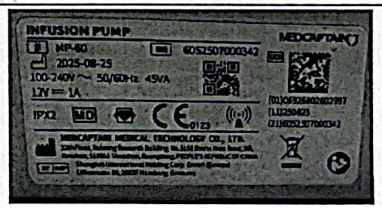
Scanned with CamScanner

UAS Timbiquí - Odontologia	Unidad odontológica portátil	4. Modulo piezas de mano y otro para el MicroMotor.	TROPHY	PORTATIL	4662		 
UAS Timbiquí - Odontologia	Unidad odontológica portátil	5. Jeringa Triple	TROPHY	PORTATIL	4661		 
UAS Timbiquí - Odontologia	Unidad odontológica portátil	6. Activado por Pedal Eléctrico. 7. Escupidera en policarbonato o acero inoxidable 8. Bandeja para instrumental 9 Butaco plegable 10. Lampara Led 11. Voltaje: de 100 v a 120 v	TROPHY	PORTATIL	4658	FUNCIONANDO	 

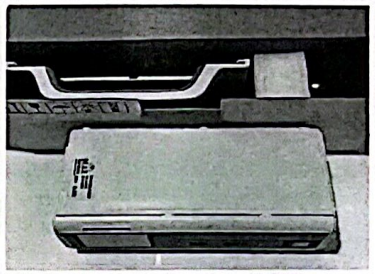
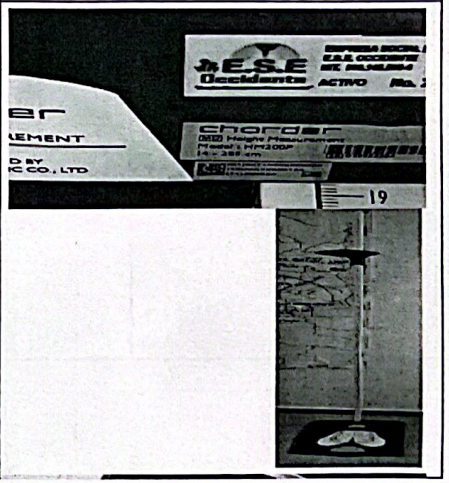
Scanned with CamScanner

UAS Timbiquí - Urgencias	Monitor fetal	1. Pantalla LCD o TFT mínimo de 5" 2. Detector de movimientos fetales 3. Impresora termica incluida 4. Tiempo de trabajo hasta 5 horas 5. Dos (2) Transductores de fetocardia (HFR) 6. Un (1) Toco transductor y Un (1) Detector o marcador de eventos 7. Alarmas visuales y sonoras: frecuencia cardiaca (altas y bajas). 8. Capacidad de almacenamiento de datos. 9. Fuente de alimentacion 100V/240V /60HZ 10. superior a 3 Modos 11. Rango de medicion FC 30bpm -240 bpm	EDAN	F3	560034-M25512430044	FUNCIONANDO Tocotransductor Serie: H2S402350119 Serie toco No 2: H2S402350098	 
UAS Timbiquí - Urgencias	Oxímetro de pulso	1. Uso adulto , pediatrico y neonatal	MINDRAY	PM-60	CR-54288050	FUNCIONANDO	 
UAS Timbiquí - Urgencias	Oxímetro de pulso	2. Rango de Medicion 0-99%	MINDRAY	PM-60	CR-54288048	FUNCIONANDO	 
UAS Timbiquí - Urgencias	Oxímetro de pulso	3. Frecuencia del pulso : 30 -254lpm	MINDRAY	PM-60	CR-54288049	FUNCIONANDO	

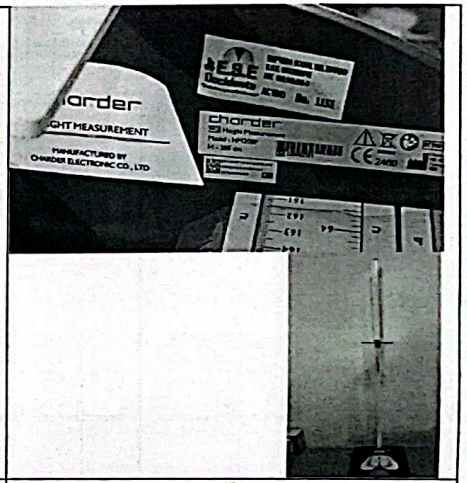
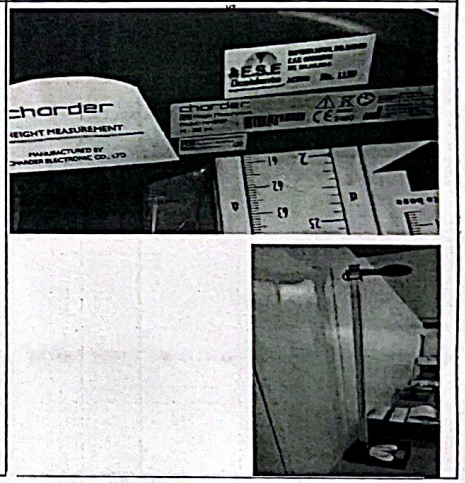
Scanned with CamScanner

UAS Timbiquí - Urgencias	Oxímetro de pulso	4. Precision +- 2%	MINDRAY	PM-60	CR-54288032	FUNCIONANDO	
UAS Timbiquí - Urgencias	Oxímetro de pulso	5. Resolucion 1%	MINDRAY	PM-60	CR-54288035	FUNCIONANDO	 
UAS Timbiquí - Urgencias	Oxímetro de pulso	6. Alarma sonoras y visibles	MINDRAY	PM-60	CR-54288051	FUNCIONANDO	
		7.Soporte para recargar				FUNCIONANDO	
UAS Timbiquí - Urgencias	Bomba de infusión	1. Bomba de infusión volumétrica o con ajuste de volumen	MEDCAPTAIN	MP-60	6052507000428	FUNCIONANDO	 
		2. Con un peso menor a 3 Kg					
		3. Rango de ajuste de volumen o objetivo de volumen a infundir de 0.1 a 9,999 ml					
		4. Exactitud o error de precisión que se encuentre dentro del rango entre -5% y 5%					
		5 Rango de configuración de infusión o rango de flujos entre 0.1 ml/h a 1200 ml/h					
		6. Sensor de burbujas de aire con sensibilidad mayor a 0.025ml					
		7. Con biblioteca o librería de fármacos o librería					

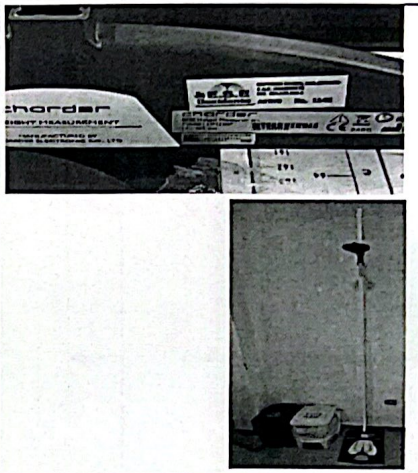
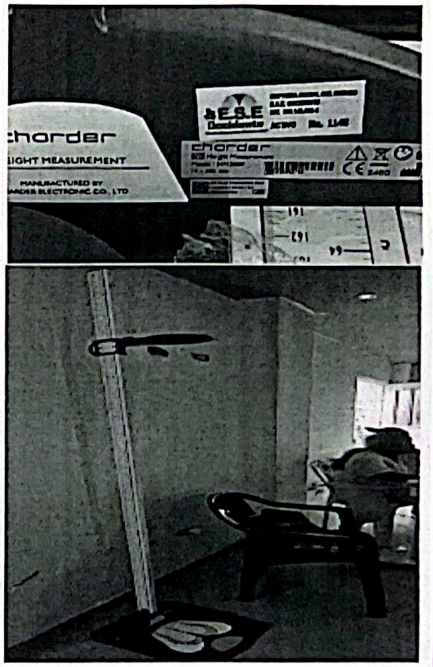
Scanned with CamScanner

UAS Timbiquí - Urgencias	Bomba de infusión	8. Sistema de alarma de oclusión. 9. Sistema de detección de dosis incorrecta o no goteo. 10. Sistema de anti caída de flujo libre o cambio de flujo en tiempo real 11. Requerimiento eléctrico 110V(+/-10%)/60 Hz. 12. Pinza de soporte o estación de trabajo. 13. Pantalla a color de 2 pulgadas mínimo con tecnología TFT 14. Bateria de ion litio recargable con autonomía mínima de 5 horas.	MEDCAPTAIN	MP-60	6052507000342	FUNCIONANDO	
UAS Timbiquí - Consulta externa	Tallímetro análogo para adultos	1. Rango de medición: °/-14 – 205 cm.	CHARDER	HM200P	C25022203	FUNCIONANDO	
UAS Timbiquí - Consulta externa	Tallímetro análogo para adultos	2 División: 1 mm / 1/8"	CHARDER	HM200P	C25022204	FUNCIONANDO	

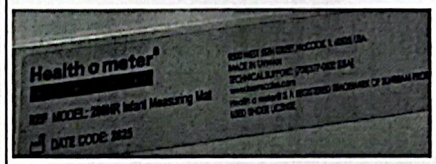
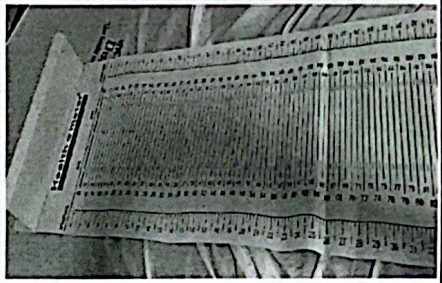
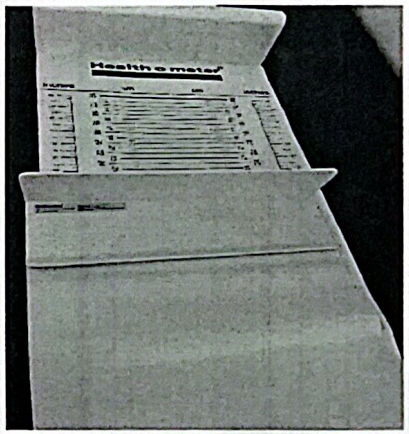
Scanned with CamScanner

UAS Timbiquí - Consulta externa	Tallímetro análogo para adultos	3. Portable, fácil de instalar , con maletin de transporte	CHARDER	HM200P	C25022761	FUNCIONANDO	
UAS Timbiquí - Consulta externa	Tallímetro análogo para adultos		CHARDER	HM200P	C25022762	FUNCIONANDO	

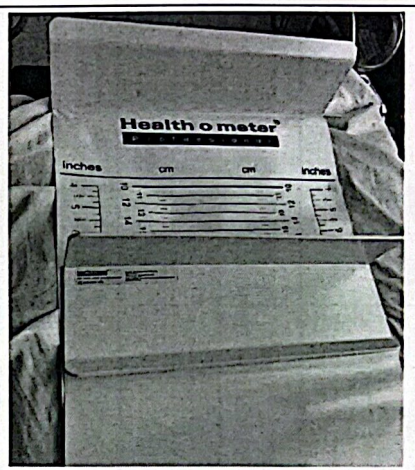
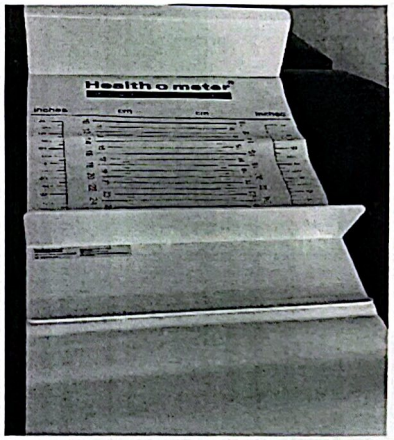
Scanned with CamScanner

UAS Timbiquí - Consulta externa	Tallímetro análogo para adultos	4. Con base de piso	CHARDER	HM200P	C25022759	FUNCIONANDO	
UAS Timbiquí - Consulta externa	Tallímetro análogo para adultos		CHARDER	HM200P	C25022760	FUNCIONANDO	

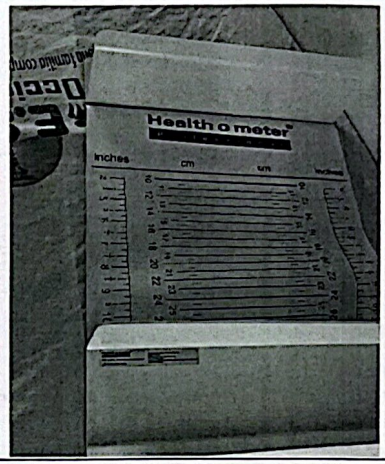
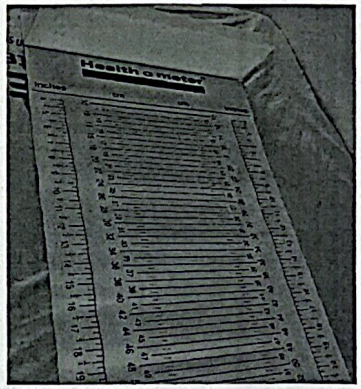
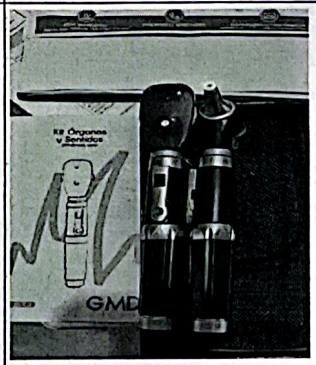
Scanned with CamScanner

S Timbiquí - Consulta externa Cons N	Infantómetro	1. Plegable	HEALTH O METER	280HR	NO REGISTRA	FUNCIONANDO	 
S Timbiquí - Consulta externa Cons N	Infantómetro	2. Alcance de medición: 10 – 100 cm,	HEALTH O METER	280HR	NO REGISTRA	FUNCIONANDO	

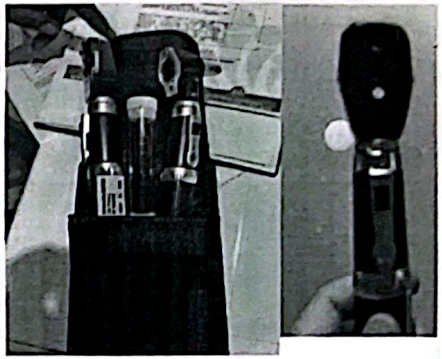
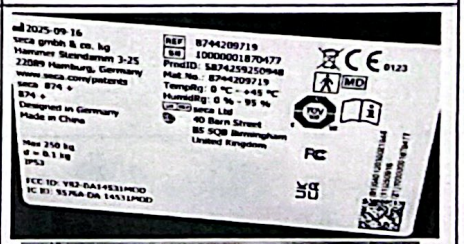
Scanned with CamScanner

AS Timbiquí - Consulta externa Cons I	Infantómetro	3. Division : menor o igual a 5mm	HEALTH O METER	280HR	NO REGISTRA	FUNCIONANDO	
UAS Timbiquí - Consulta externa	Infantómetro	4 Peso: 1.6 kg / 3.5 lbs	HEALTH O METER	280HR	NO REGISTRA	FUNCIONANDO	

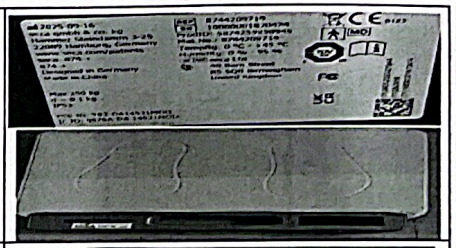
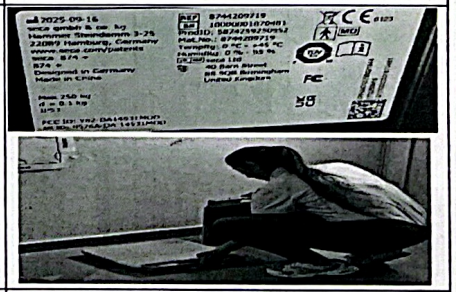
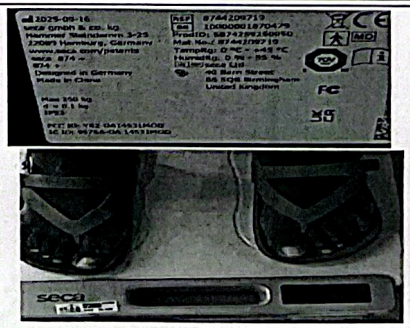
Scanned with CamScanner

UAS Timbiquí - Consulta externa	Infantómetro	5. incluye maletin	HEALTH O METER	280HR	NO REGISTRA	FUNCIONANDO	
UAS Timbiquí - Consulta externa	Infantómetro		HEALTH O METER	280HR	NO REGISTRA	FUNCIONANDO	
UAS Timbiquí - Consulta externa	Equipo de órganos portatil	1. Equipo Manual com estuche 2. Tipo de iluminacion otoscopio : Fibra Optica 3. Aumento de imagen 3x	GMD	LOS-2TF-100	NO REGISTRo - ACTIVI FIJO: 109	FUNCIONANDO	

Scanned with CamScanner

UAS Timbiquí - Consulta externa	Equipo de órganos portatil	4. Alimentación con Baterias AA 5. Luz LED Oftalmoscopio	GMD	LOS-2TF-100	NO REGISTRA- ACTIVI FIJO 109	FUNCIONANDO	
UAS Timbiquí - Consulta externa	Equipo de órganos portatil	6. Luz LED Otoscopio 7. Bases independientes 8. Aperturas diferentes igual o mayor a 5	GMD	LOS-2TF-100	NO REGISTRA -ACTIVO FIJO 110	FUNCIONANDO	
UAS Timbiquí - Consulta externa	Báscula grado médico	1. Capacidad de pesaje mayor o igual 200 Kg o superior.	SECA	874+	10000001870477	FUNCIONANDO	 

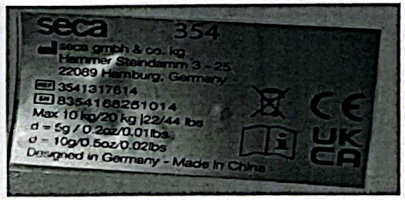
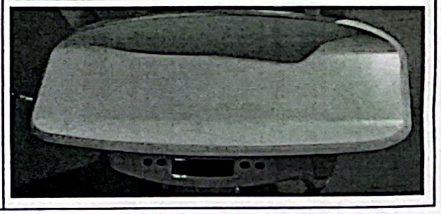
Scanned with CamScanner

UAS Timbiquí - Consulta externa	Báscula grado médico	2. Funcionamiento con baterías y adaptador de voltaje	SECA	874+	10000001870474	FUNCIONANDO	
UAS Timbiquí - Consulta externa	Báscula grado médico	3. Funcion de pesaje madre /hijo	SECA	874+	10000001870470	FUNCIONANDO	
UAS Timbiquí - Consulta externa	Báscula grado médico	4. Pantalla visualización de datos.	SECA	874+	10000001870481	FUNCIONANDO	
UAS Timbiquí - Consulta externa	Báscula grado médico	5. Tara	SECA	874+	10000001870479	FUNCIONANDO	

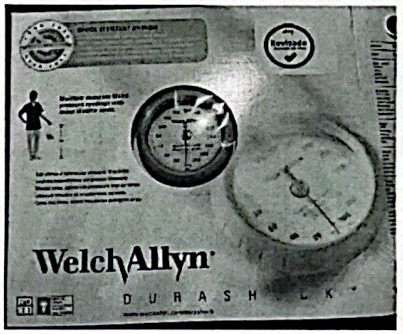
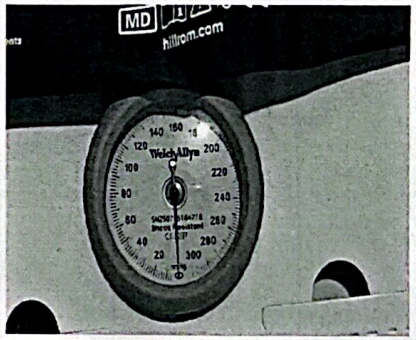
Scanned with CamScanner

UAS Timbiquí - Consulta externa	Báscula grado médico	6. Retencion en pantalla de datos y borrado	SECA	874+	10000001870471	FUNCIONANDO	
UAS Timbiquí - Consulta externa	Báscula pediátrica	1. Pesa bebe electronica o digital	SECA	354	8354329230720	FUNCIONANDO	
UAS Timbiquí - Consulta externa	Báscula pediátrica	2. Con pantalla de lectura o indicador incrustado	SECA	354	8354237230099	FUNCIONANDO	

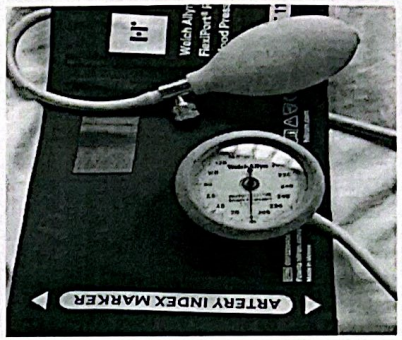
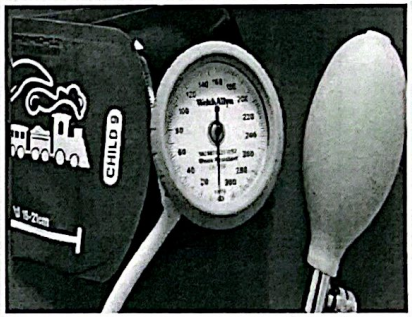
Scanned with CamScanner

UAS Timbiquí - Consulta externa	Báscula pediátrica	3. Capacidad de 20kg o superior.	SECA	354	8354168251014	FUNCIONANDO	 
UAS Timbiquí - Consulta externa	Báscula pediátrica	4. Escala de peso graduada en kilos y libras	SECA	354	8354168250911	FUNCIONANDO	 
UAS Timbiquí - Consulta externa	Báscula pediátrica	5. Función de Tara , auto Hold	SECA	354	8354168251184	FUNCIONANDO	 

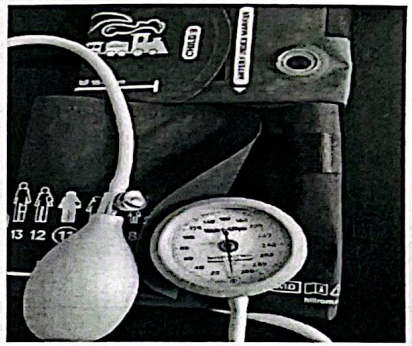
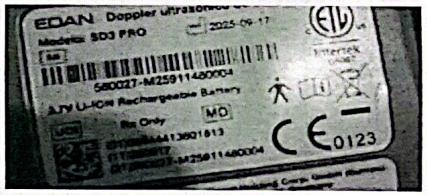
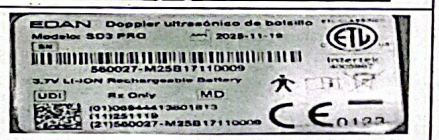
Scanned with CamScanner

UAS Timbiquí - Consulta externa	Báscula pediátrica	6. Alimentación con batería	SECA	354	8354168251185	FUNCIONANDO	
UAS Timbiquí - Consulta externa	Tensiómetro	1. Tensiómetro con brazalete adulto	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS44-11C	25071515213429	FUNCIONANDO	
UAS Timbiquí - Consulta externa	Tensiómetro	2. Rango : 0 -300 Mmhg	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS44-11C	2507151664718	FUNCIONANDO	

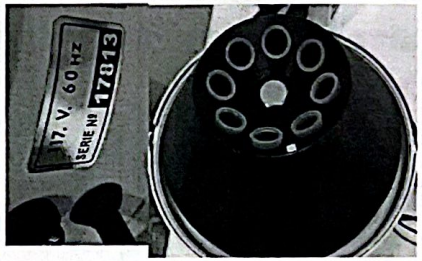

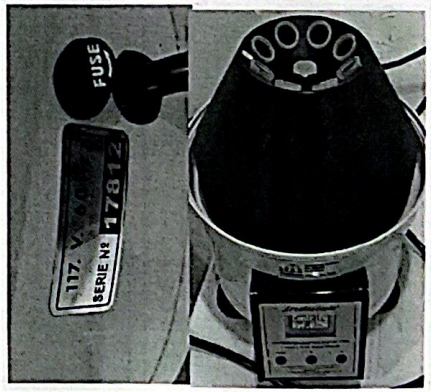
Scanned with CamScanner

UAS Timbiquí - Consulta externa	Tensiómetro	3. Intervalos : 10 Mmhg	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS44-11C	2507151221708	FUNCIONANDO	
UAS Timbiquí - Consulta externa	Tensiómetro	4. Resolucion : 2 Mmhg	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS44-11C	2507151211257	FUNCIONANDO	
UAS Timbiquí - Consulta externa	Tensiómetro	5. carcasa de proteccion	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS44-11C	250716000948	FUNCIONANDO	

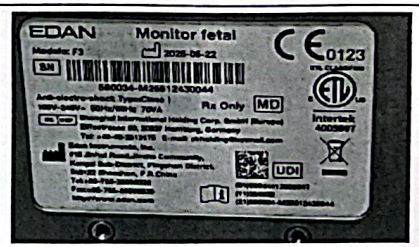
Scanned with CamScanner

UAS Timbiquí - Consulta externa	Tensiómetro	6. exactitud +/- 3 Mmhg	WELCH ALLYN	DURASHOCK DS44-11C	250715232437	FUNCIONANDO	
UAS Timbiquí - Consulta externa	Doppler fetal	1. Pantalla OLED o LCD o TFT	EDAN	SD3 PRO	S60027-M25911480002	FUNCIONANDO	
UAS Timbiquí - Consulta externa	Doppler fetal	2. Rango de latidos cardiacos fetales: +/- 60 - 210 o mayor lpm.	EDAN	SD3 PRO	S60027-M25911480004	FUNCIONANDO	 
		3. Rango de potencia de salida de audio: 0,5W - 2W					

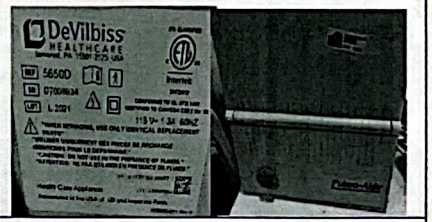
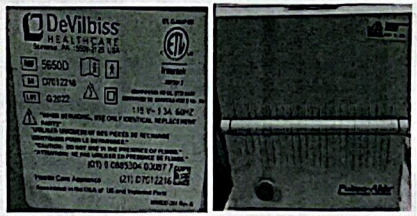
Scanned with CamScanner

UAS Timbiquí - Consulta externa	Doppler fetal	4. Frecuencia mínima de 2MHz. 5. Batería	EDAN	SD3 PRO	S60027-M25817110009	FUNCIONANDO	
UAS Timbiquí - Laboratorio clínico	Centrífuga de 8 tubos	1. Centrifuga Digital	INDULAB	035A	17813	FUNCIONANDO	
UAS Timbiquí - Laboratorio clínico	Centrífuga de 8 tubos	2. Temporizador entre 0- 99 minutos	INDULAB	035A	17814	FUNCIONANDO	 
UAS Timbiquí - Laboratorio clínico	Centrífuga de 8 tubos	3. Rango de velocidad entre 1000 - 3500 rpm 4. Fuente de Alimentacion 110V/220V 5. Capacidad Total 8 tubos	INDULAB	035A	17812	FUNCIONANDO	

Scanned with CamScanner

UAS López de Micay - Urgencias	Monitor fetal	1. Pantalla LCD o TFT mínimo de 5" 2. Detector de movimientos fetales 3. Impresora termica incluida 4. Tiempo de trabajo hasta 5 horas 5. Dos (2) Transductores de fetocardia (HFR) 6. Un (1) Toco transductor y Un (1) Detector o marcador de eventos 7. Alarmas visuales y sonoras: frecuencia cardiaca (altas y bajas). 8. Capacidad de almacenamiento de datos. 9. Fuente de alimentacion 100V/240V /60HZ 10. superior a 3 Modos 11. Rango de medicion FC 30bpm -240 bpm	EDAN	F3	560034-M25512430044	FUNCIONANDO Tocotransductor Serie: H2S4023S0098 Serie toco No 2: H2S4023S0119	 
UAS López de Micay - Urgencias	Monitor de signos vitales	1. Pantalla TFT , LED o LCD de 7" o superior 2. Opción para tomar la presión de manera manual y automatico 3. Batería recargable 4 Cable ECG de 3 o 5 derivaciones 5 Medicion de Saturación de oxígeno: 0 100%, 6 Rango de Frecuencia respiratoria: 0 120 rpm en adulto y 0 150 rpm en naciente pediatrico / neonatal 7 Rango de Frecuencia cardiaca: 25 -250 lpm, con resolución mínima de ± 1 lpm	EDAN	X12	261594-M25B18540027	FUNCIONANDO	
UAS López de Micay - Urgencias	Monitor de signos vitales	8. Rango de Temperatura corporal: 0 50°C 9 Rango de medicion de Presión no invasiva: Adulto 40 o menor a 260mmHg o mayor, Pediátrico 40 o menor a 230mmHg o mayor 10. Indicador de alarmas 11. Voltaje de alimentacion: 100 240V 50/60 Hz.	EDAN	X12	261594-M25B18440067	FUNCIONANDO	
		12. Accesorios para: Monitoreo de ECG, Saturación de oxígeno x2 (SpO2) uno adulto y uno pediatrico, Presión no invasiva (NIBP) manguera x1 y brazaletes x2 (uno adulto y uno pediatrico), Sensor de Temperatura corporal de piel x 2.					

Scanned with CamScanner

UAS López de Micay - Urgencias	Monitor de signos vitales	13. Carro de trasporte	EDAN	X12	261594-M25818440074	FUNCIONANDO	
UAS López de Micay - Urgencias	Nebulizador	Flujo De Aire mayor o igual a 9 Lpm	DEVILBISS	5650D	D7012253	FUNCIONANDO	
UAS López de Micay - Urgencias	Nebulizador	Nivel De Sonido menor o igual a 57 Dba Condiciones Eléctricas: 110 a 115v	DEVILBISS	5650D	D7008934	FUNCIONANDO	
UAS López de Micay - Urgencias	Nebulizador	Presión Máxima Del Compresor mayor a igual a 11 Psi	DEVILBISS	5650D	D7012216	FUNCIONANDO	

Lista de chequeo documentacion

Documento	Presenta a conformidad	Presenta con observaciones	No presenta	Descripción
1.Factura (s) Electrónica de venta.	X			La E.S.E OCCIDENTE, presenta a conformidad: - Factura FEV 49 emitida el 26/11/2025 por INGENIERÍA Y SOLUCIONES MEDICAS SAS; NIT : 901447421-5; valor total =$300,000,000.00 N°Equipos facturados : 79
2. Acta de entrega de dotación por parte del proveedor.	X			La E.S.E OCCIDENTE, presenta a conformidad: - Actas de entregas suministrada por ingeniería y soluciones medicas SAS relacionando 79 equipos, Fecha de entrega 23 de Diciembre de 2025.

Scanned with CamScanner

3.Recibo a satisfacción y /o acta de instalación y/o prueba de funcionamiento y/o recepción técnica (si aplica).	X			La E.S.E OCCIDENTE, presenta a conformidad: - Actas de recibido a satisfacción de equipos biomédicos relacionando 79 equipos, dejando constancia de la recepción técnica a satisfacción del contrato 330, Fecha de entrega 26 de diciembre de 2025.
4. Comprobante de entrada o ingreso de la dotación expedido por almacén General o dependencia a cargo.	X			La E.S.E OCCIDENTE, presenta a conformidad: - Certificado de entrada de elementos al almacén número 48 emitido el 26 de diciembre de 2025, relacionando 79 equipos por un valor de $300.000.000
5.Comprobante de entrega o recibo de recepción o asignación de la dotación al servicio asistencial previsto.	X			La E.S.E OCCIDENTE, presenta a conformidad: - Acta de asignación de equipos N°001 emitido el 23 de febrero de 2026, relacionando la entrega al servicio de urgencias de la UAS Lopez de micay de : tres (3) Monitores de signos vitales, tres (3) Nebulizadores, Un (1) Monitor fetal. - Acta de asignación de equipos N°002 emitido el 23 de febrero de 2026, relacionando la entrega al servicio de odontología de la UAS Timbiqui de : seis (6) Escaler, seis (6) Lampara de fotocurado, seis (6) Kit Odontologico, seis (6) Unidades odontologica portatil. - Acta de asignación de equipos N°003 emitido el 23 de febrero de 2026, relacionando la entrega al servicio de consulta externa de la UAS Timbiqui de : seis (6) Tallímetro, seis (6) Infantómetro, tres (3) Equipo de organos portatil, seis (6) Bascula grado medico, seis (6) Bascula pediatrica, seis (6) tensiómetros, tres (3) doppler fetal. - Acta de asignación de equipos N°004 emitido el 23 de febrero de 2026, relacionando la entrega al servicio de urgencias de la UAS Timbiqui de : seis (6) Oximetro de pulso, dos (2) Bomba de infusión, Un (1) Monitor fetal. - Acta de asignación de equipos N°005 emitido el 23 de febrero de 2026, relacionando la entrega al servicio de Laboratorio Clinico de la UAS Timbiqui de : tres (3) Centrifuga de 8 tubos.
6. Garantía De la Dotación	X			se evidencia certificado de garantía definiendo los términos y excepciones establecidos por una vigencia de un (1) Año a partir de la fecha de entrega de los bienes adquiridos.
7. Hoja de vida de los equipos Biomédicos	X			La E.S.E Occidente aporta fichas técnicas correspondientes a las hojas de vida de los equipos biomédicos de acuerdo a los procedimientos de clasificación institucionales.
8. Capacitación en el uso y manejo de la dotación (adjuntar lista de asistencia)	X			La E.S.E OCCIDENTE. Presenta acta de capacitación efectuada el dia 17-02-2026, refiriendo como asunto Capacitación en uso y manejo de equipos biomédicos de los servicios consulta externa odontológicos, urgencias y hospitalización. además complementa con acta de asistencia, documentos entregados a conformidad

Scanned with CamScanner

9. Certificado de comercialización de la dotación - declaración de importación de la dotación	X			La E.S.E OCCIDENTE, presenta a los documentos asociados a la declaración de importación y conceptos de no aplica de la dotación adquirida en el convenio interadministrativo. documentos entregados a conformidad
10.Registro Sanitario de la dotación	X			La E.S.E OCCIDENTE, presenta a conformidad los registros sanitarios de la dotación y conceptos de no aplica de la dotación adquirida en el convenio interadministrativo.

OBSERVACIONES GENERALES

RESPONSABLES DE DILIGENCIAMIENTO		
PROCESO GPSI -DIT	NOMBRE	Daniel Felipe Maya Villarreal
	CARGO	Profesional de apoyo - Ingeniero Biomedico
	FIRMA	
PROCESO GPSI -DIT	NOMBRE	Maria Fernanda Ordoñez A
	CARGO	Profesional de apoyo - Ingeniero Biomedica
	FIRMA	

Scanned with CamScanner