Medición con Calidad	**CALIDAD Y METROLOGIA LAS AMÉRICAS** **Nit. 1017156848-1**	***Código***	*PM-MCAL-01*
		Versión	*1.0*
		Fecha	*2017-05-20*
		N° De Orden de Servicio	
	calmet.metrologia@gmail.com - www.calmetamericas.com	***MNCF-0593***	
	Cel . 321 832 9545; 314 579 9954		
	Cra 16 #35-48;Medellín-Colombia		

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

CLIENTE:	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS			**SEDE:**	PRINCIPAL
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO ANT.				
EQUIPO:	REFRIGERADOR	**MODELO:**	VL350 GREENLINE	**PLACA INVEN:**	381
MARCA:	VESTFROST	**SERIE:**	20150766729	**UBICACIÓN:**	VACUNACIÓN

TIPO DE MANTENIMIENTO:

PREVENTIVO:	**X**	**CORRECTIVO:**		**DIAGNOSTICO:**		**GARANTIA:**	

MODALIDAD DEL SERVICIO:

LOCATIVO:		**DOMICILIO**	X	**CONTRATO:**	**SI:**	**NO:**	

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO

PROTOCOLO	**CUMPLE**	
	SI	**NO**
Antes de proceder a realizar el aseo,Comunicar un adia antes a la entidad guarde los inmunobiológicos en un termo o caja térmica bien rodeados de paquetes refrigerantes de acuerdo a las normas de la cadena de frio ó manual de PAI	X	
Desconectar la nevera sin previa manipulación del termostato	X	
Apague el estabilizador de voltaje y desconéctelo	X	
Abra el grifo o tapón de desagüe que se encuentra en el fondo del refrigerador y ubique un Recipiente plano debajo del mismo para que se reciba el agua.	X	
Mantenga la tapa del refrigerador abierta	X	
Limpie el interior del refrigerador con agua tibia y un detergente suave que no tenga hipoclorito	X	
Revisar motor y sistema eléctrico, estado fisico, estado de pintura, capilar, ductos refrigerantes, ventilador si tiene y desagüe	X	
Revisar cable de poder y enchufe eléctrico	X	
Revisar y/o corregir nivelación del motor	X	
Revisar integridad de la pintura del motor	X	
Revisar estado de los tornillos y bases	X	
Realizar limpieza del motor con una escobilla o un paño limpio y seco	X	
Revisar paneles de la caba interior y los tarros de agua destilada	X	
Revisar puerta de seguridad, visagras, rodachines, manija y Empaque	X	
Revisar la nivelacion de la puerta Y Soportes en cada lado. Para asegurar hermeticidad.	X	
Inspeccionar sistema de control(termostato, display, sensor de temperatura y bateria)	X	
Realizar limpieza exterior con paño suave y verificar estado de pintura.	X	
Secar cada parte del refrigerador muy bien, colocar el tapón o grifo en su ugar y conectar el equipo al suministro eléctrico	X	
Ubicar el equipo a una distancia entre 15 a 20 cms de la pared para favorecer la ventilación y enfriamiento adecuados	X	
Posterior a la limpieza y desinfección, se confirma la adecuada temperatura de las mismas para regresar los inmunobiológicos a ellas.	X	

Verirficacion del motor AC:	Amperaje	1,12A	
Verificar la temperatura de cadena de frio con patrones adecuados como minimo en 6 puntos diferentes o según sea el Volumen de la Nevera.		X	

OBSERVACIONES:

SE AJUSTA CONTROLADOR DE TEMPERATURA YA QUE LA MINIMA MARCA EN LA NOCHE Y MADRUGADA POR DEBAJO DE 2°C.

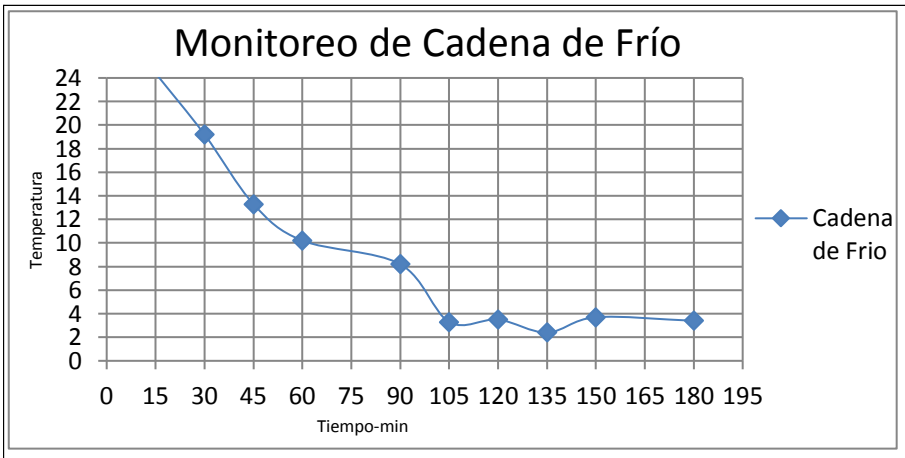

Tiempo(min)	Temperatura °C
15	24,4
30	19,2
45	13,3
60	10,2
90	8,2
105	3,3
120	3,5
135	2,4
150	3,7
180	3,4

RECOMENDACIONES:

NINGUNA

Fecha de Mantenimiento:	14/05/2026	**Ejecutó:**	Ing. Andres Felipe Restrepo Muñoz
Recibe:		**Cargo:**	Ingenieria