


MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA ACTA DE VERIFICACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA EMPRESAS DE QUE IMPLEMENTAN EL DEA EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA						ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA SECRETARIA LOCAL DE SALUD	
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO							
Nombre o razón social:	COLEGIO INTEGRADO LOS ANDES	Dirección:	CL 42 4 47				
Representante legal:	FABIO ALEXANDER LOPEZ	Correo electrónico:	ciandes@hotmail.com				
Recibe la auditoria:	MAIRA JOSE RODRIGUEZ	Teléfono:	3176200702				
Cargo/perfil:	COORDINADORA	Fecha: (D/M/A)	14 DE ABRIL DE 2026				
DATOS DE LA VERIFICACIÓN / AUDITORÍA							
Normas de referencia:	-Ley 1831 del 2017, "Por medio de la cual se reglamenta el uso del desfibrilador externo automático DEA, en transportes de asistencia lugares de alta afluencia de público, y se dictan otras disposiciones". -Decreto 1465 del 2019, "Por el cual se adiciona el Título 13 a la Parte 8 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 en relación con los Desfibriladores Externos Automáticos". -Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social. -Decreto 4725 del 2005, "Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano". -Resolución 3316 del 2019, "Por la cual se establecen disposiciones para el uso del Desfibrilador Externo Automático -DEA". -Resolución 4816 del 2008, "Por la cual se reglamenta el programa nacional de tecnovigilancia".						
DATOS DE LOS DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATICOS (DEA)							
MARCA	MODELO	SERIE		UBICACIÓN			

DOTACION ADICIONAL	23	Elementos de protección personal	NA				SE RECOMINDA CONTAR CON CLOREXIDINA, TERMOMETRO INFRARROJO, TIJERAS DE TRAUMA, LINTERNA RECARGABLE, SOLUCION SALINA 2 UNIDADES, GUANTES LIMPIOS 5 PARES, GUANETES ESTERILES 1 PAR, TAPABOCAS 5 UNIDADES, BAJALENGUAS PQ POR 3 O 5 UNIDADES, TAPABOCAS N95 2 UNIDADES, GAFAS DE SEGURIDAD, GASAS 10 UNIDADES Y VENDAS DE ALGODON Y ELASTICAS DE 2*5, 3*5, 5*5, ESPERADRAPO, ALCOHOL, MICROPORE Y TERMOHIGROMETRO CON REGISTRO DIARIO DE TEMPERATURA Y HUMENDAD, INVENTARIO CON FECHAS DE VENCIMIENTOS
	24	Dispositivo de barrera para ventilación boca a boca	NA				
	25	Rasuradoras	NA				
	26	Vendajes	NA				
	27	Apósitos para el manejo de heridas	NA				
	28	Dispositivos para la inmovilización de extremidades	NA				
ENTRENAMIENTO	29	A numero plural de colaboradores, mínimo una vez por año del personal	NA				
	30	Enfocando en los primeros tres (3) eslabones de la cadena de supervivencia, a saber: i) Reconocimiento y activación del sistema de respuesta de emergencias ii) Reanimación cardiopulmonar - RCP de calidad inmediata iii) Desfibrilación rápida	NA				SE DEBE REALIZAR 1 VEZ POR AÑO
	31	Certificado de asistencia vigente en "Primer Respondiente" (solo para personal que no sea talento humano en salud) con duración mínima de ocho (8) horas, El componente teórico podrá desarrollarse en modalidad presencial o virtual y el componente práctico debe ser presencial de no menos de (4) horas.	NA				SE DEBE REALIZAR 1 VEZ POR AÑO
	32	Certificado vigente en "Soporte vital básico" o "Soporte vital avanzado" (solo para talento humano en salud)	NA				
SEÑALIZACIÓN	33	Símbolo internacional del DEA, del ILCOR (International Liaison Committe on Resuscitation), cuadrado verde con símbolo blanco, según la norma ISO 7010 para señales y modelos de seguridad o su equivalente nacional	NA				
UBICACIÓN	34	Disponer de información gráfica (planos y mapas informativos del lugar) que permita conocer la ubicación de los DEA instalados en el sitio	NA				
	35	Disponer de los protocolos de uso CADENA DE SUPERVIVENCIA	NA				
	36	Disponer de acceso a un sistema de comunicación que permita la activación de la cadena de supervivencia y de los servicios de emergencia	NA				
	37	Contar con la señalización necesaria, de fácil visualización y acceso, libre de obstáculos y protegido del deterioro por factores ambientales	NA				
	38	Ubicar en los sitios de mayor circulación o estancia de personas	NA				
DOCUMENTACIÓN	39	Disponer en el sitio donde esté instalado el DEA de una guía rápida de instrucciones de uso, de acuerdo con las recomendaciones de uso del manual de instrucciones suministrado por el fabricante o importador	NA				
	40	Contar con la hoja de vida de cada equipo, la cual deberá contener la marca, modelo, número de serie, número del permiso de comercialización, nombre del fabricante, nombre del importador	NA				
	41	Contar con el cronograma y soportes del mantenimiento preventivo o correctivo de acuerdo con las especificaciones establecidas por el fabricante en el manual de instrucciones	NA				SE DEBE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1 VEZ AL AÑO
	42	Manual de operación en idioma español	NA				
	43	Dicha documentación deberá estar a disposición de la autoridad sanitaria de la jurisdicción donde se encuentre el equipo, cuando esta sea requerida	NA				
	44	Protocolo de DEA actualizado para la disponibilidad necesaria (geográfica, por factores de emergencia y riesgo de los DEA)	NA				


SIMULACRO	45	Mínimo 1 vez al año	NA				
	46	Procedimiento para simulacro que contenga:	NA				
	47	Se debe contemplar la verificación del procedimiento y protocolo	NA				
	48	Se debe verificar el personal entrenado	NA				
	49	Se debe verificar la disponibilidad y acceso del DEA	NA				
	50	Se debe verificar la operación para el uso de los DEA	NA				
	51	En los ejercicios de simulacro se deben incorporar los siguientes tres (3) pasos iniciales de la cadena de supervivencia: a. Reconocimiento y activación del sistema de respuesta de emergencias b. Reanimación Cardiopulmonar - RCP de calidad inmediata c. Desfibrilación rápida	NA				

RESUMEN DE LA VERIFICACIÓN / AUDITORIA						
TOTAL		0	0	0	0	SERIES DE LOS DEA
Cumple	0	0	0	0	0	CUMPLE
No Cumple	0	0	0	0	0	NO CUMPLE
No Aplica	49	51	0	0	0	NO APLICA

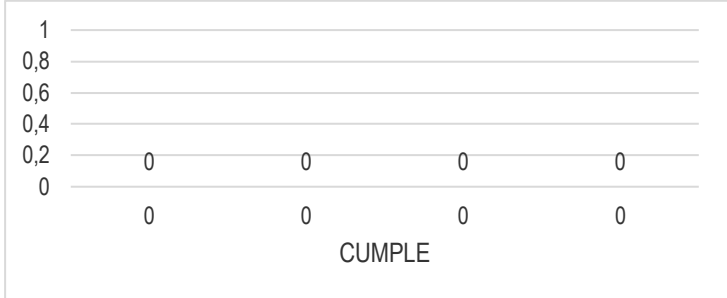


Bar chart showing the distribution of the CUMPLE series. The Y-axis ranges from 0 to 1. The X-axis categories are CUMPLE, NO CUMPLE, and NO APLICA. The values are 0 for CUMPLE, 0 for NO CUMPLE, and 0 for NO APLICA.

Categoría	Valor
CUMPLE	0
NO CUMPLE	0
NO APLICA	0

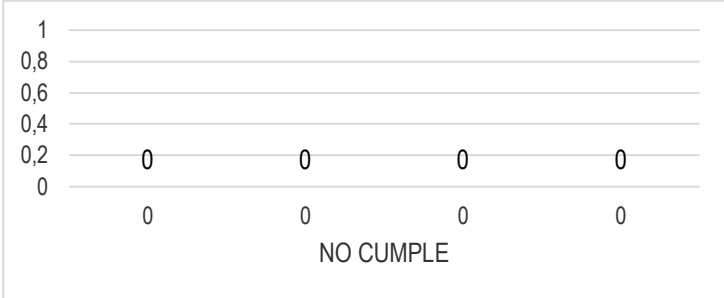

Bar chart showing the distribution of the NO CUMPLE series. The Y-axis ranges from 0 to 1. The X-axis categories are CUMPLE, NO CUMPLE, and NO APLICA. The values are 0 for CUMPLE, 0 for NO CUMPLE, and 0 for NO APLICA.


Categoría	Valor
CUMPLE	0
NO CUMPLE	0
NO APLICA	0

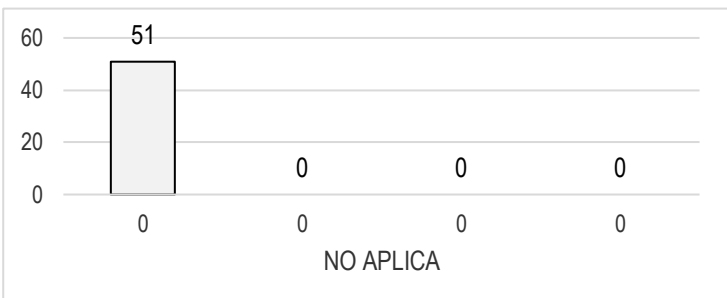

Bar chart showing the distribution of the NO APLICA series. The Y-axis ranges from 0 to 60. The X-axis categories are CUMPLE, NO CUMPLE, and NO APLICA. The values are 51 for CUMPLE, 0 for NO CUMPLE, and 0 for NO APLICA.

Categoría	Valor
CUMPLE	51
NO CUMPLE	0
NO APLICA	0

HALLAZGOS EVIDENCIADOS Y/O RECOMENDACIONES:									
SE SOCIALIZAN LOS FORMATOS Y EL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN A LOS CORREOS DE SEM@FLORIDABLANCA.GOV.CO ZONA PROTEGIDA: NO APLICA PROXIMA VISITA: NO APLICA, LA INSTITUCIÓN COLEGIO INTEGRADO LOS ANDES NO LE APLICAN LOS CRITERIOS EXIGIDOS POR LA NORMA, "instituciones, establecimientos y centros educativos de preescolar, educación básica y media, aforo de 1000 o mas personas" SIENDO TAN SOLO 80 personas									

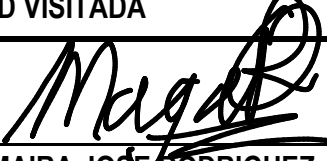FIRMAS DE CIERRE DEL ACTA Y RECIBIDO DE LA INFORMACIÓN									
Leída y aprobada la presente acta, firman quienes intervinieron en la presente diligencia por la secretaria local de salud de Floridablanca y el auditado.									
PROFESIONALES DE LA SECRETARIA LOCAL DE SALUD					FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD VISITADA				
FIRMA:					FIRMA:				
NOMBRE COMPLETO:	JEFFERSSON RODRÍGUEZ				NOMBRE COMPLETO:	MAIRA JOSE RODRIGUEZ			
CARGO / PERFIL:	ING. BIOMÉDICO				CARGO / PERFIL:	COORDINADORA			
CEDULA:	1098708750				CEDULA:	1098720020			
FIRMA:					FIRMA:				
NOMBRE COMPLETO:	LUZ HELENA LOPEZ				NOMBRE COMPLETO:				
CARGO / PERFIL:	PROFESIONAL DE LA SALUD				CARGO / PERFIL:				
CEDULA:	63562796				CEDULA:				