	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC - BACOF

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 12 Año: 2025

CONTRATO N°. 080-02-MDN-CGFMDIGSA-FAC-JEFSA-2025

CONTRATISTA: XINGMEDICAL SAS

VALOR DEL CONTRATO: $ 50.022.900,00

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, en un solo pago total y fecha de pago dentro de los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y sus documentos. Notas: 1. El pago al Contratista se realizará previa resentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana – Jefatura Salud FAC se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. NOTA 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 29. Mes 06. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE USO HOSPITALARIO PARA LA JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONA

CONTRATO MODIFICATORIO No 001

FECHA DE FIRMA: 16/07/2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:
Plazo de ejecución: A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato y la ejecución en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y hasta el 30 de septiembre de 2025.

Modifíquese parcialmente las GARANTÍA Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO, estipulados en la póliza de cumplimiento No: 33-44-101267336, por prórroga y conforme a los SMMLV del año 2025, expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A, actualización así:

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	15.006.870 COP	30/03/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	25.011.450 COP	30/09/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Descripción	Nombre del documento		
Poliza No 101258665-1.pdf	Poliza No 101258665-1.pdf	Descargar	Detalle
Poliza No 101258665-1.pdf	Poliza No 101258665-1.pdf	Descargar	Detalle

Las demás condiciones del contrato permanecen idénticas a las pactadas inicialmente

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 29-06-2025 hasta el 30-09-2025

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: OP: 406124125 de fecha 2025-10-27 03:35:18, por valor de $50,022,900.00

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

No aplica

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí ____.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

No aplica

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

No aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

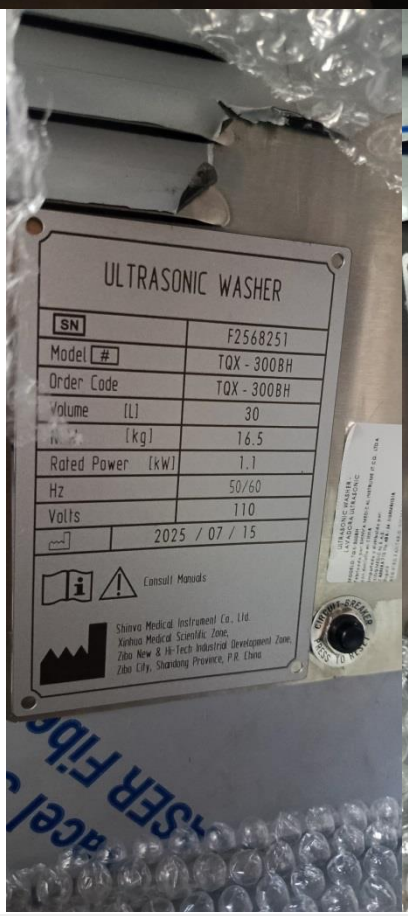
El contratista hace recepción de bienes el día 25-09-2025 de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico así:










ULTRASONIC WASHER
SN
F2568251
Model #
TQX - 300BH
Order Code
TQX - 300BH
Volume [L]
30
[kg]
16.5
Rated Power [kW]
1.1
Hz
50/60
Volts
110
2025 / 07 / 15
Consult Manuals
Shinva Medical Instrument Co., Ltd.
Xinhua Medical Scientific Zone,
Zibo New & Hi-Tech Industrial Development Zone,
Zibo City, Shandong Province, P.R. China


ULTRASONIC WASHER
SN
F2568225
Model #
TQX - 300BH
Order Code
TQX - 300BH
Volume [L]
30
N.W [kg]
16.5
Rated Power [kW]
1.1
Hz
50/60
Volts
110
2025 / 07 / 15
Consult Manuals
Shinva Medical Instrument Co., Ltd.
Xinhua Medical Scientific Zone,
Zibo New & Hi-Tech Industrial Development Zone,
Zibo City, Shandong Province, P.R. China


SHINVA







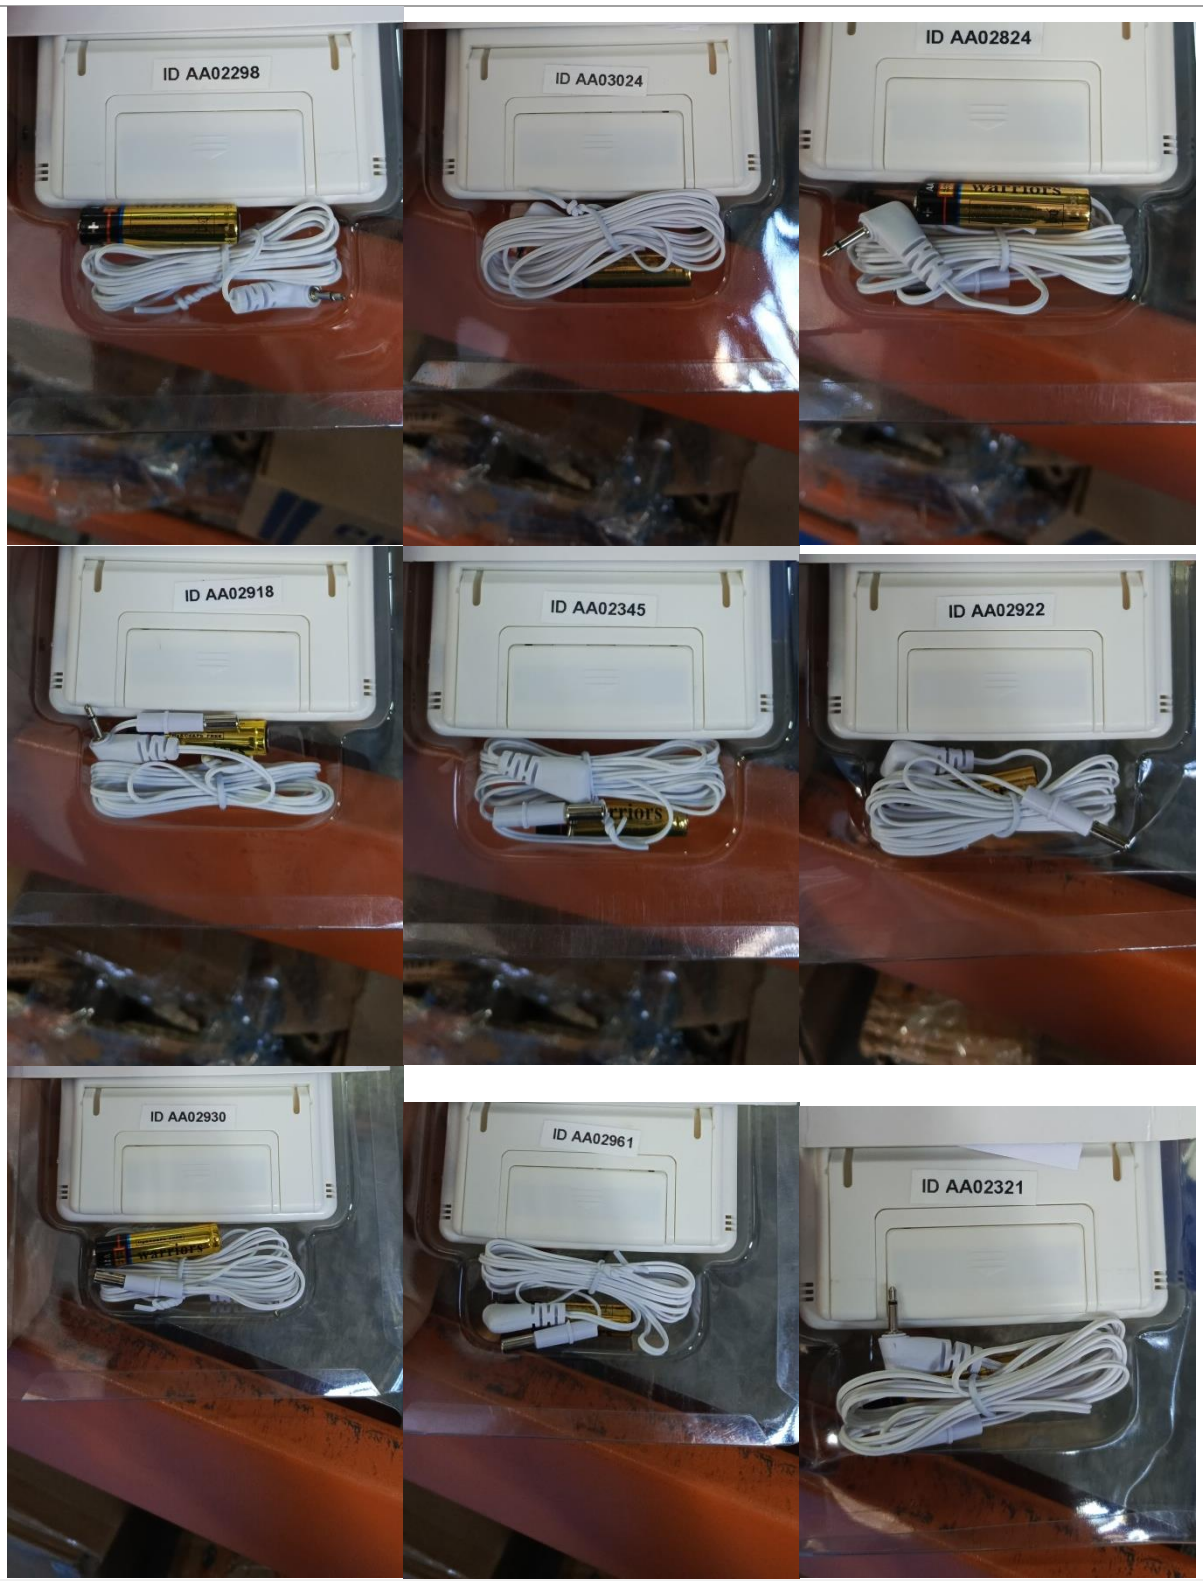
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024







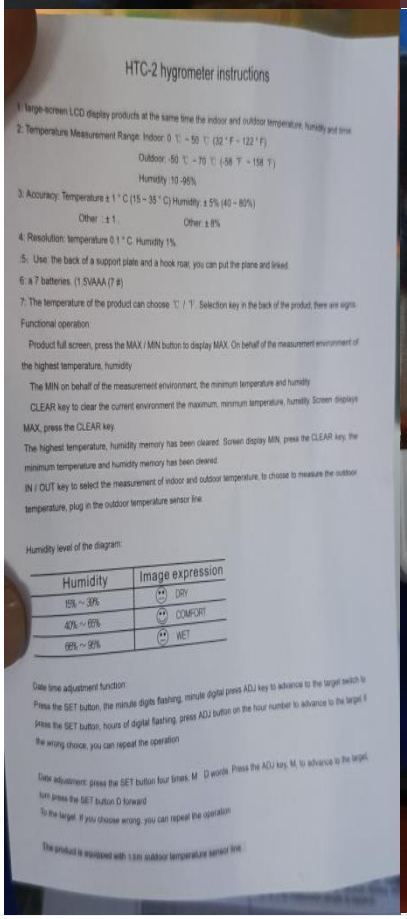

ID AA02732
ID AA02746
ID AA02933
ID AA03010
MADE IN CHINA
ID AA02801
ID AA02948


ID AA02298
ID AA03024
ID AA02824
ID AA02918
ID AA02345
ID AA02922
ID AA02930
ID AA02961
ID AA02321


ID AA02728


MADE IN CHINA
ID AA02412


MADE IN CHINA
ID AA02925


HTC-2 hygrometer instructions
1: large-screen LCD display products at the same time the indoor and outdoor temperature, humidity and time
2: Temperature Measurement Range: Indoor: 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 °F ~ 122 °F)
Outdoor: -50 ℃ ~ 70 ℃ (-58 °F ~ 158 °F)
Humidity :10 -95%
3: Accuracy: Temperature ± 1 ° C (15 ~ 35 ° C) Humidity ± 5% (40 ~ 80%)
Other : ± 1 . Other: ± 8%
4: Resolution: temperature 0.1 ° C. Humidity 1%.
5: Use: the back of a support plate and a hook rear, you can put the plane and linked
6: a 7 batteries. (1.5VAAA (7 #)
7: The temperature of the product can choose '℃ / °F'. Selection key in the back of the product, there are signs
Functional operation
Product full screen, press the MAX / MIN button to display MAX. On behalf of the measurement environment of the highest temperature, humidity
The MIN on behalf of the measurement environment, the minimum temperature and humidity
CLEAR key to clear the current environment the maximum. minimum temperature, humidity Screen displays MAX, press the CLEAR key.
The highest temperature, humidity memory has been cleared. Screen display MIN, press the CLEAR key, the minimum temperature and humidity memory has been cleared
IN / OUT key to select the measurement of indoor and outdoor temperature, to choose to measure the outdoor temperature, plug in the outdoor temperature sensor line
Humidity level of the diagram:
Humidity
Image expression
15% ~ 39%
DRY
40% ~ 65%
COMFORT
66% ~ 95%
WET
Date time adjustment function
Press the SET button, the minute digits flashing, minute digital press ADJ key to advance to the target switch to
Press the SET button, hours of digital flashing, press ADJ button on the hour number to advance to the target, if the wrong choice, you can repeat the operation
Date adjustment: press the SET button four times. M D words. Press the ADJ key, M, to advance to the target, turn press the SET button D forward
To the target. If you choose wrong, you can repeat the operation
The product is equipped with 1.5m outdoor temperature sensor line


TEMPERATURE
IN
12:00
52 %
CALIBRACIÓN No. CV6442
xingmedical
CALIBRACIÓN No. CV6455
xingmedical
IN/OUT
CLEAR


TEMPERATURE
IN
19.2 °C
12:00
54 %
IN/OUT


TEMPERATURE
IN/OUT CLEAR MAX/MIN
TEMPERATURE
TEMPERATURE
IN/OUT CLEAR
TEMPERATURE
IN/OUT CLEAR
TEMPERATURE
IN/OUT


TEMPERATURE
IN/OUT
CLEAR
MAX/MIN
xingmedical

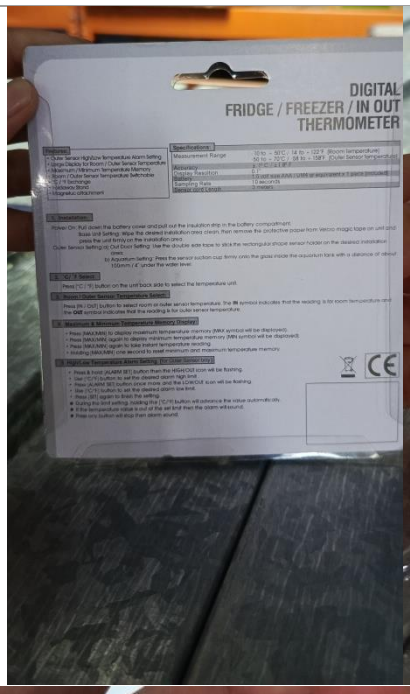

TEMPERATURE
TEMPERATURE
TEMPERATURE
TEMPERATURE
TEMPERATURE
TEMPERATURE


DIGITAL THERMOME
ID AA03421
ID AA03424
ID AA03425
ID AA03426


MAX/MIN
IN/OUT
ALARMSET
20.6°C
-50°C TO+70°C / -58°F TO+ 158°F
DIGITAL THERMOME
ID AA03424


MAX/MIN
IN/OUT
ALARMSET
°C/°F
20.8°C
-50°C TO+70°C / -58°F TO+ 158°F
DIGITAL THERMOME
ID AA03424

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

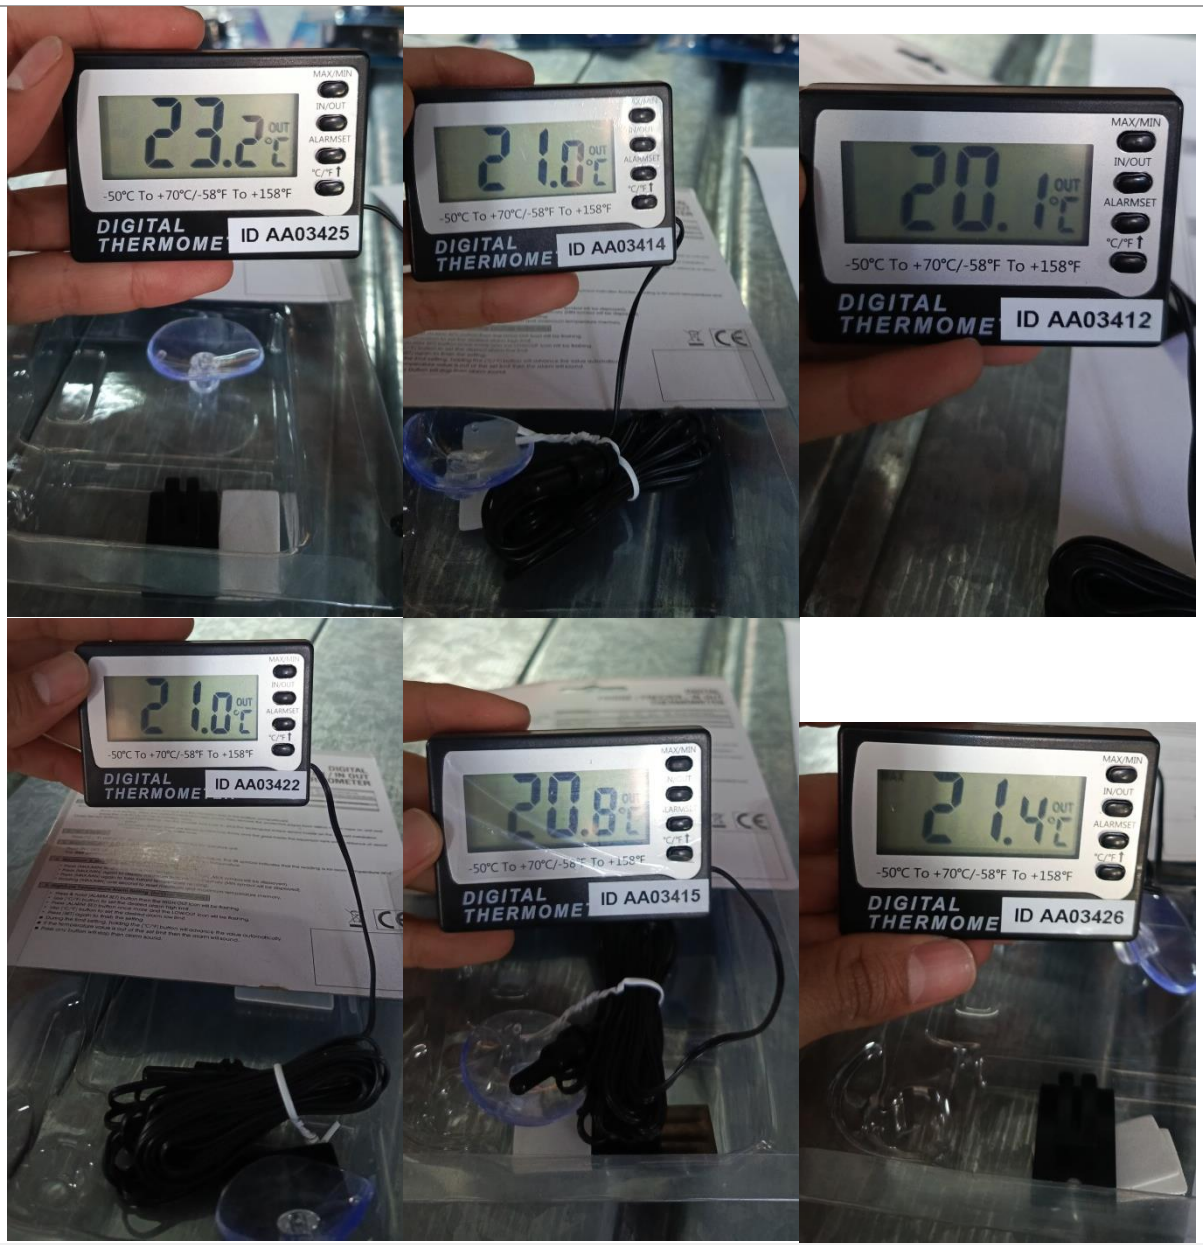


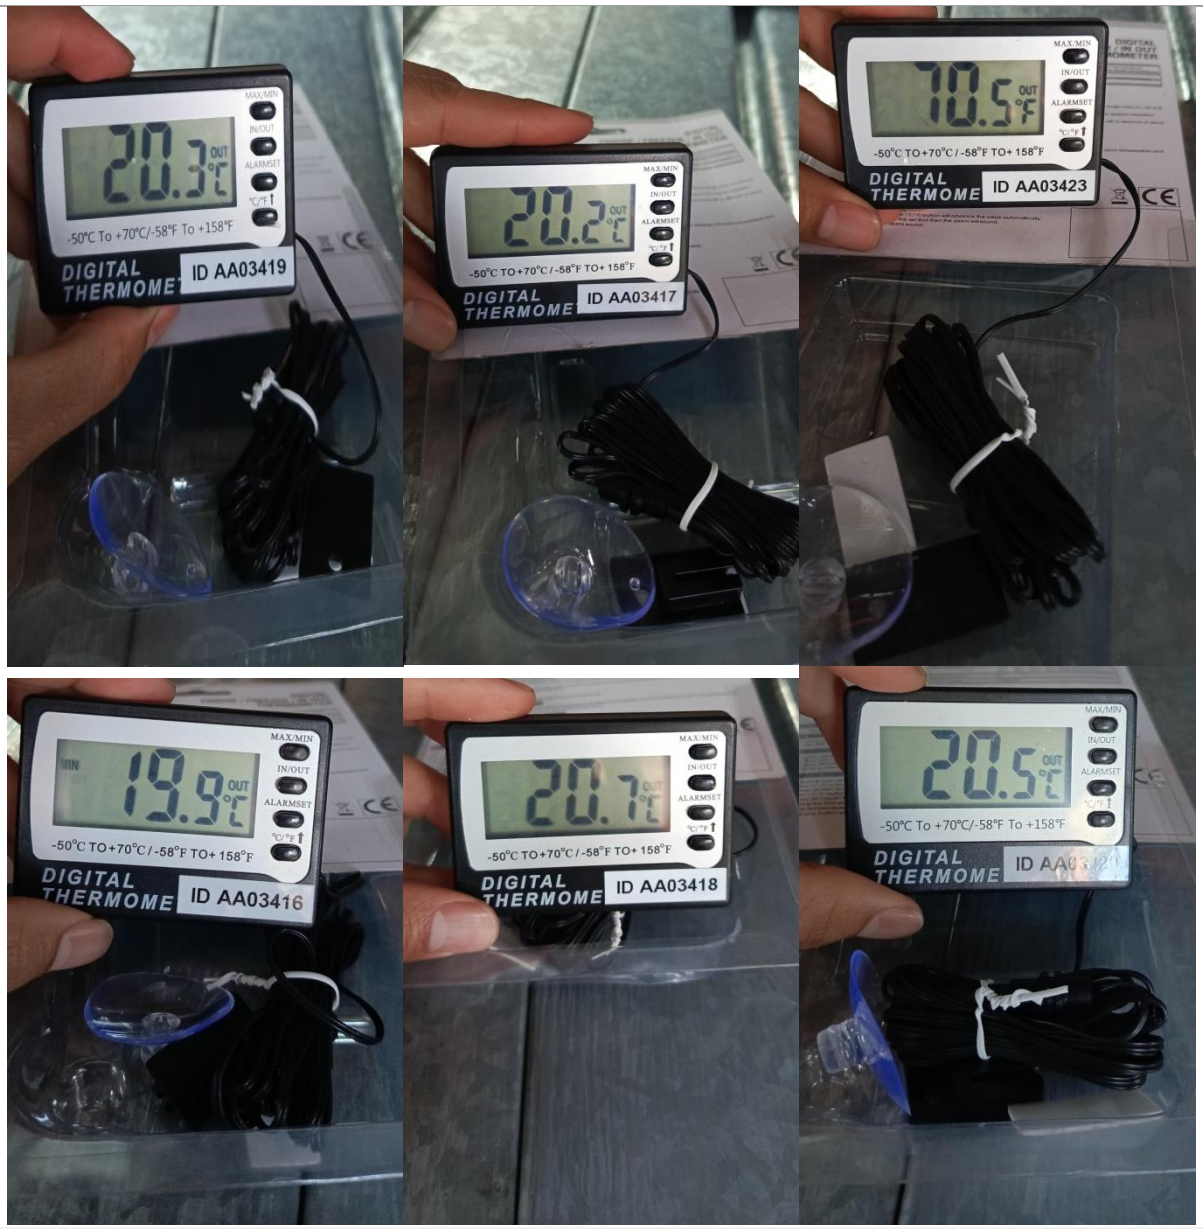








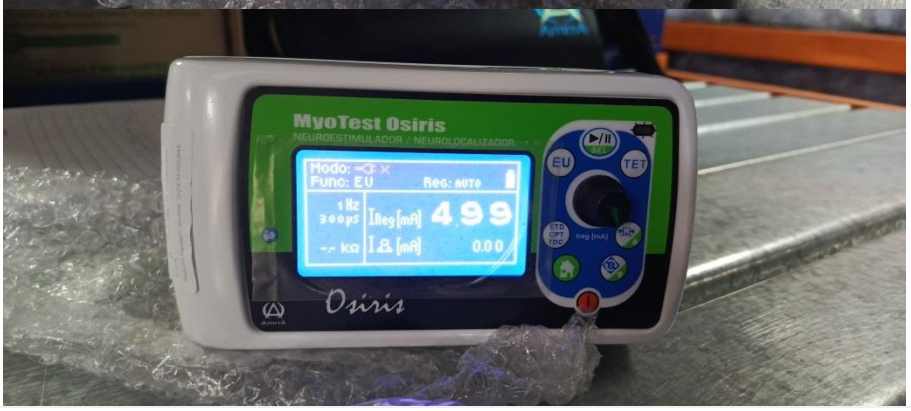

23.2 OUT °C
-50°C To +70°C/-58°F To +158°F
DIGITAL THERMOME
ID AA03425
21.0 OUT °C
-50°C To +70°C/-58°F To +158°F
DIGITAL THERMOME
ID AA03414
MAX/MIN
IN/OUT
ALARMSET
°C/°F
20.1 OUT °C
-50°C To +70°C/-58°F To +158°F
DIGITAL THERMOME
ID AA03412
21.0 OUT °C
-50°C To +70°C/-58°F To +158°F
DIGITAL THERMOME
ID AA03422
20.8 OUT °C
DIGITAL THERMOME
ID AA03415
21.4 OUT °C
-50°C To +70°C/-58°F To +158°F
DIGITAL THERMOME
ID AA03426

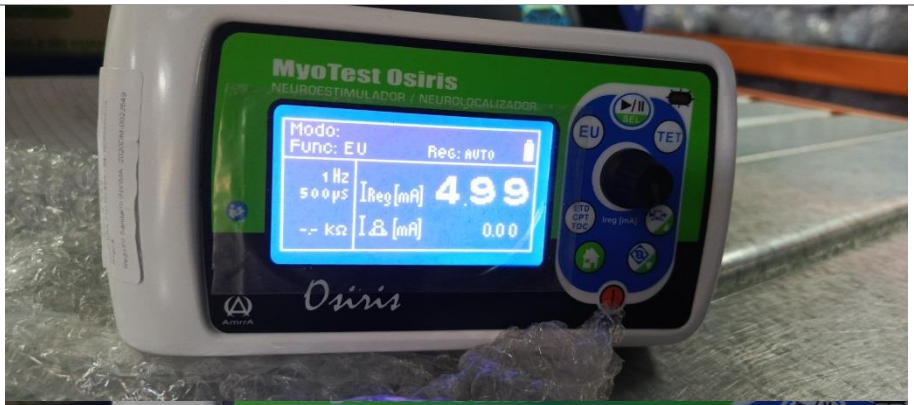

20.3°C
-50°C To +70°C/-58°F To +158°F
DIGITAL THERMOME
ID AA03419
20.2°C
-50°C TO +70°C / -58°F TO+ 158°F
DIGITAL THERMOME
ID AA03417
70.5°F
-50°C TO+70°C / -58°F TO+ 158°F
DIGITAL THERMOME
ID AA03423
19.9°C
-50°C TO+70°C / -58°F TO+ 158°F
DIGITAL THERMOME
ID AA03416
20.7°C
-50°C TO+70°C / -58°F TO+ 158°F
DIGITAL THERMOME
ID AA03418
20.5°C
-50°C To +70°C/-58°F To +158°F
DIGITAL THERMOME


MAX/MIN
IN/OUT
ALARM SET
°C/°F
20.5°C
OUT
-50°C To +70°C/-58°F To +158°F
DIGITAL THERMOME
ID AA03420


MyoTest Osiris
NEUROESTIMULADOR / NEUROLOCALIZADOR
Modo:
Func: EU
Reg: AUTO
1 Hz
1000 µs
Ireg [mA]
500
-.- kΩ
I Δ [mA]
0.00
EU
TET
SEL
Osiris


MyoTest Osiris
Modo:
Func: EU
Reg: AUTO
1 Hz
100 µs
Ireg [mA]
499
-.- kΩ
I Δ [mA]
0.00
EU
TET
Osiris


MyoTest Osiris
NEUROESTIMULADOR / NEUROLOCALIZADOR
Modo:
Func: EU
Reg: AUTO
1 Hz
300 µs
Ireg [mA]
499
-.- kΩ
I Δ [mA]
0.00
EU
TET
Osiris


MyoTest Osiris
NEUROESTIMULADOR / NEUROLOCALIZADOR
Modo:
Func: EU
Reg: AUTO
1 Hz
500 µs
-.- kΩ
Ireg [mA]
4.99
I& [mA]
0.00
EU
TET
SEL
Osiris


NEUROESTIMULADOR / NEUROLOCALIZADOR
Modo:
Func: EU
Reg: AUTO
1 Hz
500 µs
-.- kΩ
Ireg [mA]
4.99
I& [mA]
0.00
EU
TET
SEL
Osiris


MyoTest Osiris
NEUROESTIMULADOR / NEUROLOCALIZADOR
Modo:
Func: EU
Reg: MANUAL
2 Hz
500 µs
-.- kΩ
Ireg [mA]
4.99
I& [mA]
0.00
EU
TET
SEL
ETD
CPT
TDC
Osiris


MyoTest Osiris
NEUROESTIMULADOR / NEUROLOCALIZADOR
Modo:
Func: EU
Reg: MANUAL
4 Hz
500 µs
-.- kΩ
Ireg [mA]
4.99
I& [mA]
0.00
EU
TET
SEL
Osiris

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

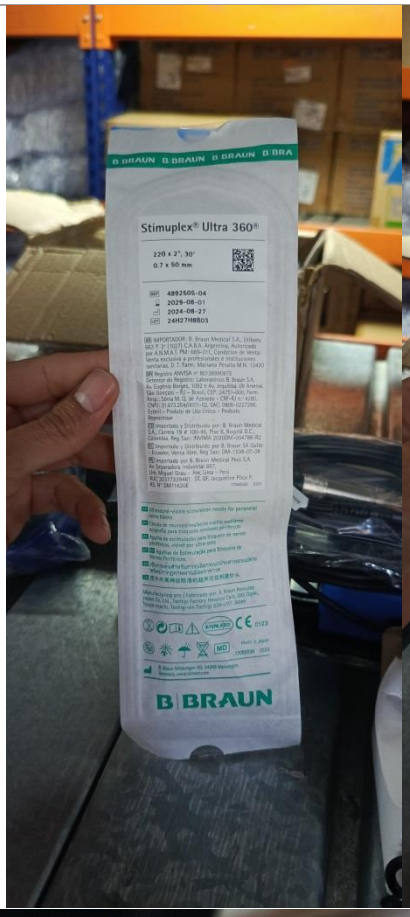











B BRAUN
Stimuplex® Ultra 360®
B BRAUN




MyoTest Osiris®
NEUROLOCALIZADOR / ESTIMULADOR PARA ANESTESIA
Alimentación: 8.4 V ⎓ ; 300 mA
Producto Autorizado por ANMAT: PM-1202-5
Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias
AmrrA de Marcelo Oscar Castiglione
Fragata Pte. Sarmiento 2311, CABA, Argentina
Director Técnico: Ing. Carlos Serventi - M.N. N° 2412
Modelo: OSIRIS
LOT 11/23
SN 100445
Instrucciones y Advertencias
Conecte el aplicador requerido para acceder a los modos de trabajo: BAJA, PEG o ALTA. Ajuste la corriente de salida con la perilla, elija el ancho de pulso con la tecla W y la frecuencia con la tecla EU. Presione las teclas TET, ETD, CPT y TDC para elegir las funciones adicionales (solo ALTA). Inicie / pause el estímulo presionando la tecla ▶/⏸
Usar solo con accesorios compatibles.



La Entidad realiza el pago de las obligaciones al Contratista, teniendo en cuenta que la empresa reporta problemas con su sistema de facturación y genera la factura el 03-10-2025, sin embargo la entrega fue realizada dentro del plazo de ejecución el día 25-09-2025, para lo cual se le solicita un documento donde especifique lo dicho con el fin de tener soporte y se anexa al presente informe.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

No quedan tareas ni pagos pendientes del contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO: X**

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	T2. JULIAN SNAIDER OSORIO VANEGAS
FIRMA:	
C.C. No.	1.106.779.128
DEPENDENCIA:	JEFSA – SULOG- AINBI

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-027**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	**VERSIÓN N°:**	**05**
		VIGENCIA:	**12-12-2024**

Bogotá D.C, 30 de octubre de 2025

Señores:
JEFATURA SALUD FAC
Ciudad

ASUNTO: ACLARACIÓN SOBRE EXPEDICIÓN DE FACTURA

REFERENCIA: CONTRATO COMPRAVENTA NO: 080-02-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025
OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE USO HOSPITALARIO PARA LA JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL

Yo, **CAMILO ANDRES CONTRERAS ARIZA** identificado con cedula de ciudadanía No: **80.093.775** de Bogotá D.C, obrando en mi condición de representante legal de la compañía **XINGMEDICAL S.A.S** identificada con NIT: **900.315.100-6**. Por medio del presente se permite informar que, en el marco del Contrato No. 080-02-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025, cuyo objeto corresponde a la "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE USO HOSPITALARIO PARA LA JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL", la ejecución contractual fue desarrollada dentro del plazo establecido por la entidad.

El contrato inicialmente tenía como fecha de terminación el día 18 de julio de 2025; no obstante, mediante Contrato Modificatorio No. 001 suscrito el 16 de julio de 2025, el plazo de ejecución fue prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2025. Así mismo, se deja constancia de que la entrega de los bienes objeto contractual fue realizada dentro del término contractual modificado, conforme al formato de entrega de inventario No. 4769 y demás soportes de recibido a satisfacción suscritos por la supervisión contractual.

Respecto de la Factura No. 7079, expedida con fecha 30 de octubre de 2025, se informa que su generación se realizó con posterioridad al plazo contractual debido a inconvenientes operativos presentados en el sistema de facturación, situación reportada por el área contable de la empresa, lo cual ocasionó retrasos en el proceso de emisión del documento electrónico. No obstante lo anterior, dicha situación obedeció exclusivamente a una novedad administrativa y operativa relacionada con el sistema de facturación y no afectó la ejecución, entrega ni cumplimiento de las obligaciones contractuales, las cuales fueron ejecutadas oportunamente dentro del plazo de ejecución vigente.

Adicionalmente, en el informe de supervisión del contrato se dejó constancia de que el porcentaje de ejecución contractual correspondió al 100%, sin presentarse incumplimientos atribuibles al contratista y sin obligaciones pendientes de ejecución. El presente documento se expide como soporte aclaratorio para efectos del expediente contractual y trazabilidad documental en SECOP II.

NOMBRE DEL PROPONENTE: XINGMEDICAL S.A.S.
NIT: 900.315.100-6 (RÉGIMEN COMÚN)
DIRECCIÓN: Carrera 71D # 48A-54. Normandía, Bogotá D.C
TELÉFONO: +57(1) 310 236 1255
CORREO: gerencia@xingmedical.com

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
NOMBRE: CAMILO ANDRES CONTRERAS ARIZA
C.C.: No: 80.093.775 de Bogotá DC

	ENTREGA DE INVENTARIO	Código	XCO-F04
		Vesión	2
		Fecha	2024-01-12

CLIENTE	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA JEFATURA DE SALUD	SALIDA	4769
OFERTA		OFERTA	FAC080-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025
ASESOR COMERCIAL	XINGMEDICAL	FECHA	2025-07-15

Item	Código	Cantidad	Descripción	Marca	Serie / ID
1	HTC-2	19	TERMOHIGROMETRO HTC-2 ORIGINAL	XING	AA02824 / AA02961 / AA02933 / AA02728 / AA02321 / AA02918 / AA02925 / AA02922 / AA02345 / AA03024 / AA02412 / AA02298 / AA02930 / AA03010 / AA02746 / AA02732 / AA02801 / AA02948 / AA03029
2	TH022	16	TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMOS Y MINIMOS MODELO: TH022	XING	AA03424 / AA003423 / AA03425 / AA03426 / AA03422 / AA03421 / AA03415 / AA03416 / AA03417 / AA03417 / AA03413 / AA03419 / AA03411 / AA03412 / AA03418 / AA03420 / AA03414
3	TQX-300BH	2	LAVADORA ULTRASONICA PEQUEÑA DE 30 LITROS	SHINVA	F2568225 / F2568251
4	OSIRIS	1	ESTIMULADOR DE NERVIO PERIFERICO Y NEUROLOCALIZADOR CON AGUA STIMUPLEX	AMRRA	100445
5					
6					
7					
8					
9					
10					

ENTREGA

XINGMEDICAL

-

RECIBE

Nombre: Jr. Julian Osorio

Cargo: Supervisor Contrato

25-09-25